

Фотографические изображения

Коктейль зондов VENTANA HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail для определения статуса гена HER2 методом гибридизации in situ (ISH) для диагностики in vitro в иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark

Коктейль зондов VENTANA HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail для определения статуса гена HER2 методом гибридизации in situ (ISH) для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark (общий вид)




Коктейль зондов VENTANA HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail для определения статуса гена HER2 методом гибридизации in situ (ISH) для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark (дозатор с реагентом)



Коктейль зондов VENTANA HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail для определения статуса гена HER2 методом гибридизации in situ (ISH) для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark (дозатор с реагентом)



Коктейль зондов VENTANA HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail для определения статуса гена HER2 методом гибридизации in situ (ISH) для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark (дозатор с реагентом)

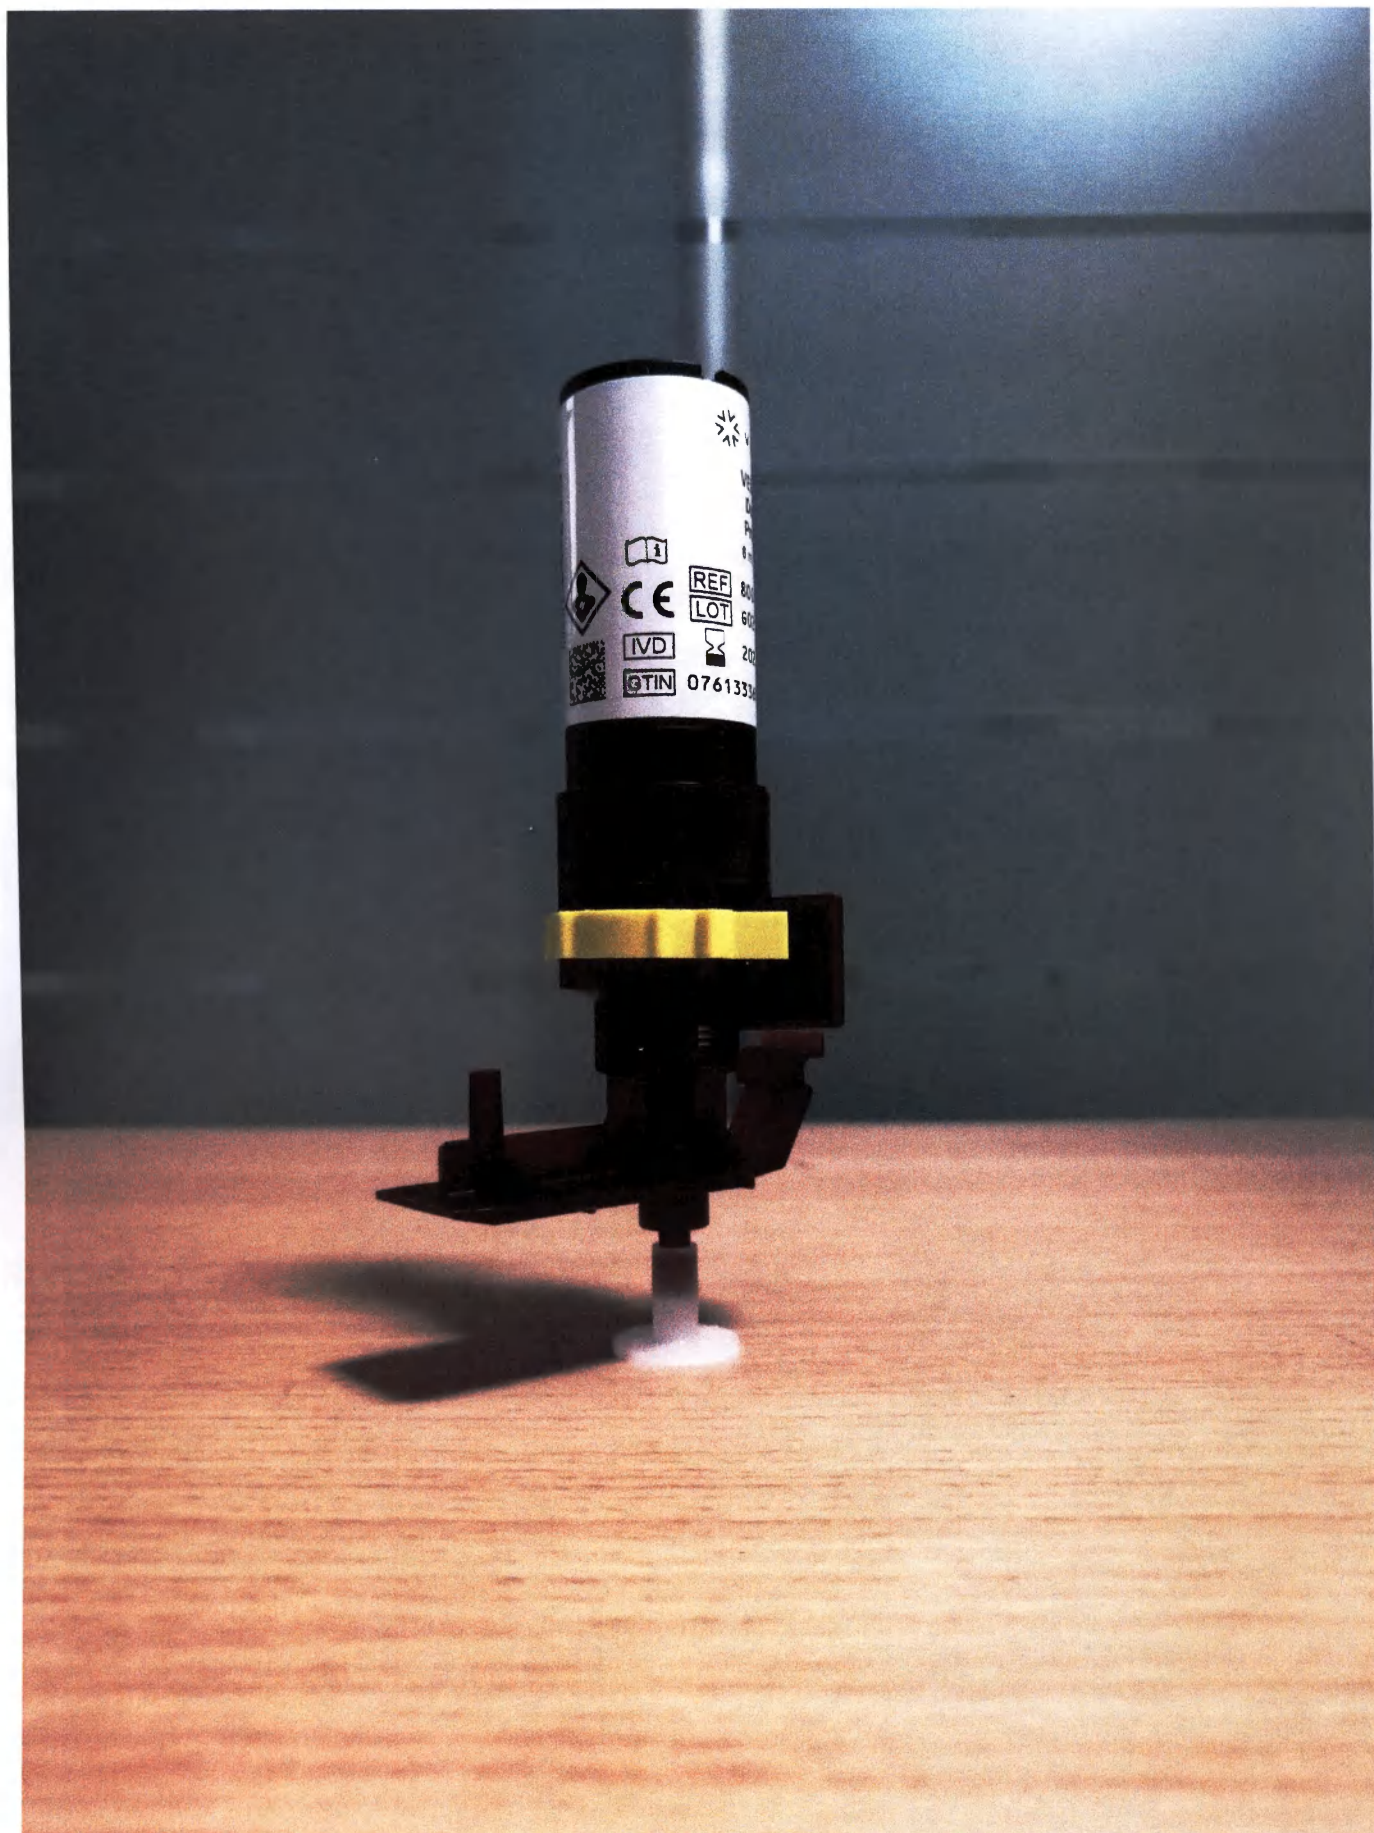

Коктейль зондов VENTANA HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail для определения статуса гена HER2 методом гибридизации in situ (ISH) для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark (дозатор с реагентом)



Коктейль зондов VENTANA HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail для определения статуса гена HER2 методом гибридизации in situ (ISH) для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark (маркировка)



Коктейль зондов VENTANA HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail для определения статуса гена HER2 методом гибридизации in situ (ISH) для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark (маркировка)




Коктейль зондов VENTANA HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail для определения статуса гена HER2 методом гибридизации in situ (ISH) для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark (маркировка)



Коктейль зондов VENTANA HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail для определения статуса гена HER2 методом гибридизации in situ (ISH) для диагностики in vitro на иммунотейнерах автоматических серии BenchMark (маркировка)



Коктейль зондов VENTANA HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail для определения статуса гена HER2 методом гибридизации in situ (ISH) для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark (маркировка)

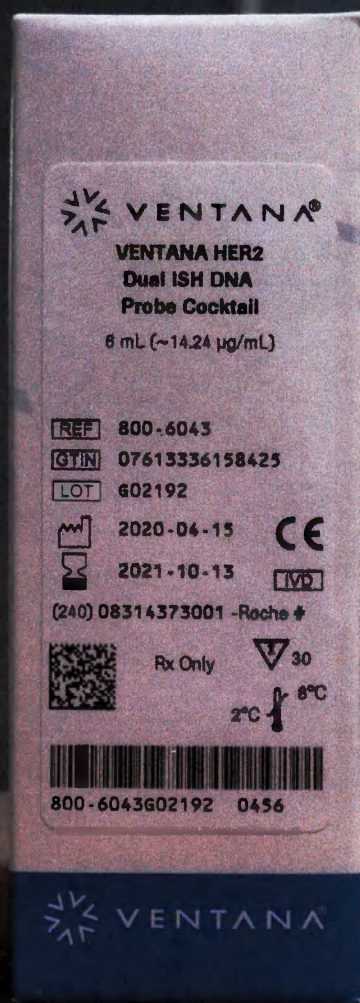

Коктейль зондов VENTANA HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail для определения статуса гена HER2 методом гибридизации in situ (ISH) для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark (маркировка)

Коктейль зондов VENTANA HER2 Dual ISH DNA Probe
Cocktail для определения статуса гена HER2 методом
гибридизации in situ (ISH) для диагностики in vitro ■
иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark



Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке.

Дату производства см. на упаковке.

Температура хранения см. на упаковке.

Номер лота см. на упаковке

Производитель:  Diagnostics GmbH

(Грош Диагностика ГмбХ), Sandhofer Strasse 116, D-68305

Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус»
(ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трудовая площадь,

д.2 Тел: +7 495 229-6899, Факс: +7 495 229-62-64

E-mail: moscow_reception_dia@roche.com

Кат. номер 08314373001 (800-6043)



VENTANA®

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
12 листа (ов)



по доверенности
от 04.02.2021 (Гришина Д.В.)