Фотографические изображения
медицинского изделия

Анализатор автоматический микробиологический DxM MicroScan WalkAway Instrument с принадлежностями

Специалист по регистрации
ООО «Бекмен Культер»
_____ Немцова А.С.
«16» _____ 2021 г.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Аналитический модуль анализатора DxM 1040 MicroScan WalkAway Instrument

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Крышки лотков для WalkAway, 240 шт./уп., не более 15 упаковок (при необходимости)

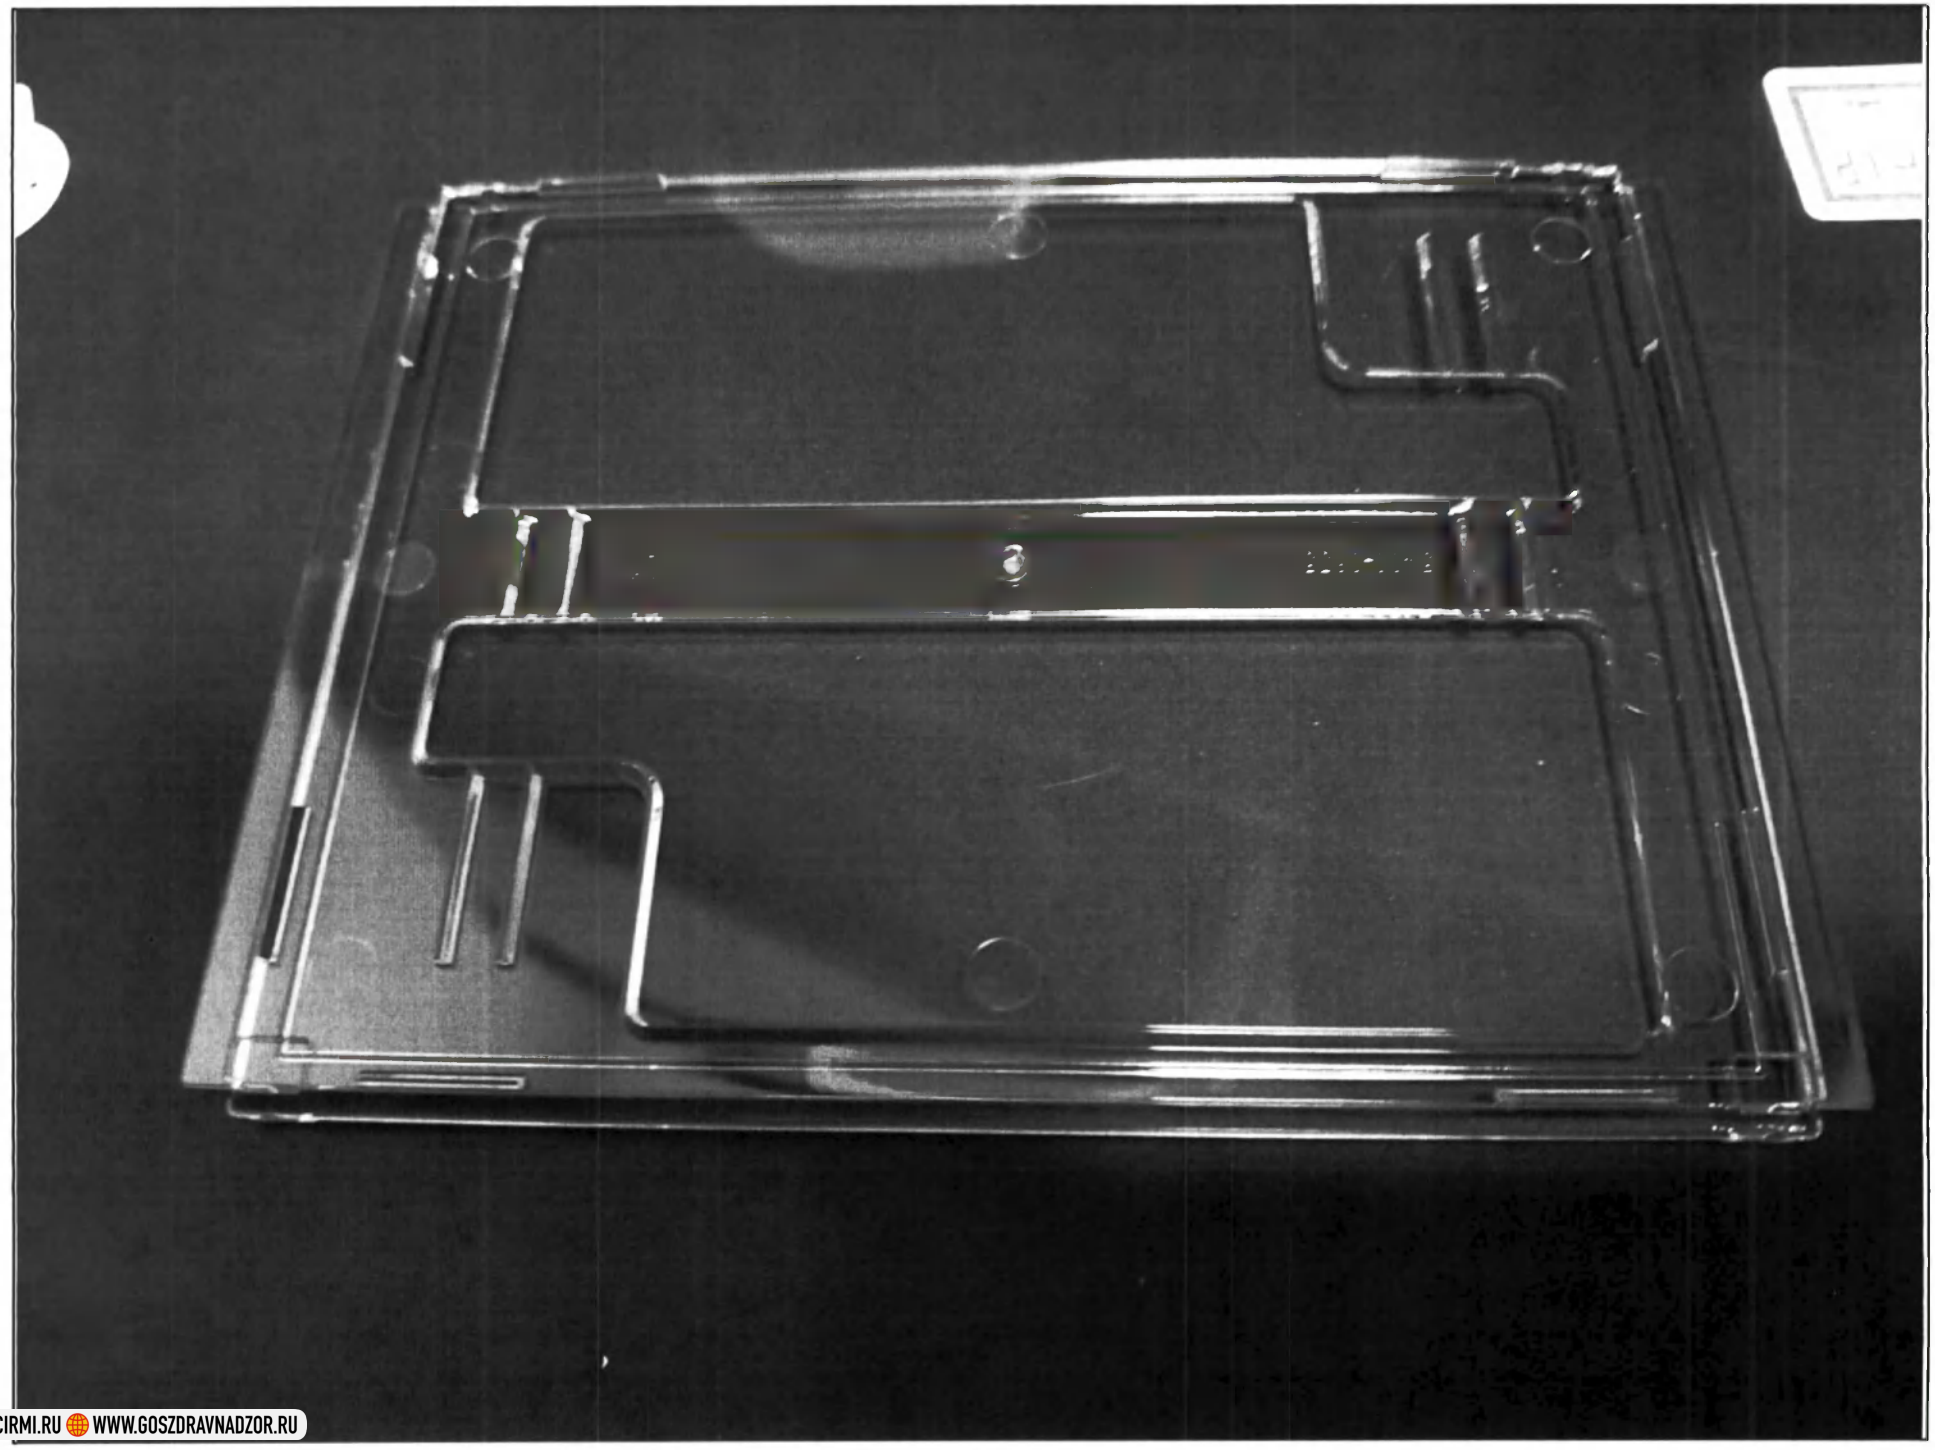

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Платы подключения питания, не более 10 шт.

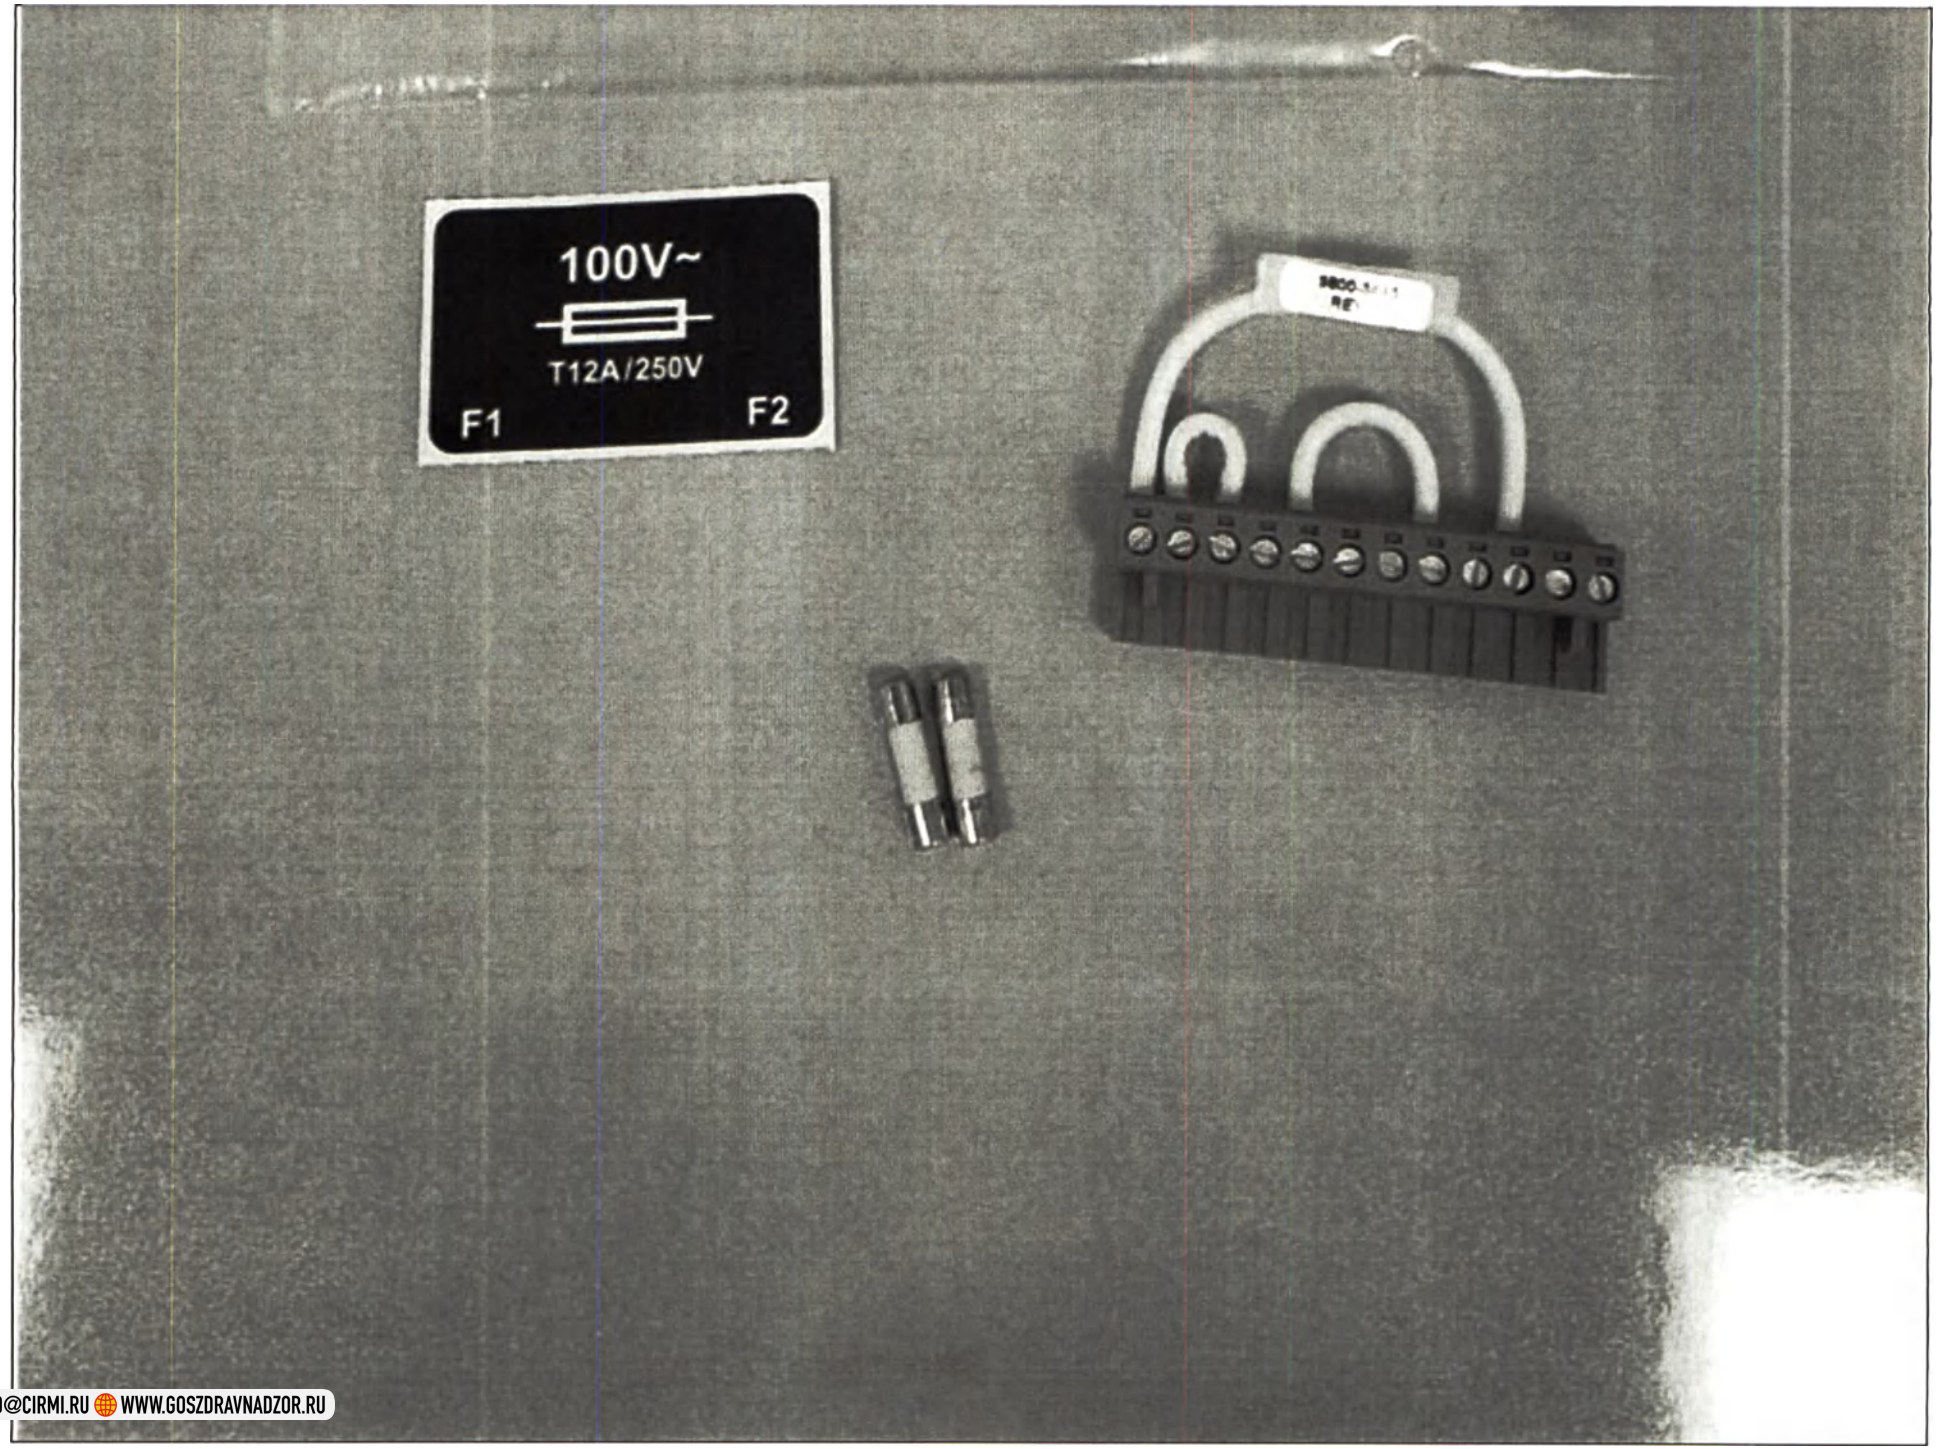

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Кабели Ethernet категории 5, не более 5 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Адаптер , не более 3 шт

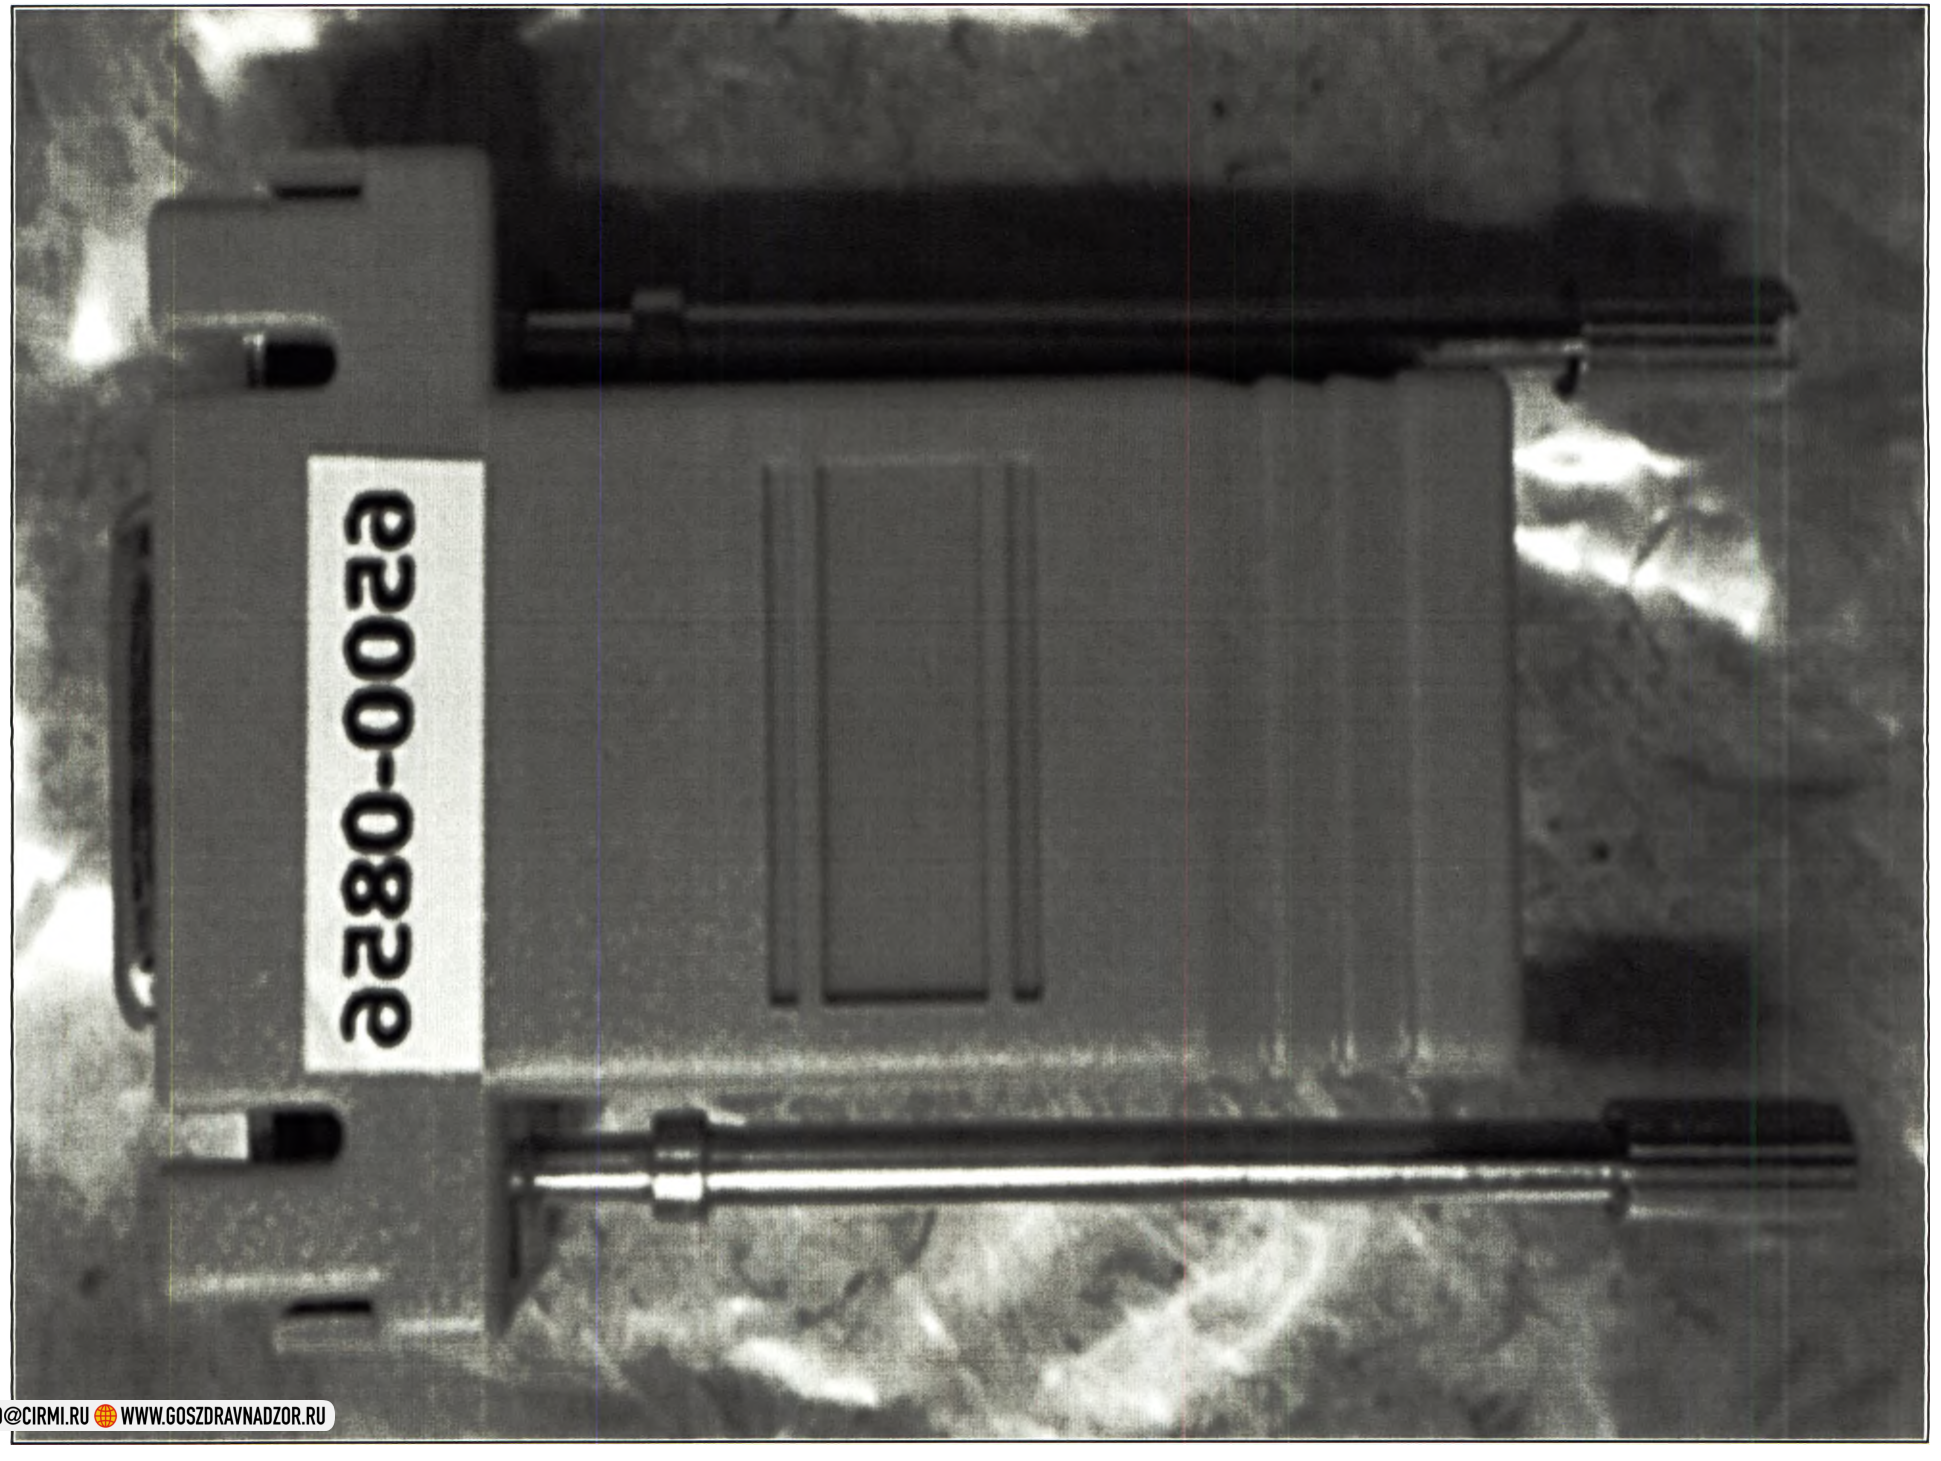

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Крышки для бутылей с реагентами, не более 10 шт.

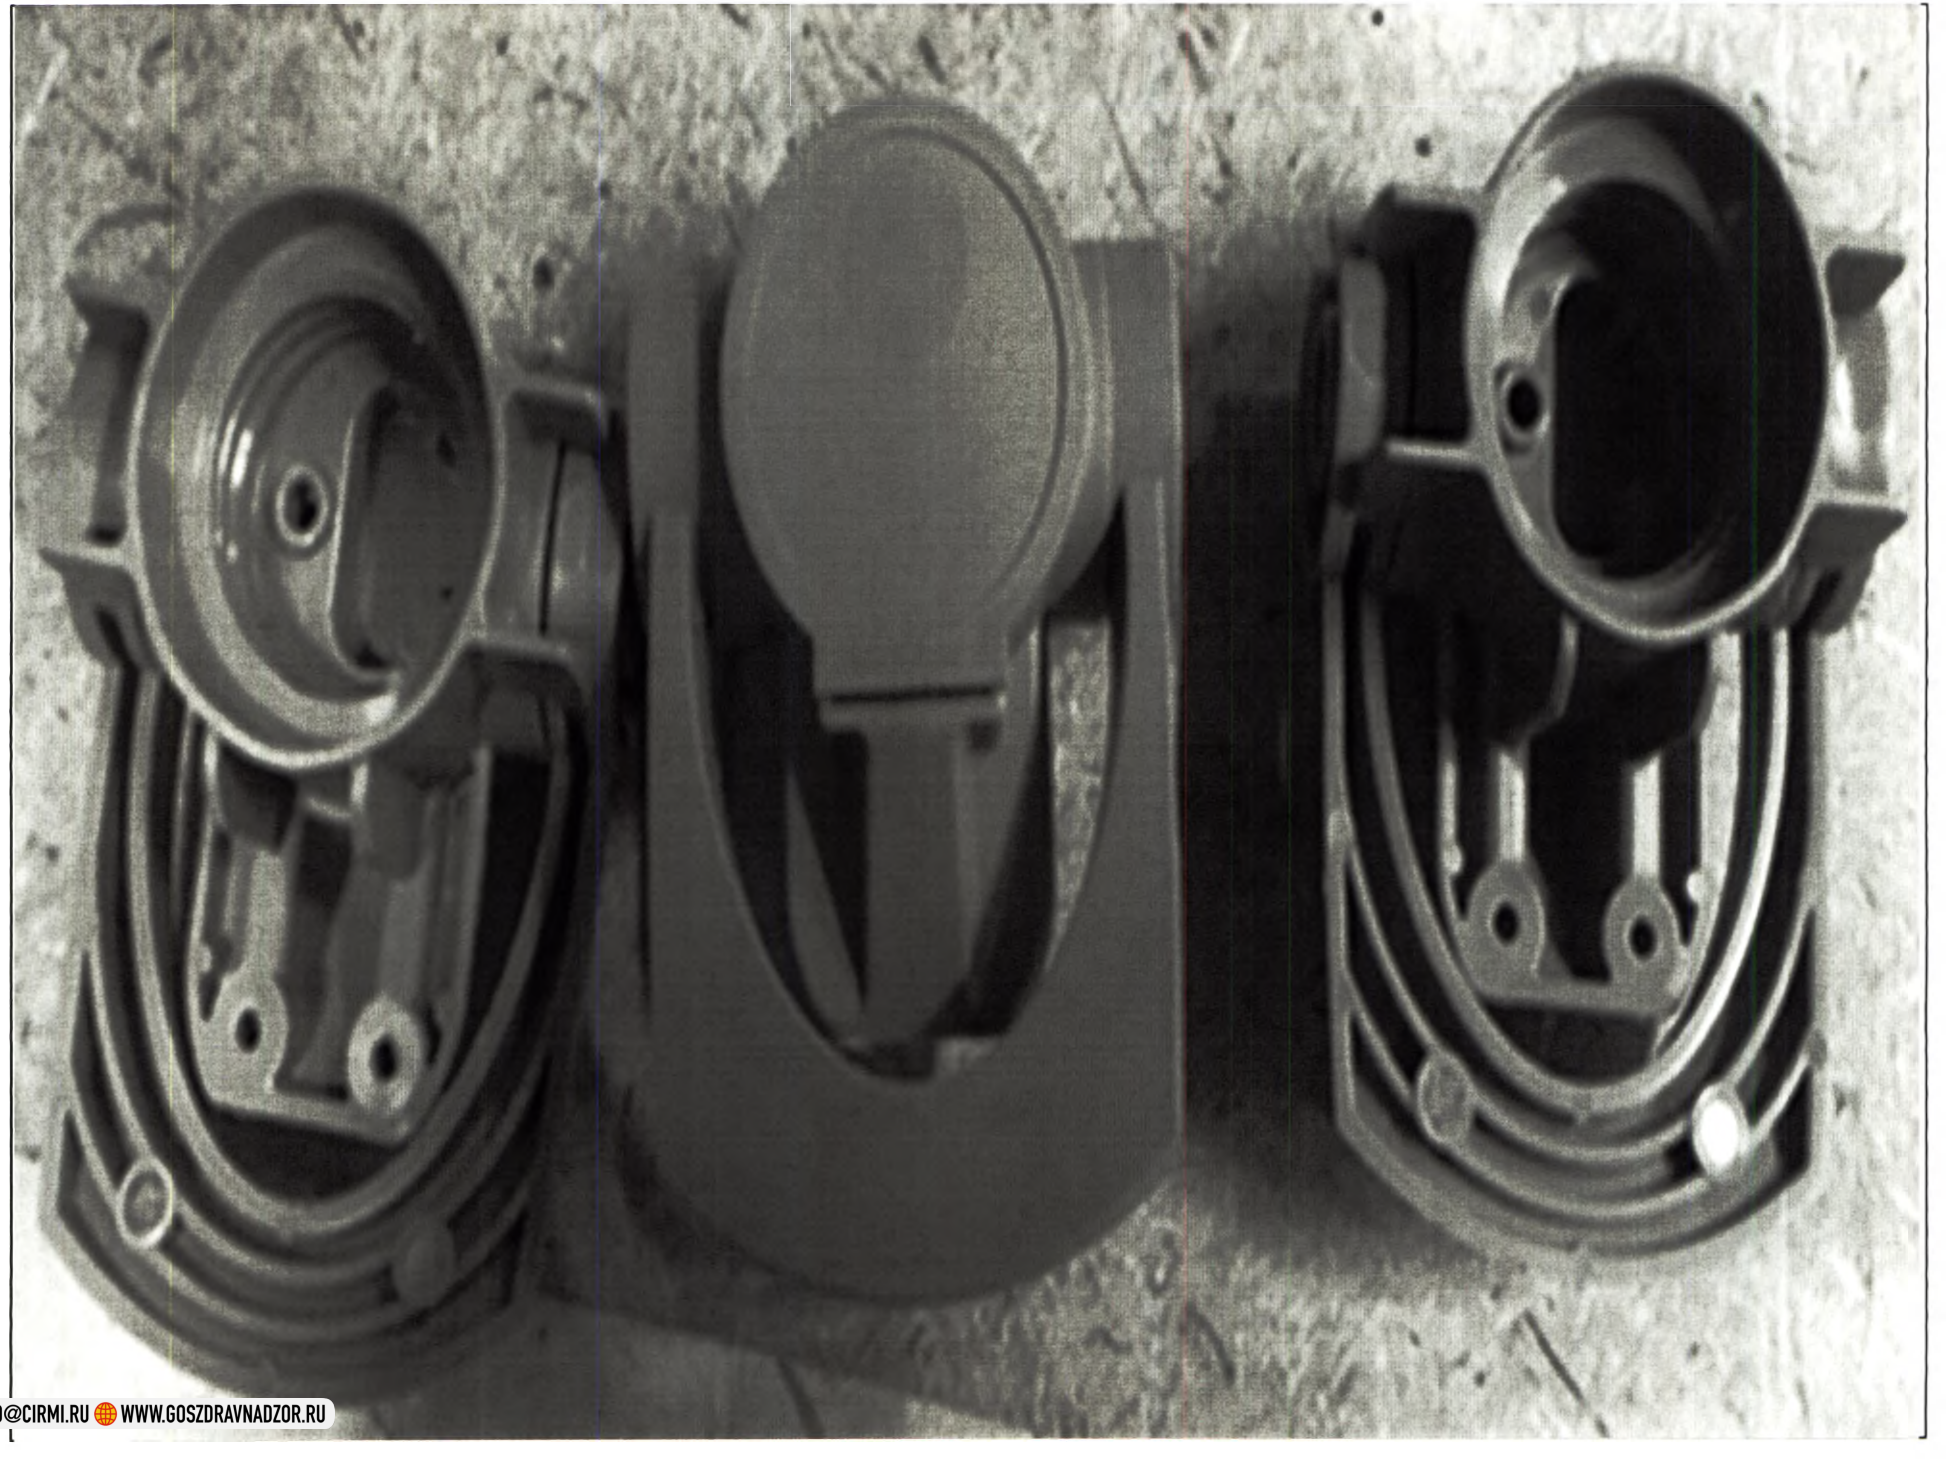

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Компакт диски в комплекте с инструкцией по установке, не более 5 шт

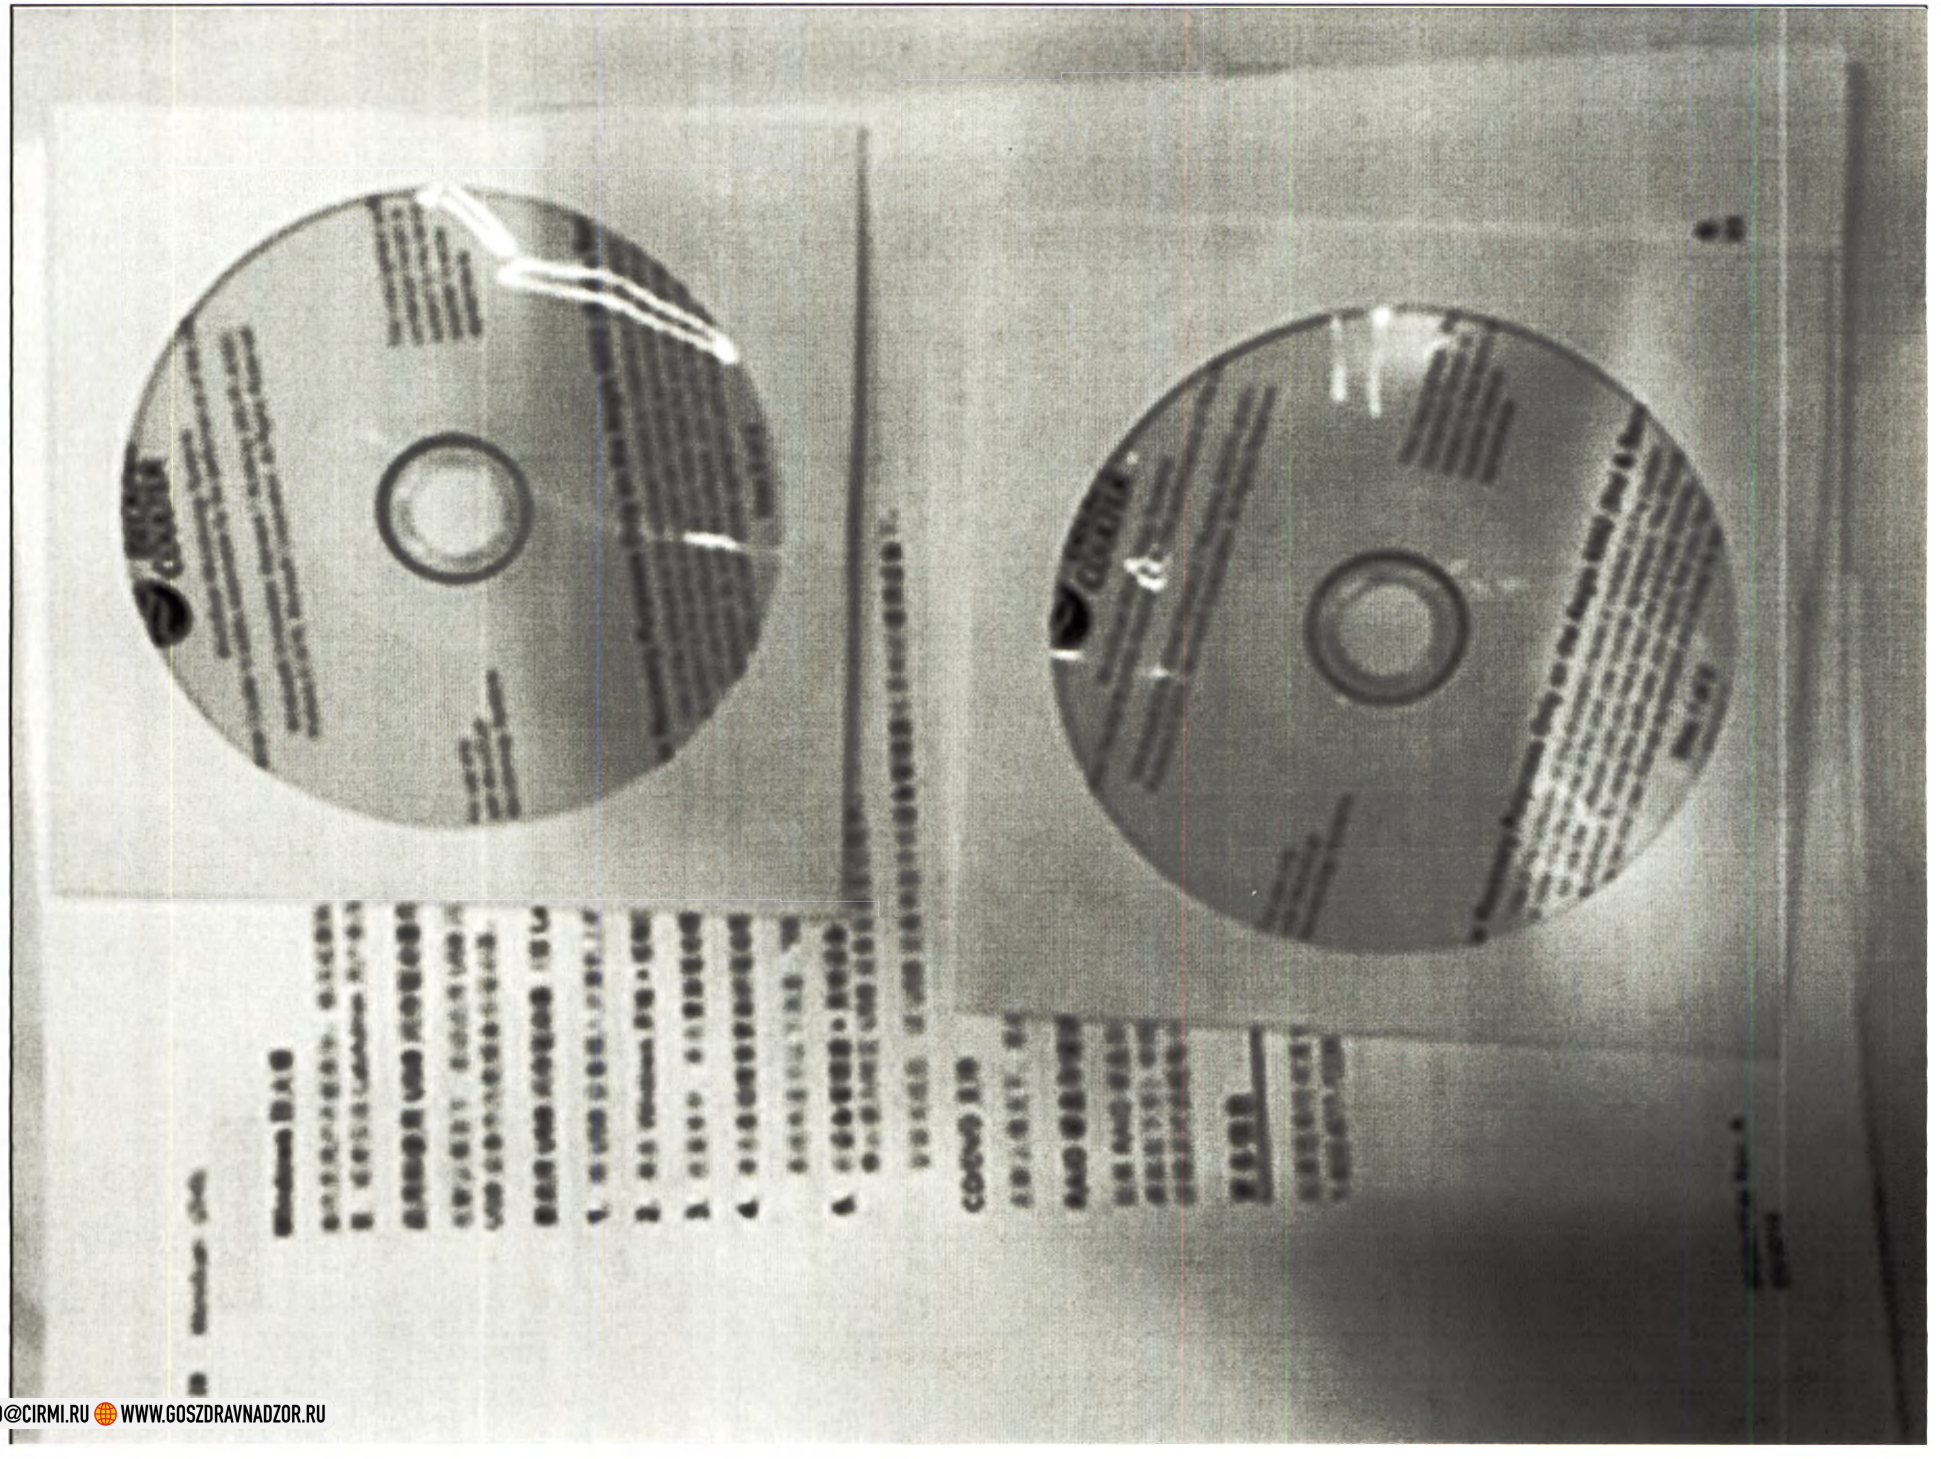

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Переходник

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Набор для обслуживания системы раскапывания реагентов, в составе: Сальник ёмкости (30 мл) для реагента, не более 60 шт.;

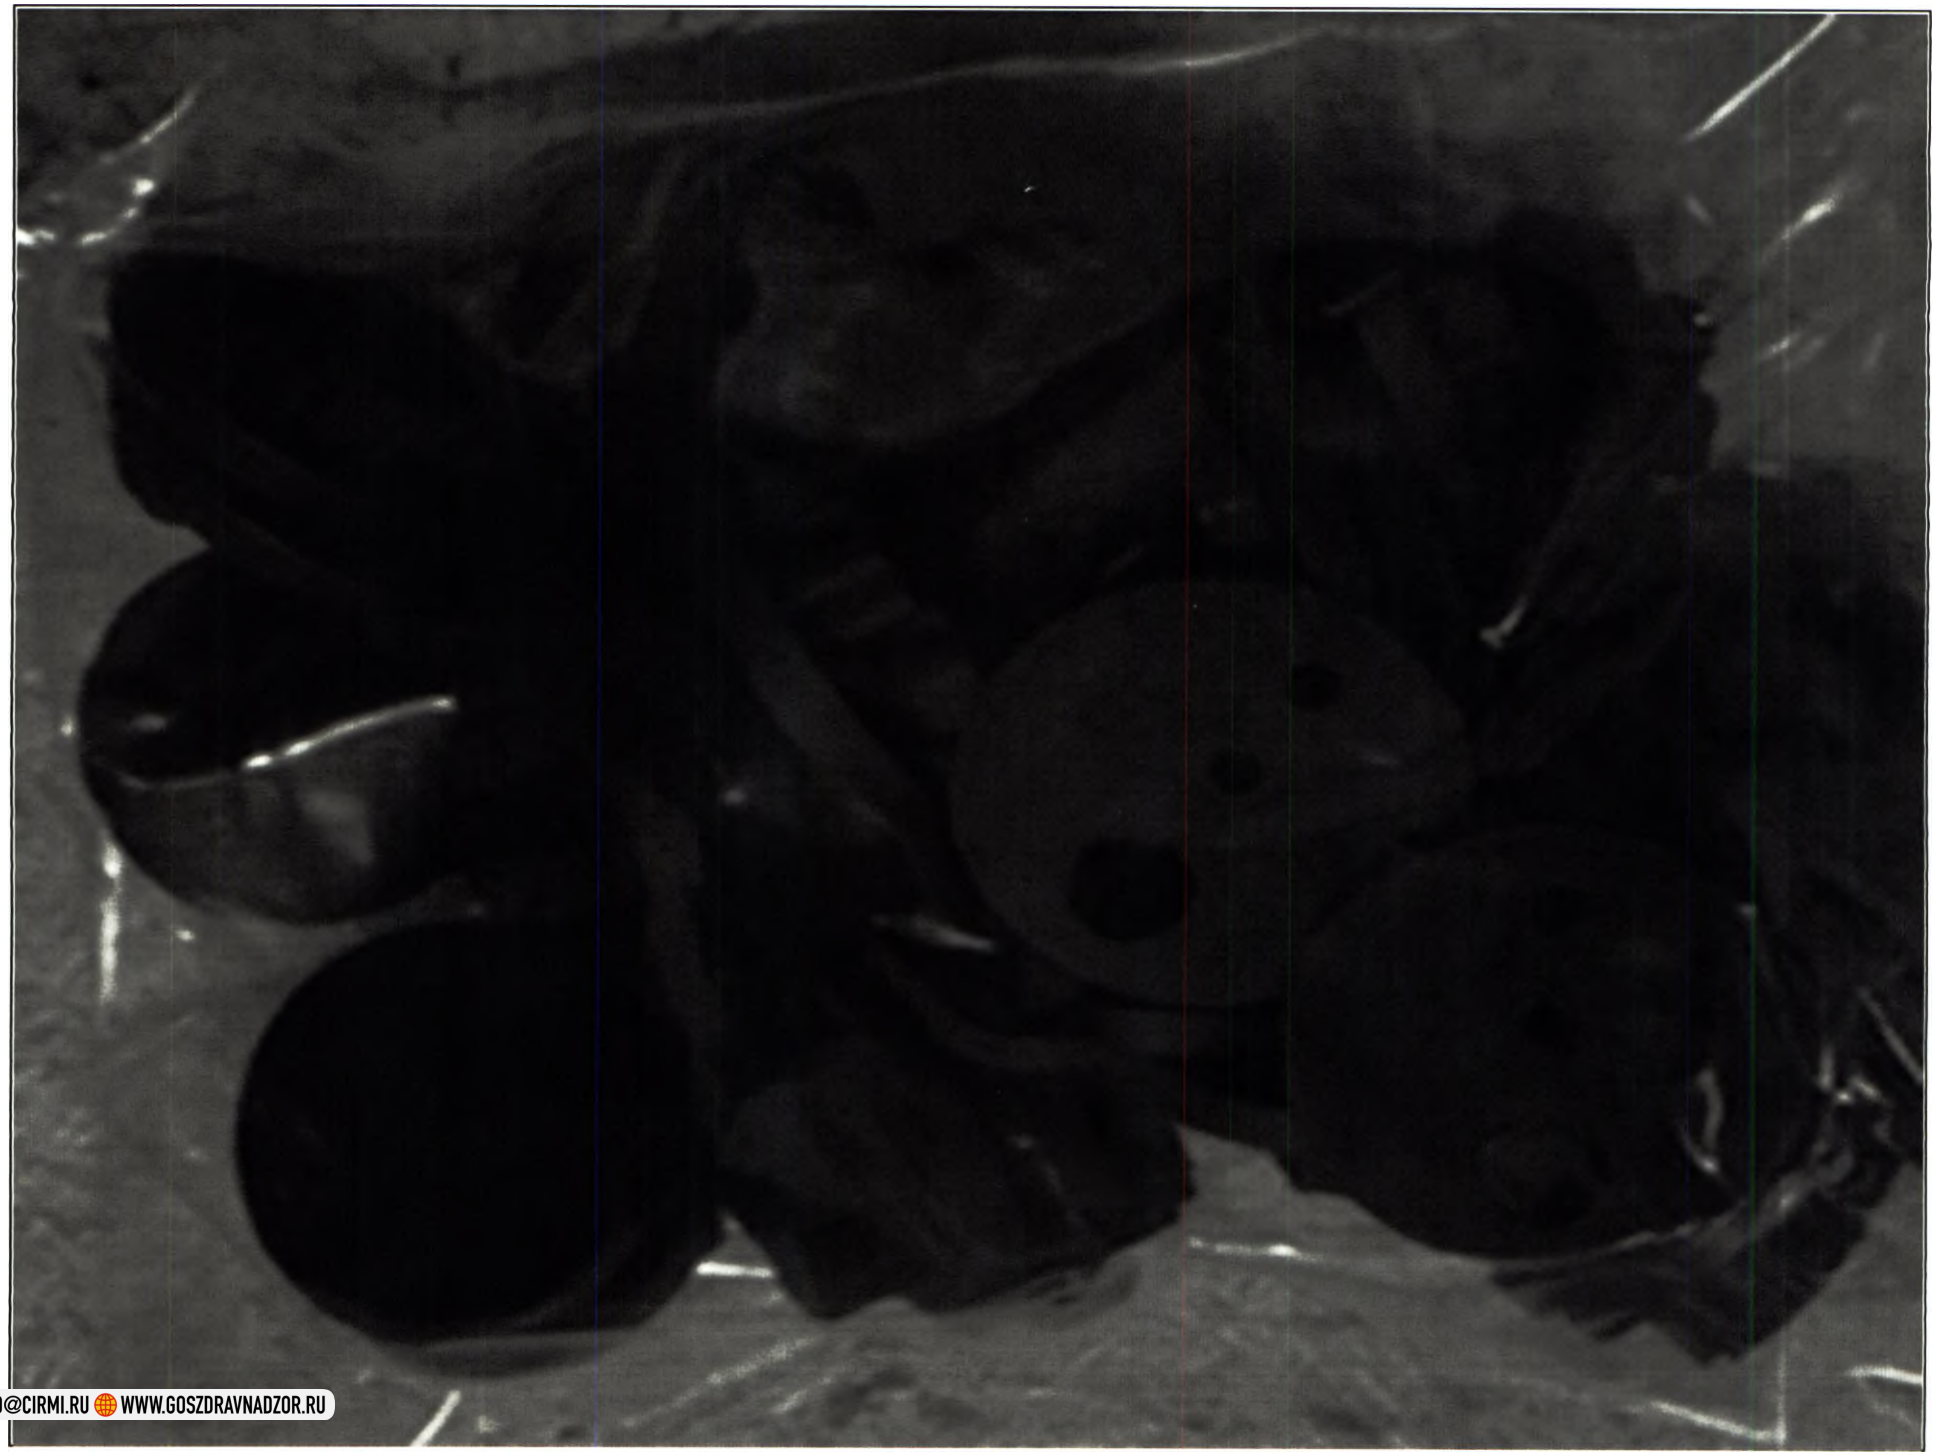

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Набор для обслуживания системы раскапывания реагентов, в составе: Сальник ёмкости (60 мл) для реагента, не более 60 шт.;

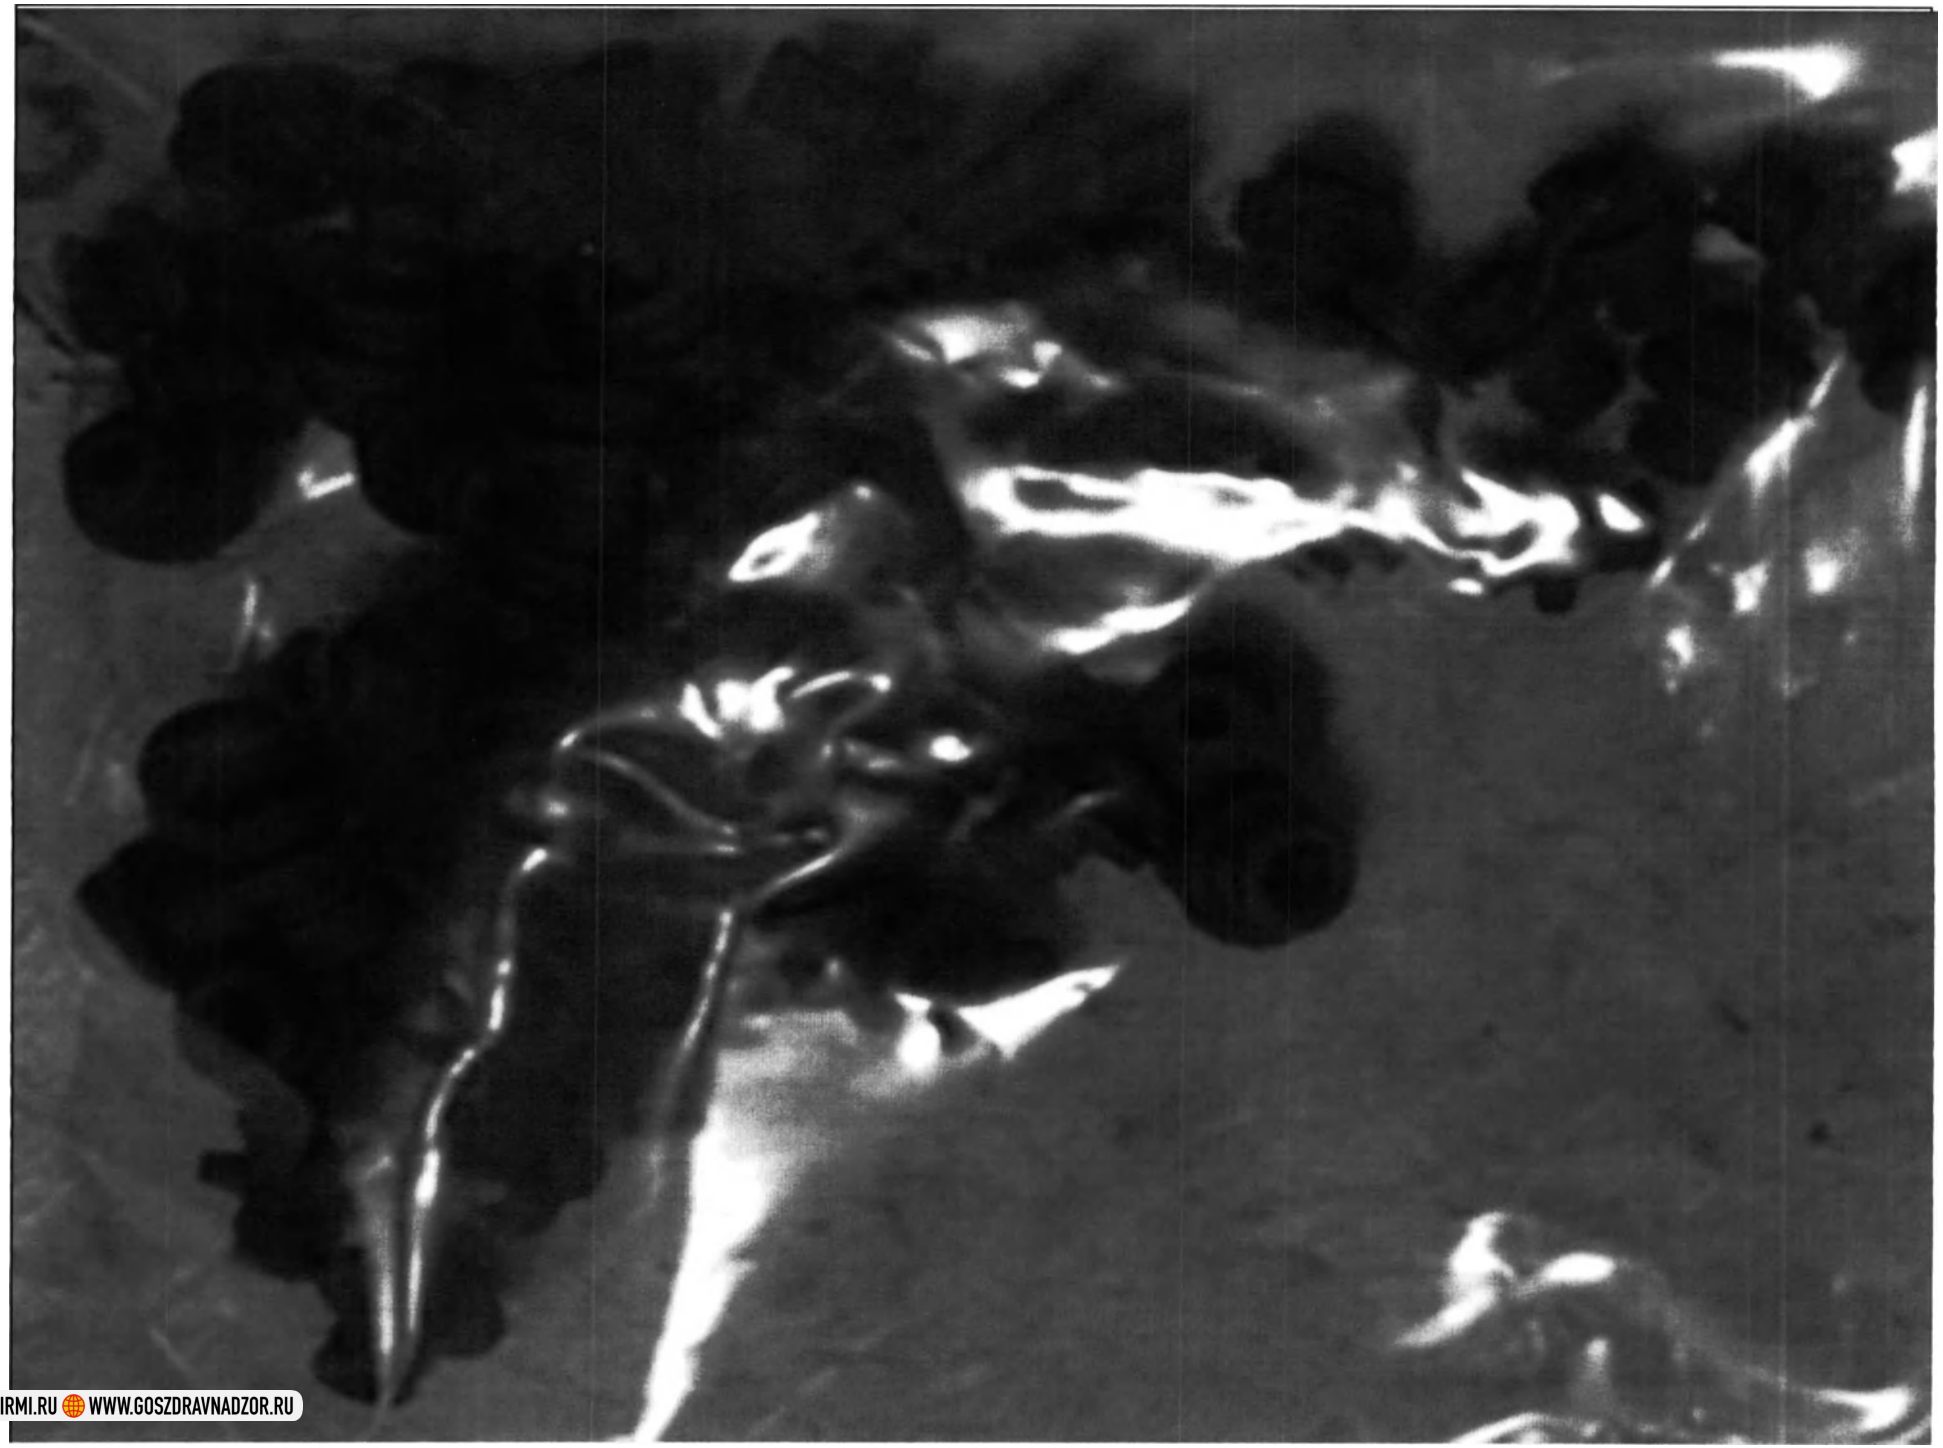

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Набор для обслуживания системы раскапывания реагентов, в составе: Кольца для крышки к флаконам с реагентами, не более 120 шт.

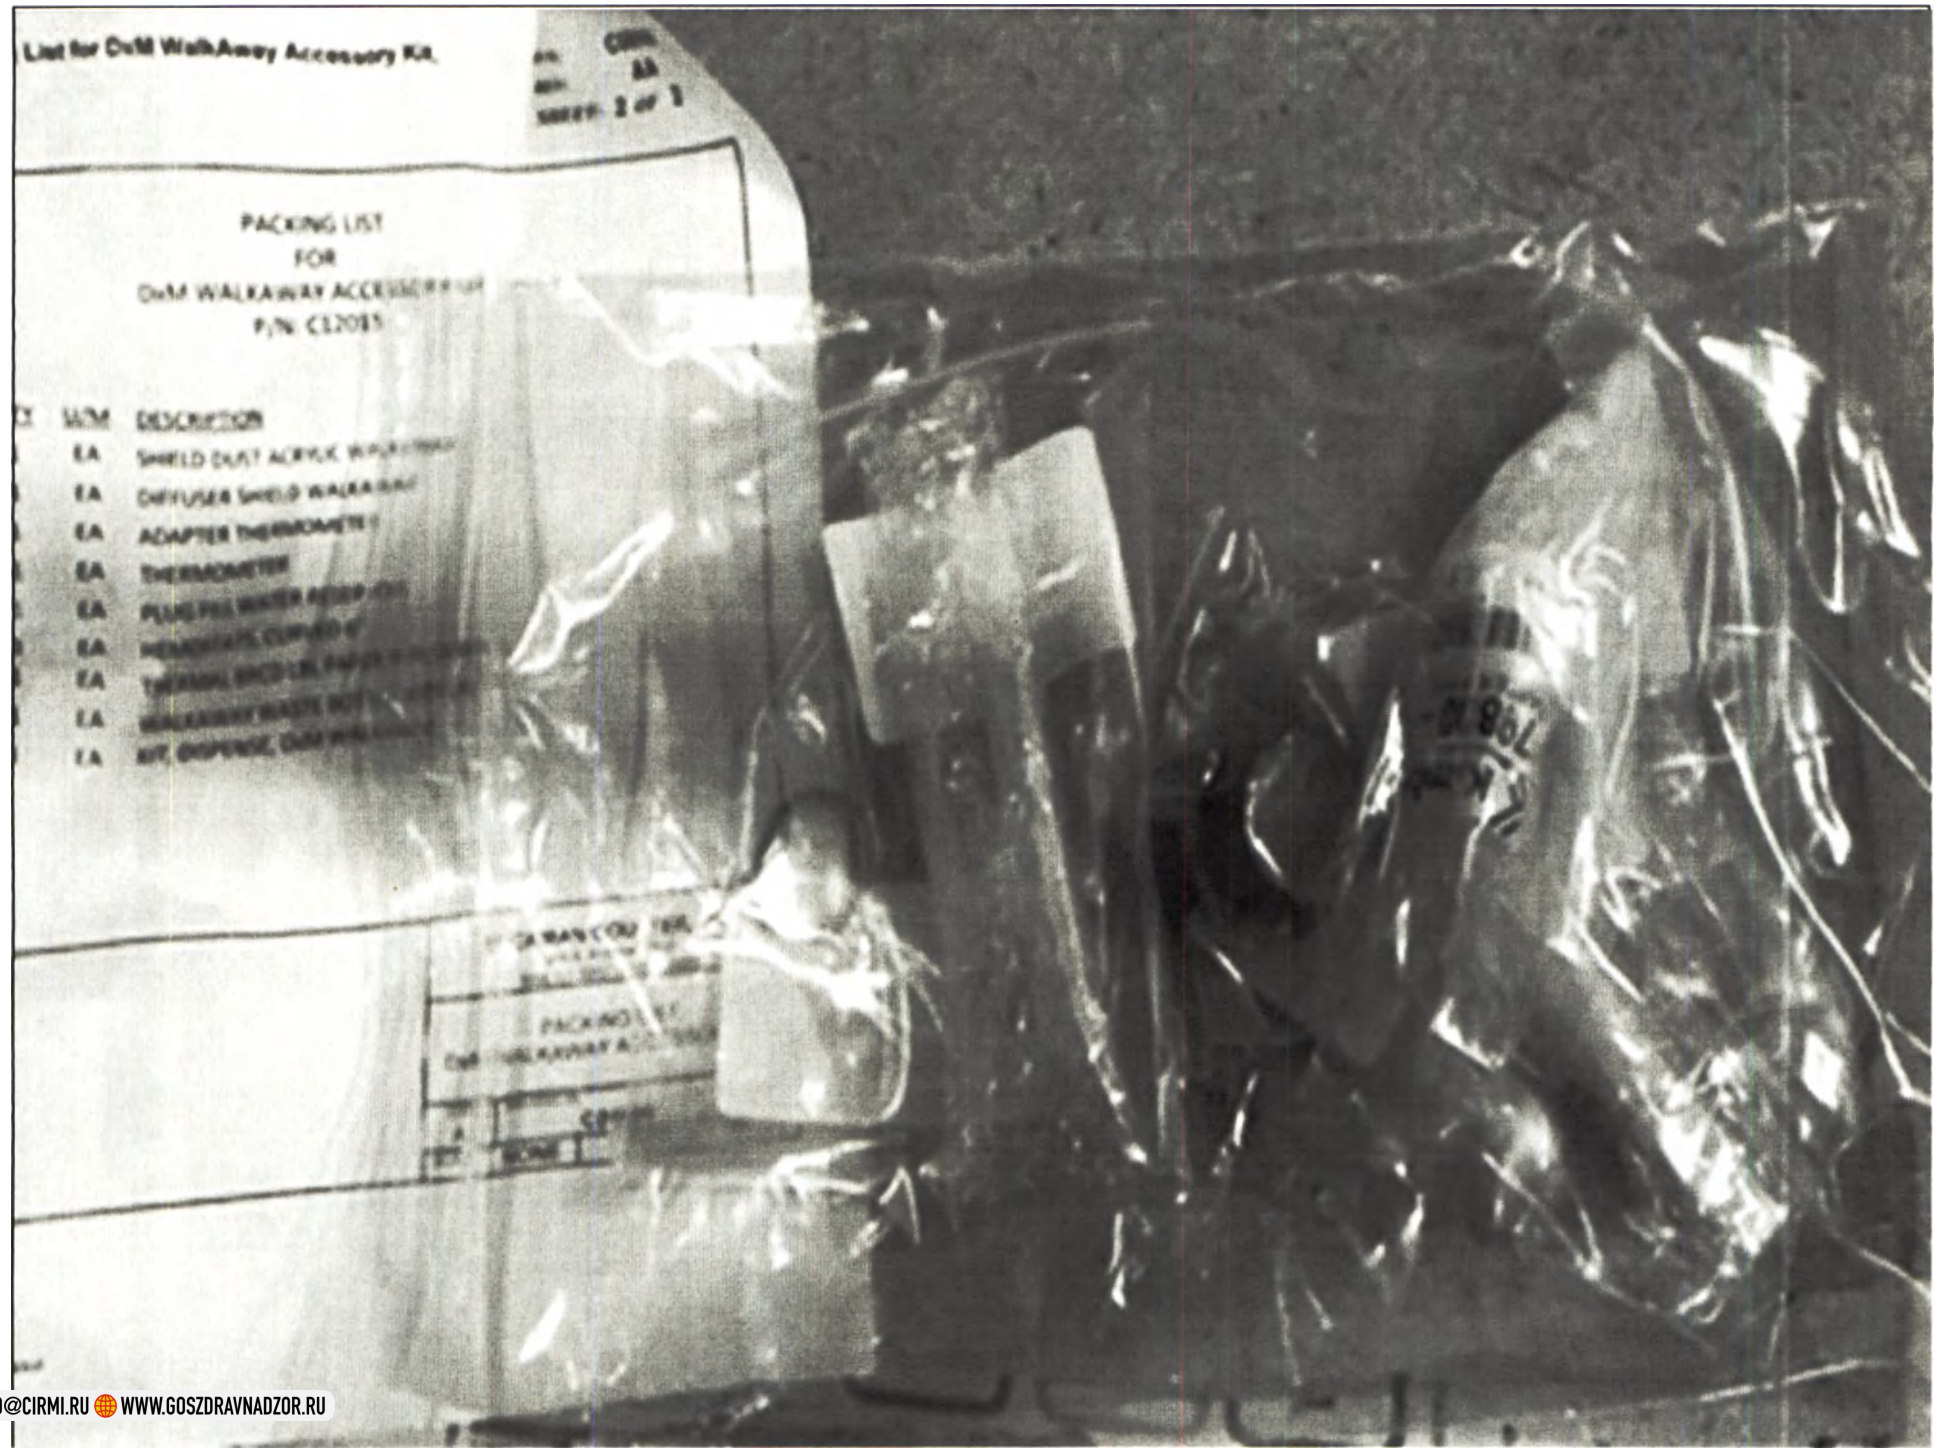

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Принтер для печати штрих-кодов в комплекте с сетевыми кабелями, не более 8-х шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Компьютер в сборке, в составе: Монитор, Клавиатура, Мышь

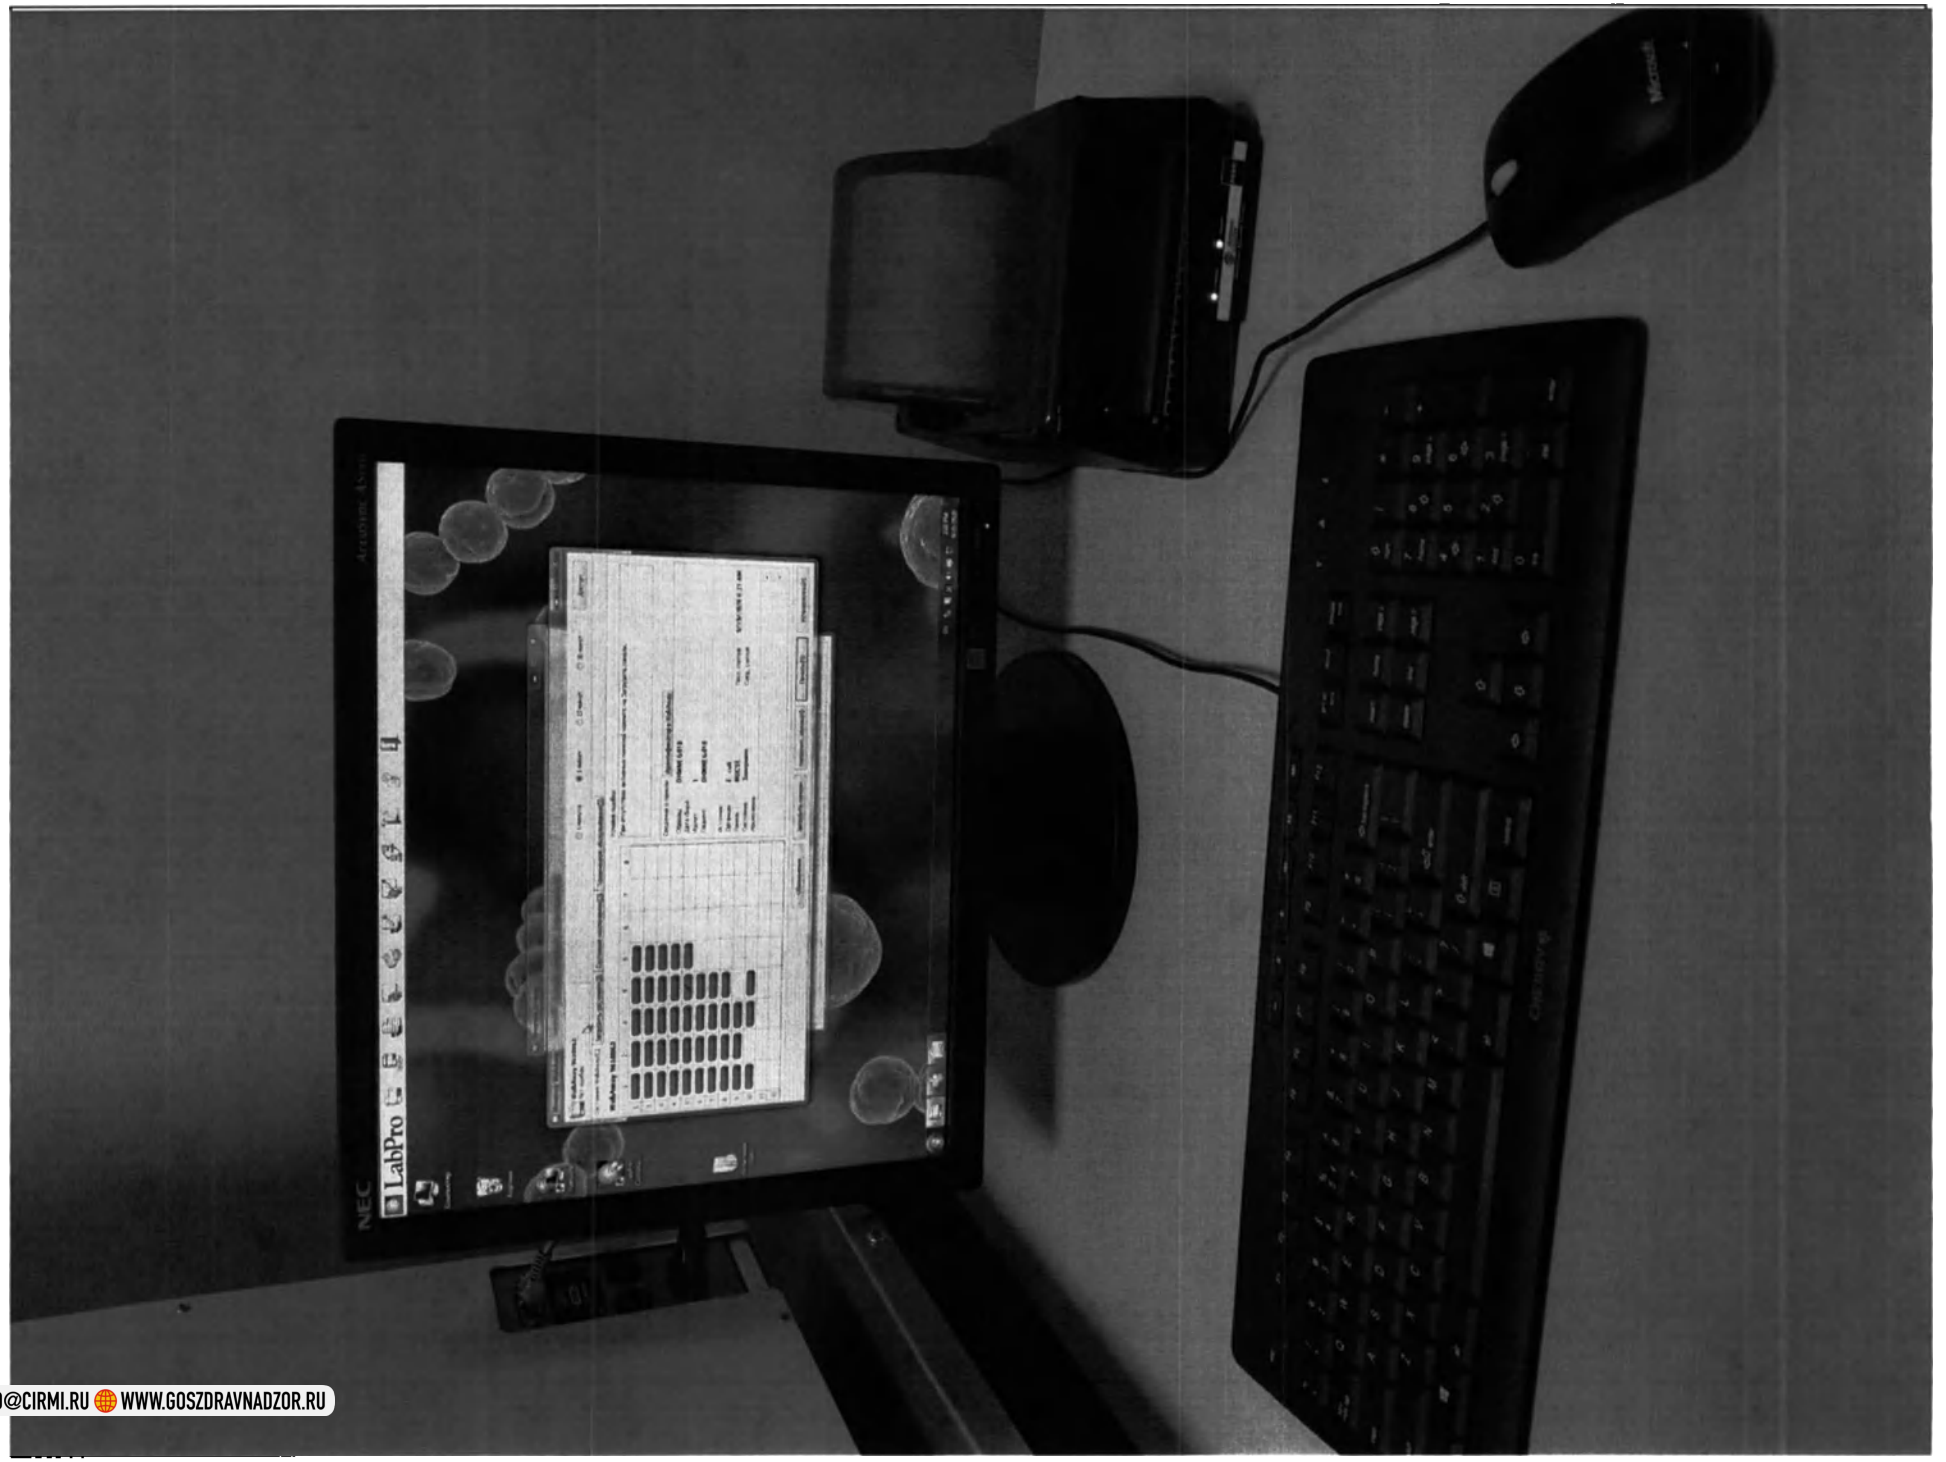

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Компьютер в сборке, в составе: Системный блок

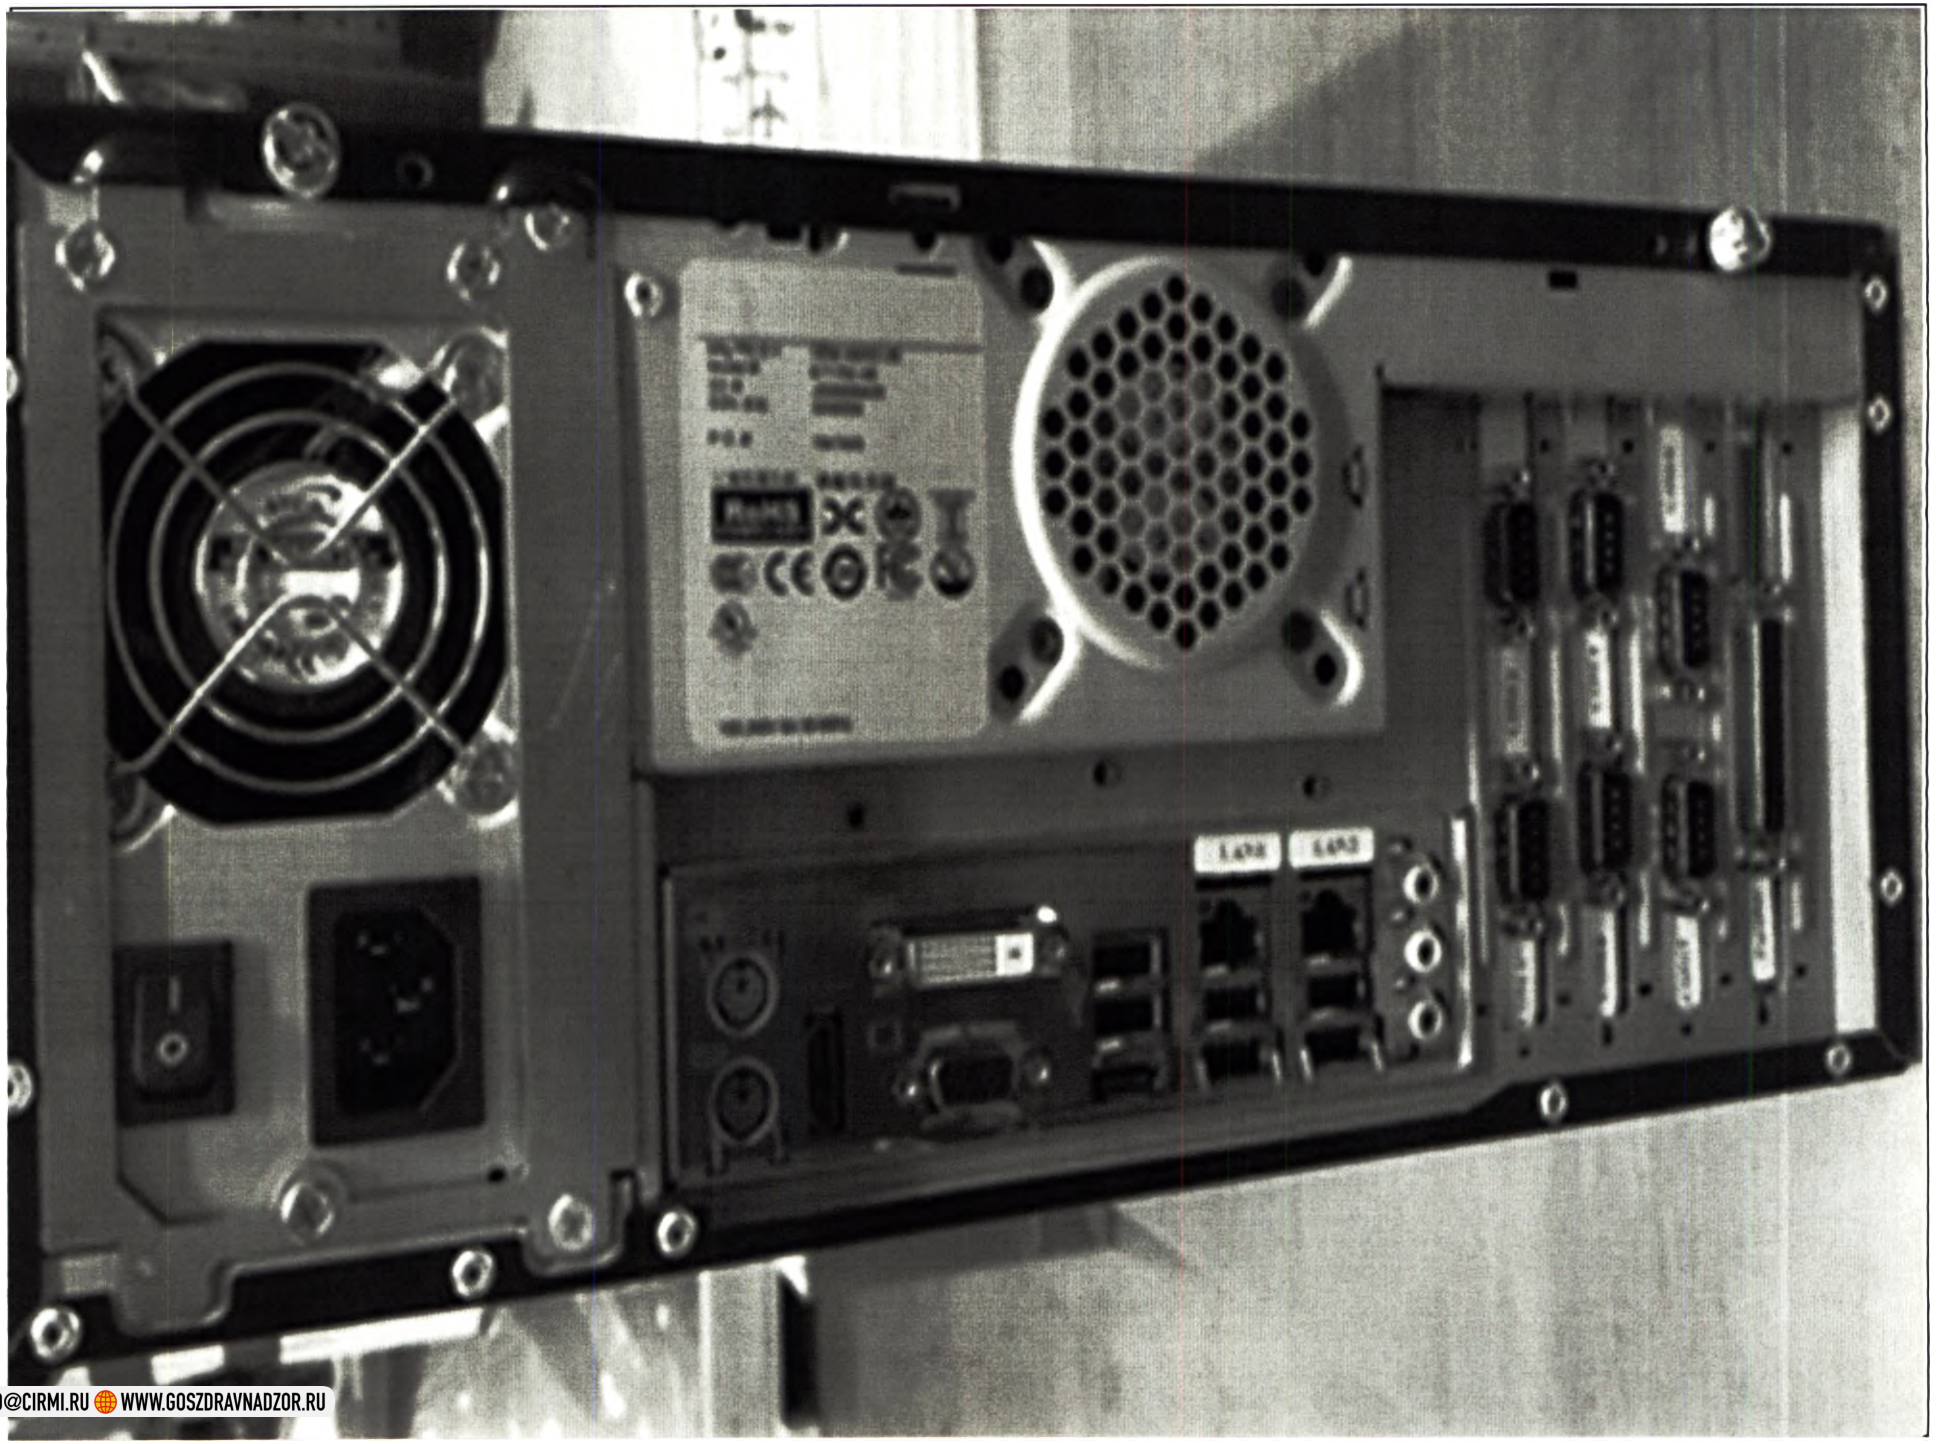

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

MicroScan Турбидиметр, в составе: Измеритель мутности, адаптеры питания, не более 3 шт.

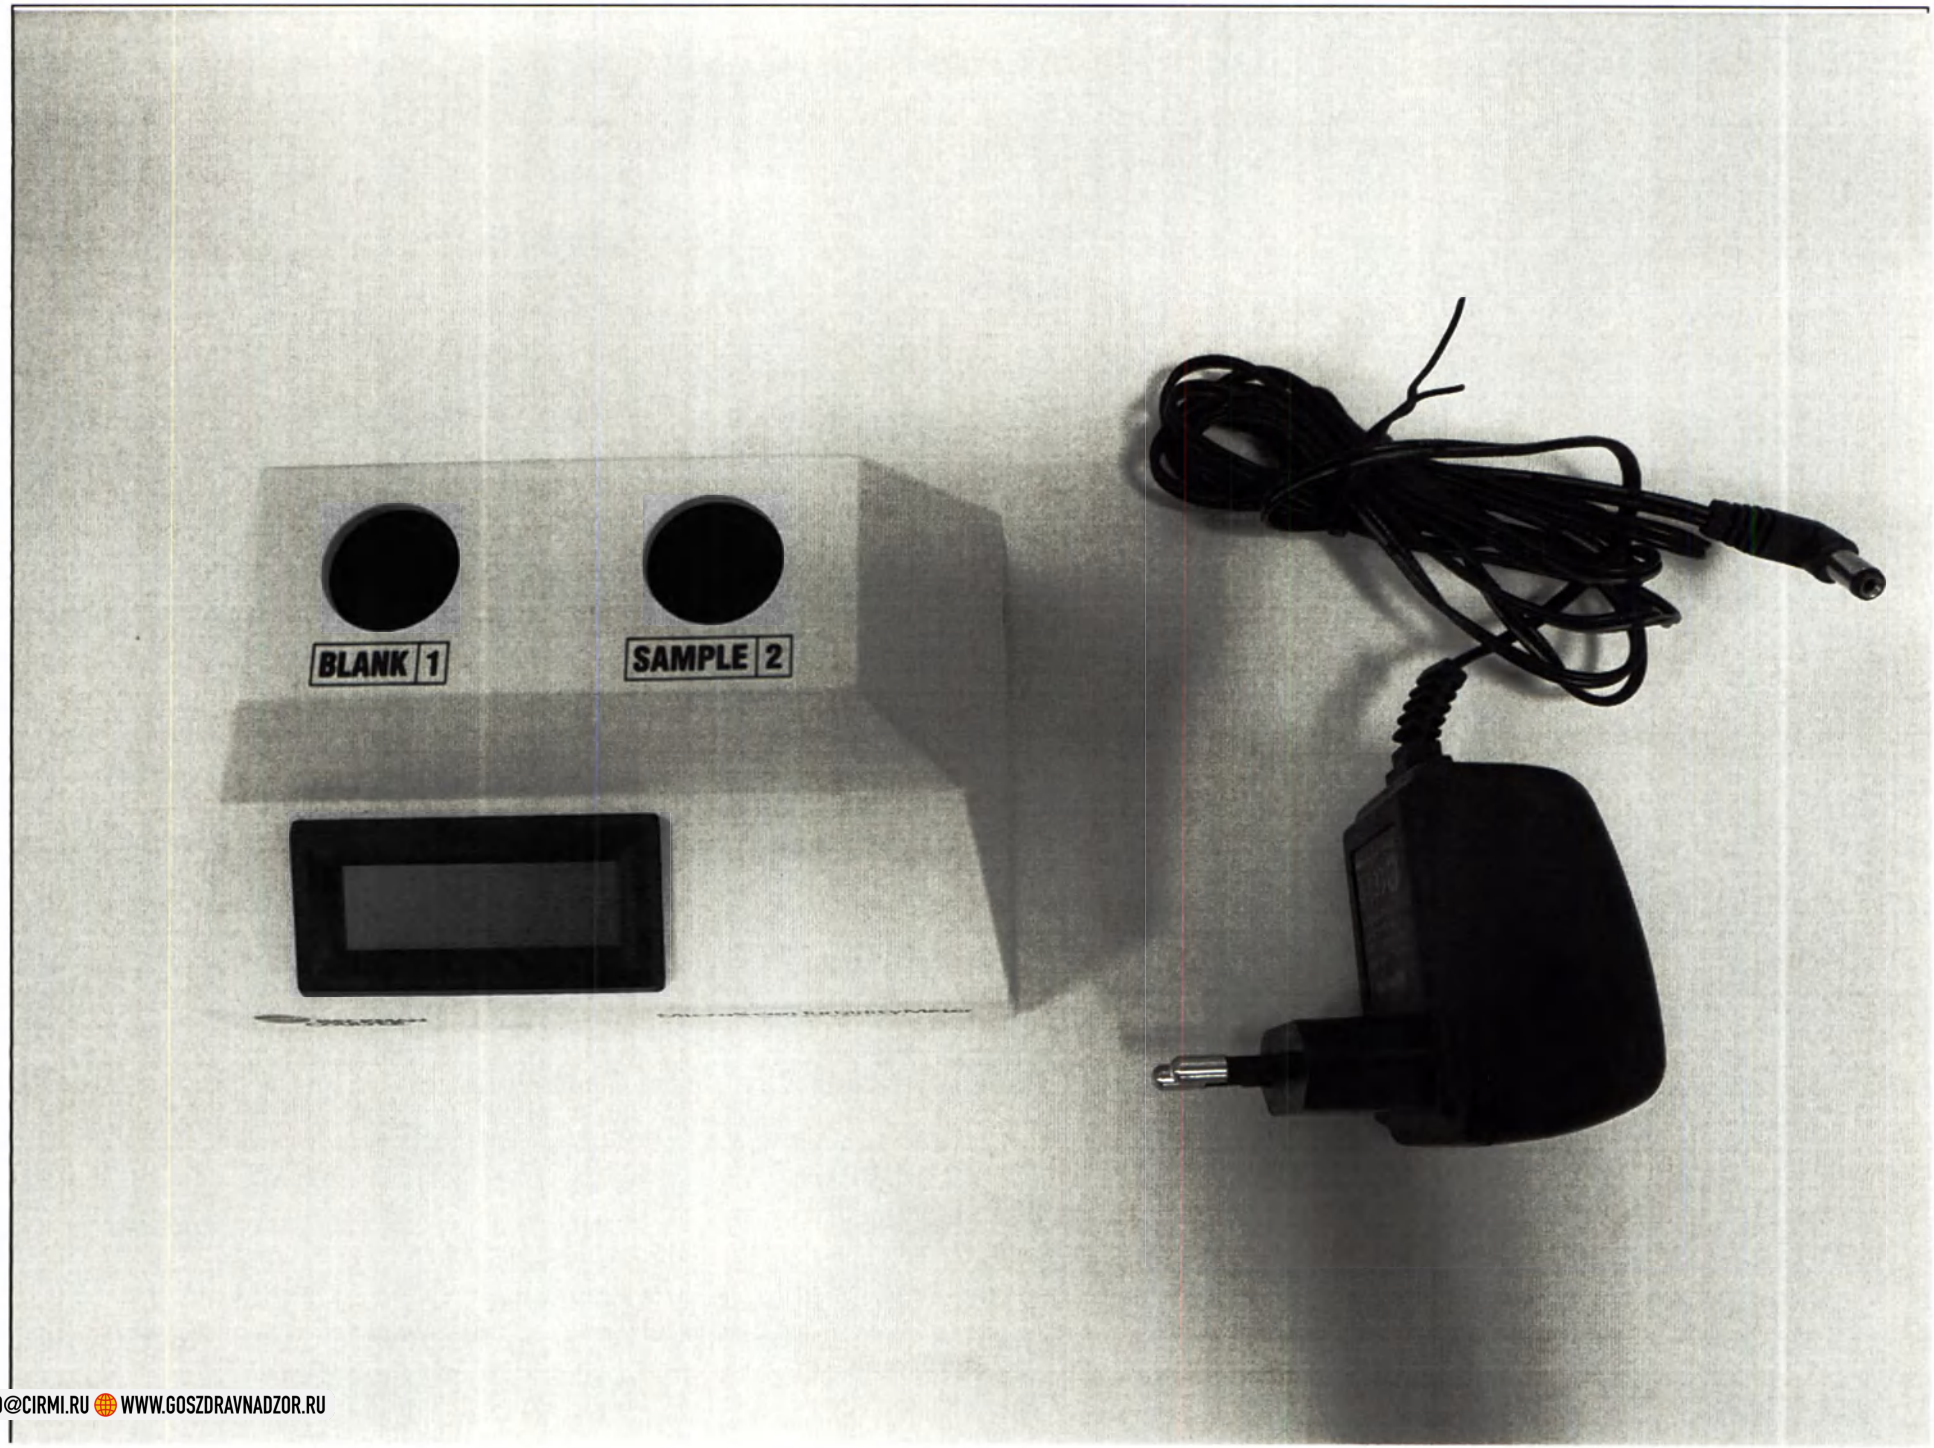

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пипетка многоканальная Renok, в составе: пипетка многоканальная RENOK, базаруководство пользователя по Renok

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пипетка многоканальная Renok, в составе: прокладка уплотнительная

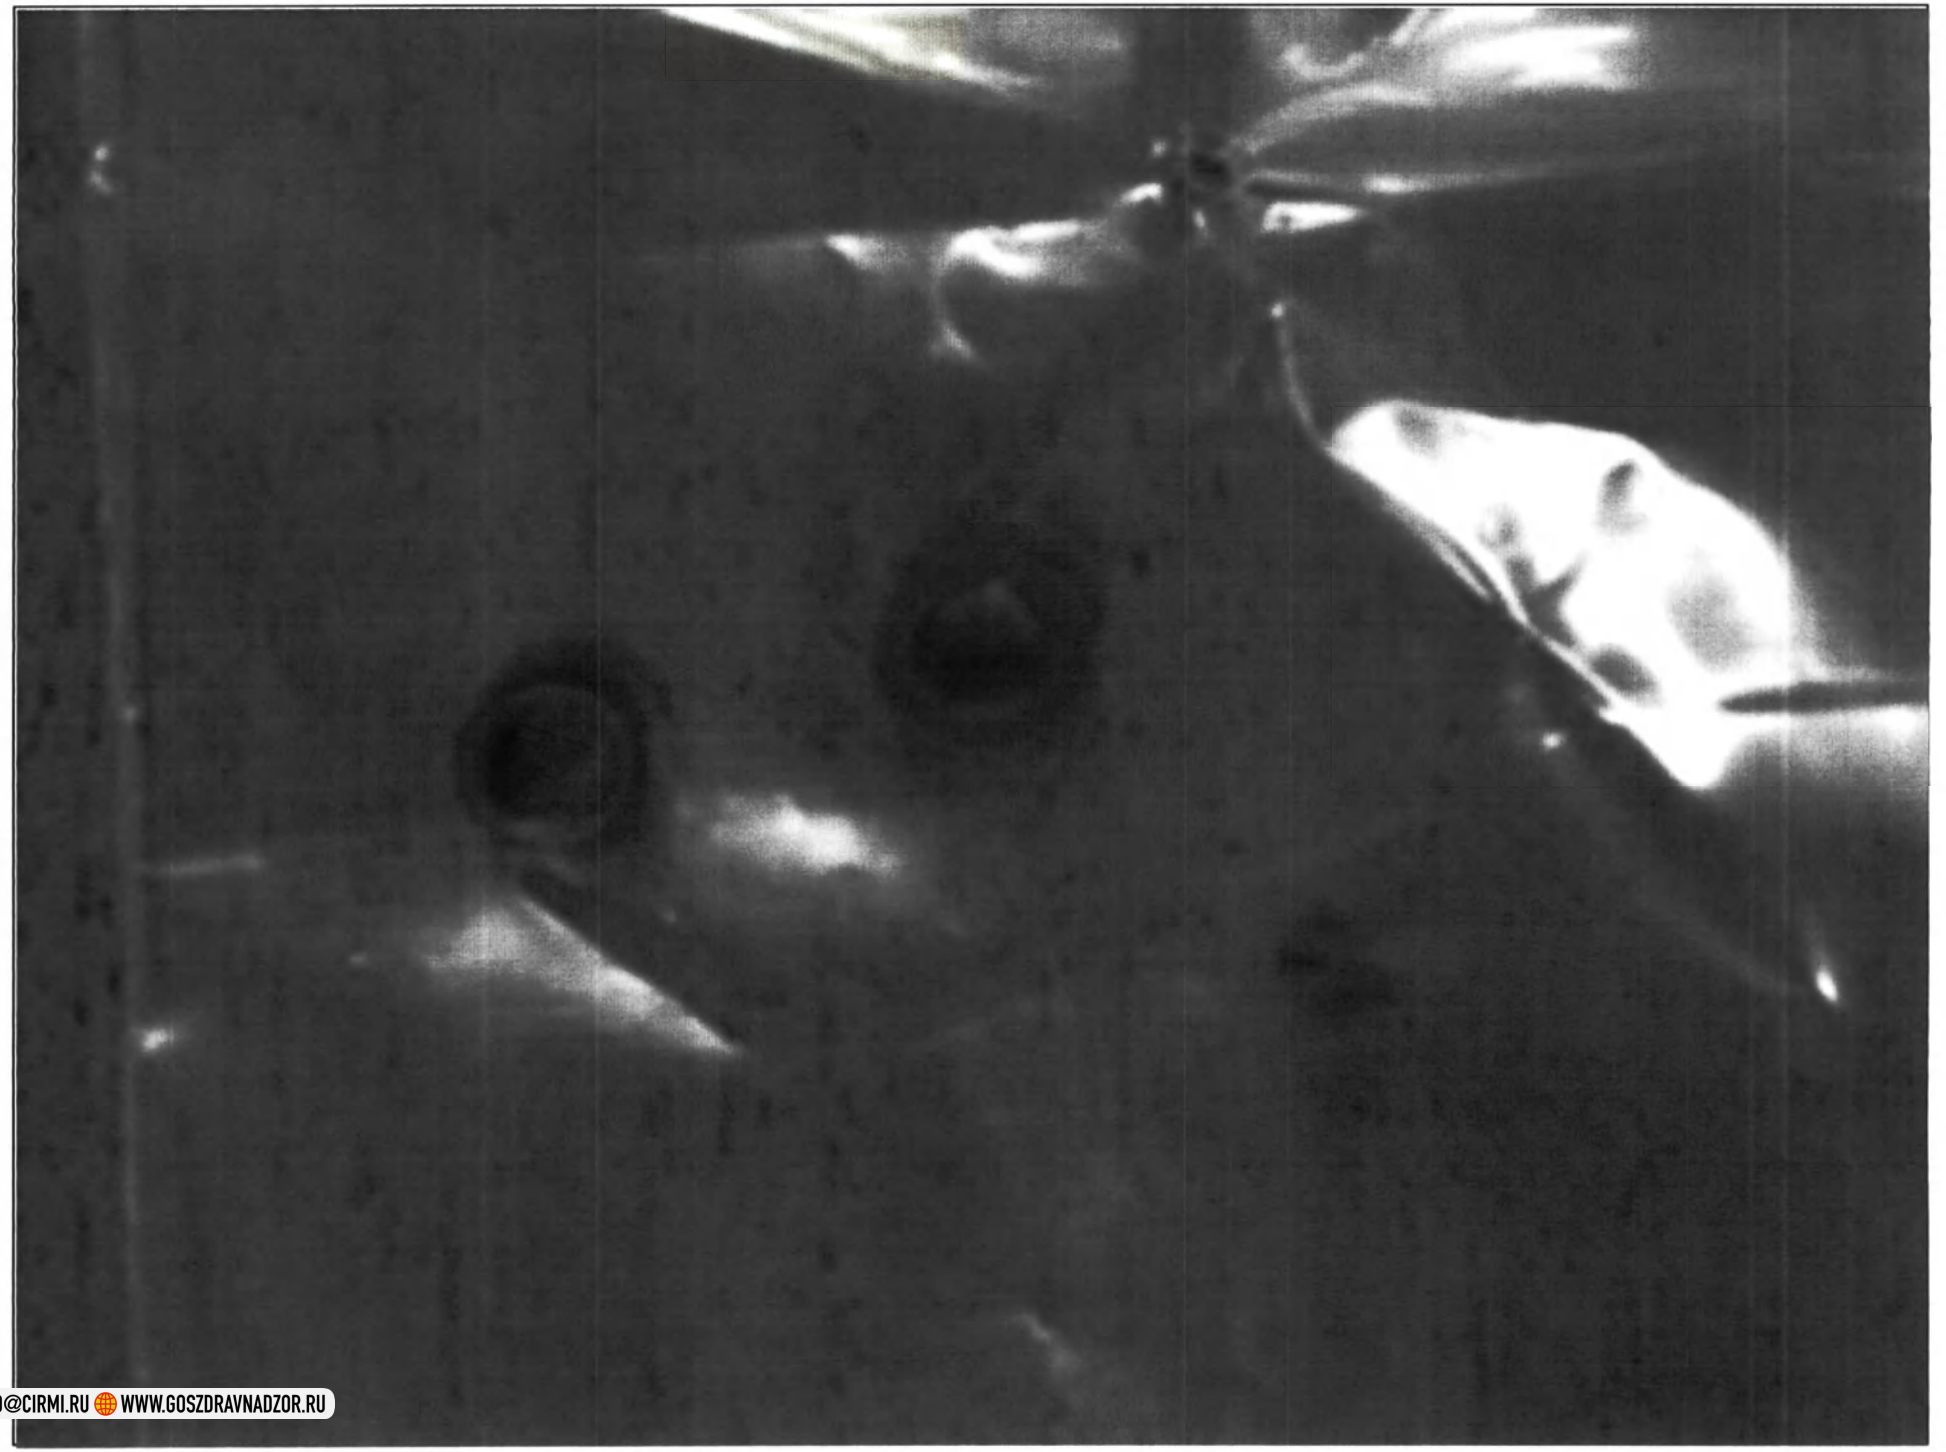

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

MICROBIOLOGY

MicroScan
RENOK Rehydrator/Inoculator System
Instrument Guide

RENOK Rehydrator/Inokulator-System
Bedienungsanleitung

Sistema rehidratador/inoculador RENOK
Guía del instrumento

Système réhydratateur/inoculateur RENOK
Guide de l'instrument

Sistema reidratatore/inoculatore RENOK
Guida dello strumento

Sistema Re-hidratador/Inoculador RENOK
Guia do instrumento

Σύστημα επανενυδάτωσης/ενοφθαλμισμού RENOK
Οδηγός οργάνου

For *in vitro* Diagnostic Use

9020-7657, Rev. BB

US FMR MR

BECKMAN COULTER

IVD CE

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Программное обеспечение LabPro на диске, не более 3 шт.

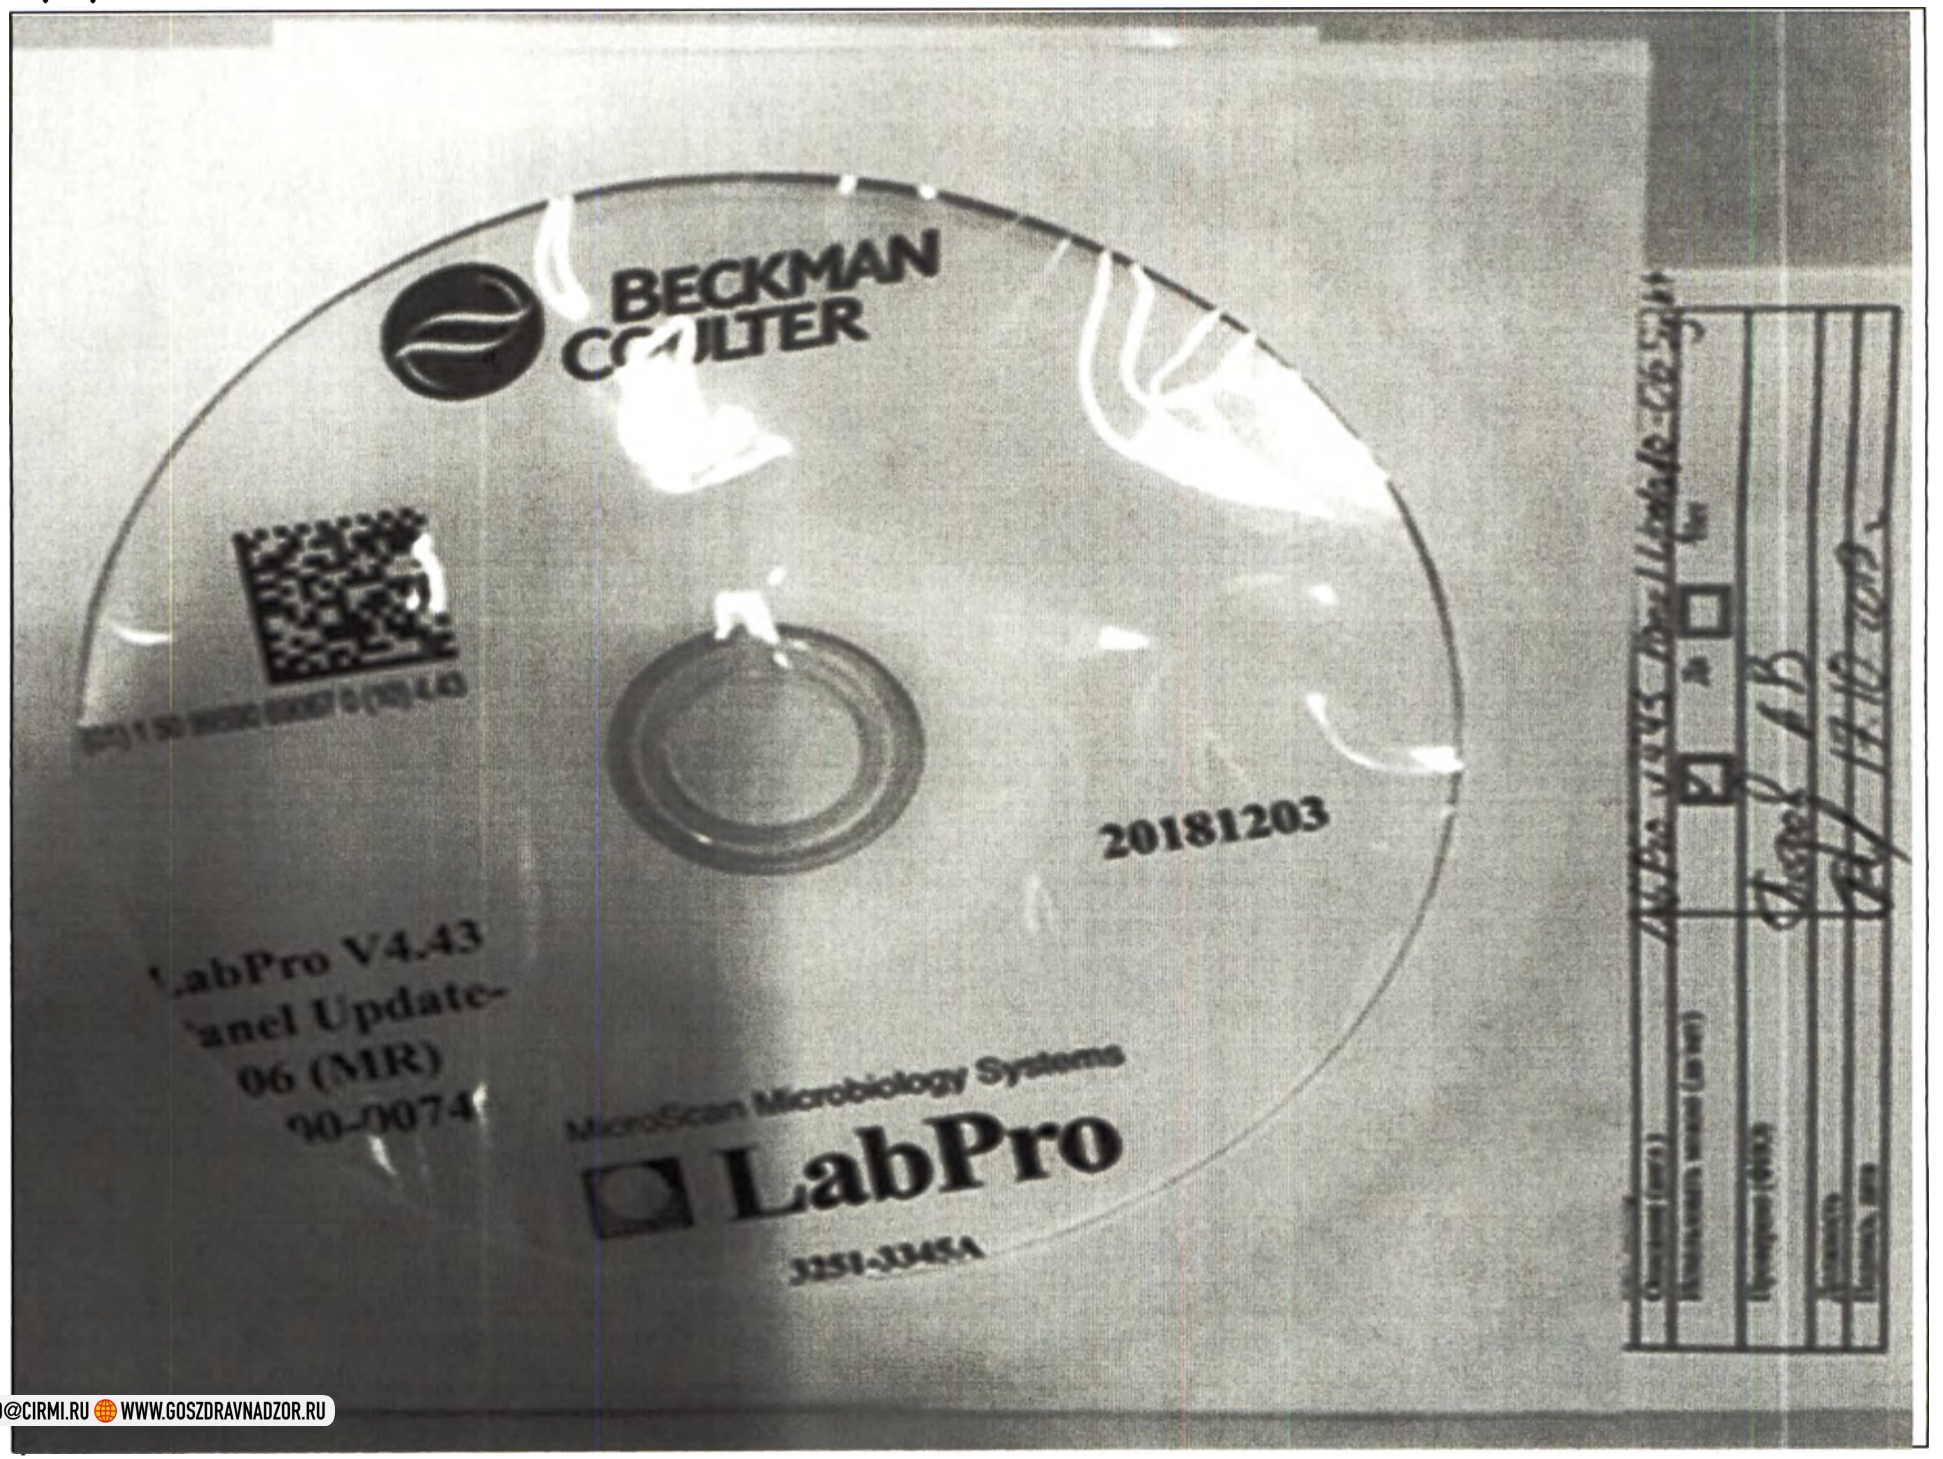

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

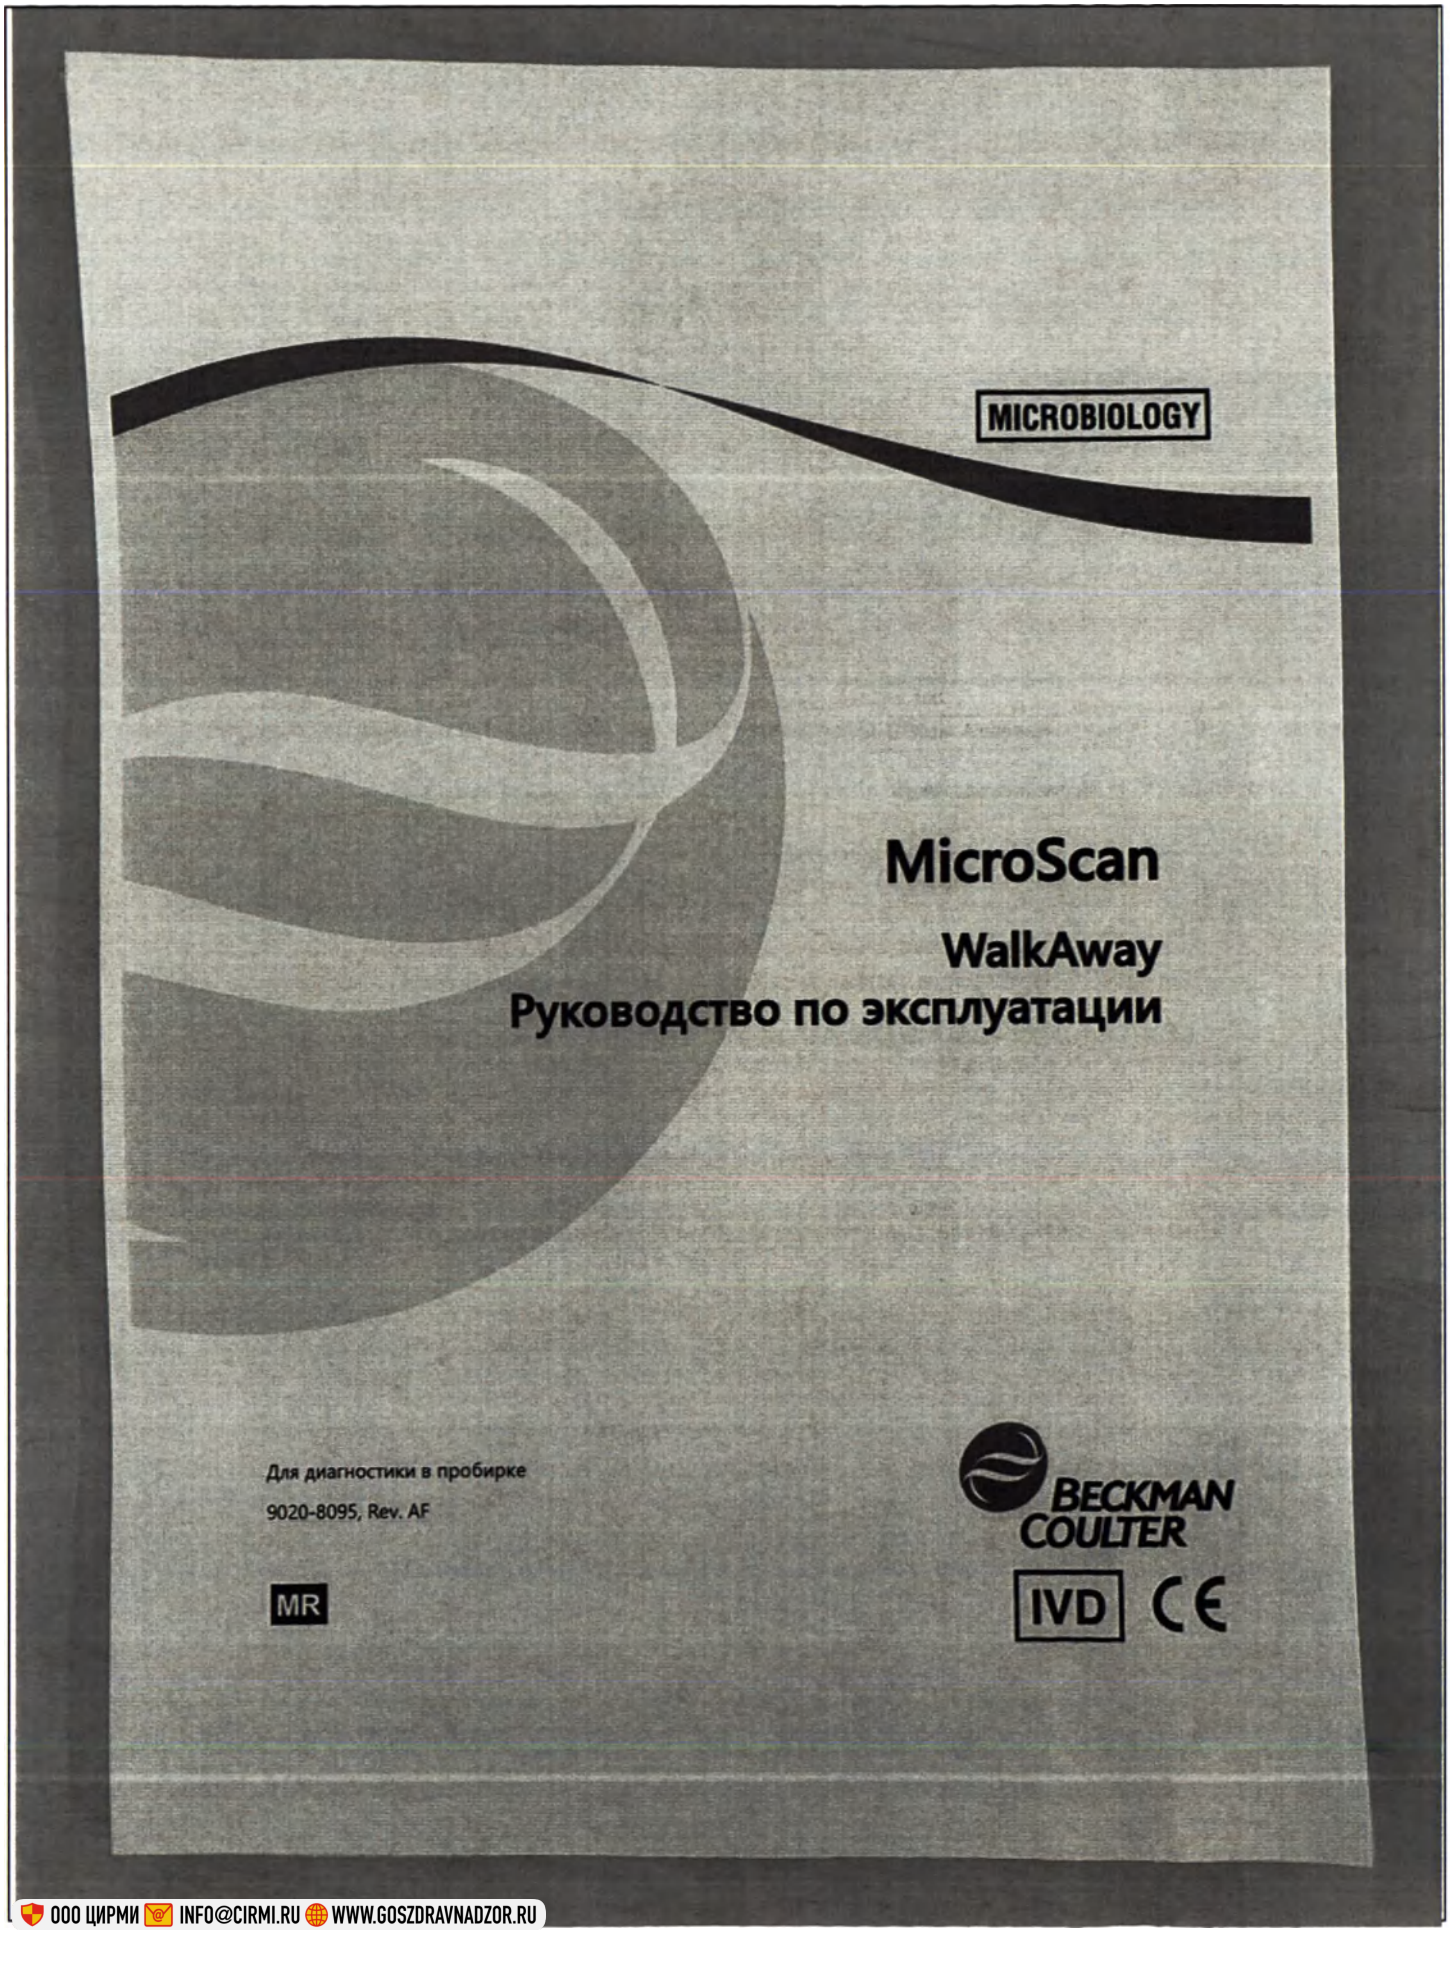

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Бумага для принтера штрих-кода, не более 3 рулонов

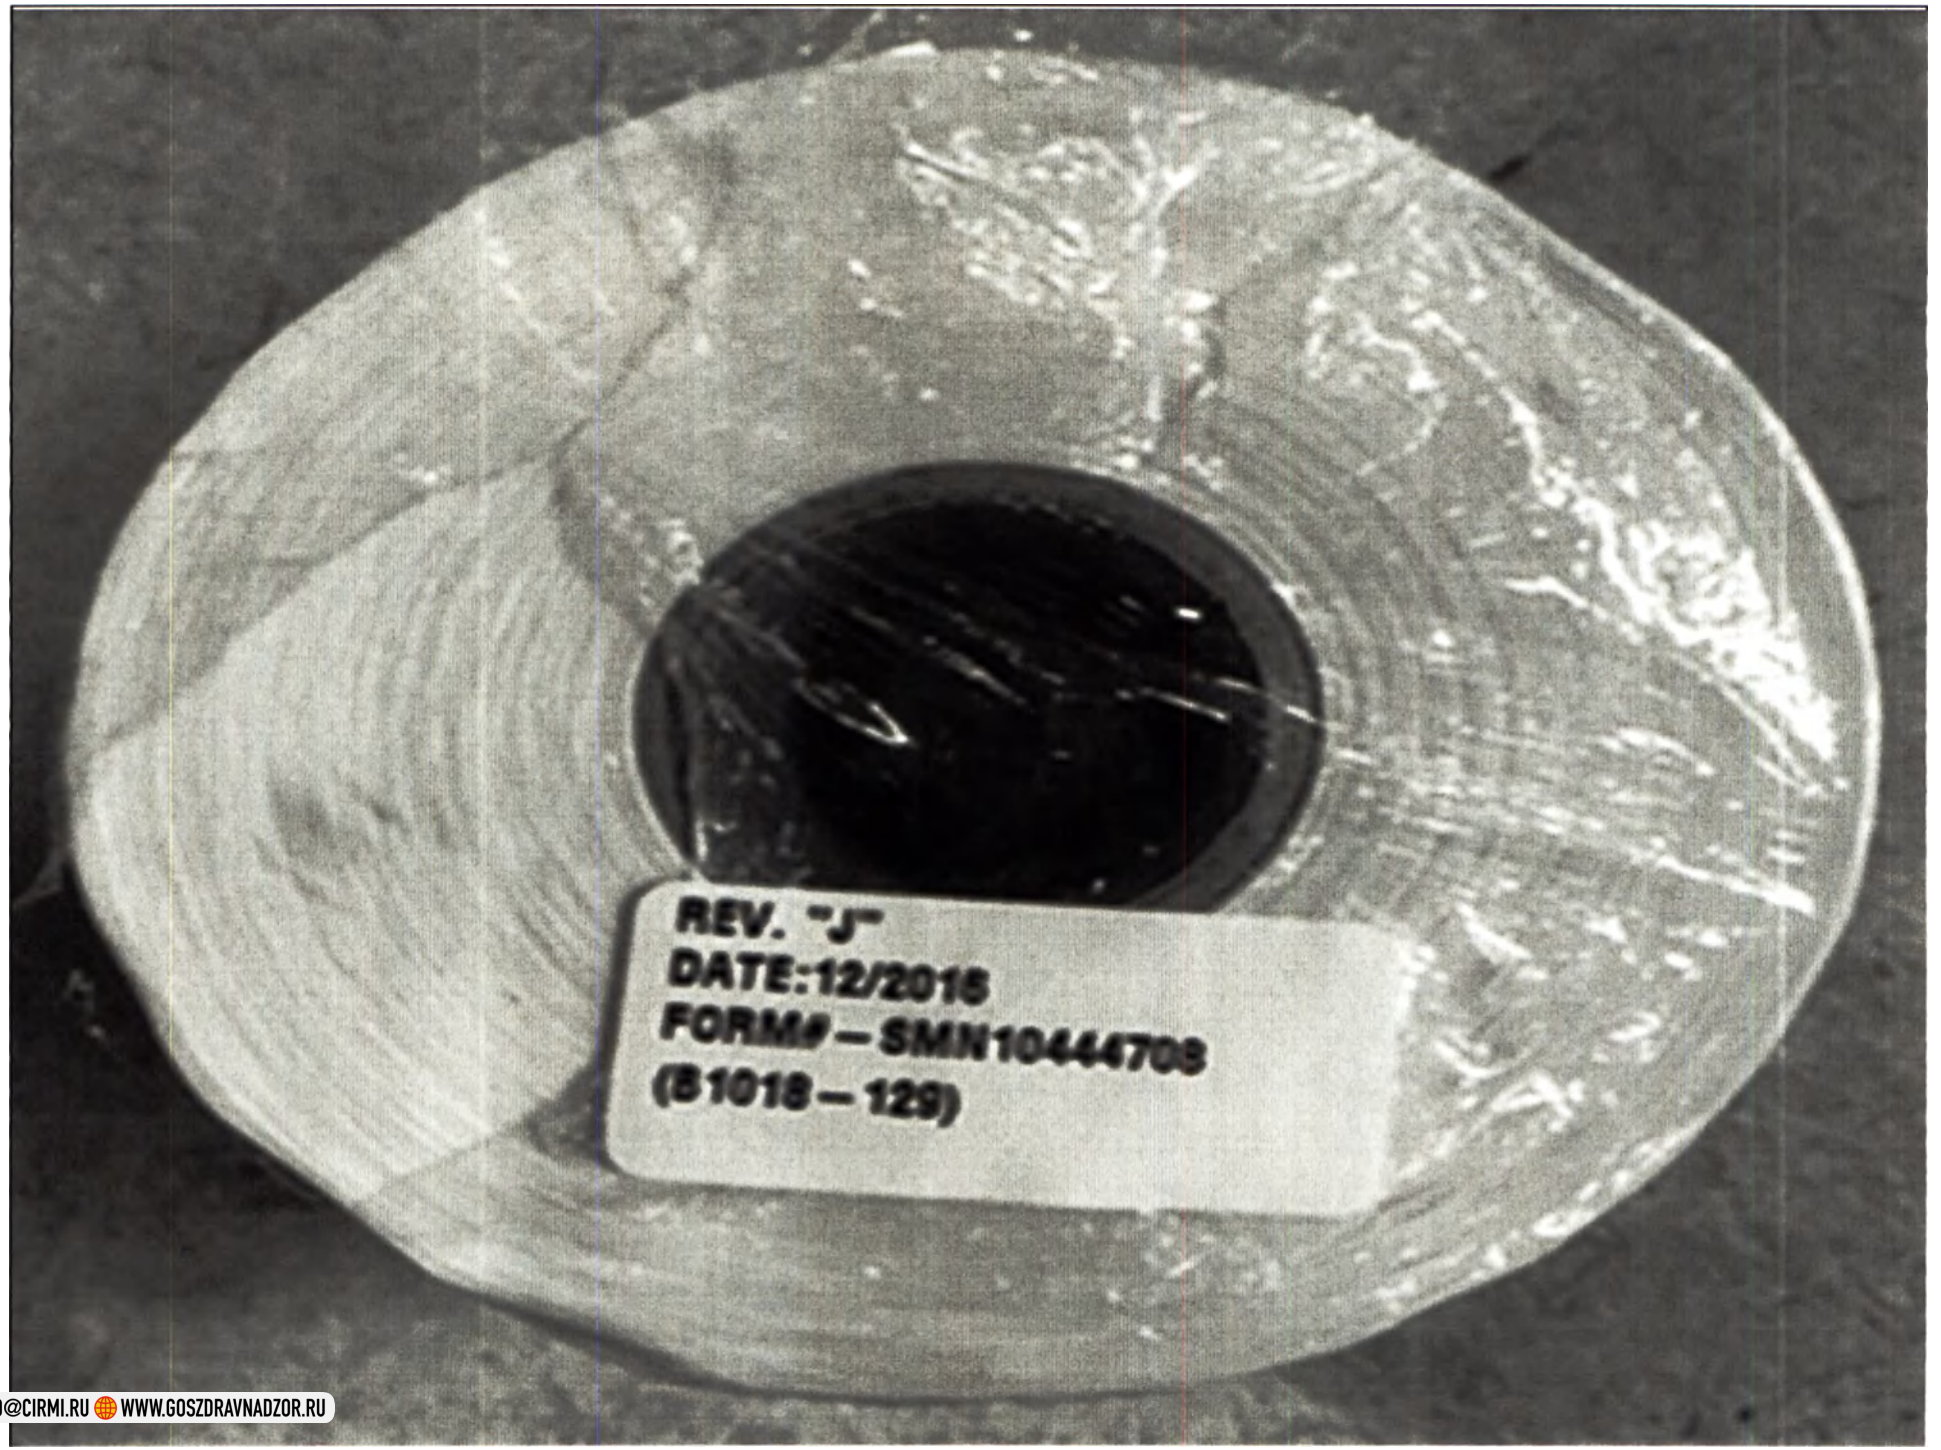

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Термометр, не более 2 шт.

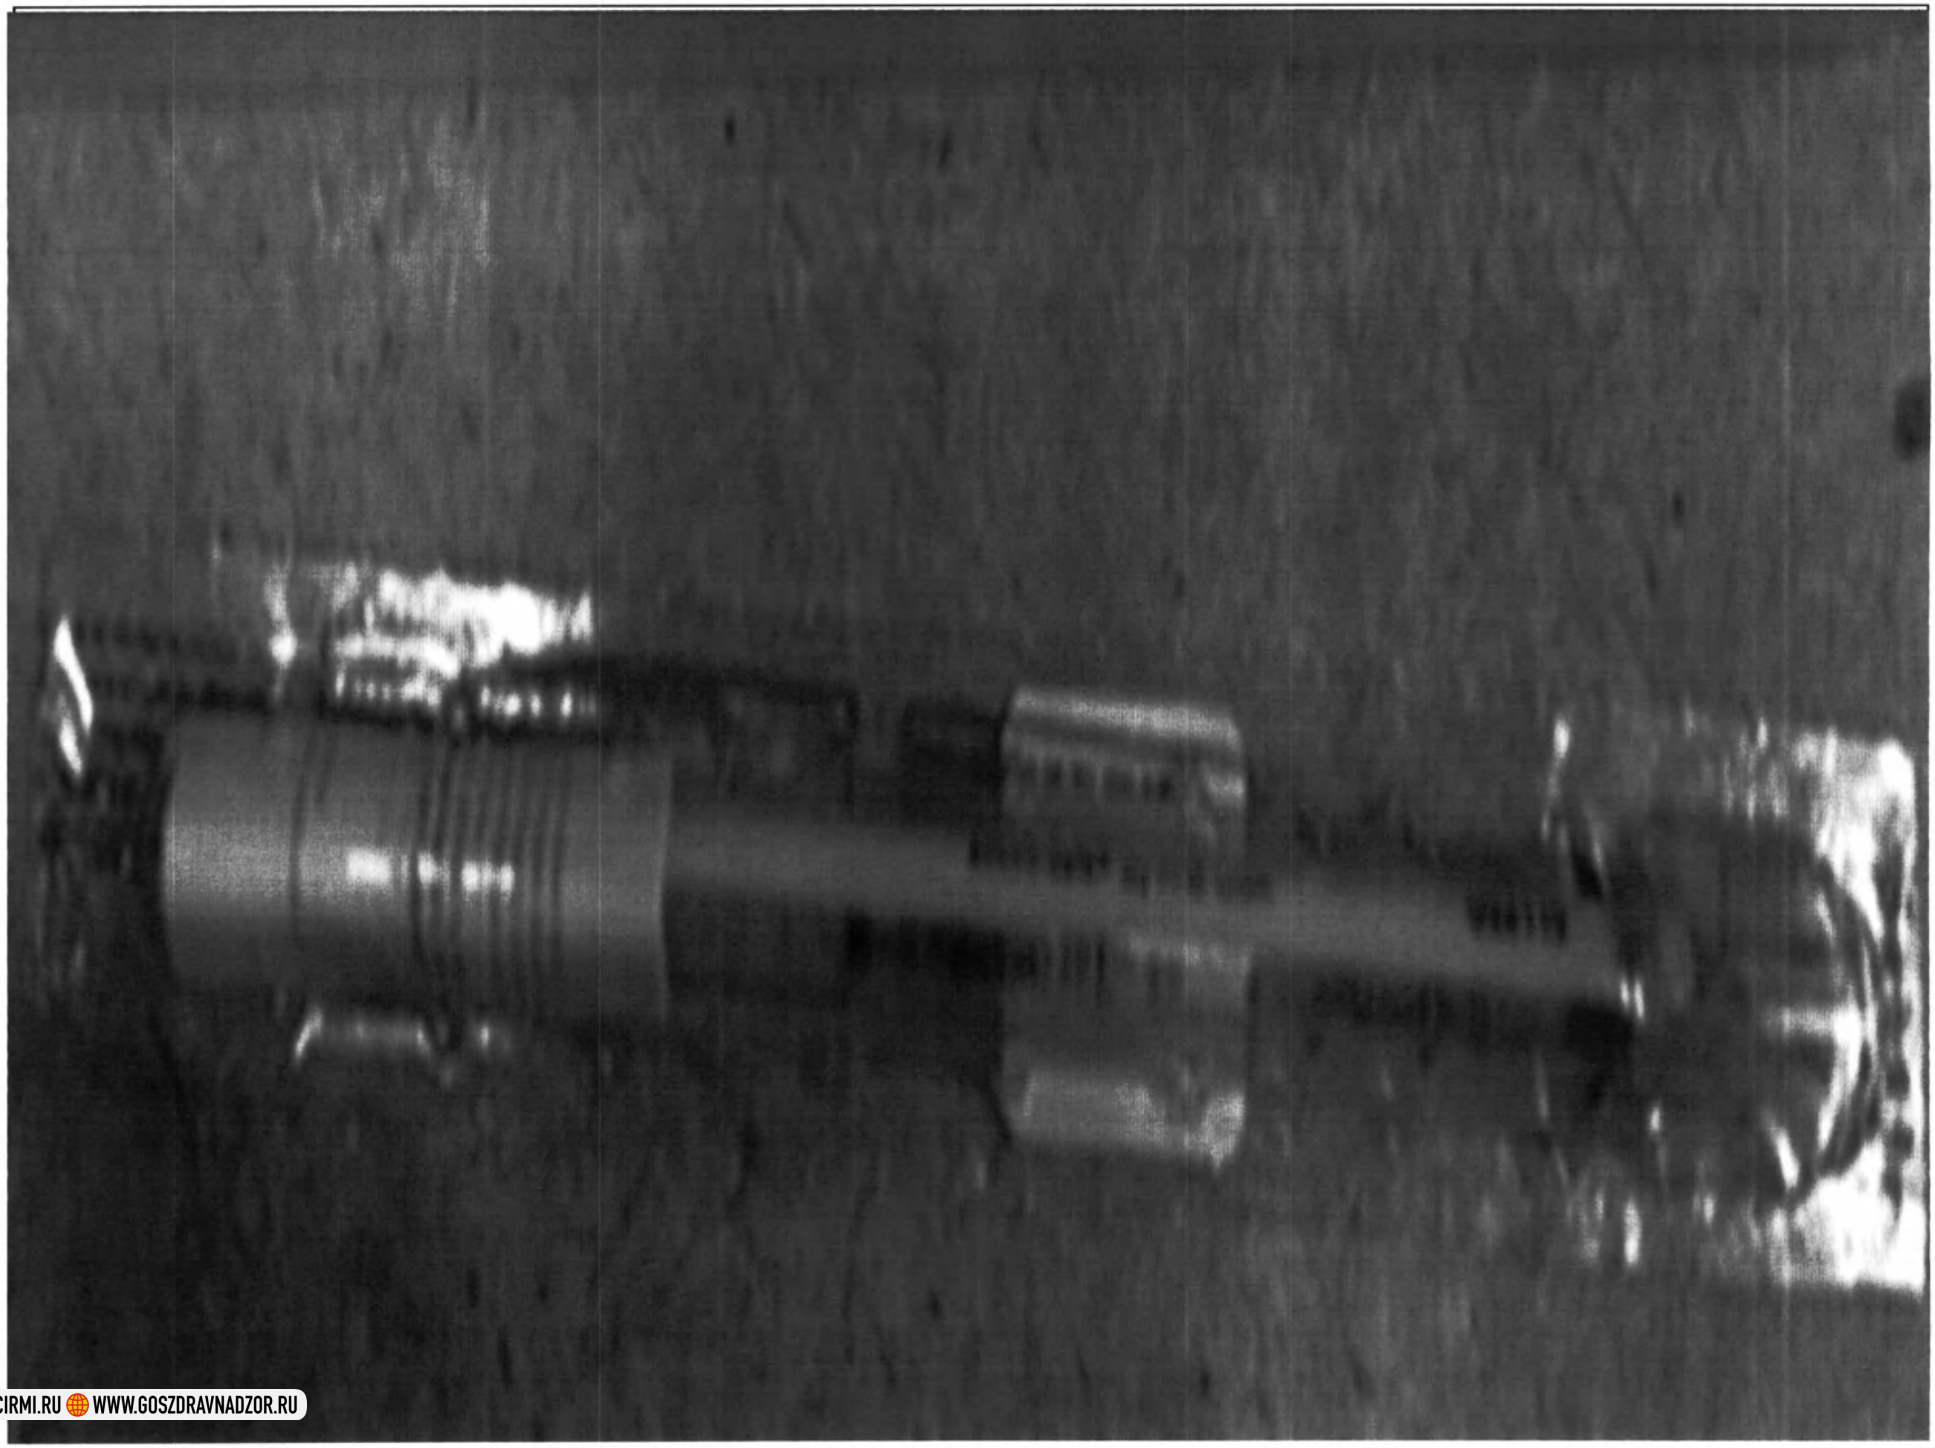

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Адаптер термометра, не более 2 шт..

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотодиодный экран, не более 3 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Диффузор, не более 3 шт.

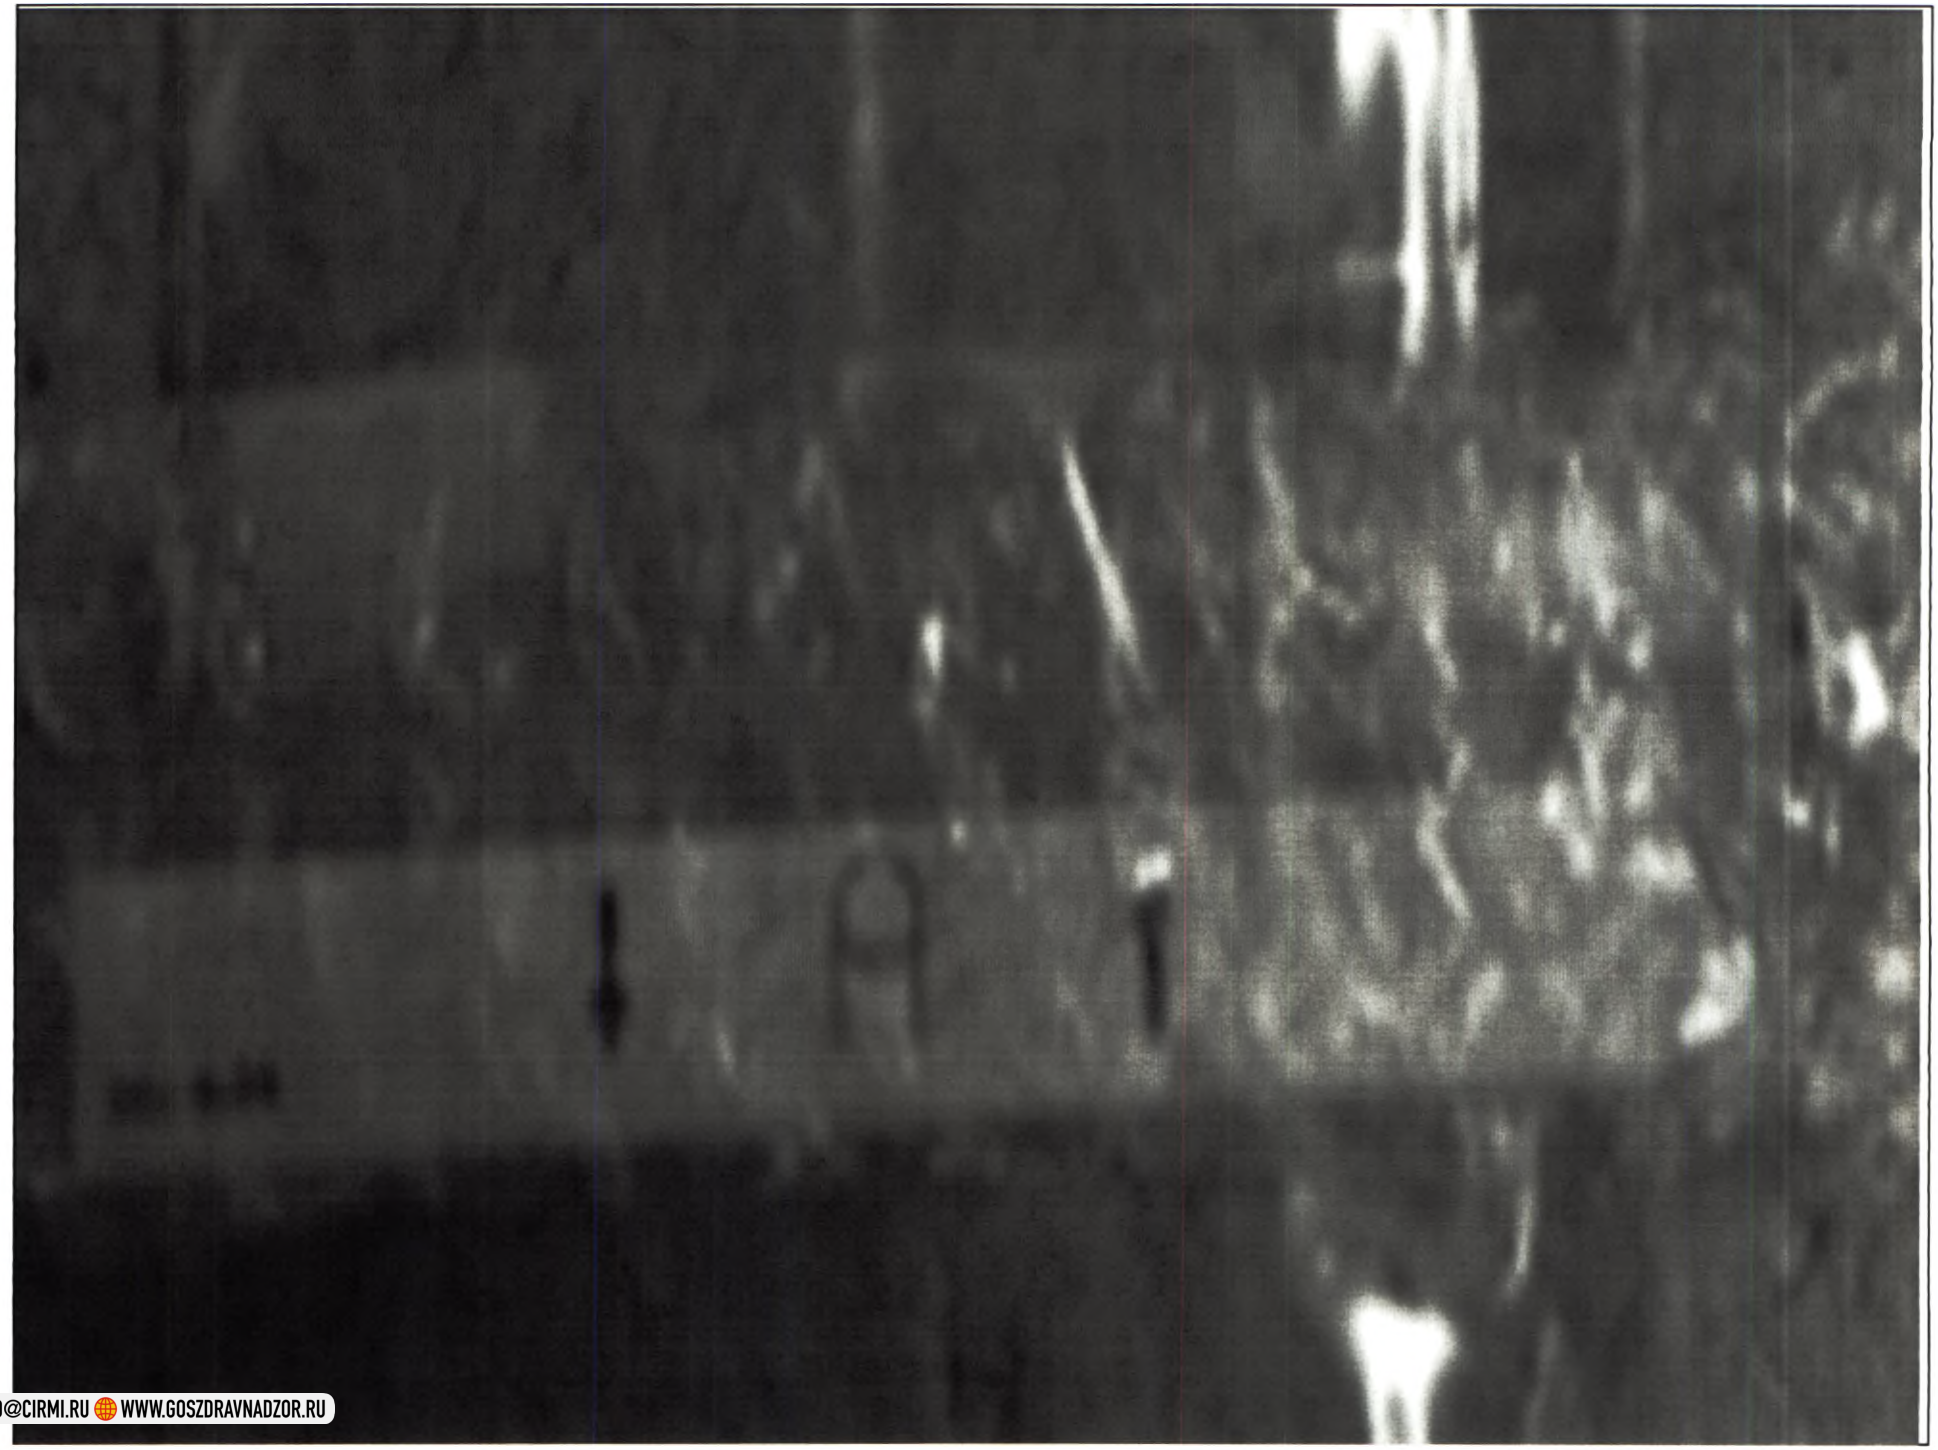

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Емкость для отходов реагентов с заглушками, не более 8 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Зажим, не более 2 шт.

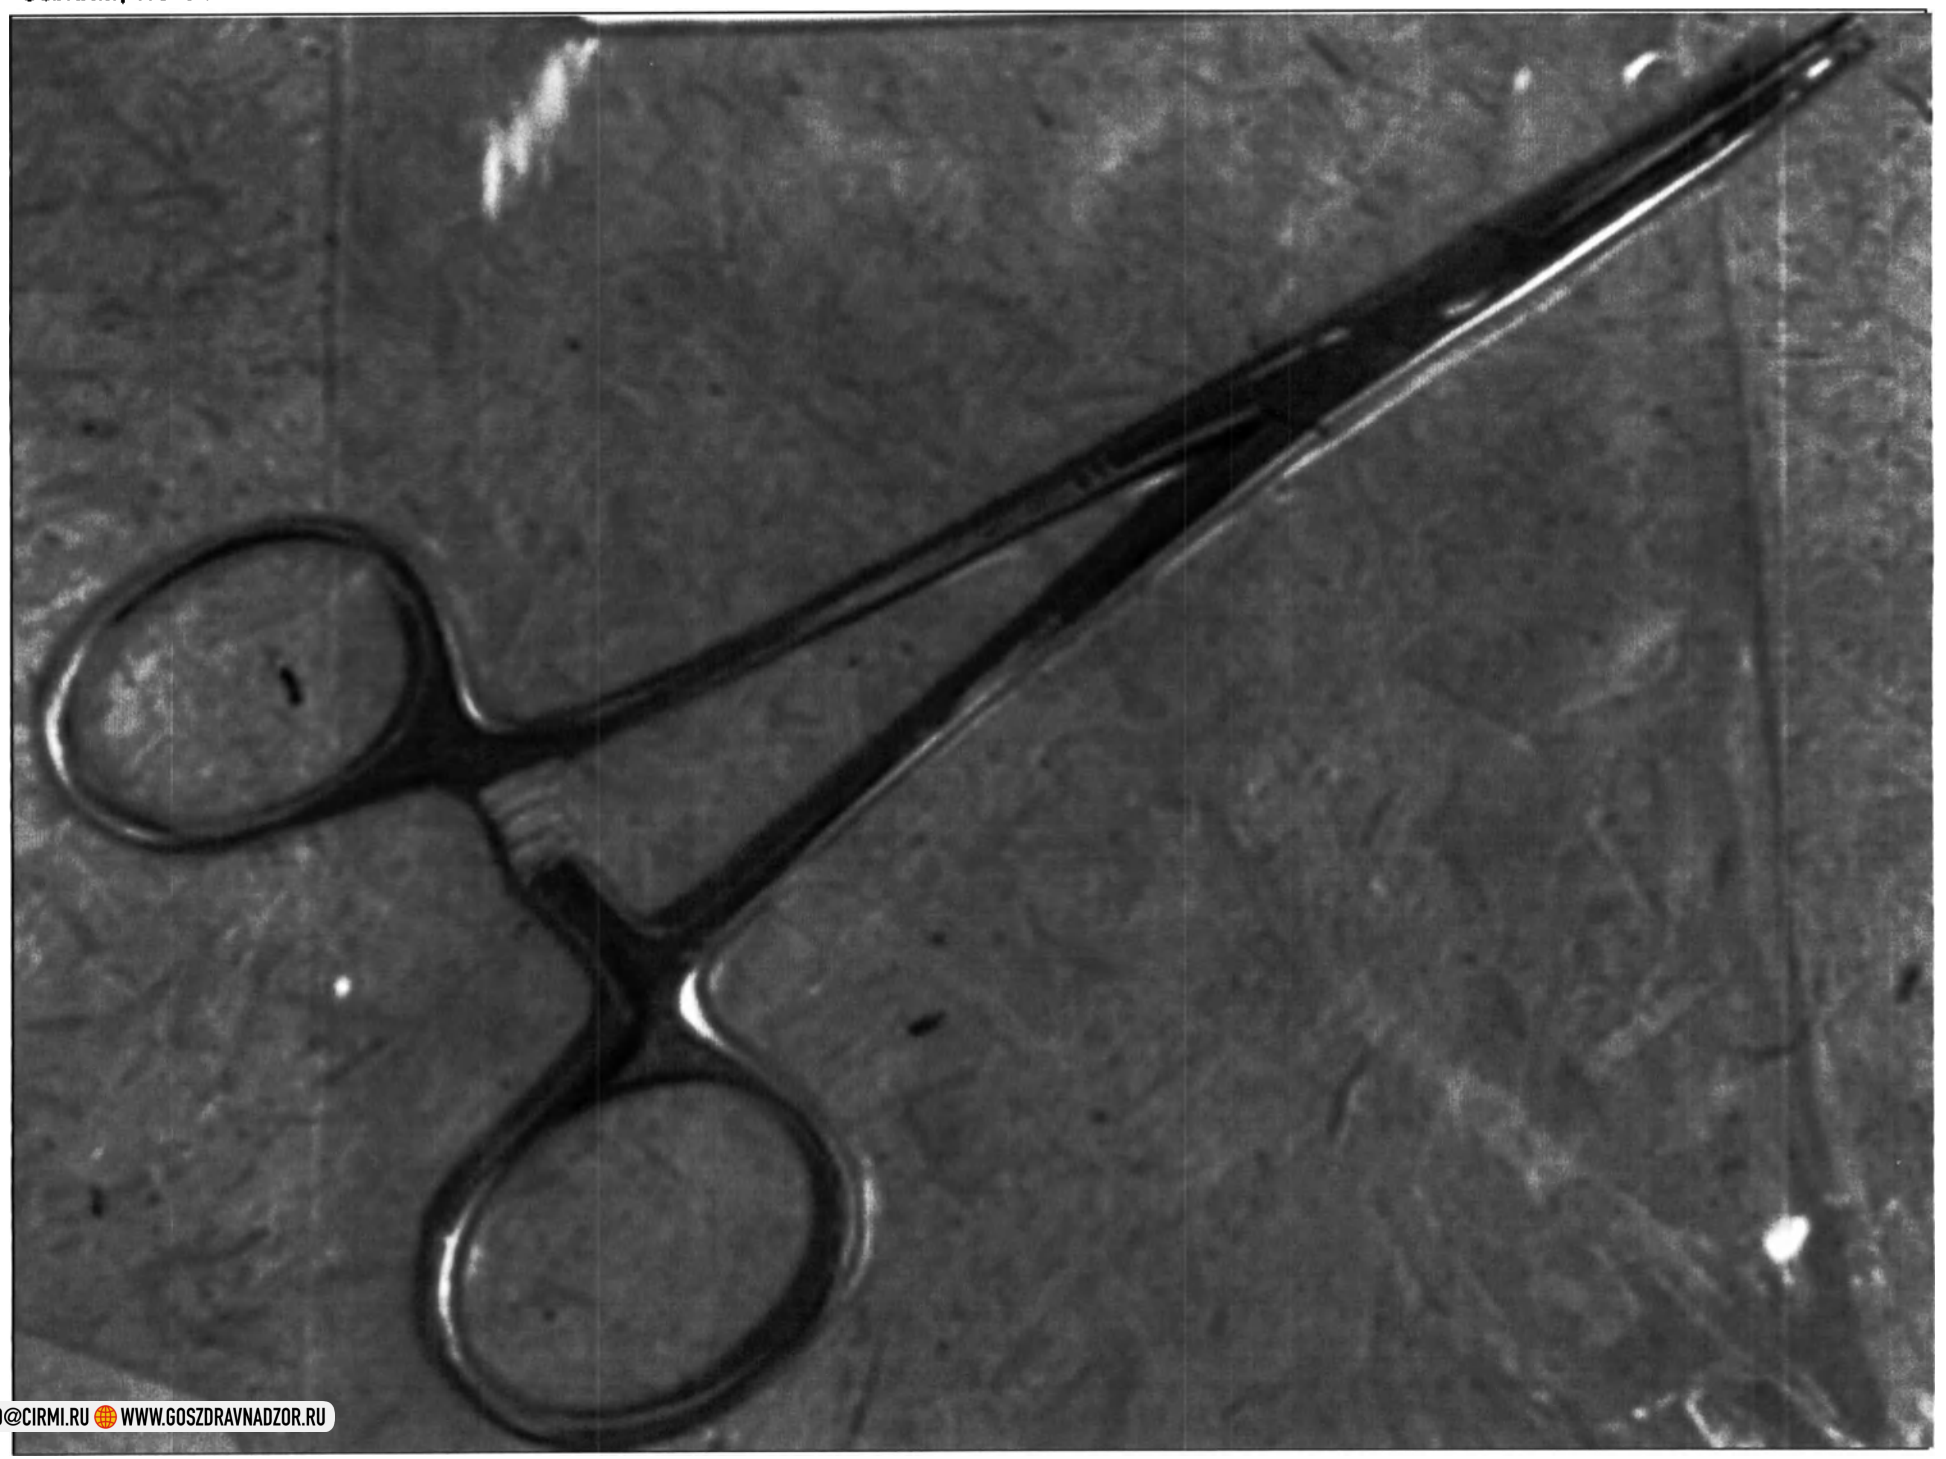

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пробка впускная резервуара для воды, не более 2 шт.

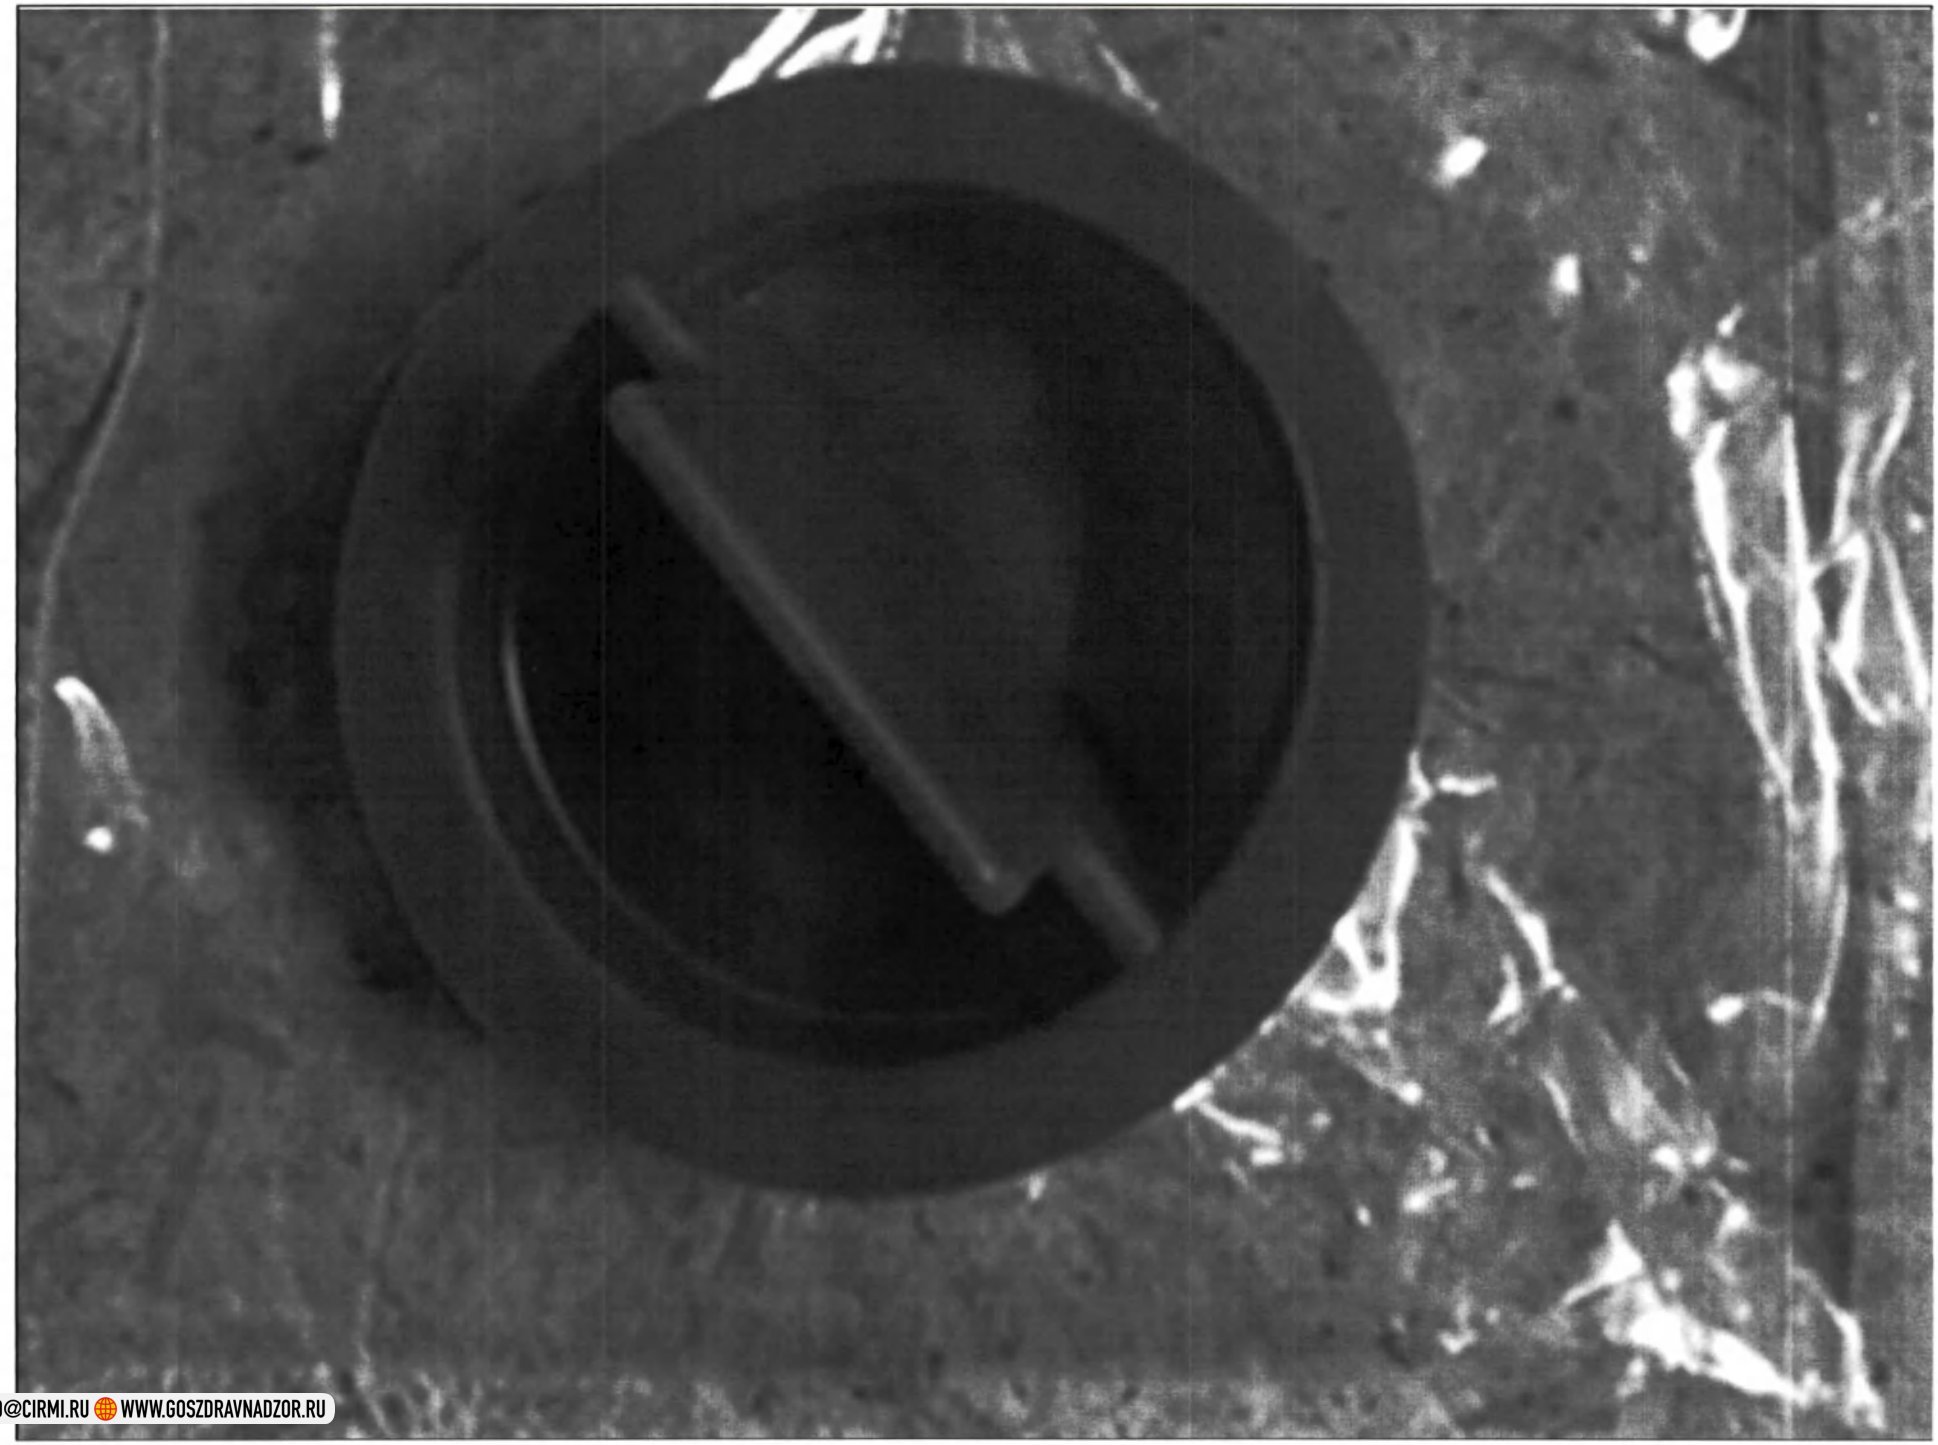

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Сетевые кабели, не более 12 шт

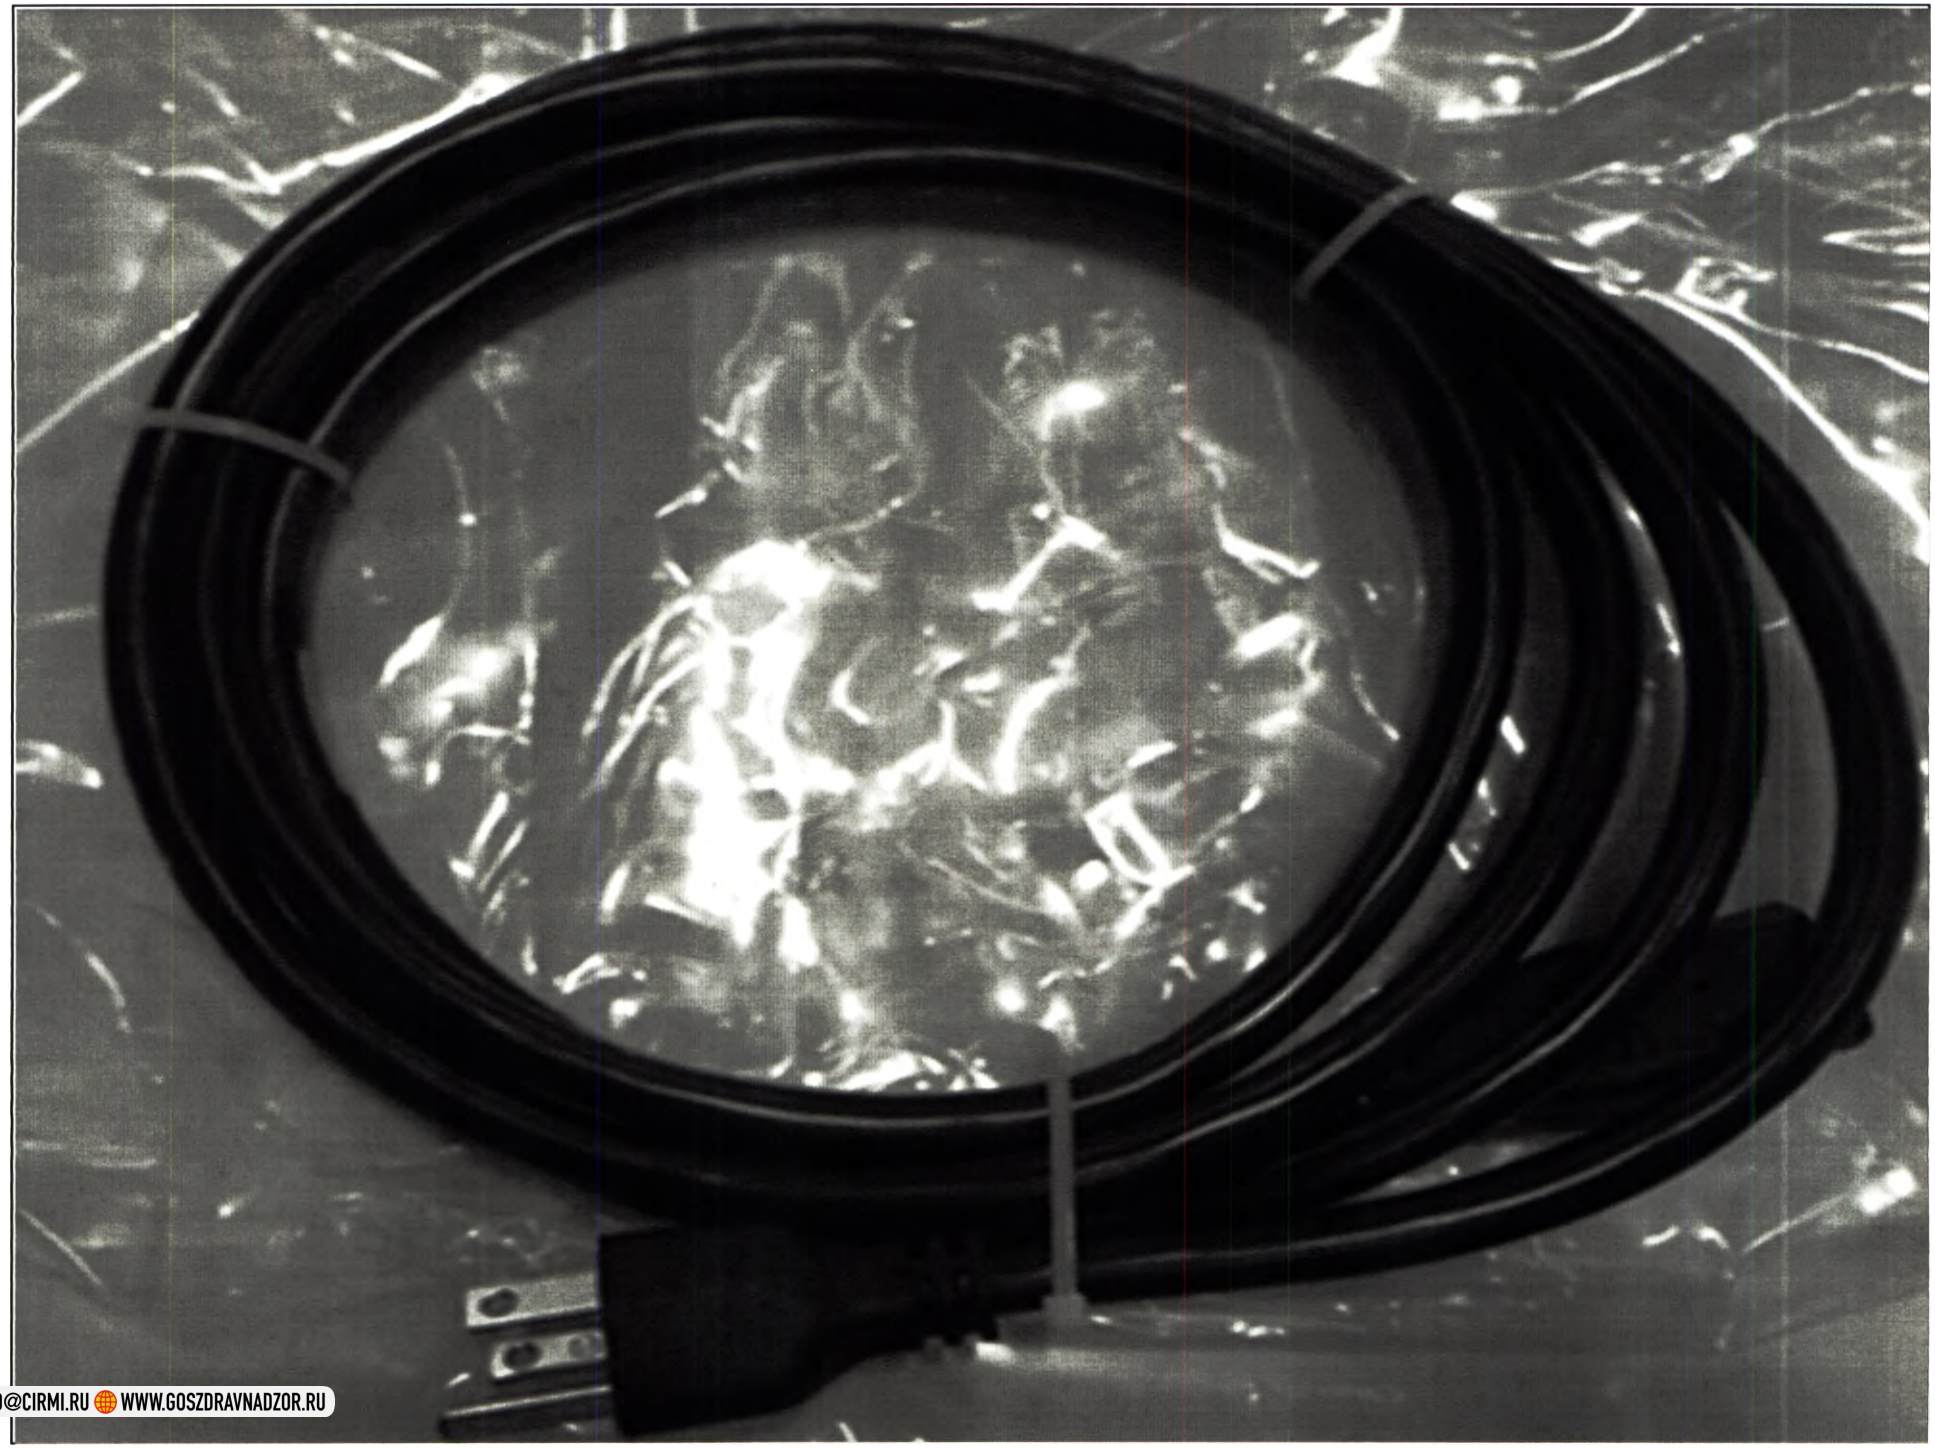

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Флеш-накопитель, не более 2 шт.

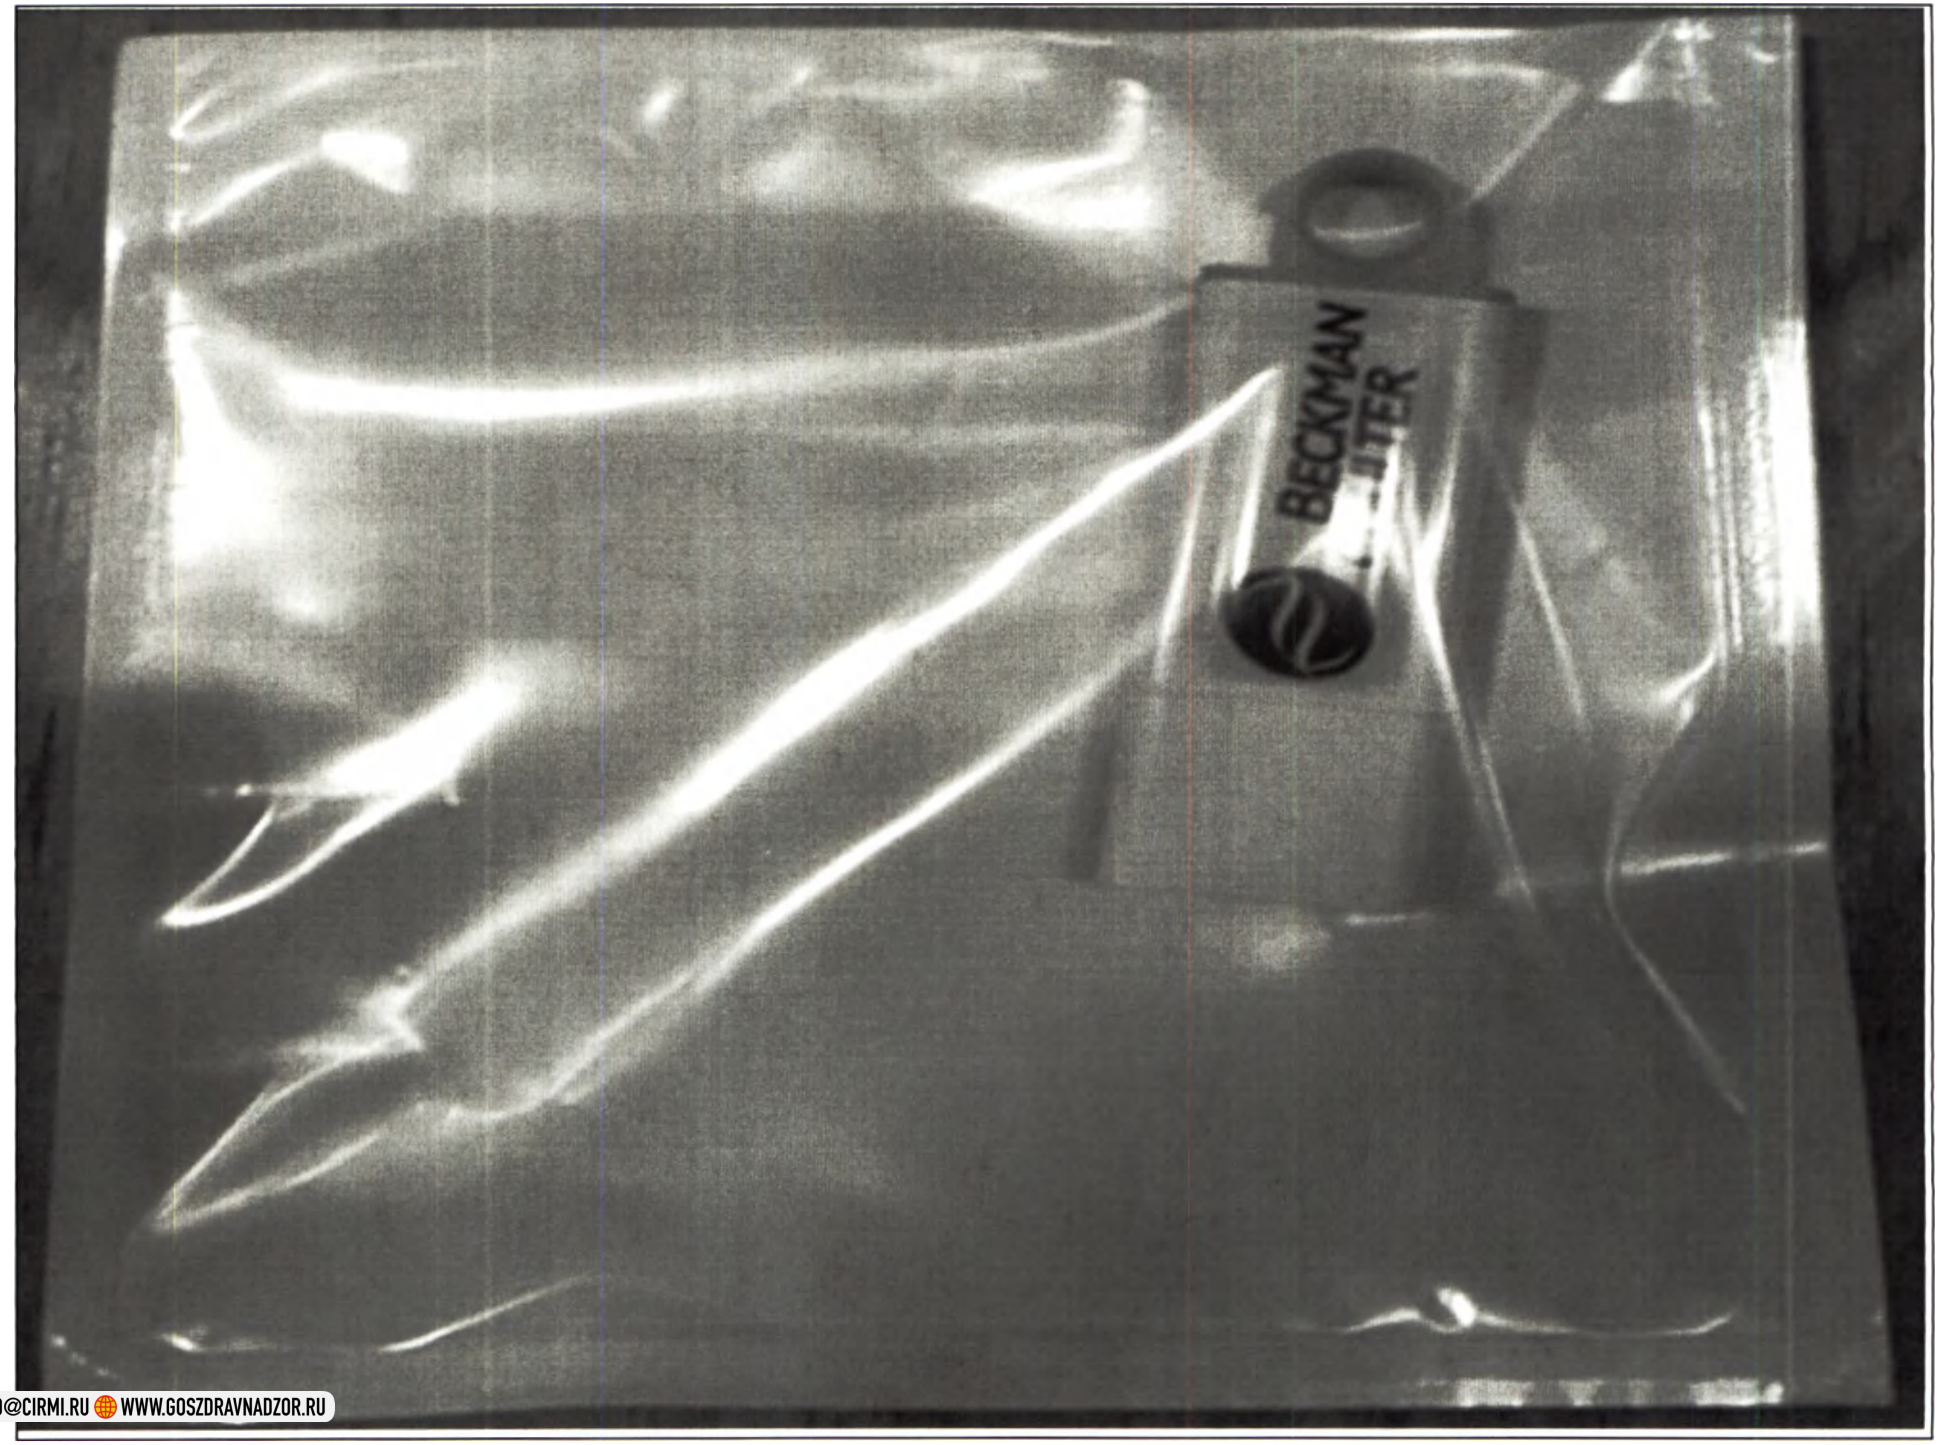

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Диск с настройками грабера, не более 2 шт

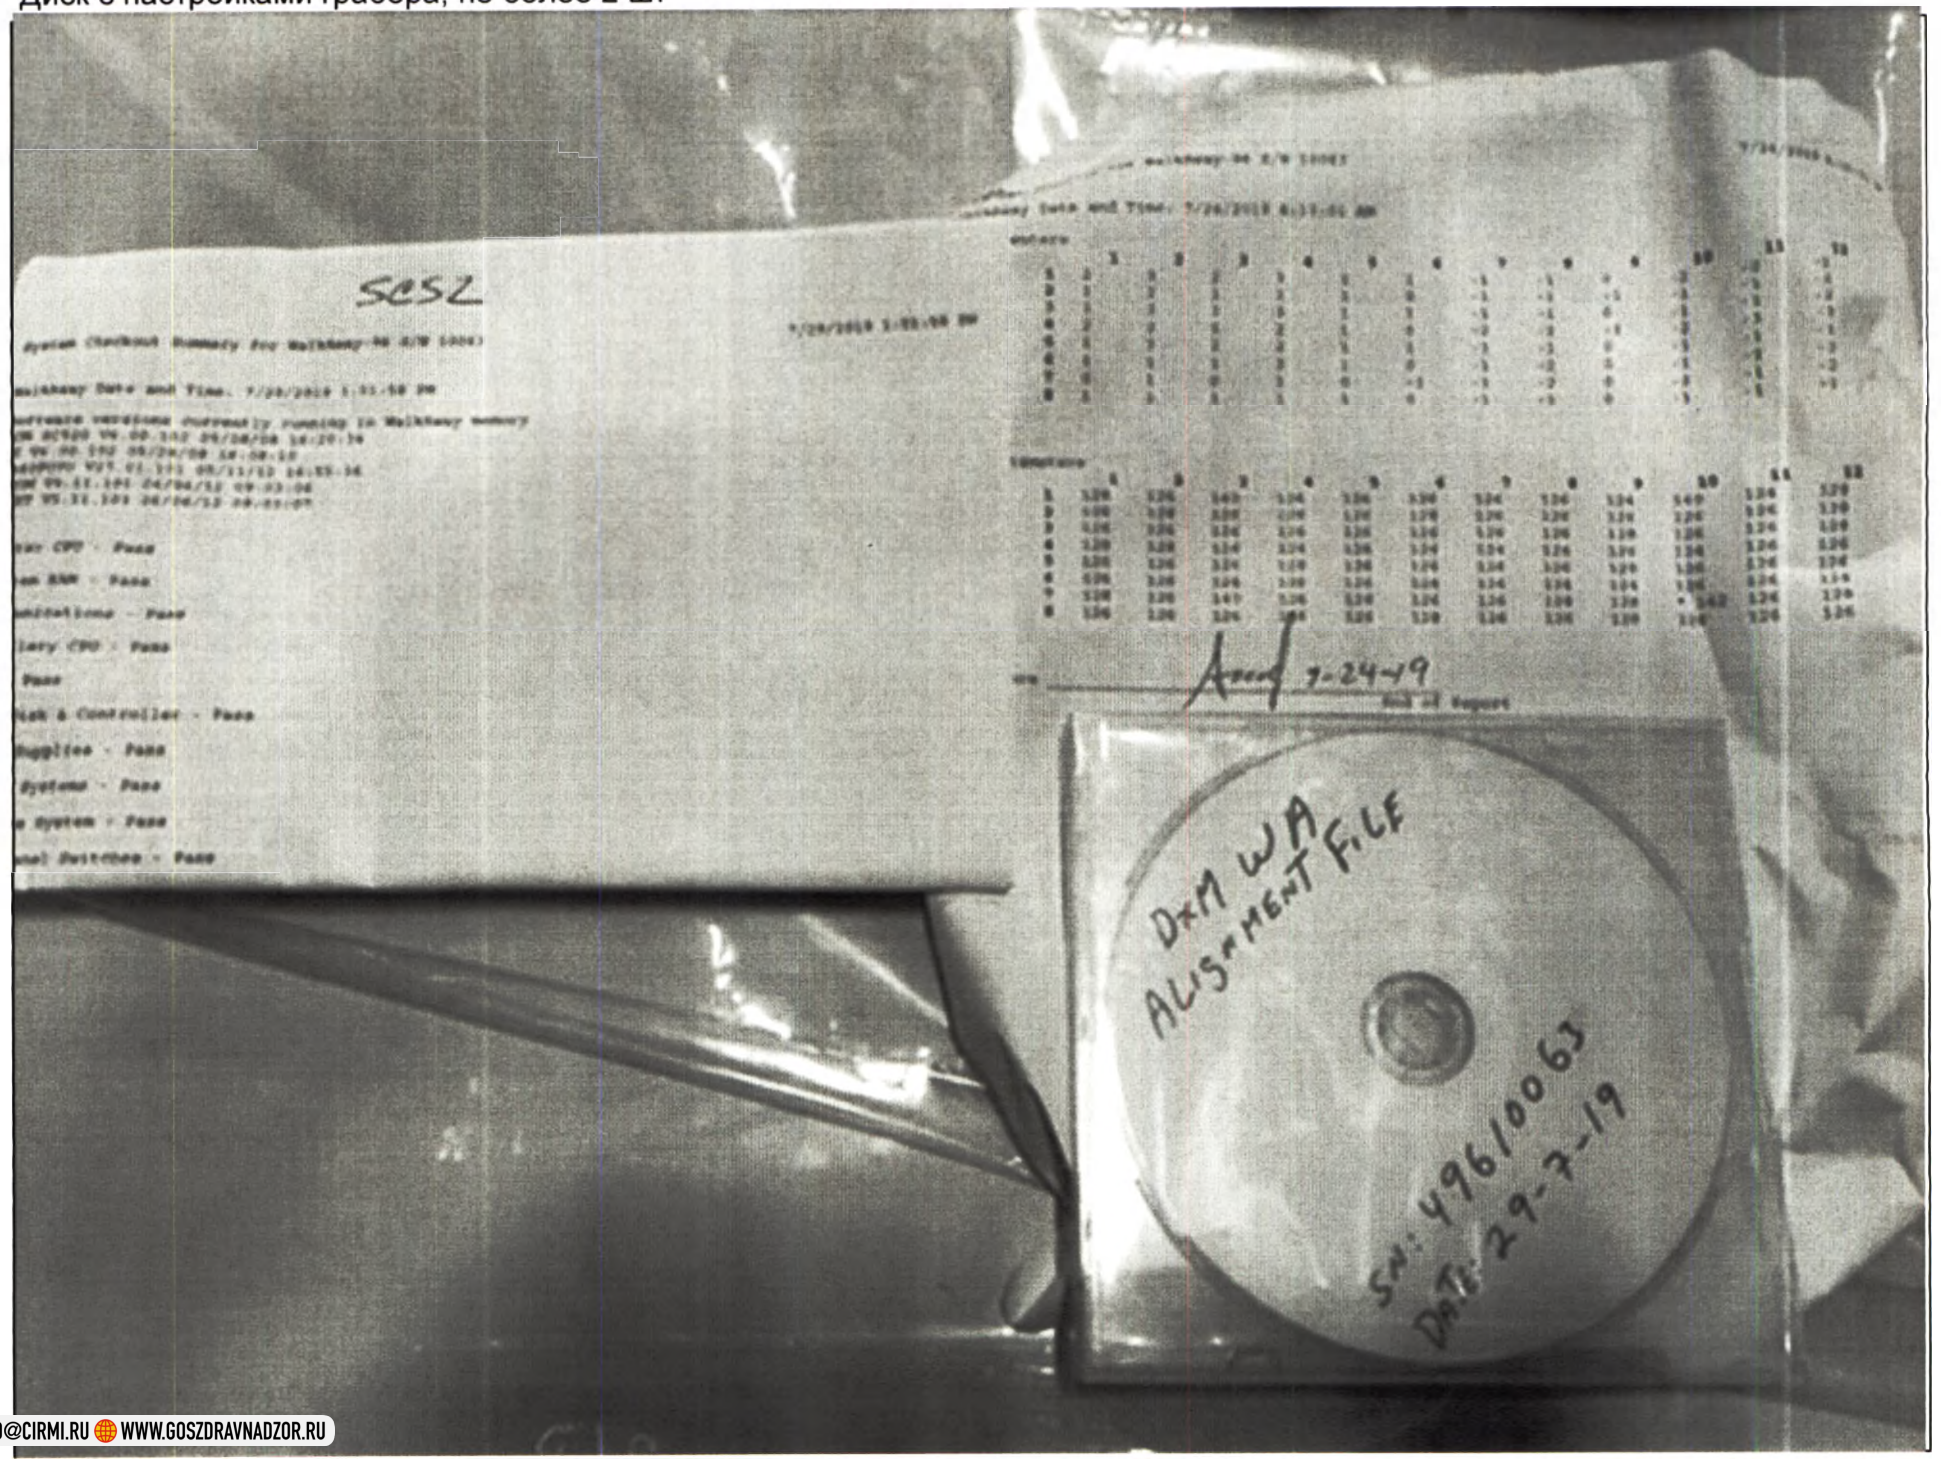

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Аналитический модуль анализатора DxM 1096 MicroScan WalkAway Instrument

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Крышки лотков для WalkAway, 240 шт./уп., не более 15 упаковок (при необходимости)

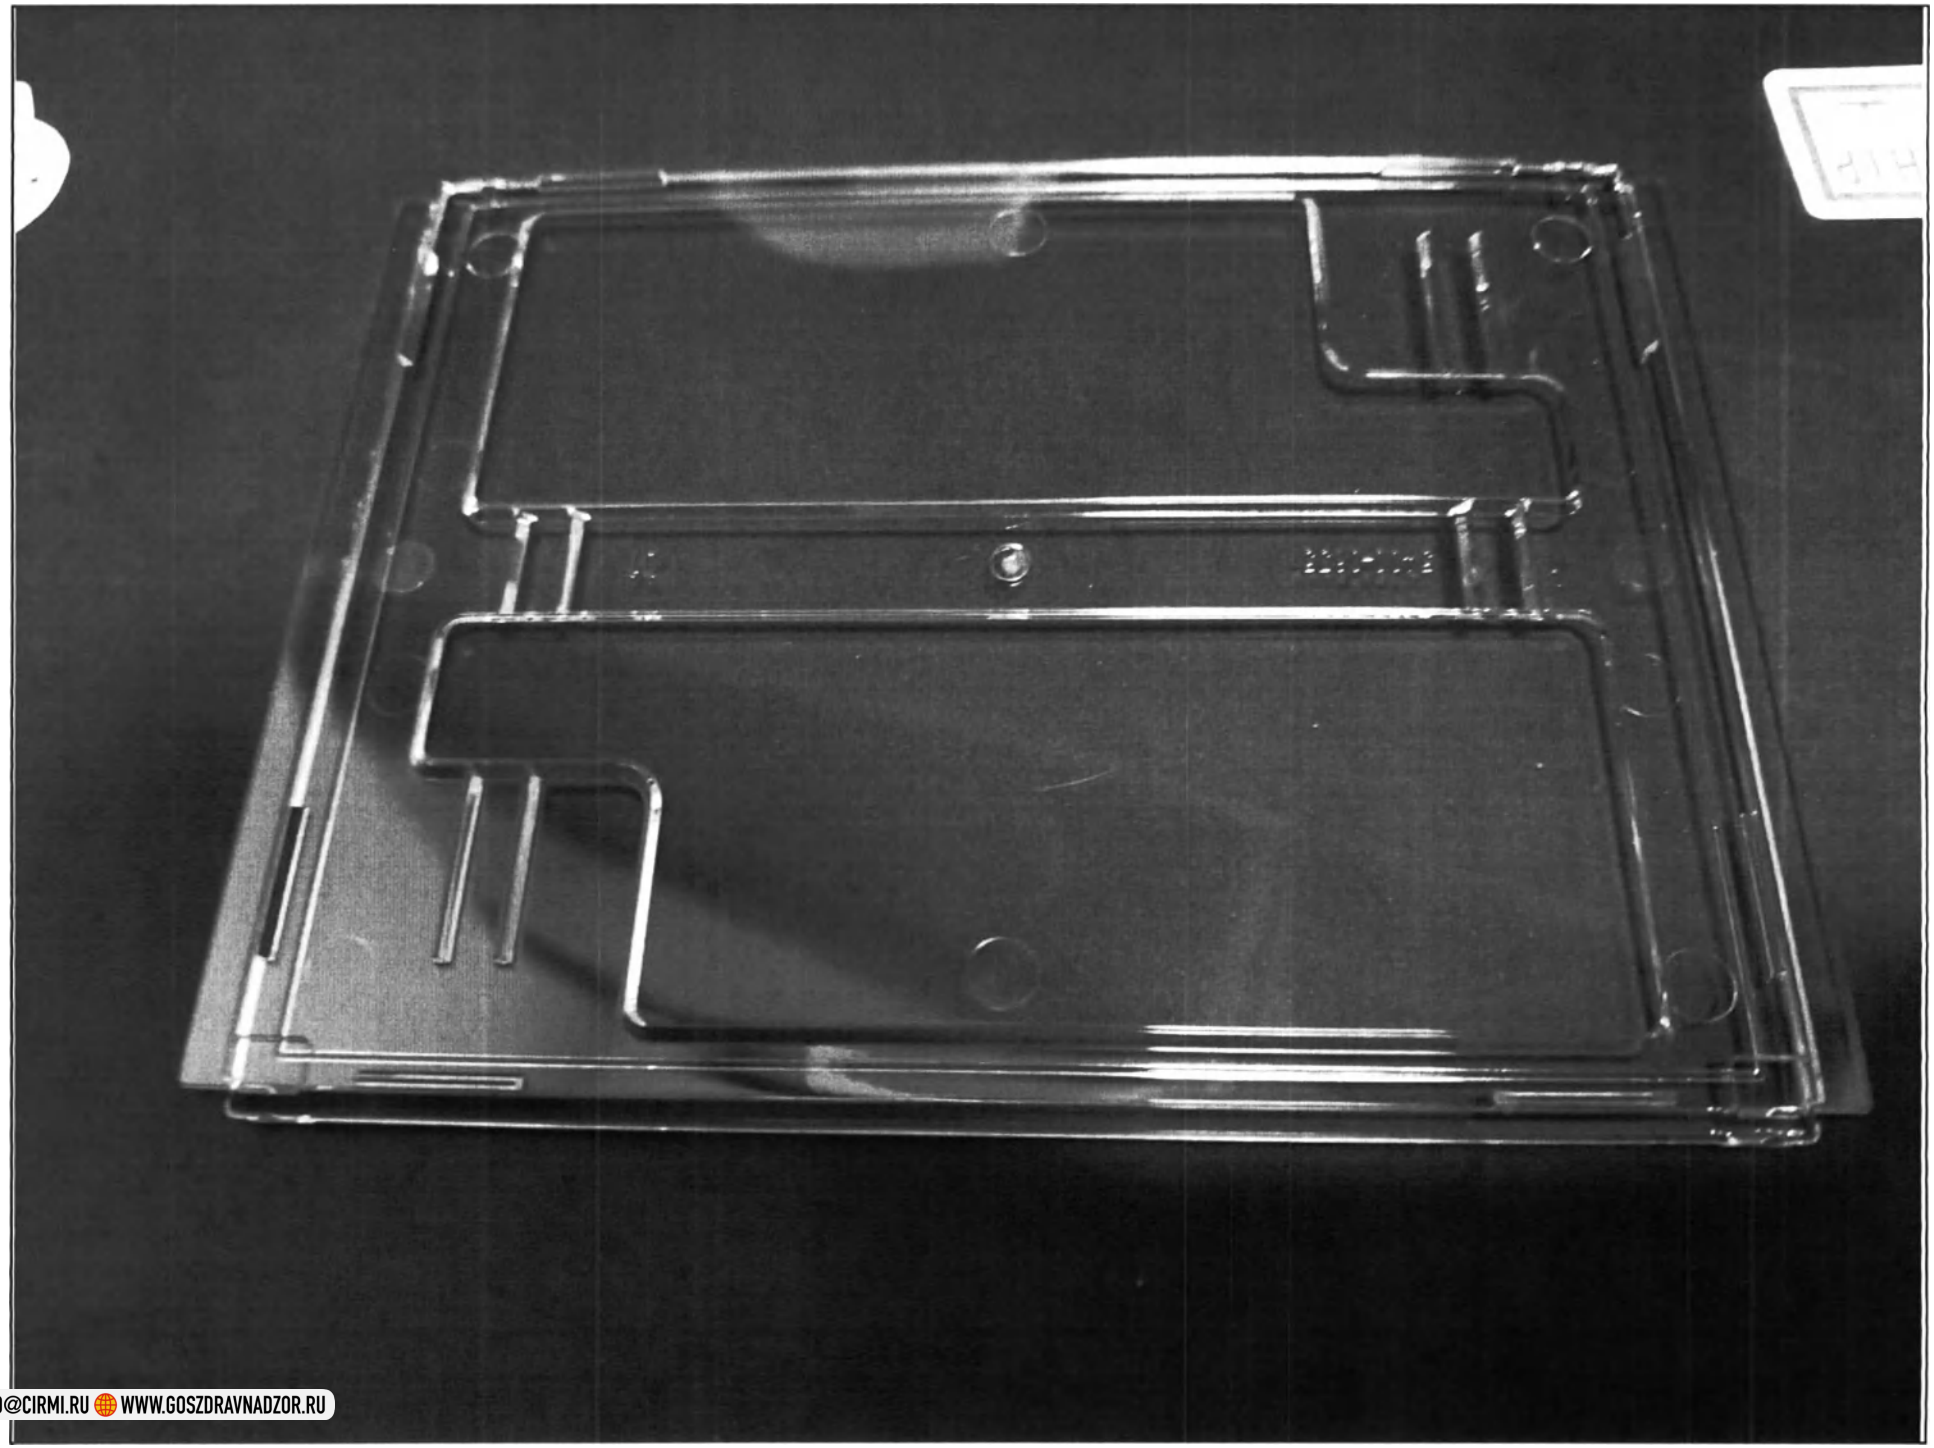

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Платы подключения питания, не более 10 шт.

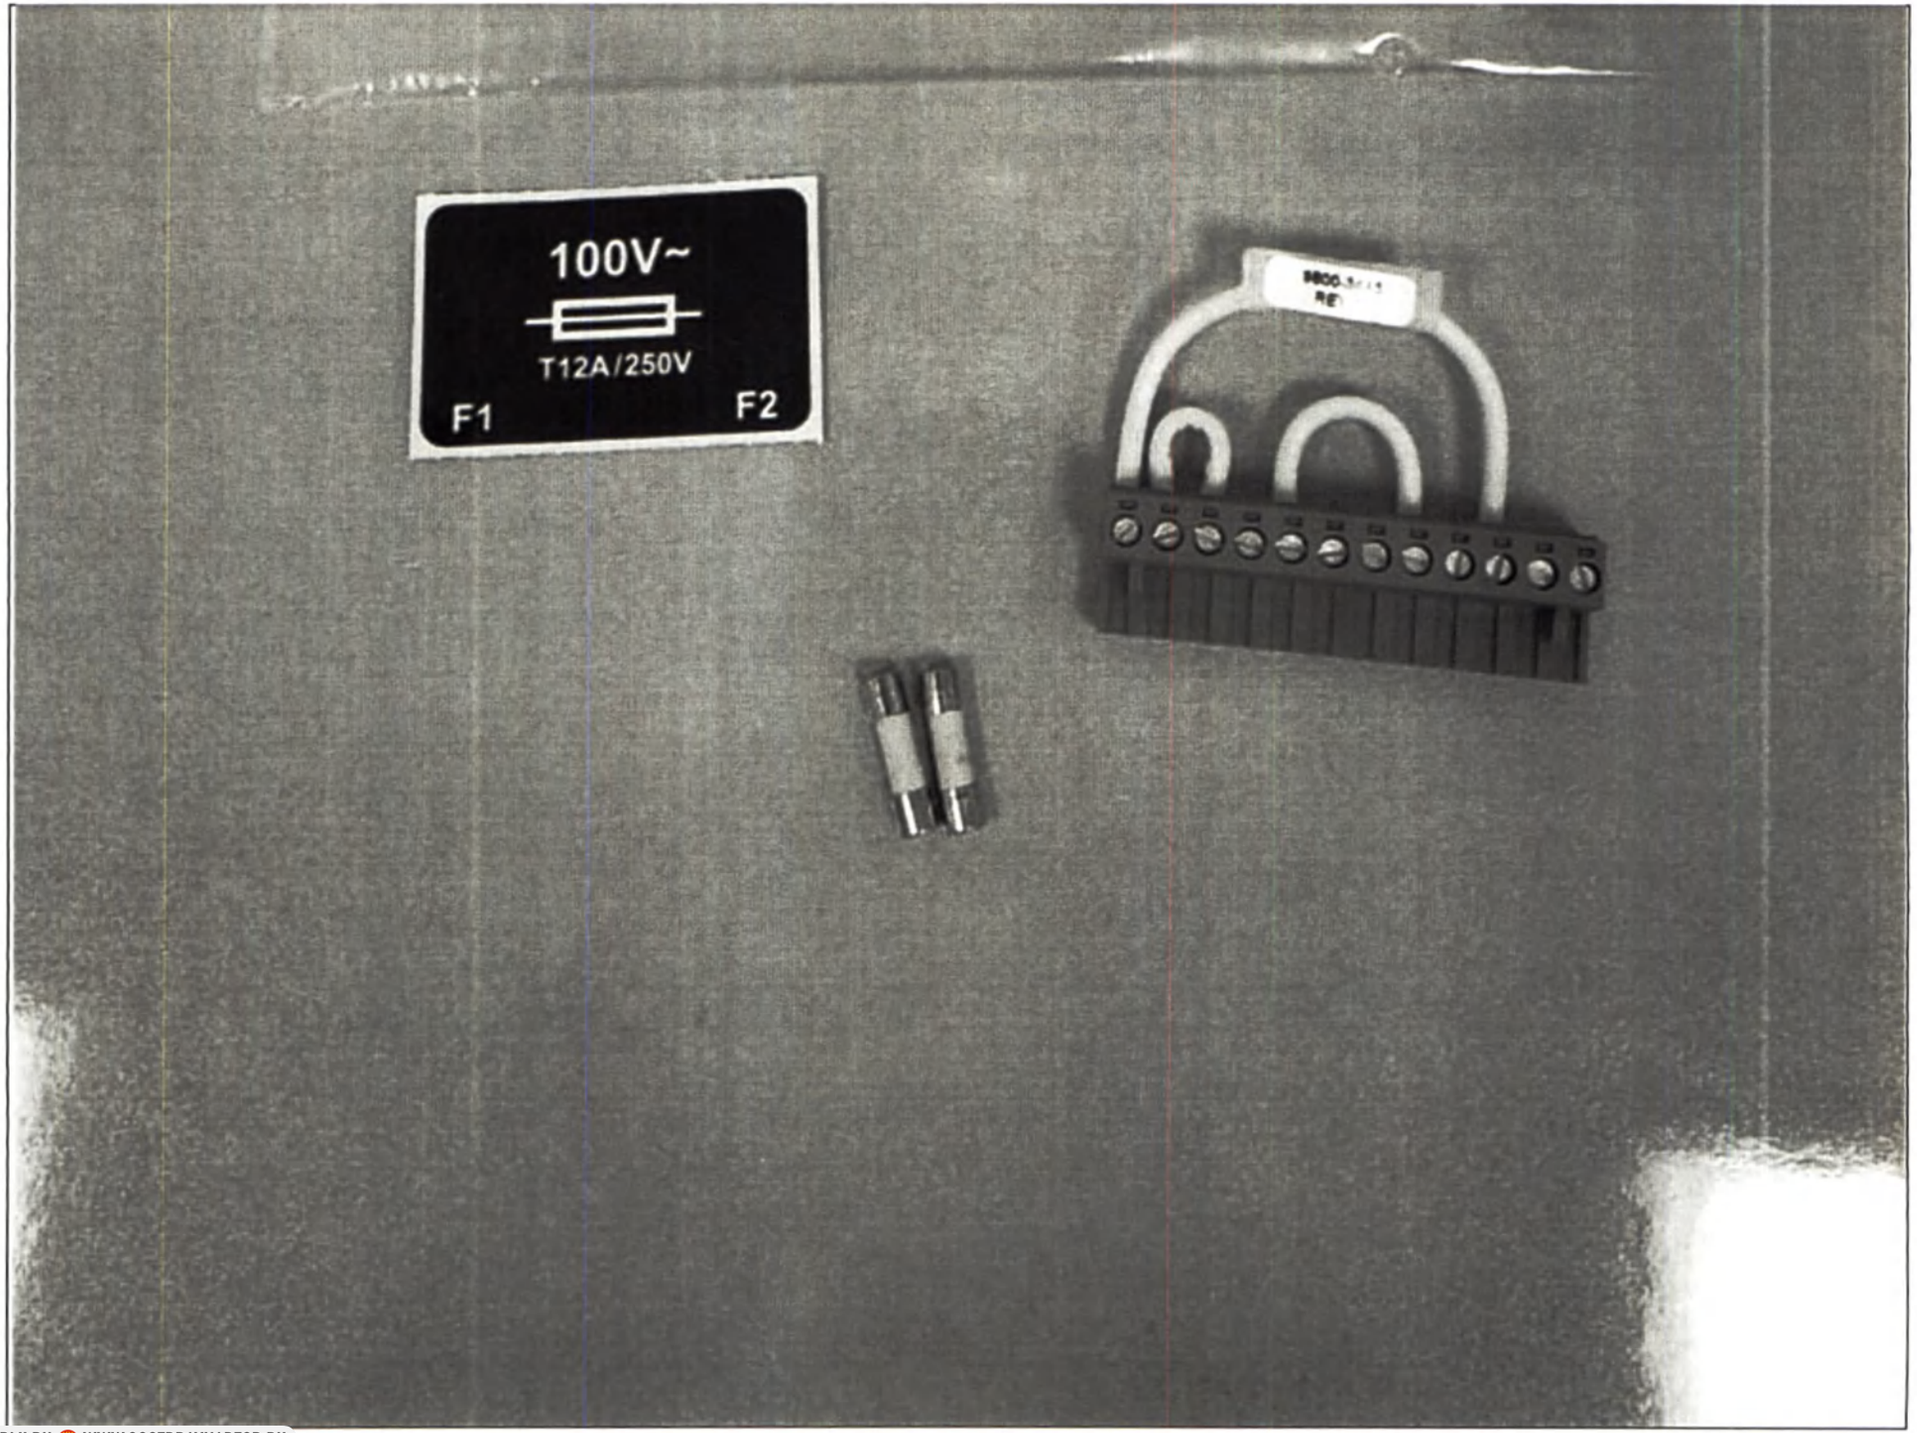

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Кабели Ethernet категории 5, не более 5 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Адаптер , не более 3 шт

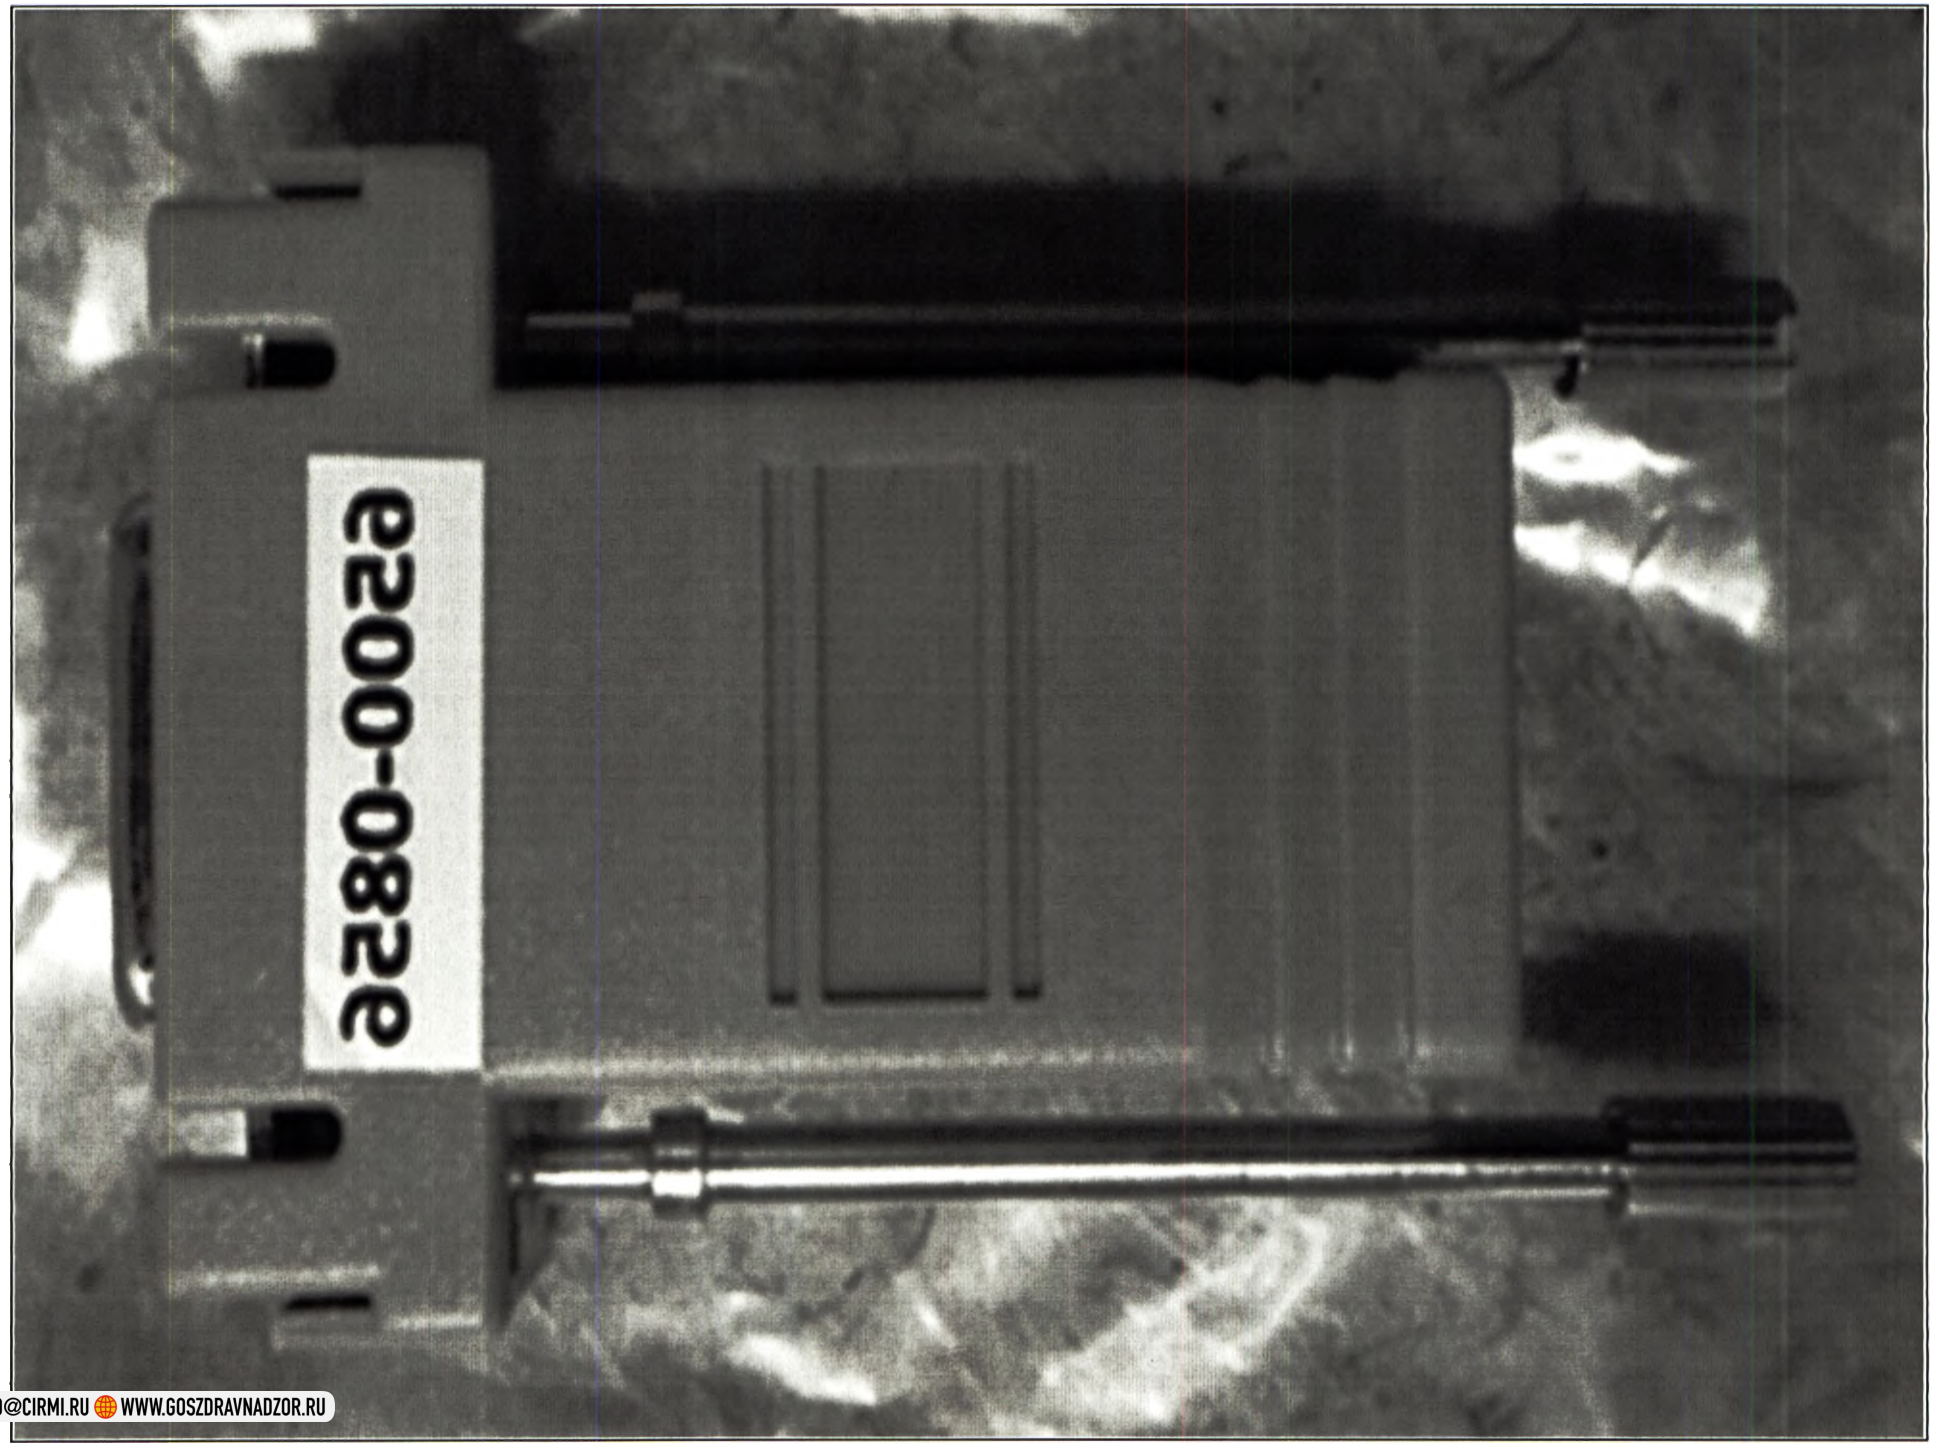

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Крышки для бутылей с реагентами, не более 10 шт.

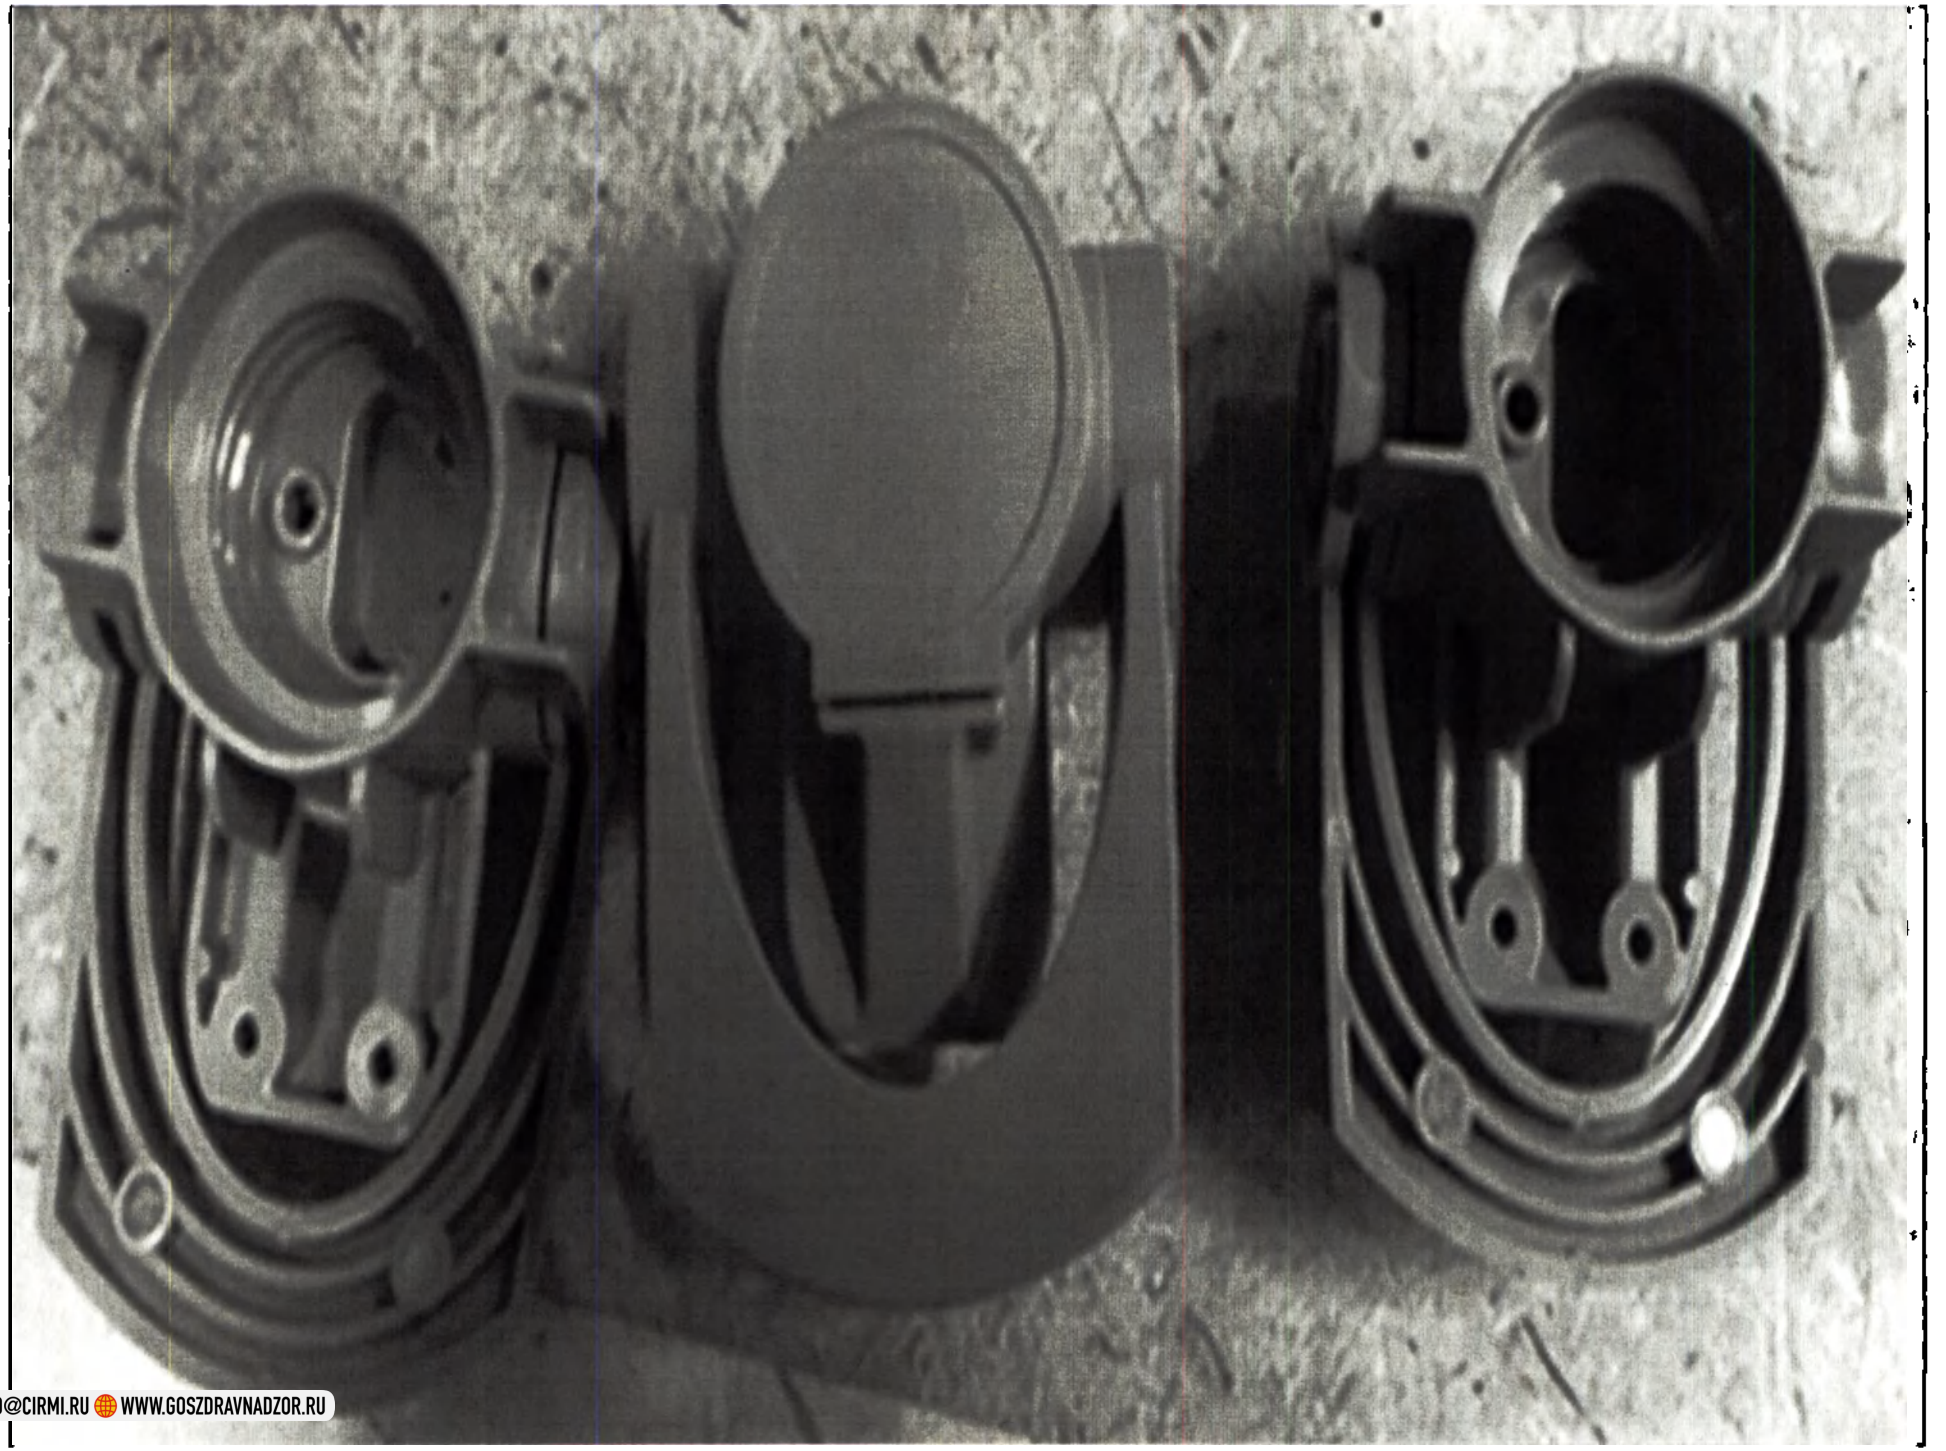

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Компакт диски в комплекте с инструкцией по установке, не более 5 шт

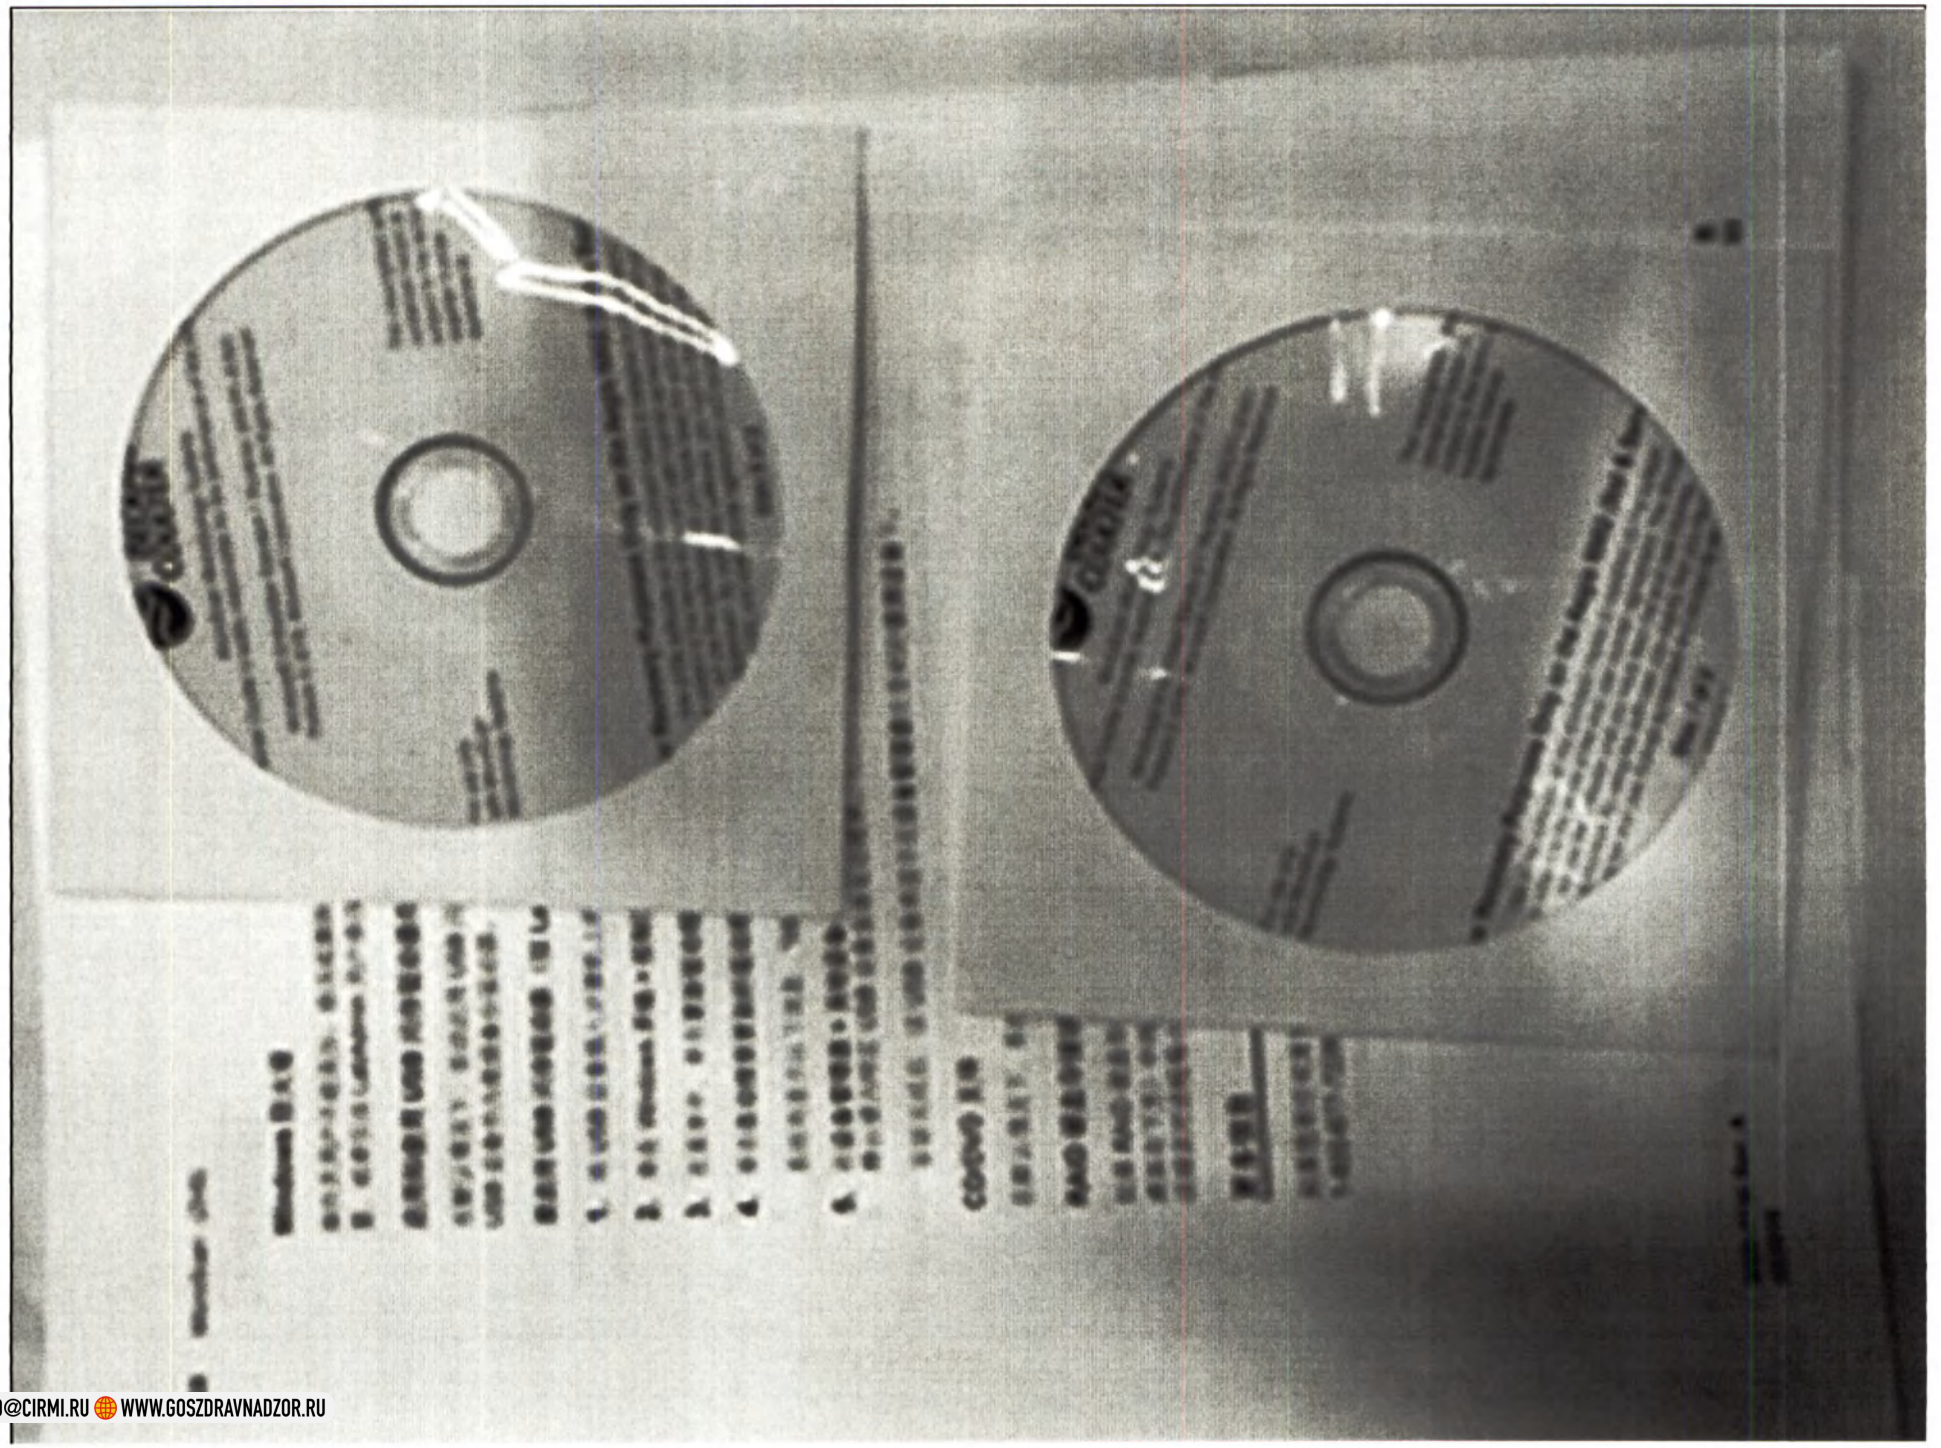

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Переходник

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Набор для обслуживания системы раскапывания реагентов, в составе: Сальник ёмкости (30 мл) для реагента, не более 60 шт.;

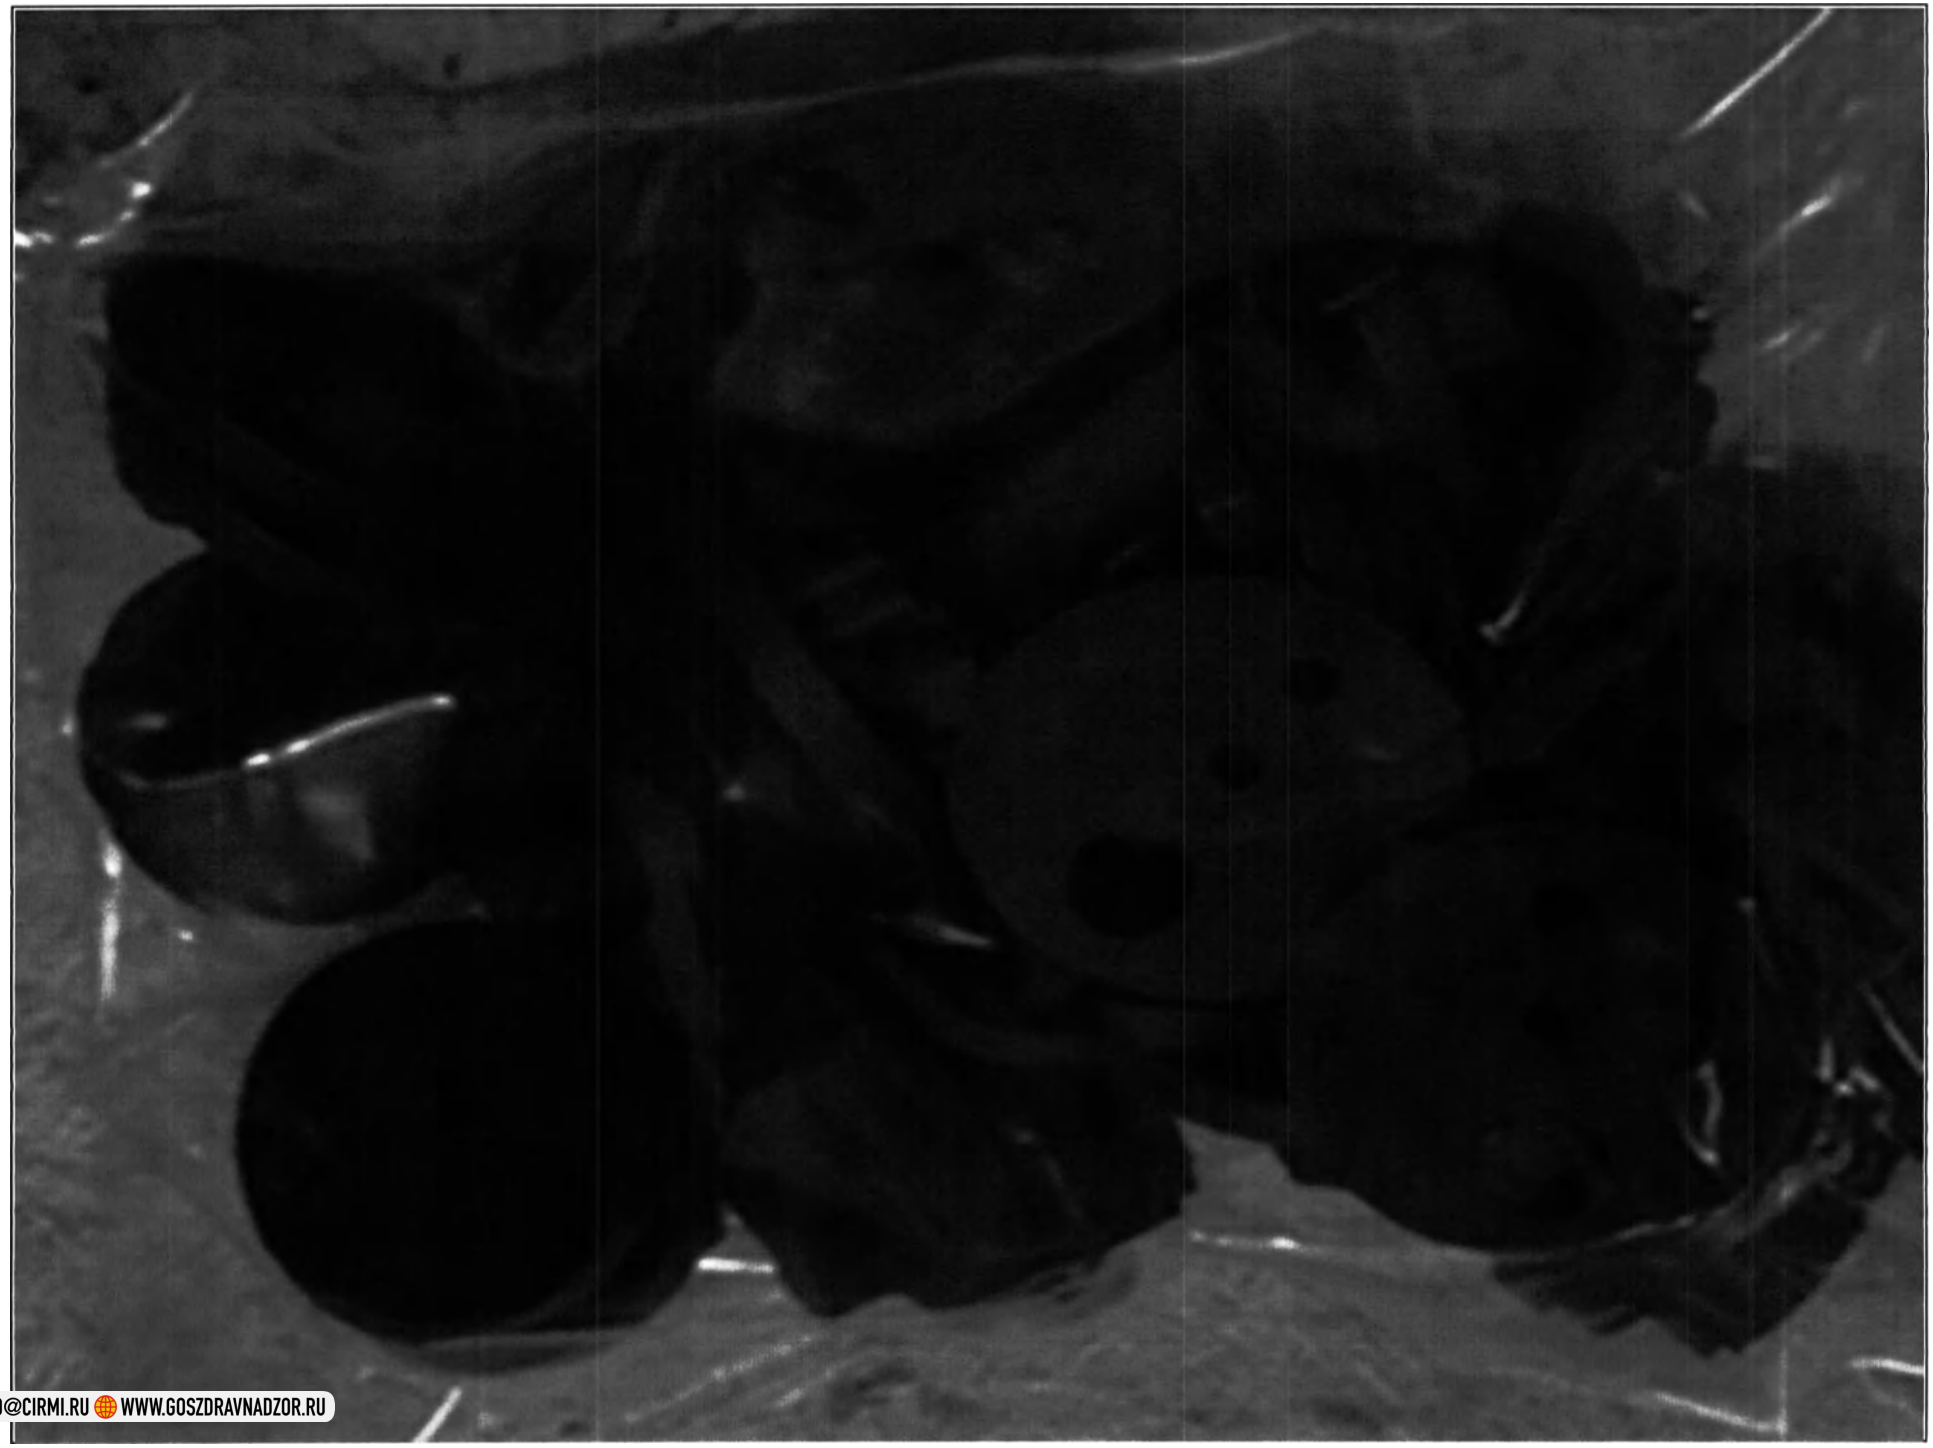

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Набор для обслуживания системы раскапывания реагентов, в составе: Сальник ёмкости (60 мл) для реагента, не более 60 шт.;

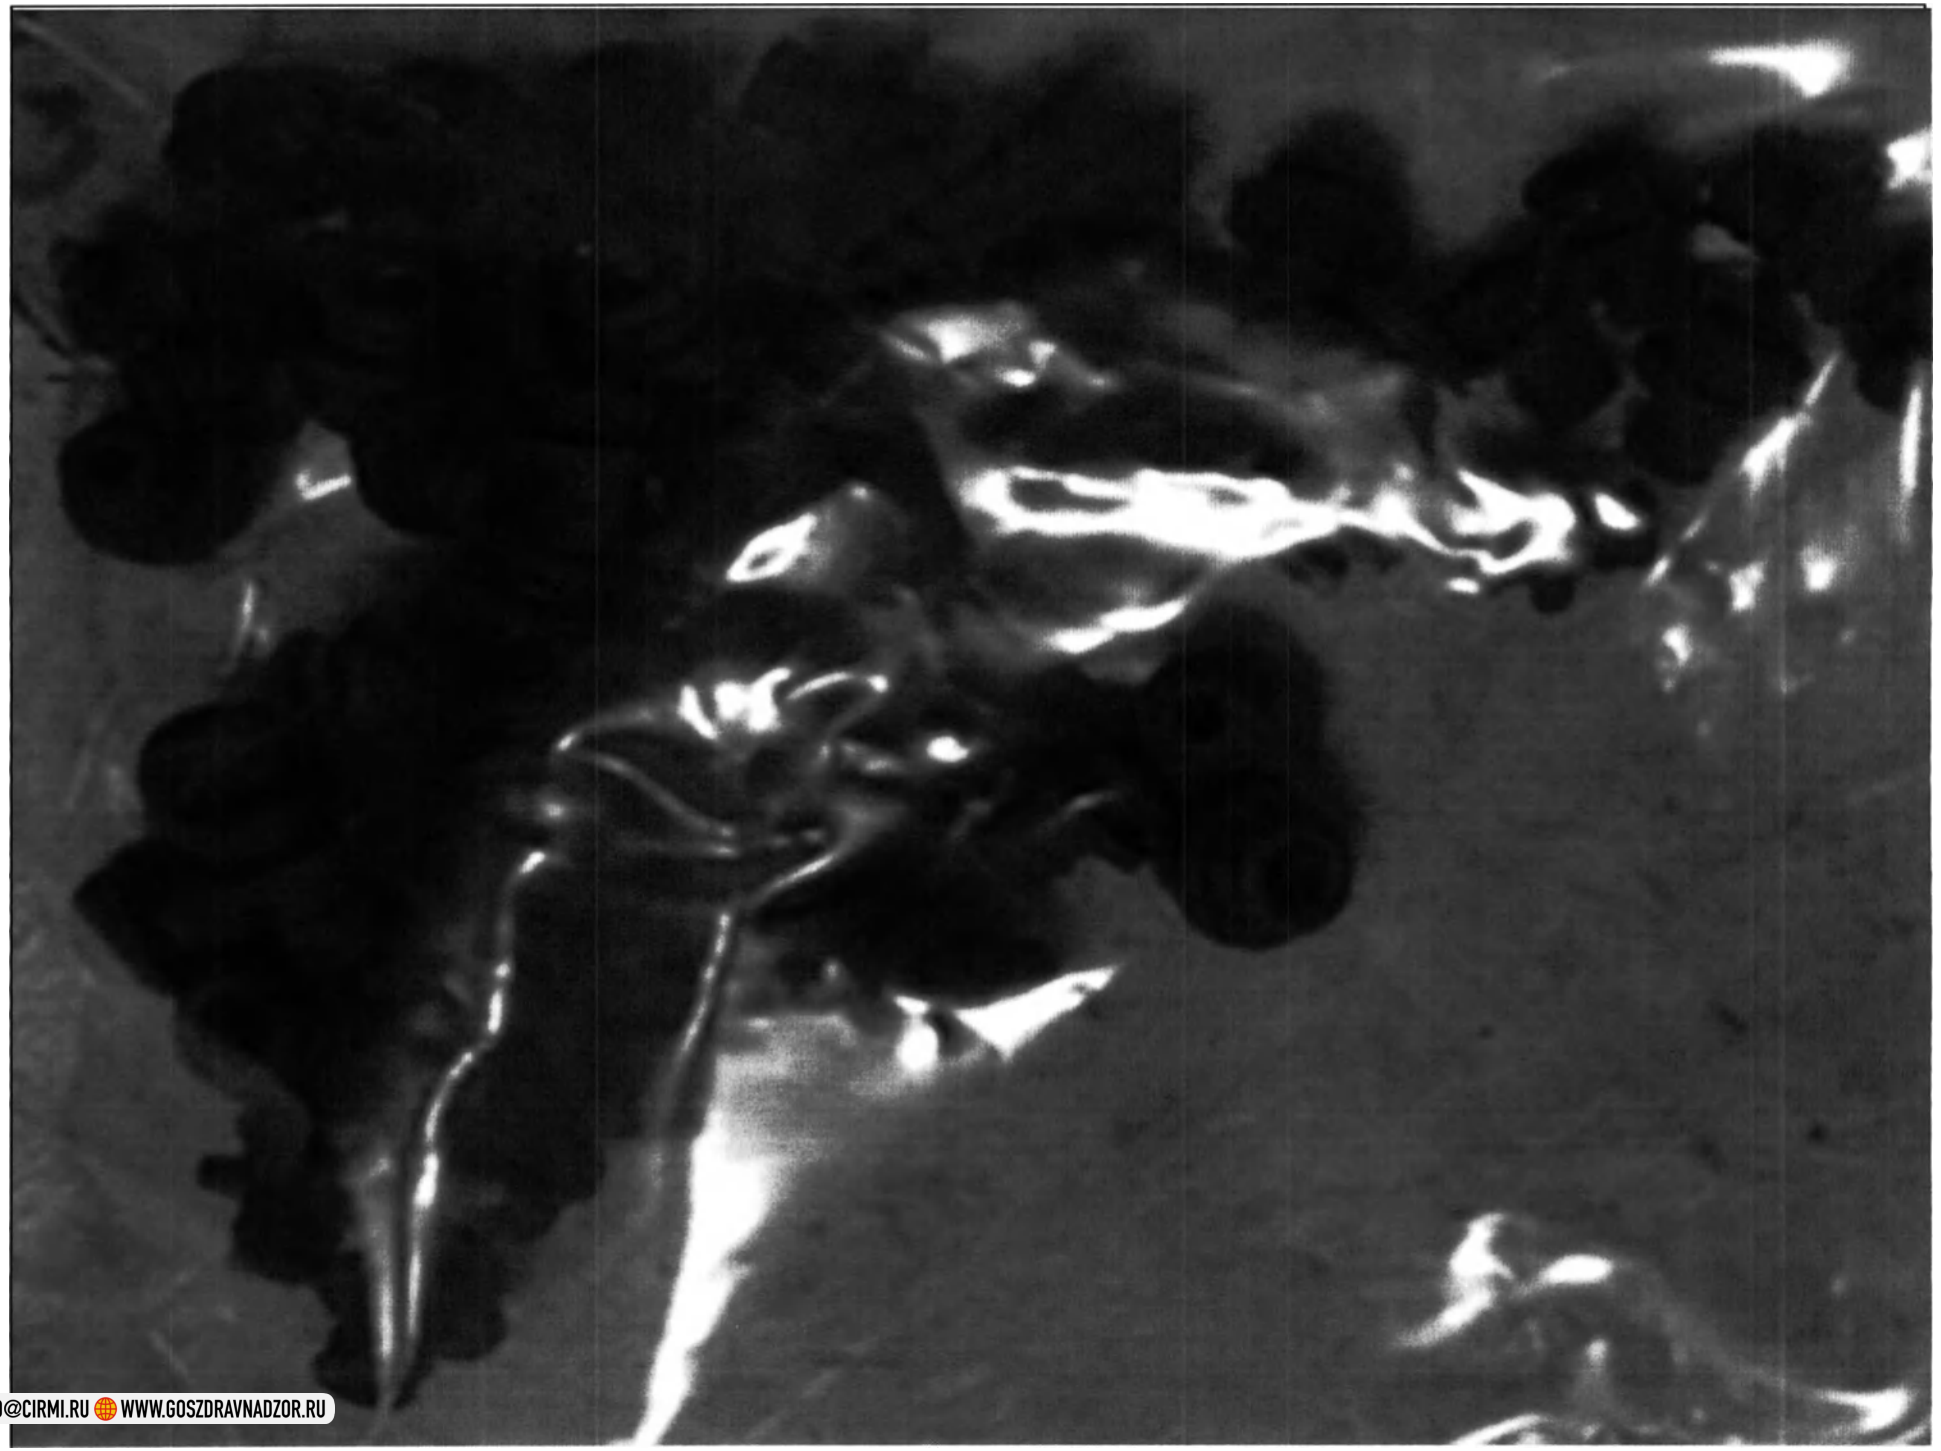

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Набор для обслуживания системы раскапывания реагентов, в составе: Кольца для крышки к флаконам с реагентами, не более 120 шт.

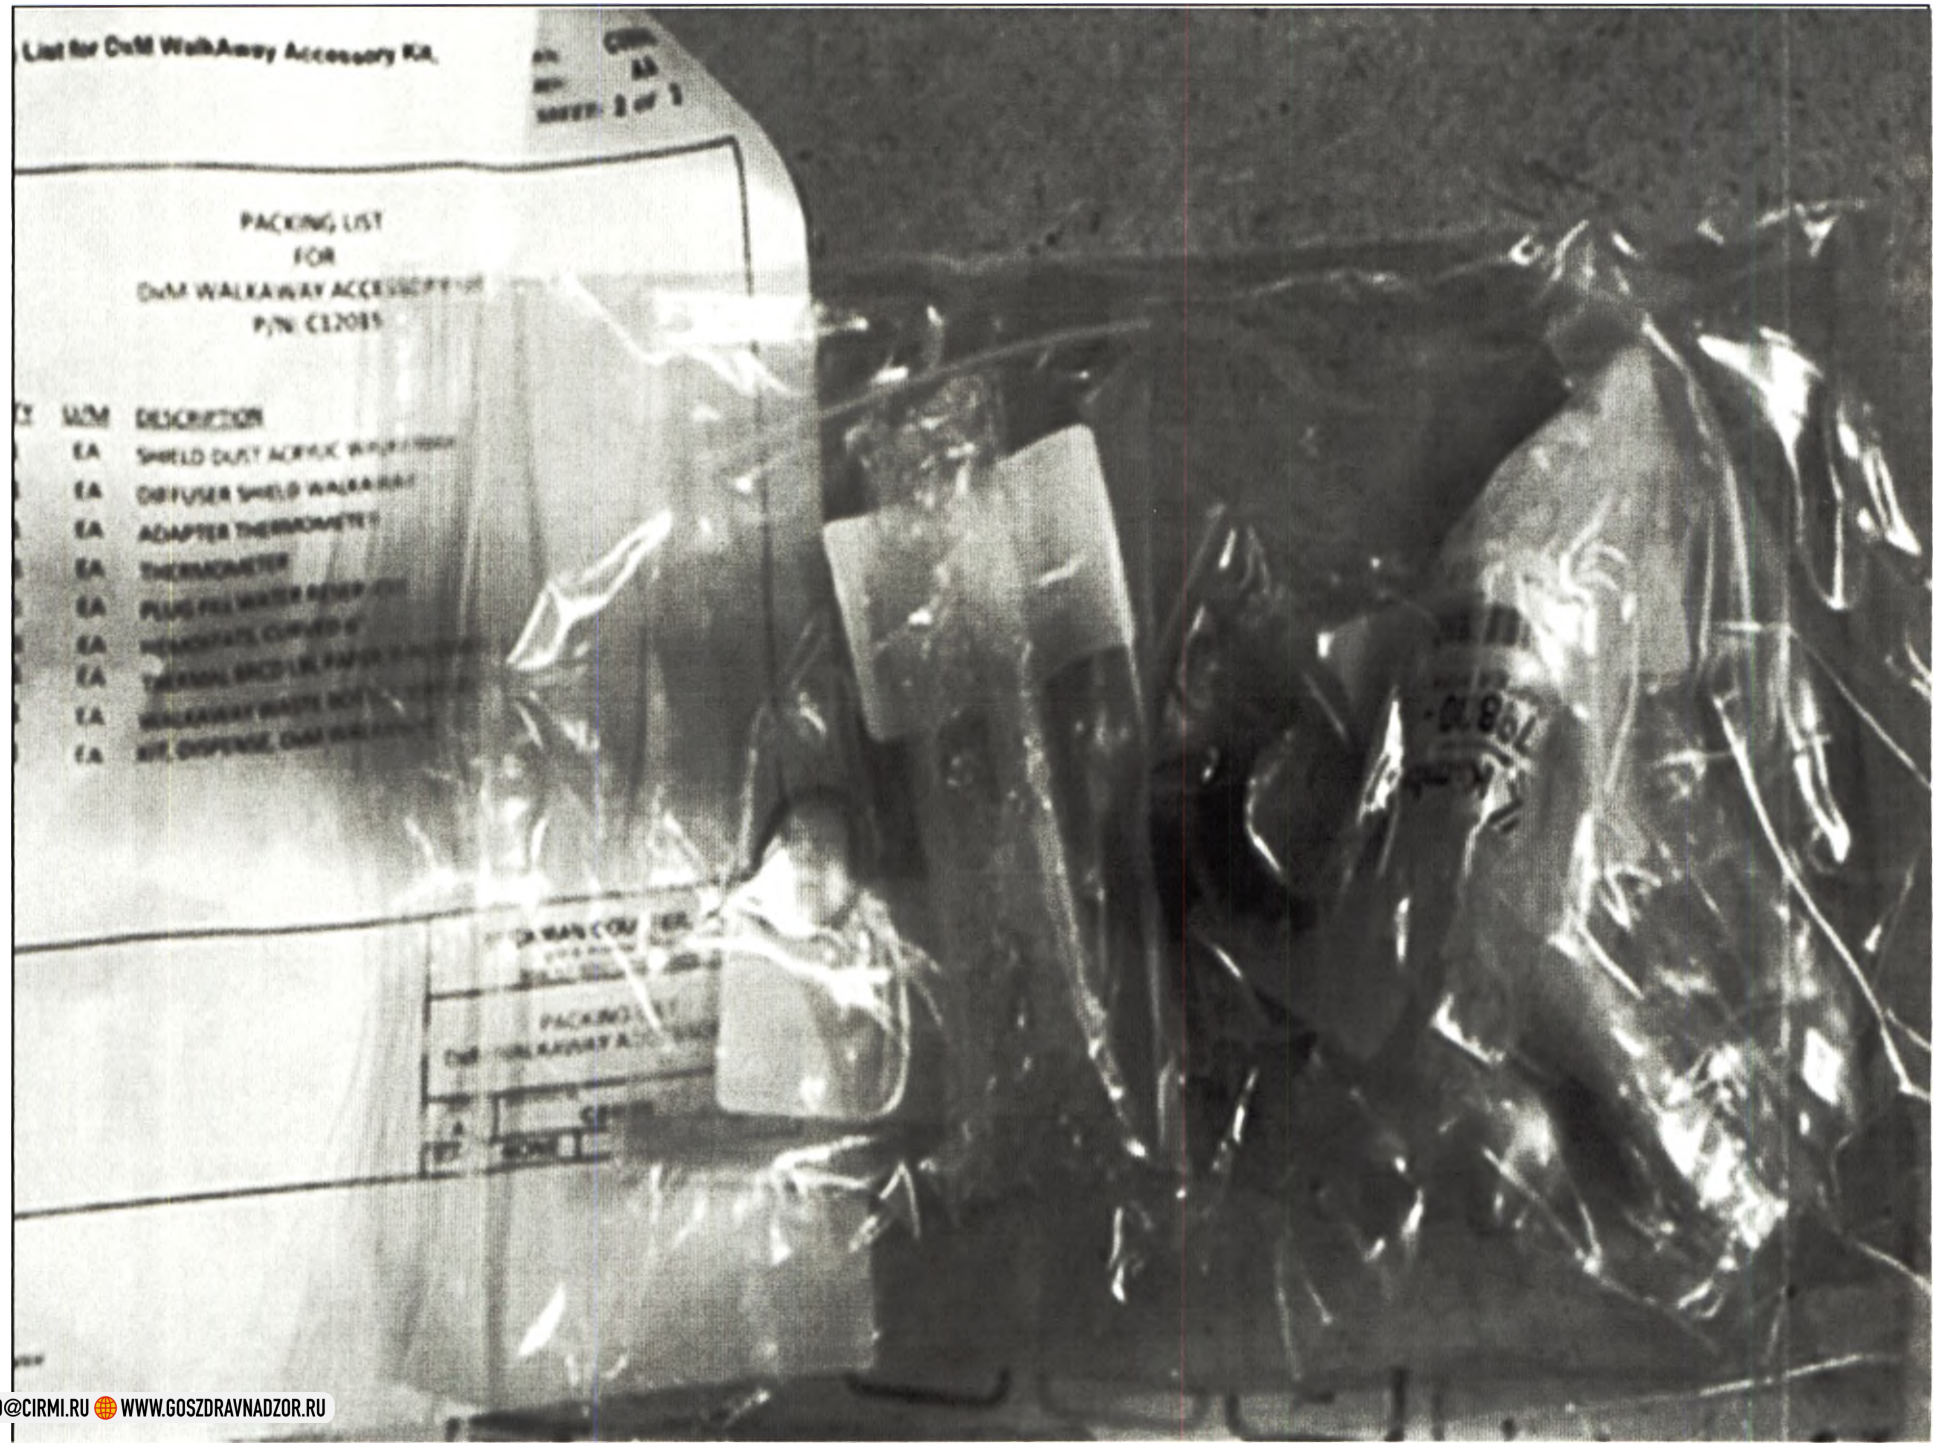

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Принтер для печати штрих-кодов в комплекте с сетевыми кабелями, не более 8-х шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Компьютер в сборке, в составе: Монитор, Клавиатура, Мышь

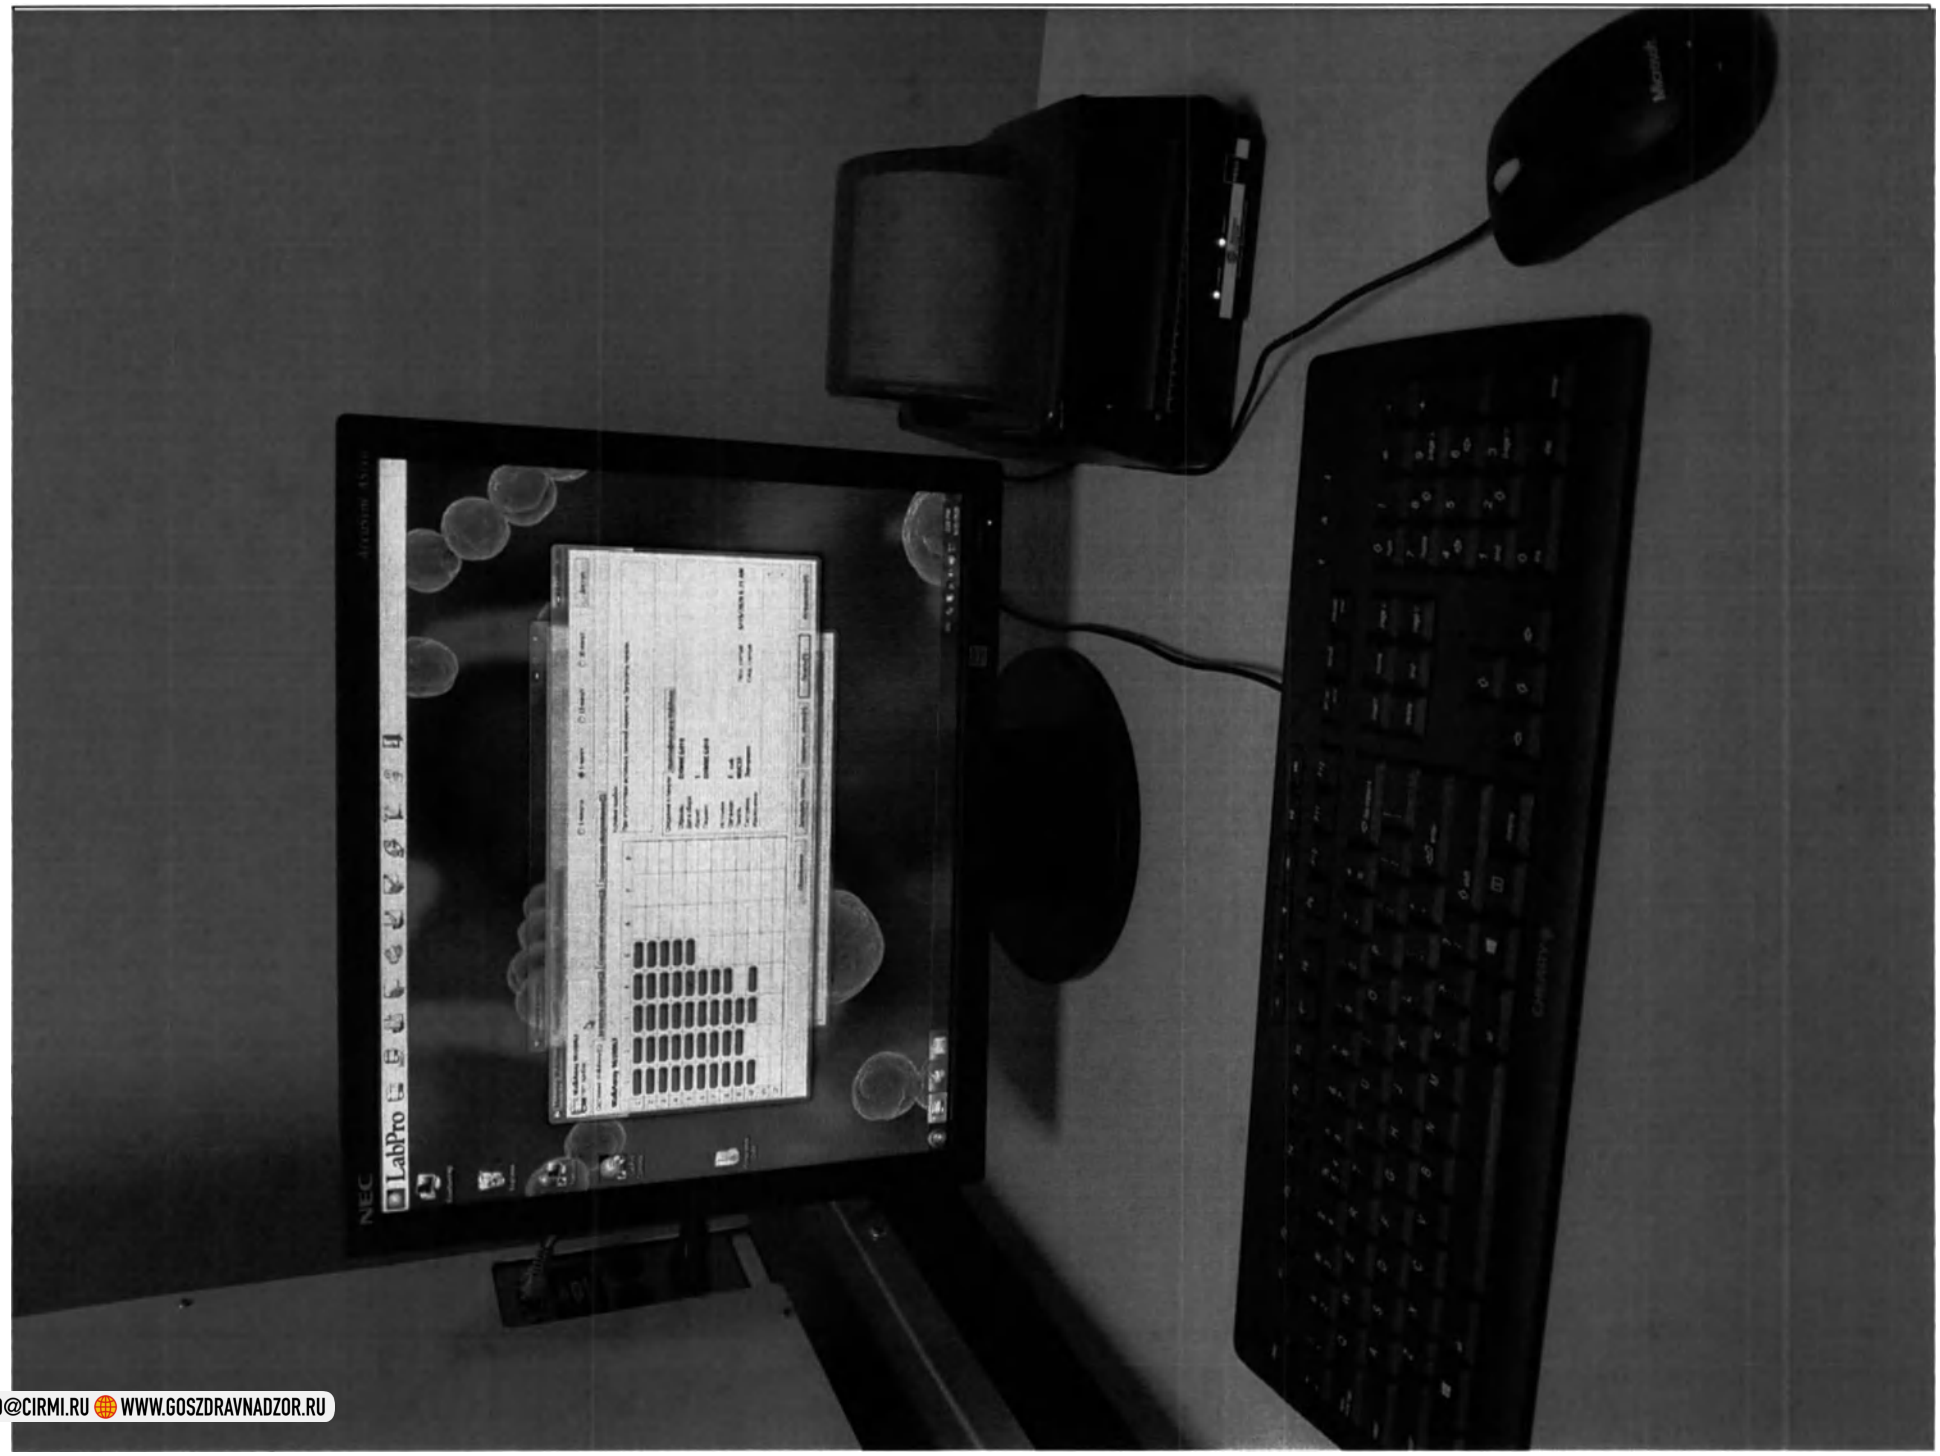

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Компьютер в сборке, в составе: Системный блок

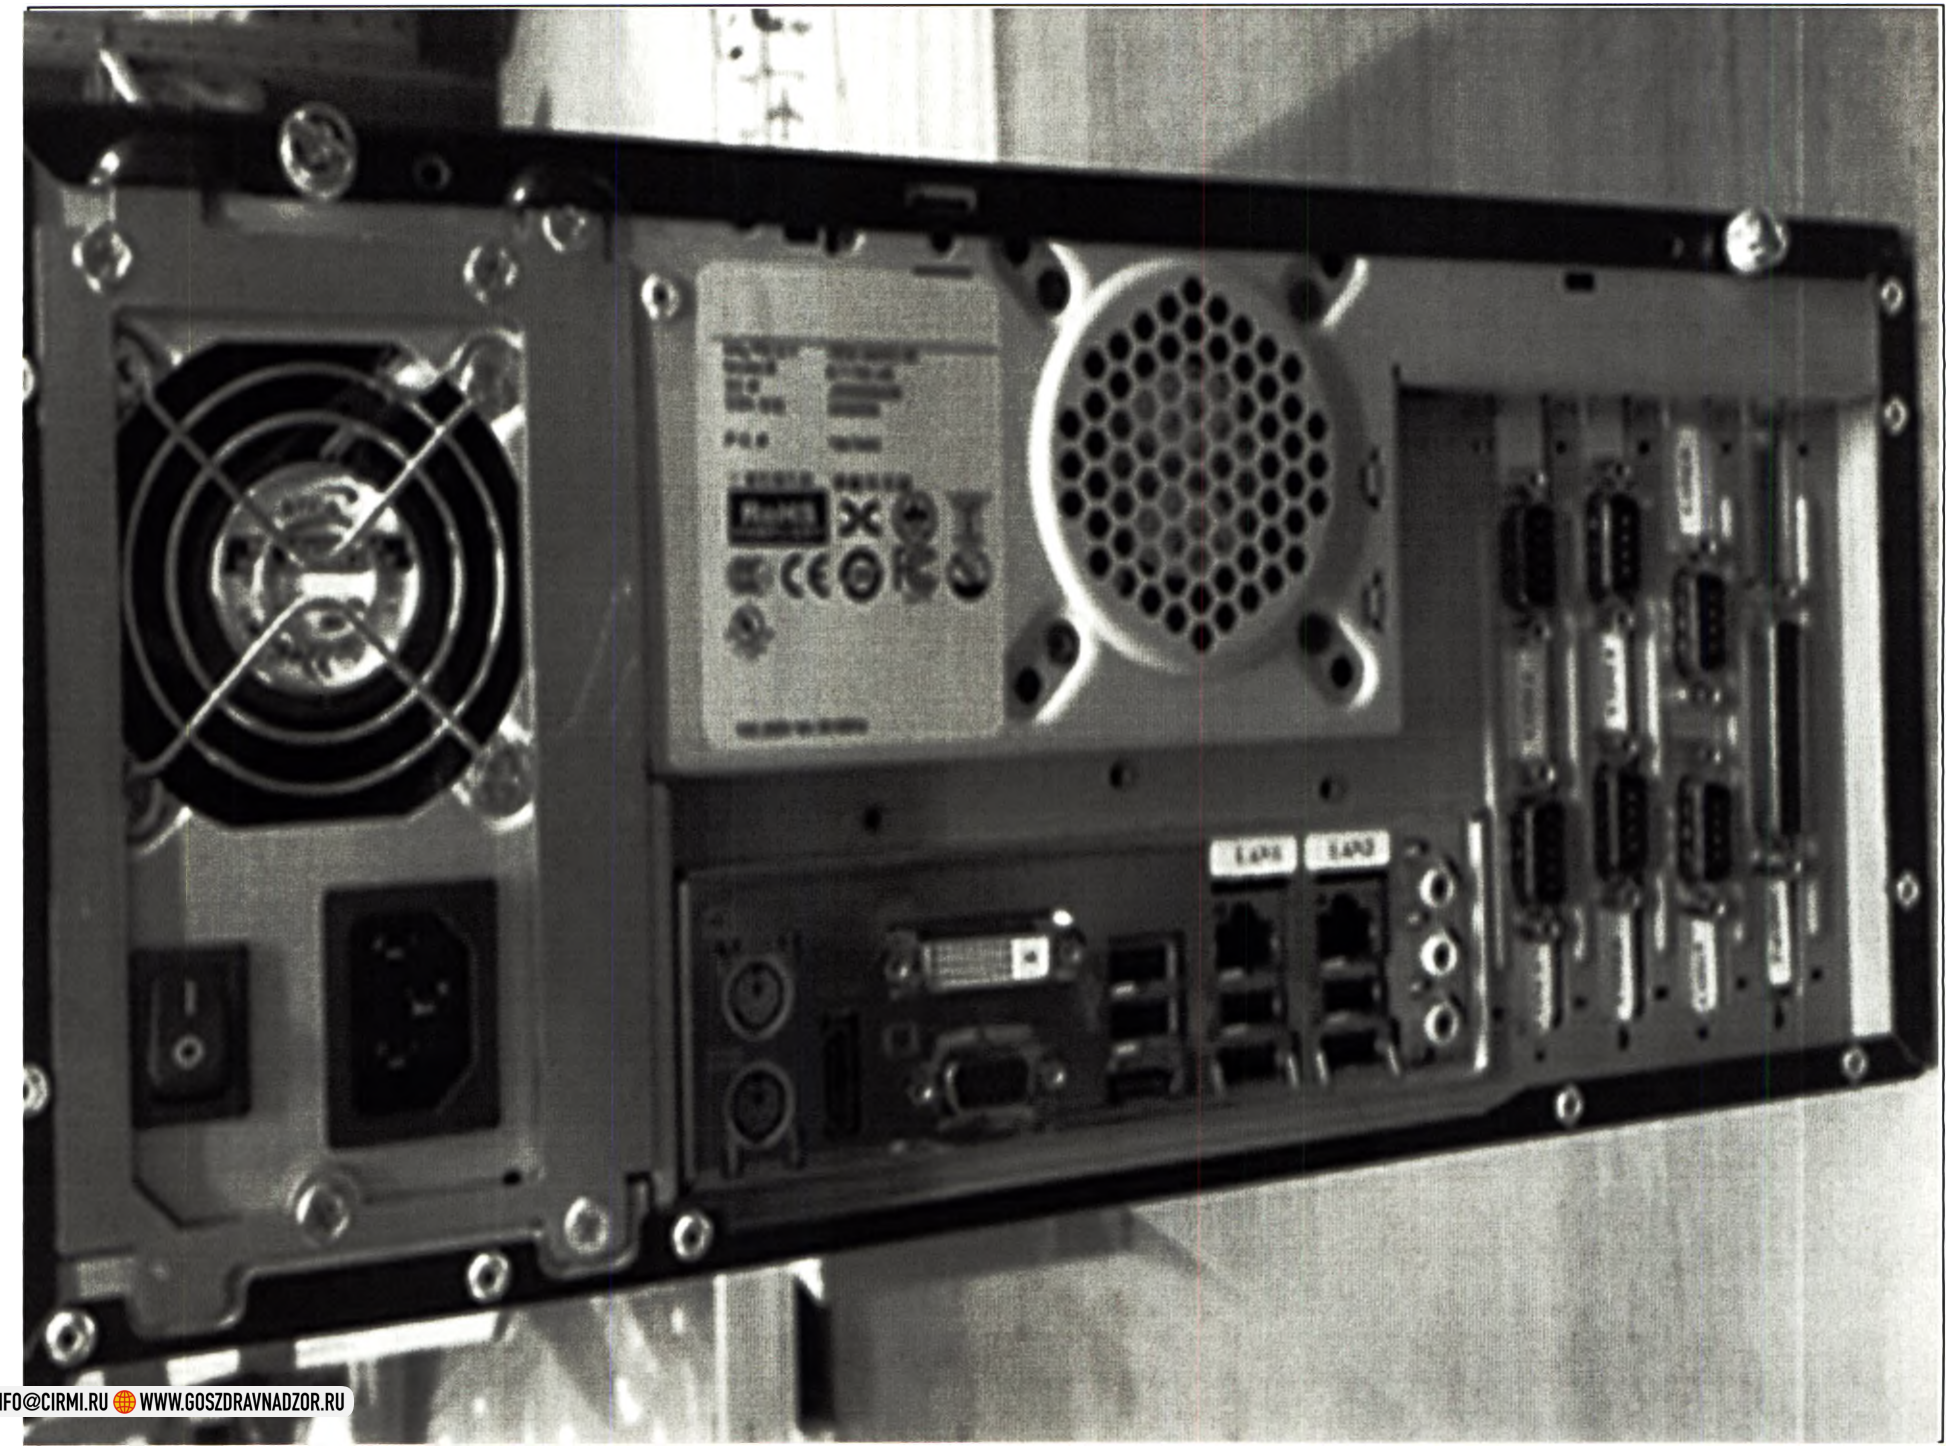

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

MicroScan Турбидиметр, в составе: Измеритель мутности, адаптеры питания, не более 3 шт.

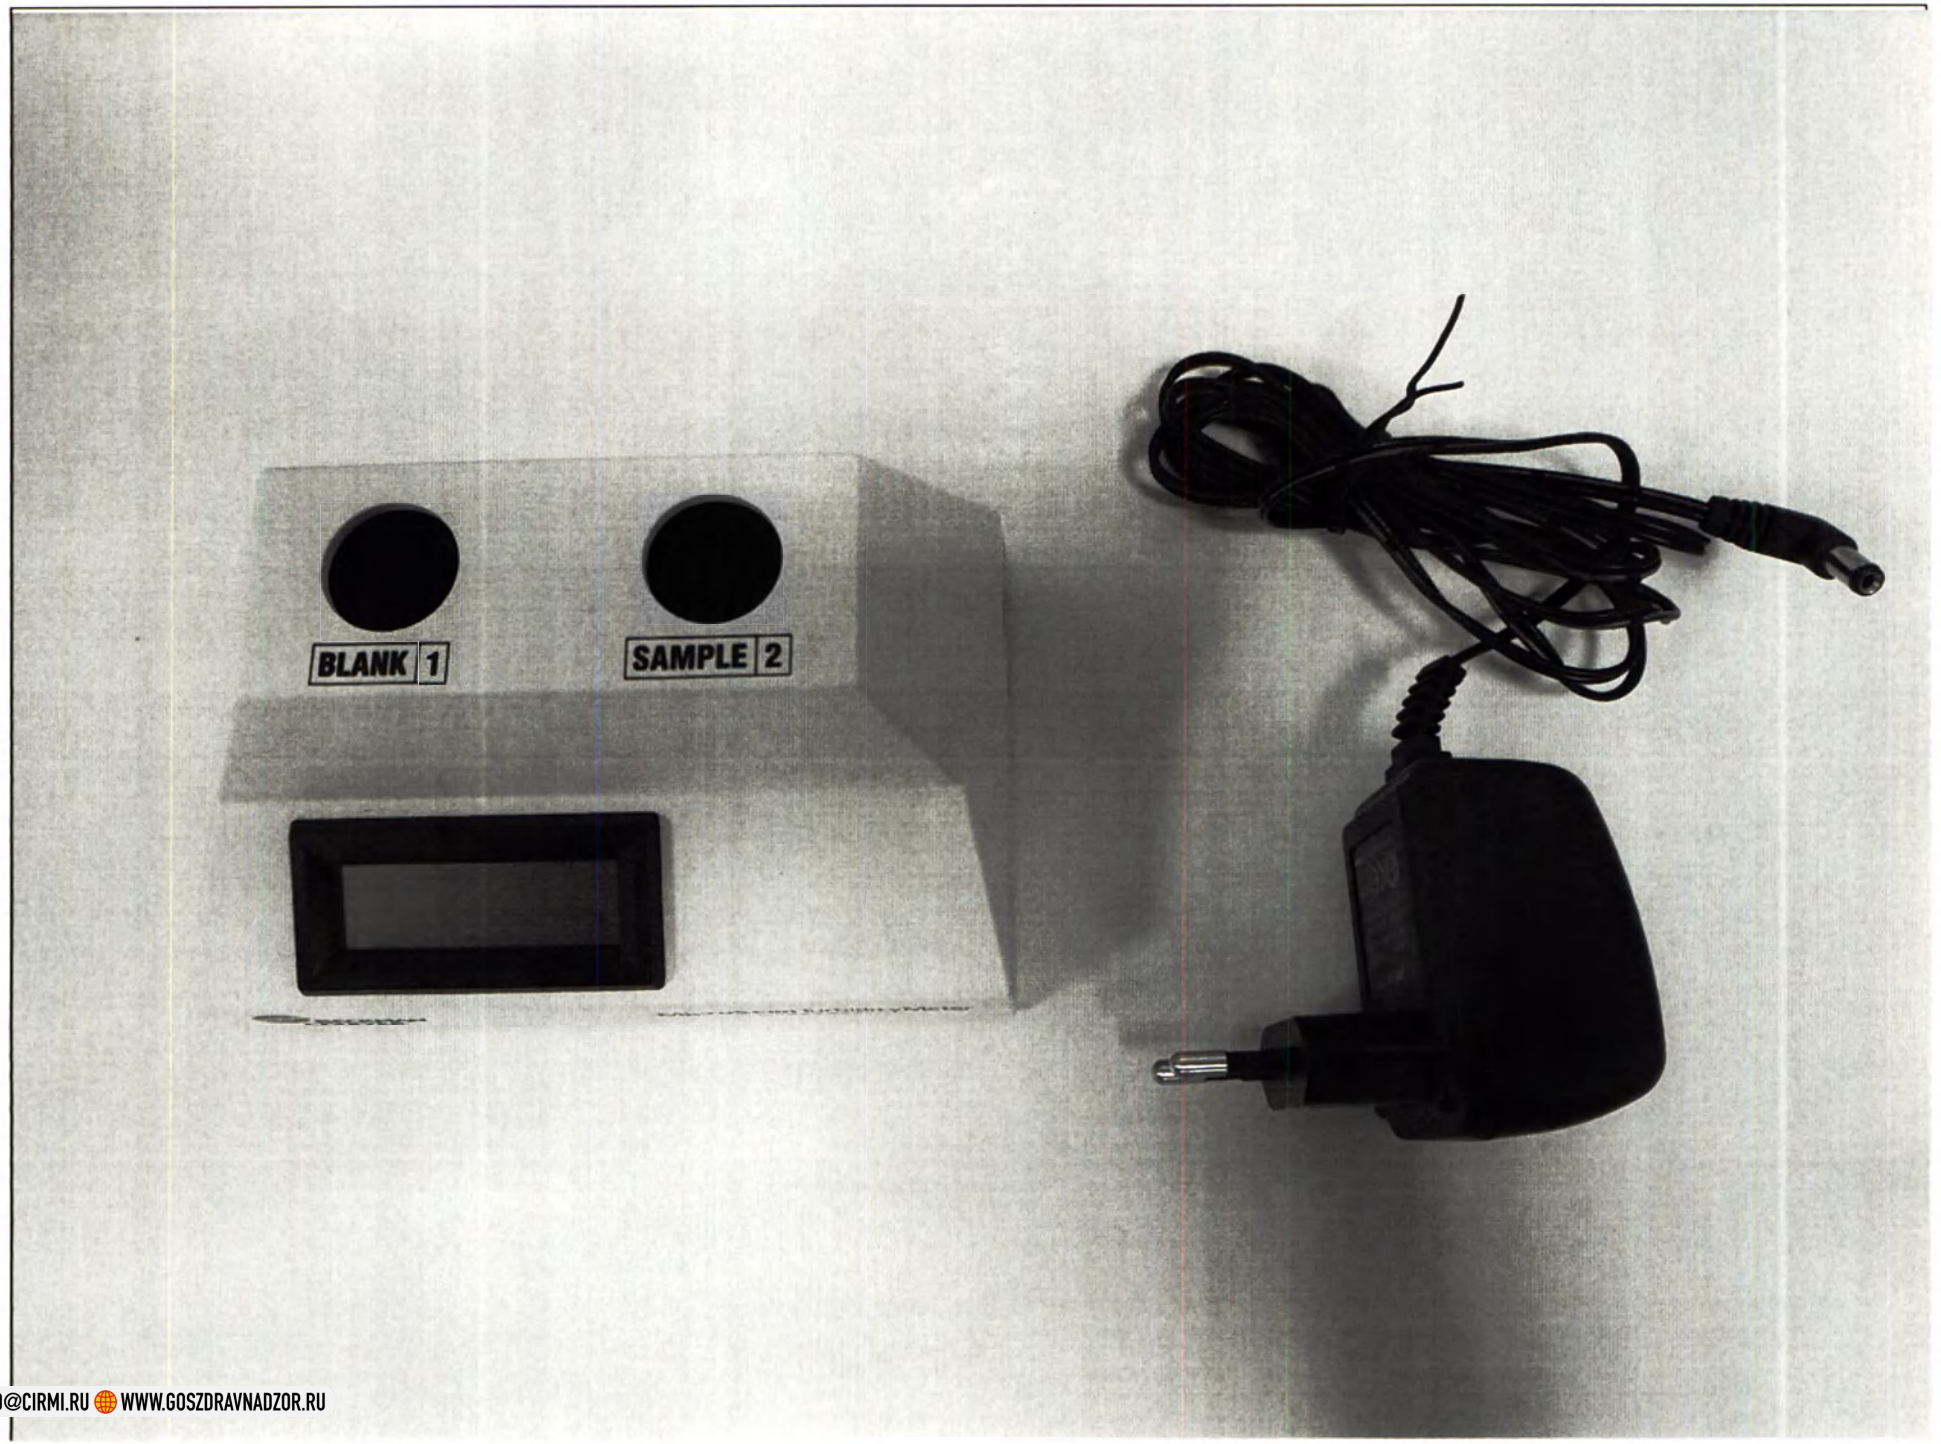

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пипетка многоканальная Renok, в составе: пипетка многоканальная RENOK, базаруководство пользователя по Renok

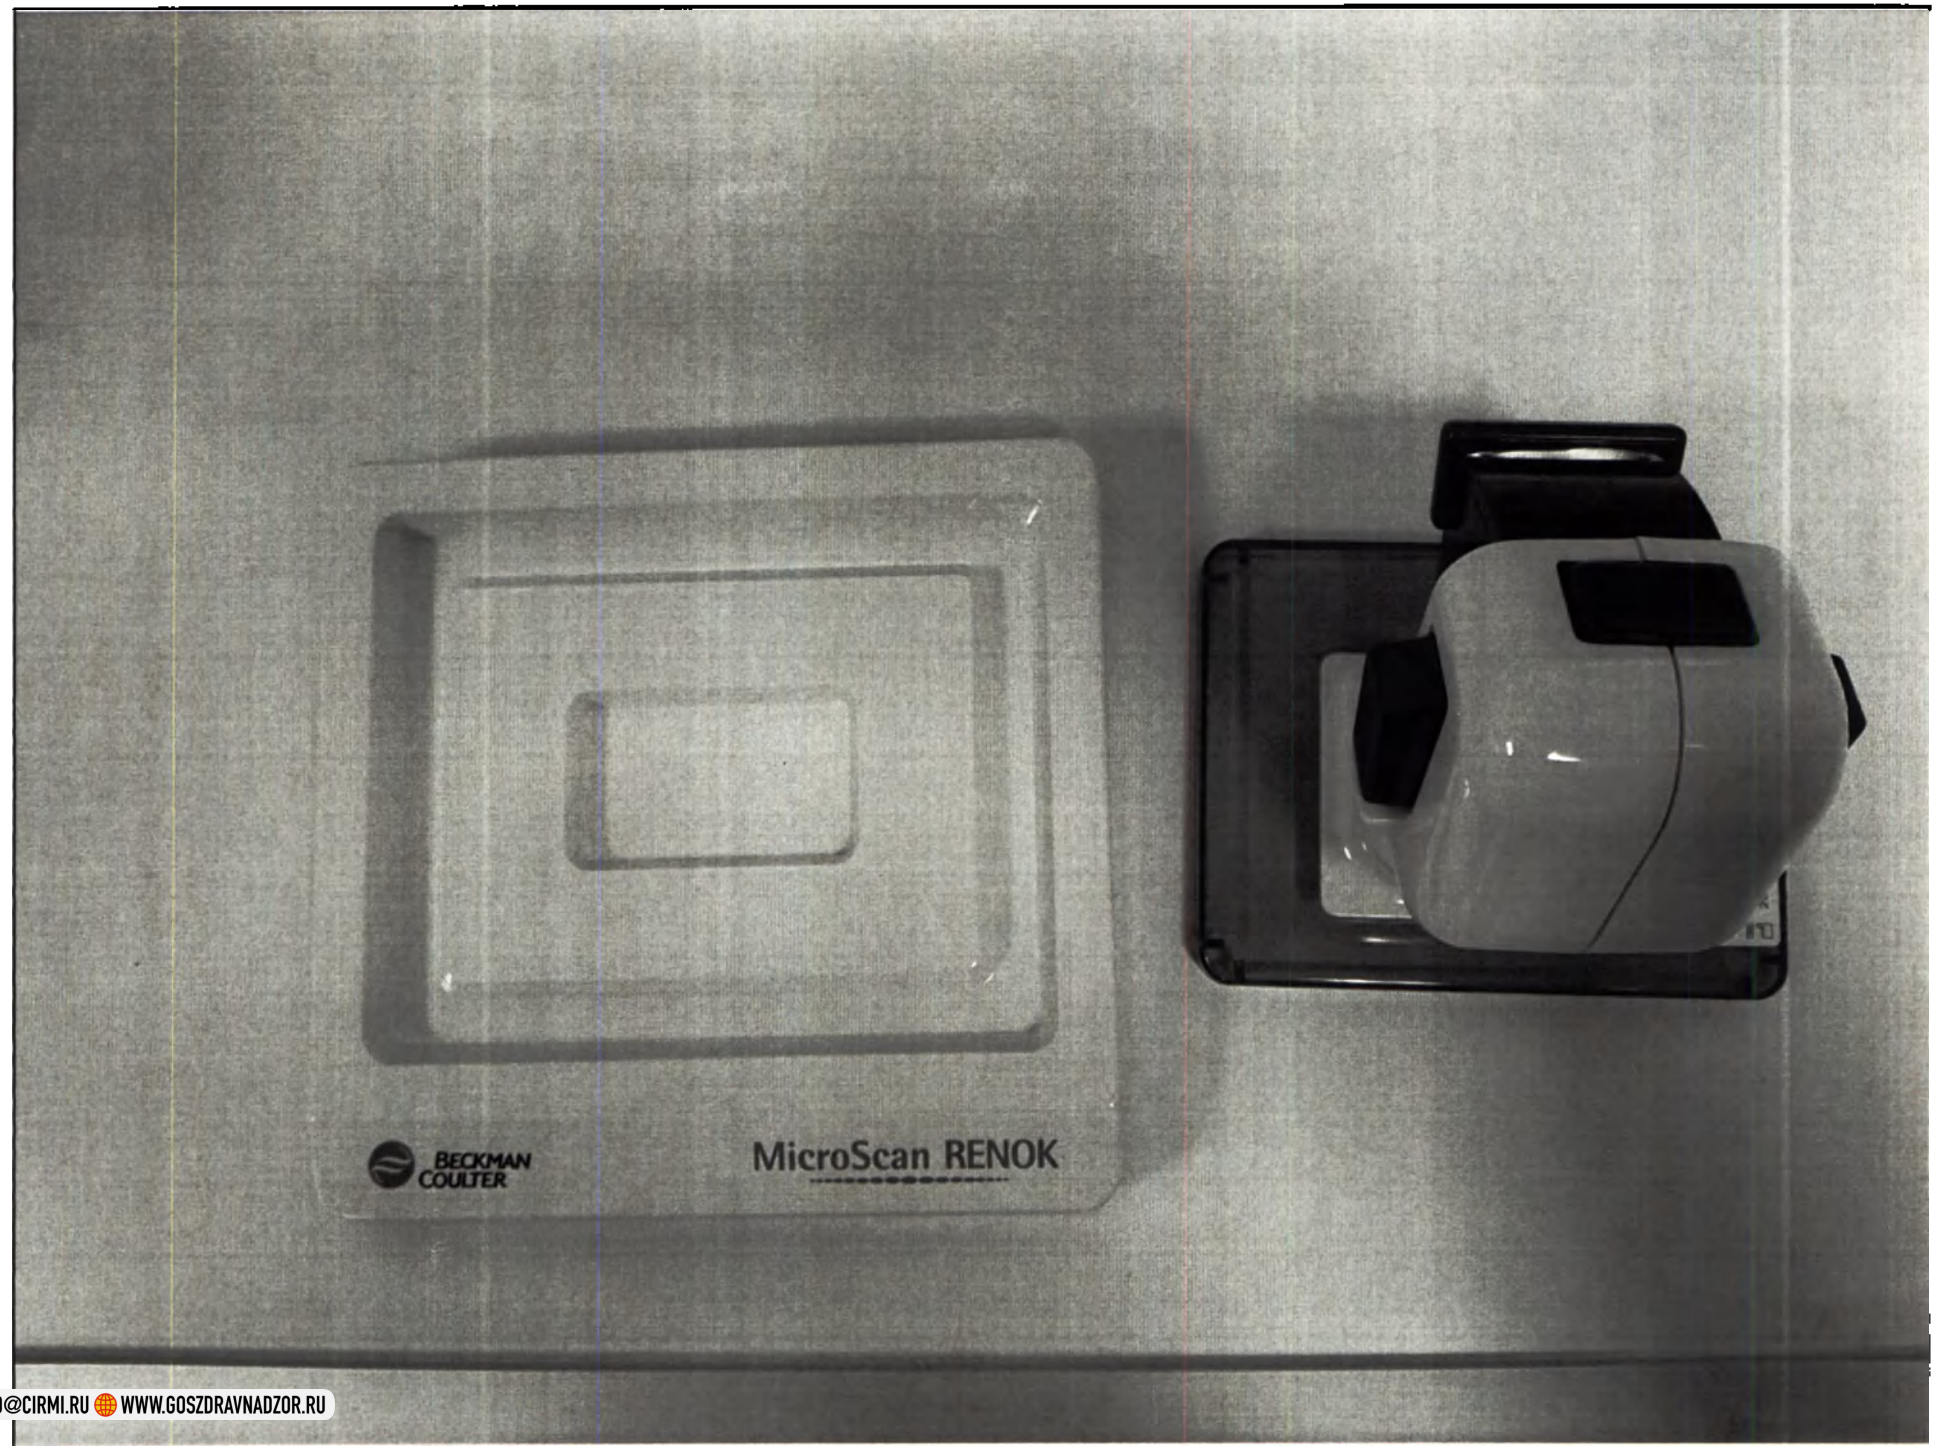

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пипетка многоканальная Renok, в составе: прокладка уплотнительная

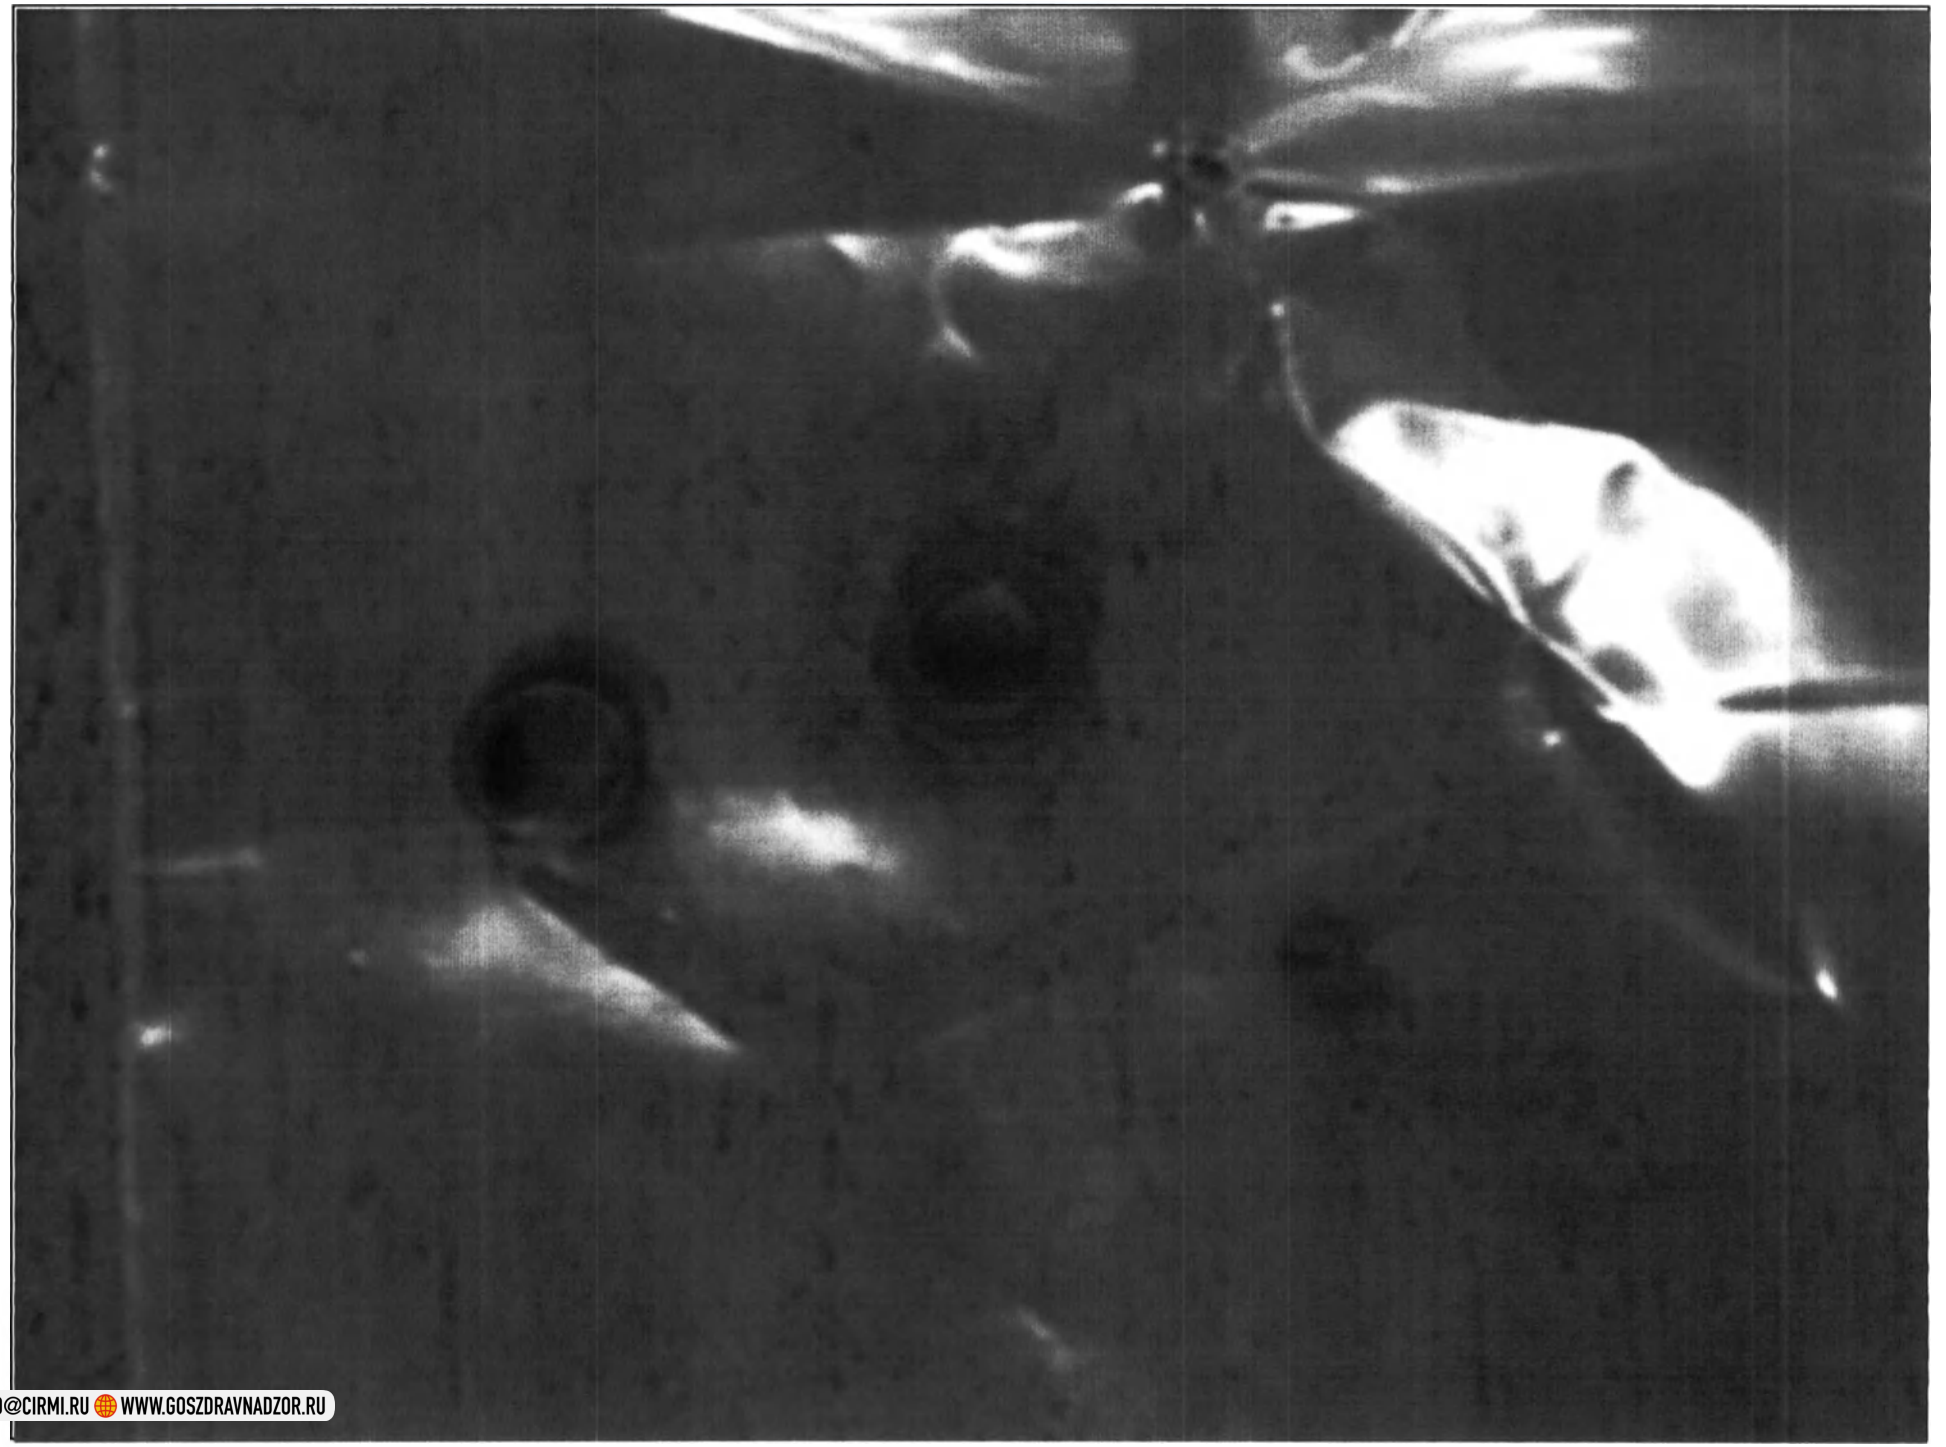

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Программное обеспечение LabPro на диске, не более 3 шт.

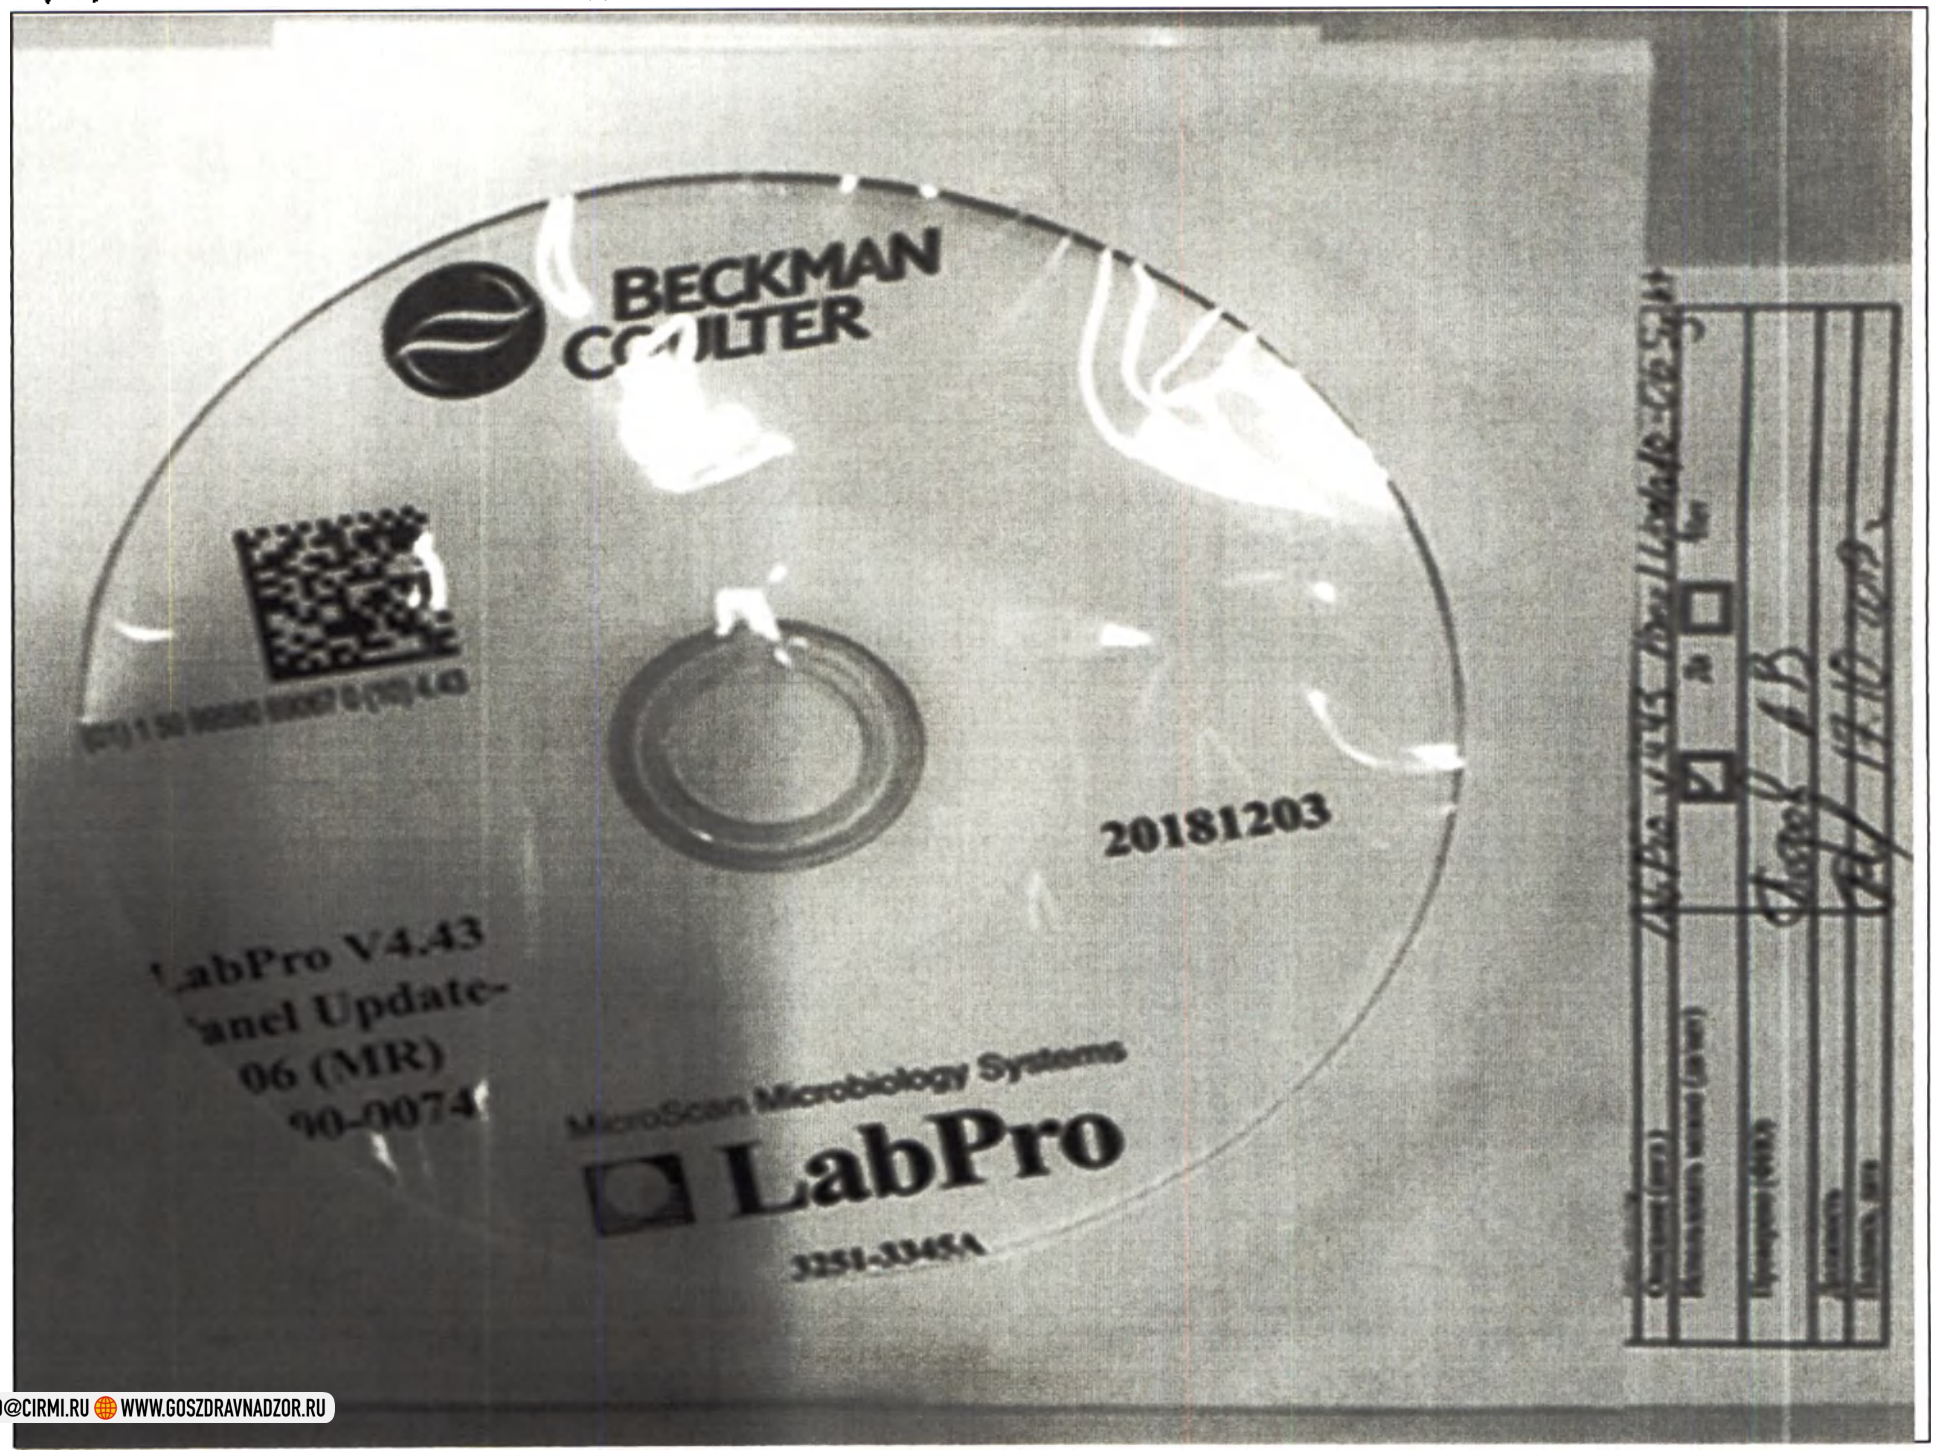

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Бумага для принтера штрих-кода, не более 3 рулонов

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Термометр, не более 2 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Адаптер термометра, не более 2 шт..

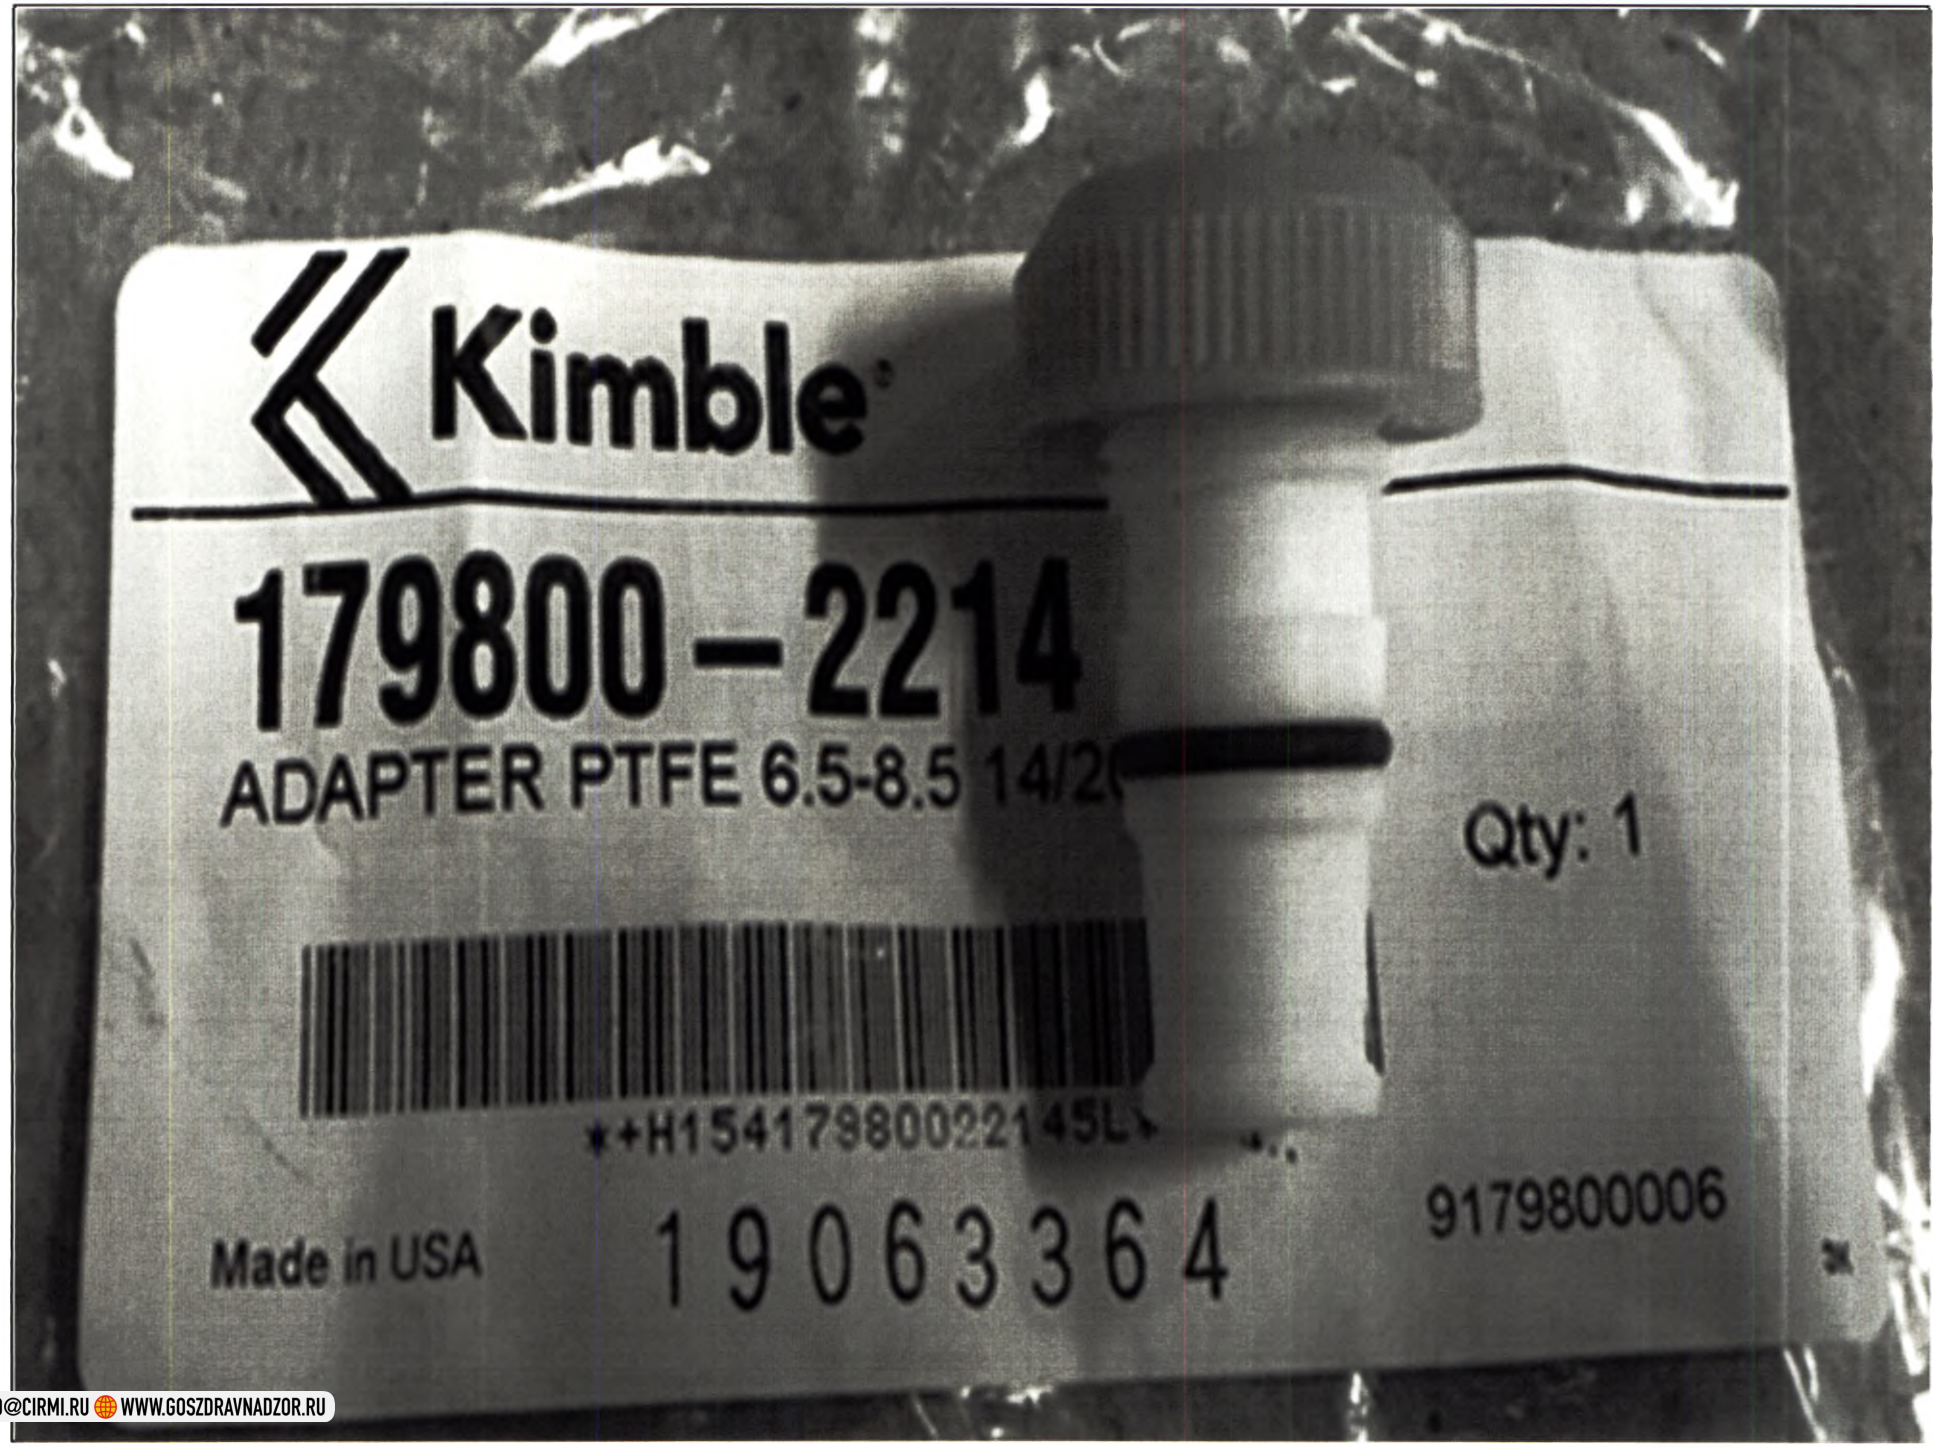

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фотодиодный экран, не более 3 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Диффузор, не более 3 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Емкость для отходов реагентов с заглушками, не более 8 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Зажим, не более 2 шт.

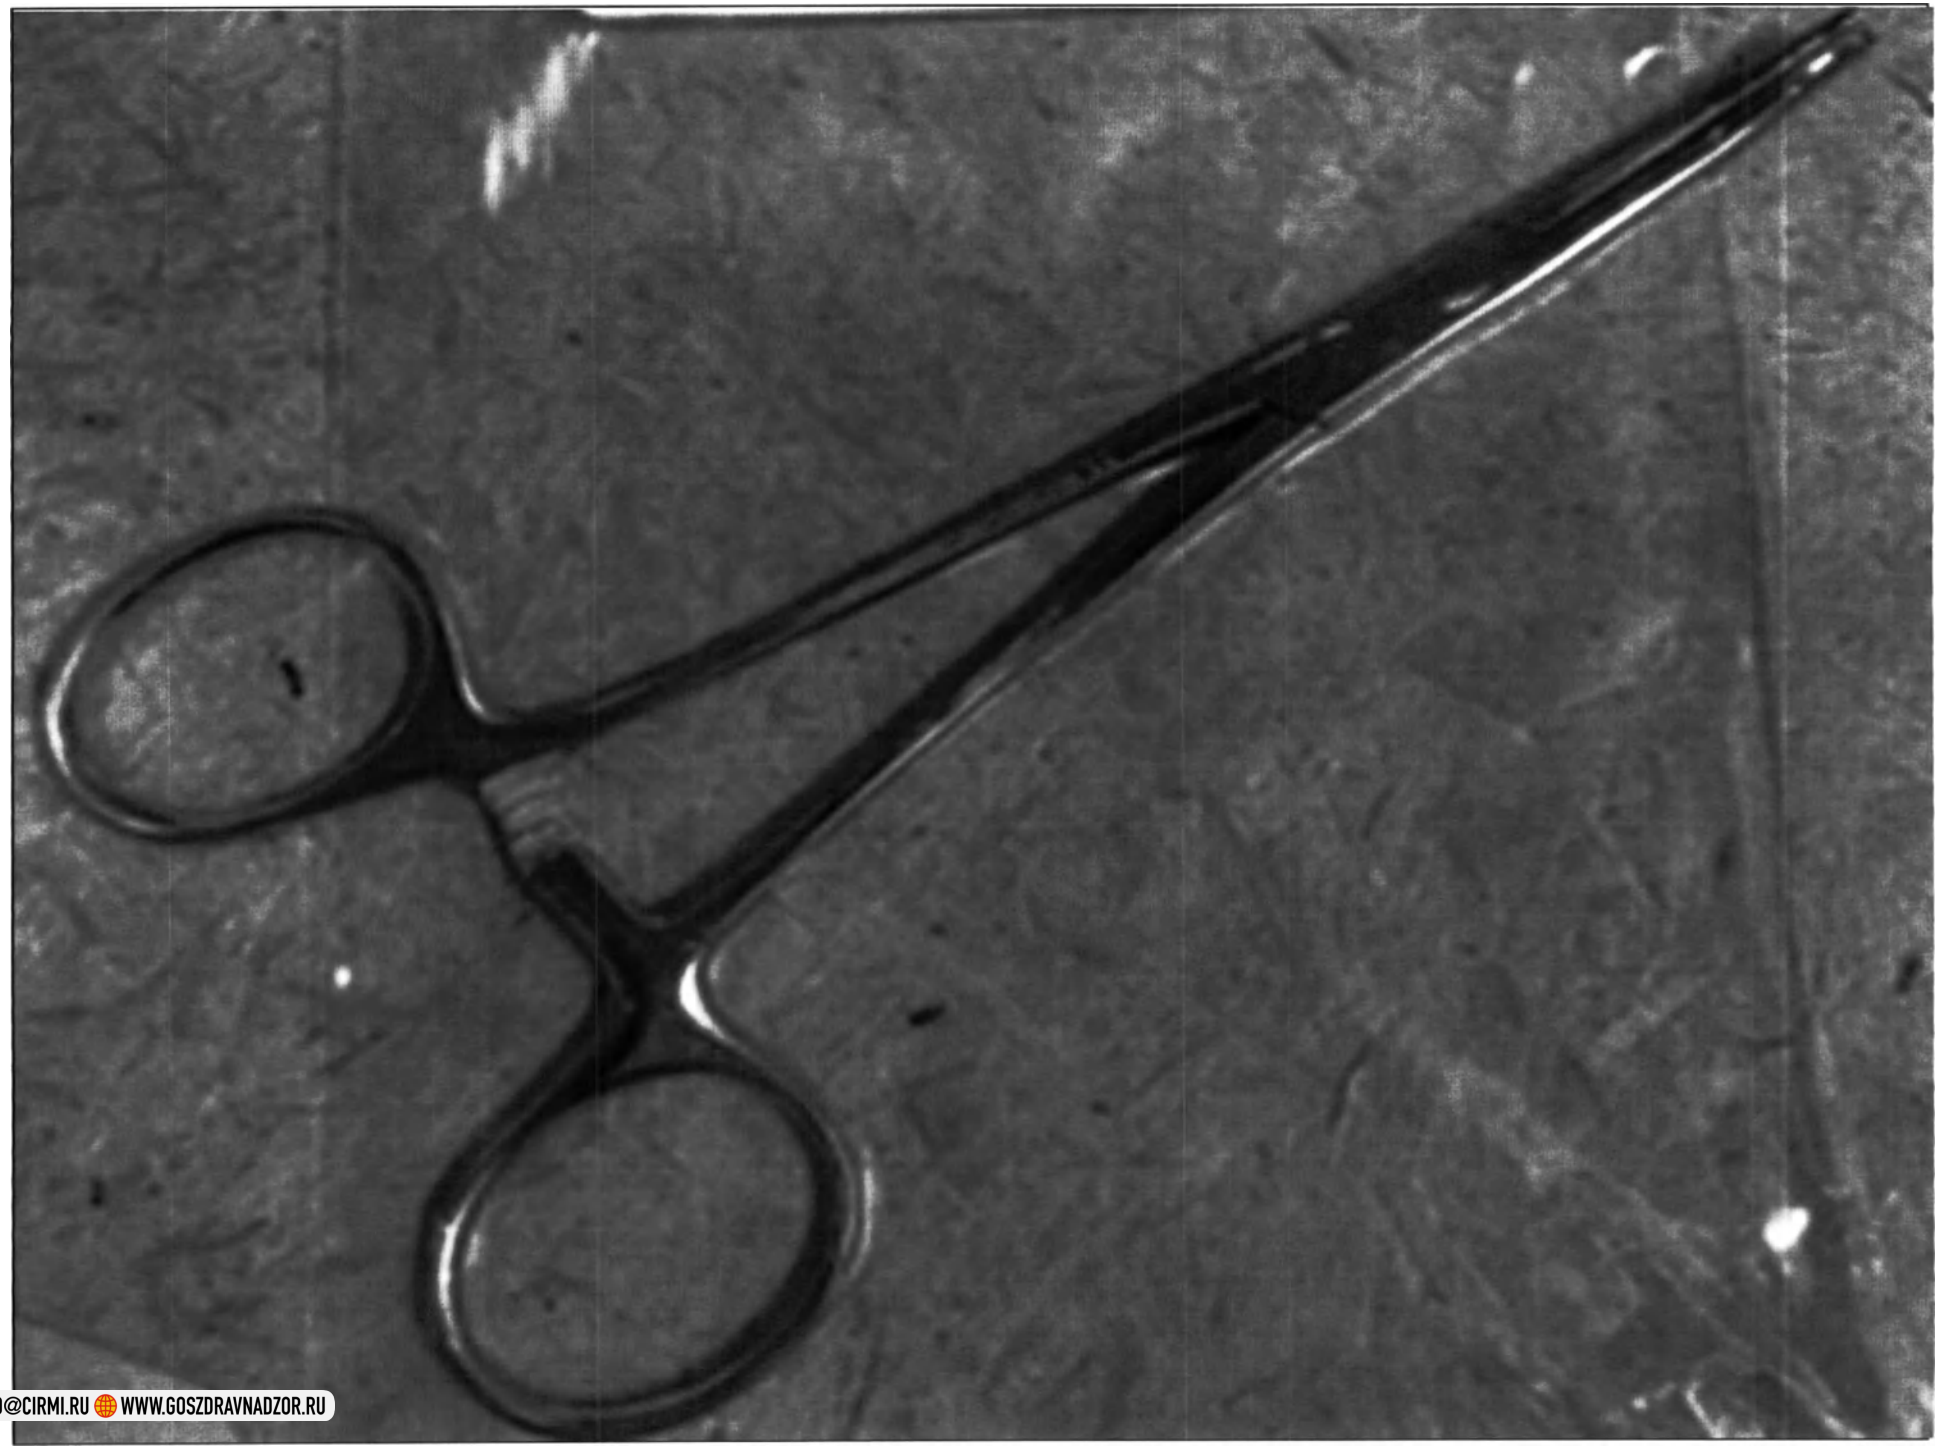

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пробка впускная резервуара для воды, не более 2 шт.

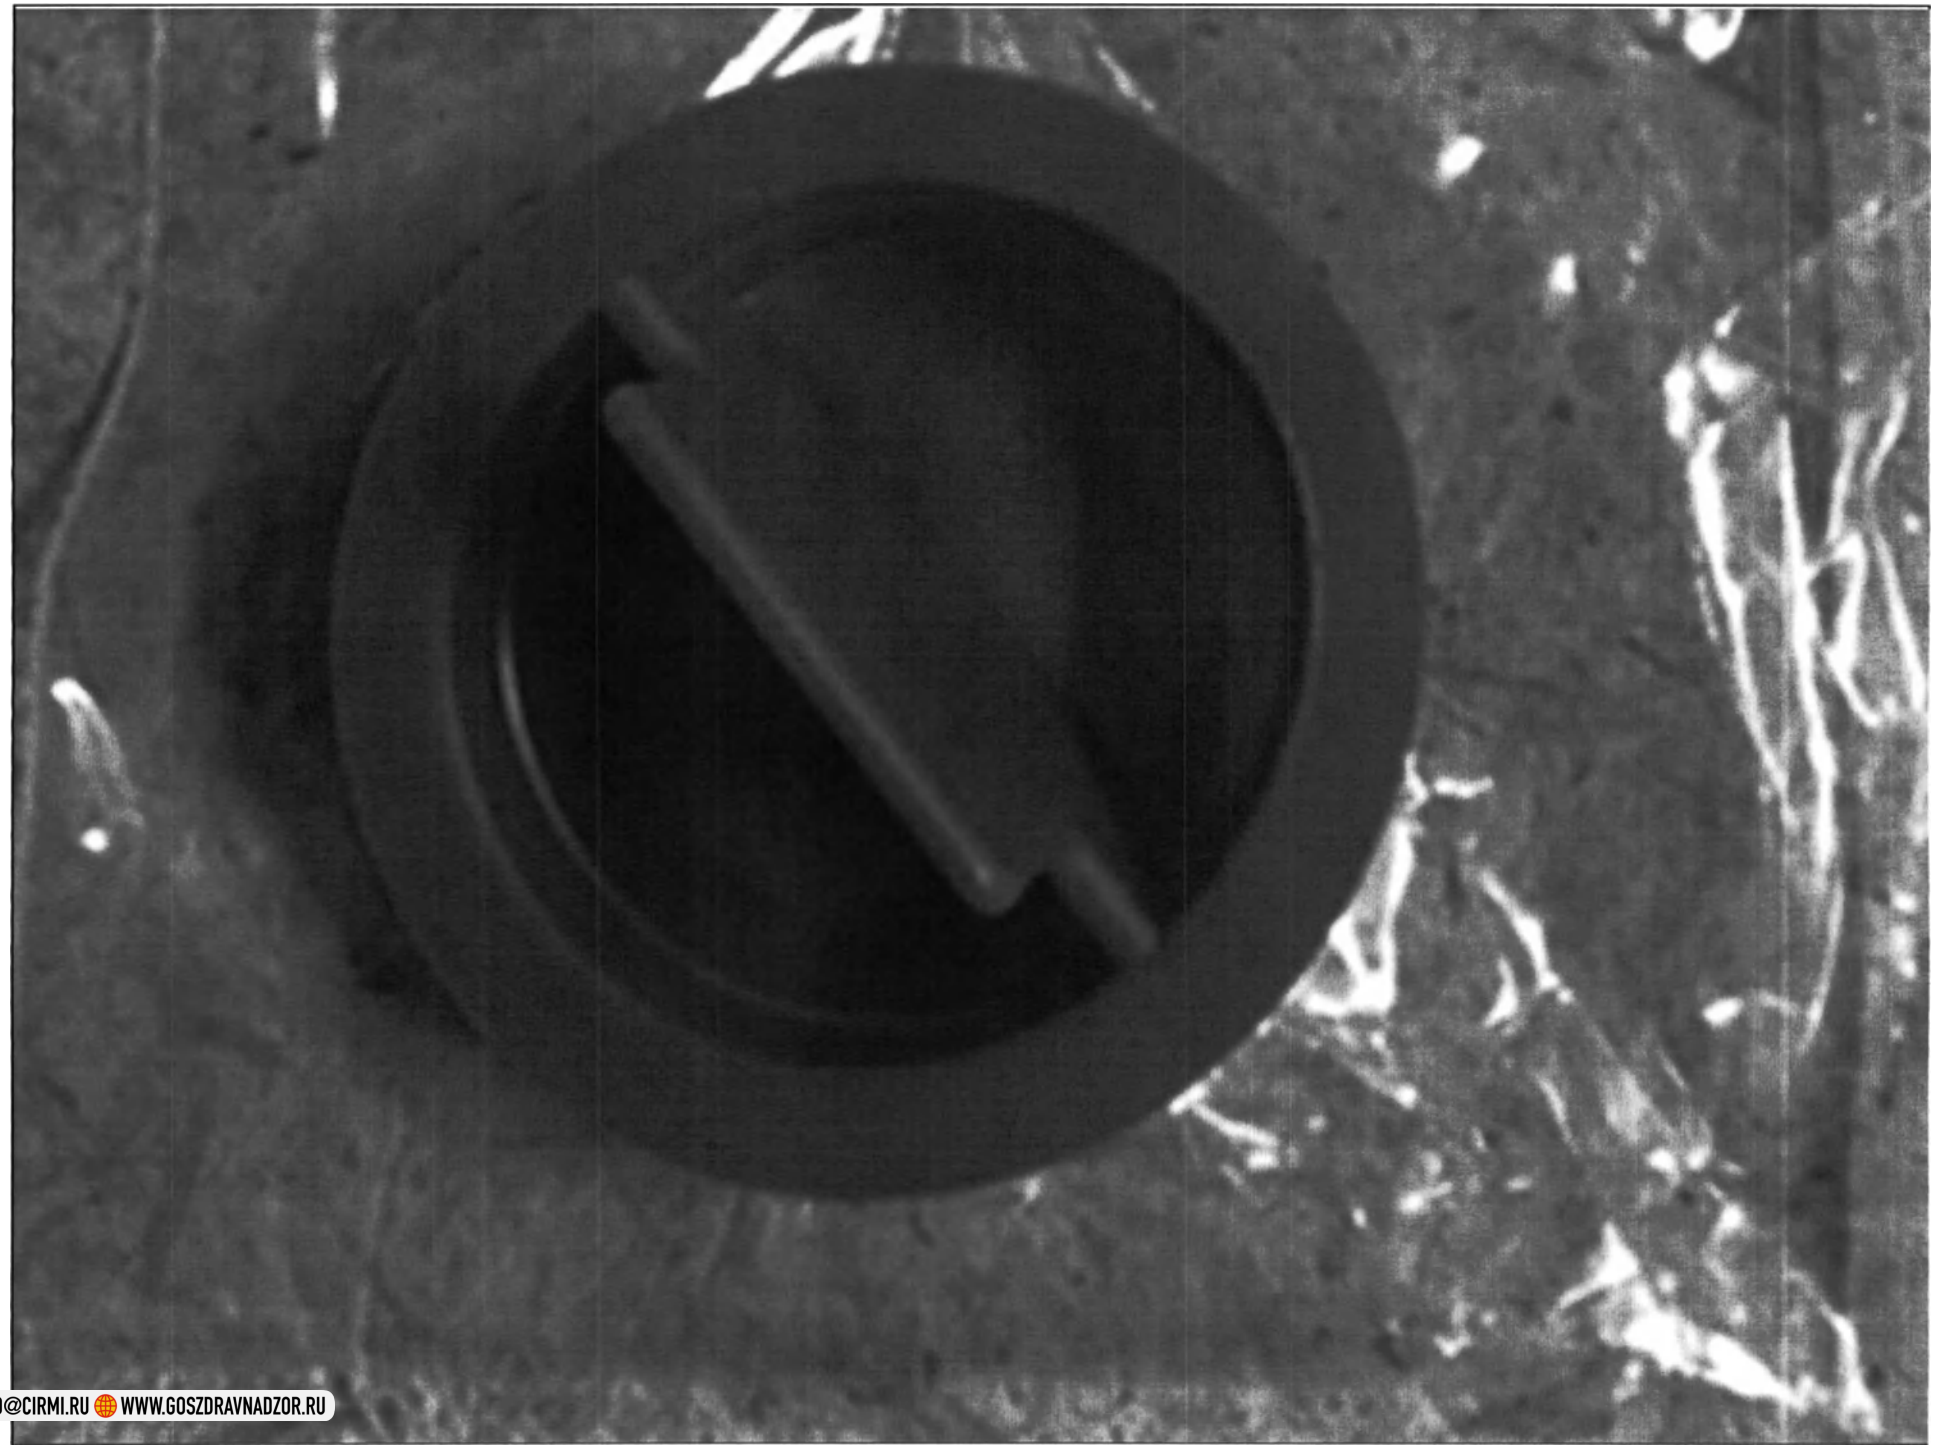

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Сетевые кабели, не более 12 шт

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Флеш-накопитель, не более 2 шт.

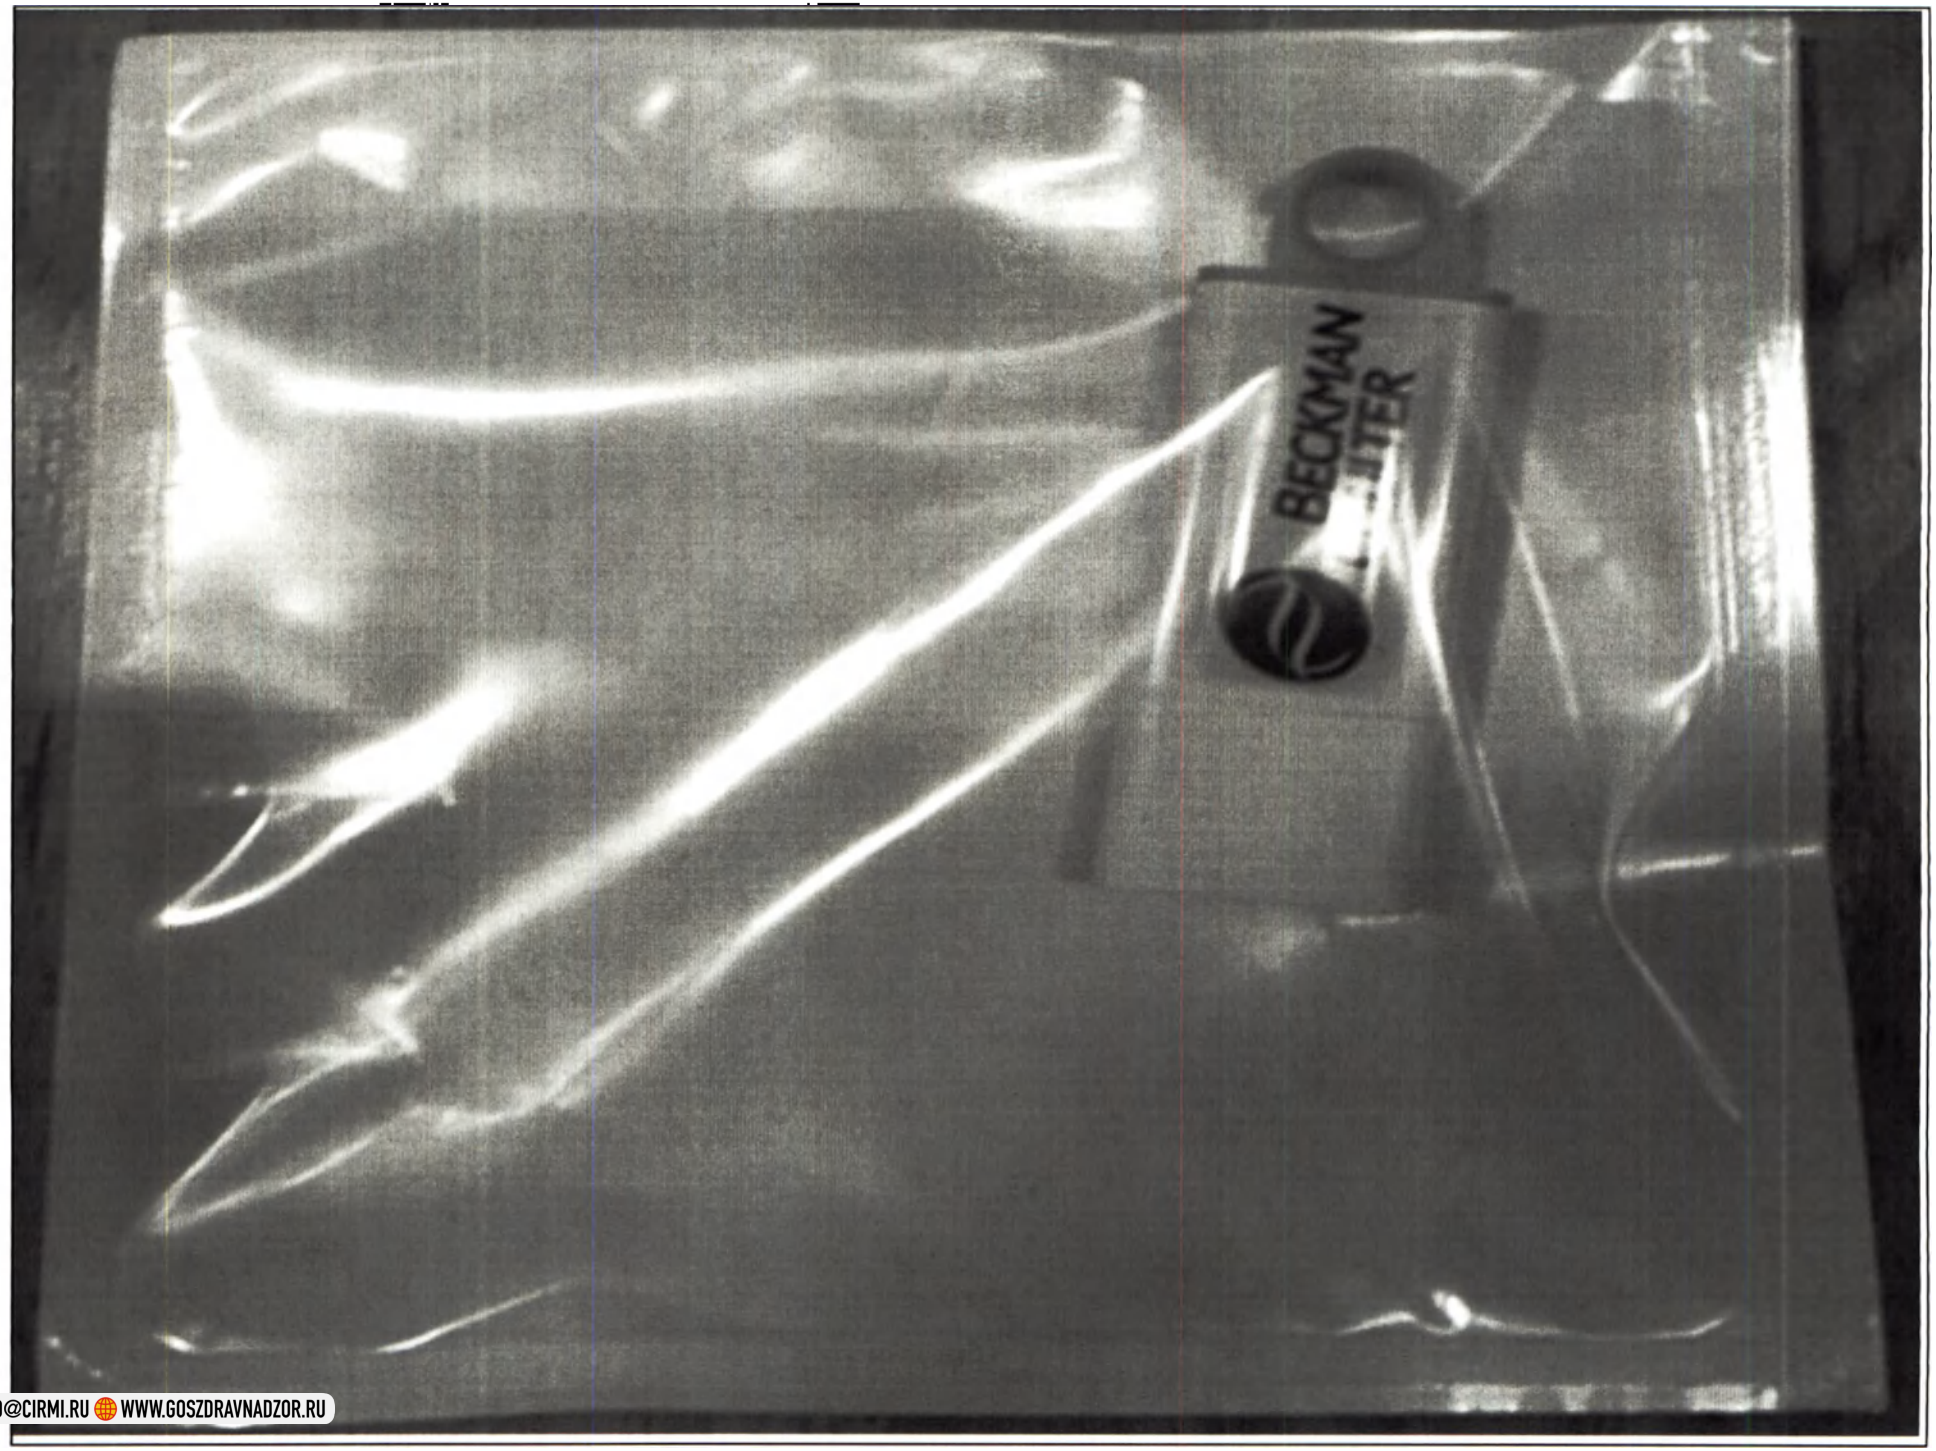

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Диск с настройками грабера, не более 2 шт

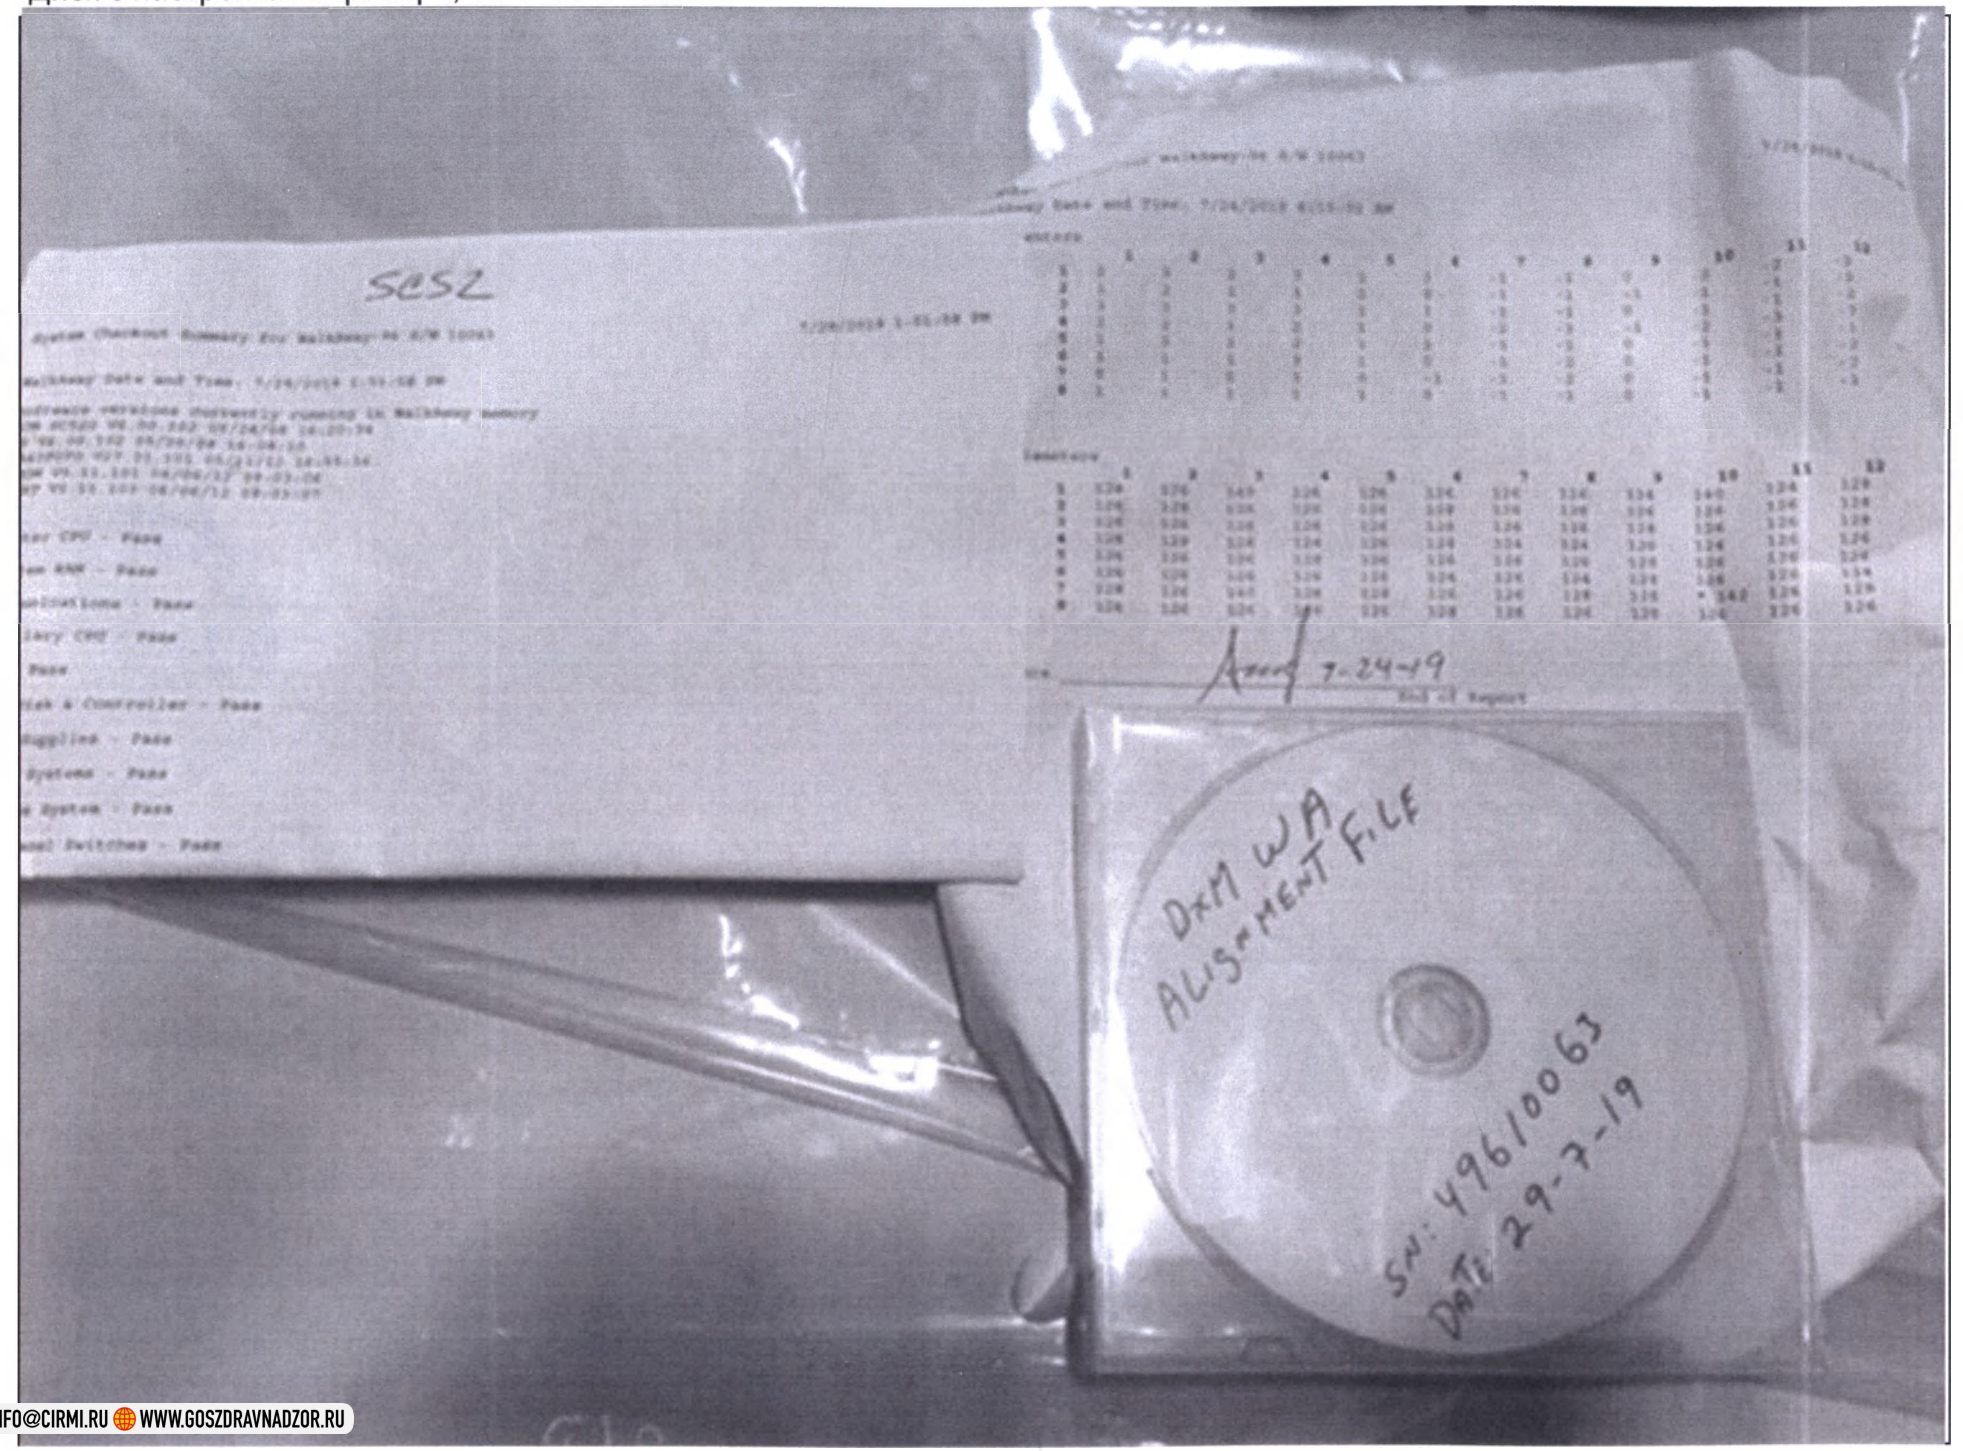

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
63 листов

"Бекмен Курьер
Beckman Courier LLC

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU