

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

медицинского изделия
для диагностики in vitro

«Набор эритроцитов стандартных «Across Identi Cell» для идентификации антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro»

производства

Dia Pro Tıbbi Ürünler San. Ve Tic. A.Ş. (Диа Про Тибби Урюнлер Сан. Ве Тик. А.С.), Турция

Утверждено:

Полное имя: Мокеев Д.В.

Должность: Генеральный директор ООО «Адвенсум»


Название компании: ООО «Адвенсум»

Подпись:


Дата:

Печать:



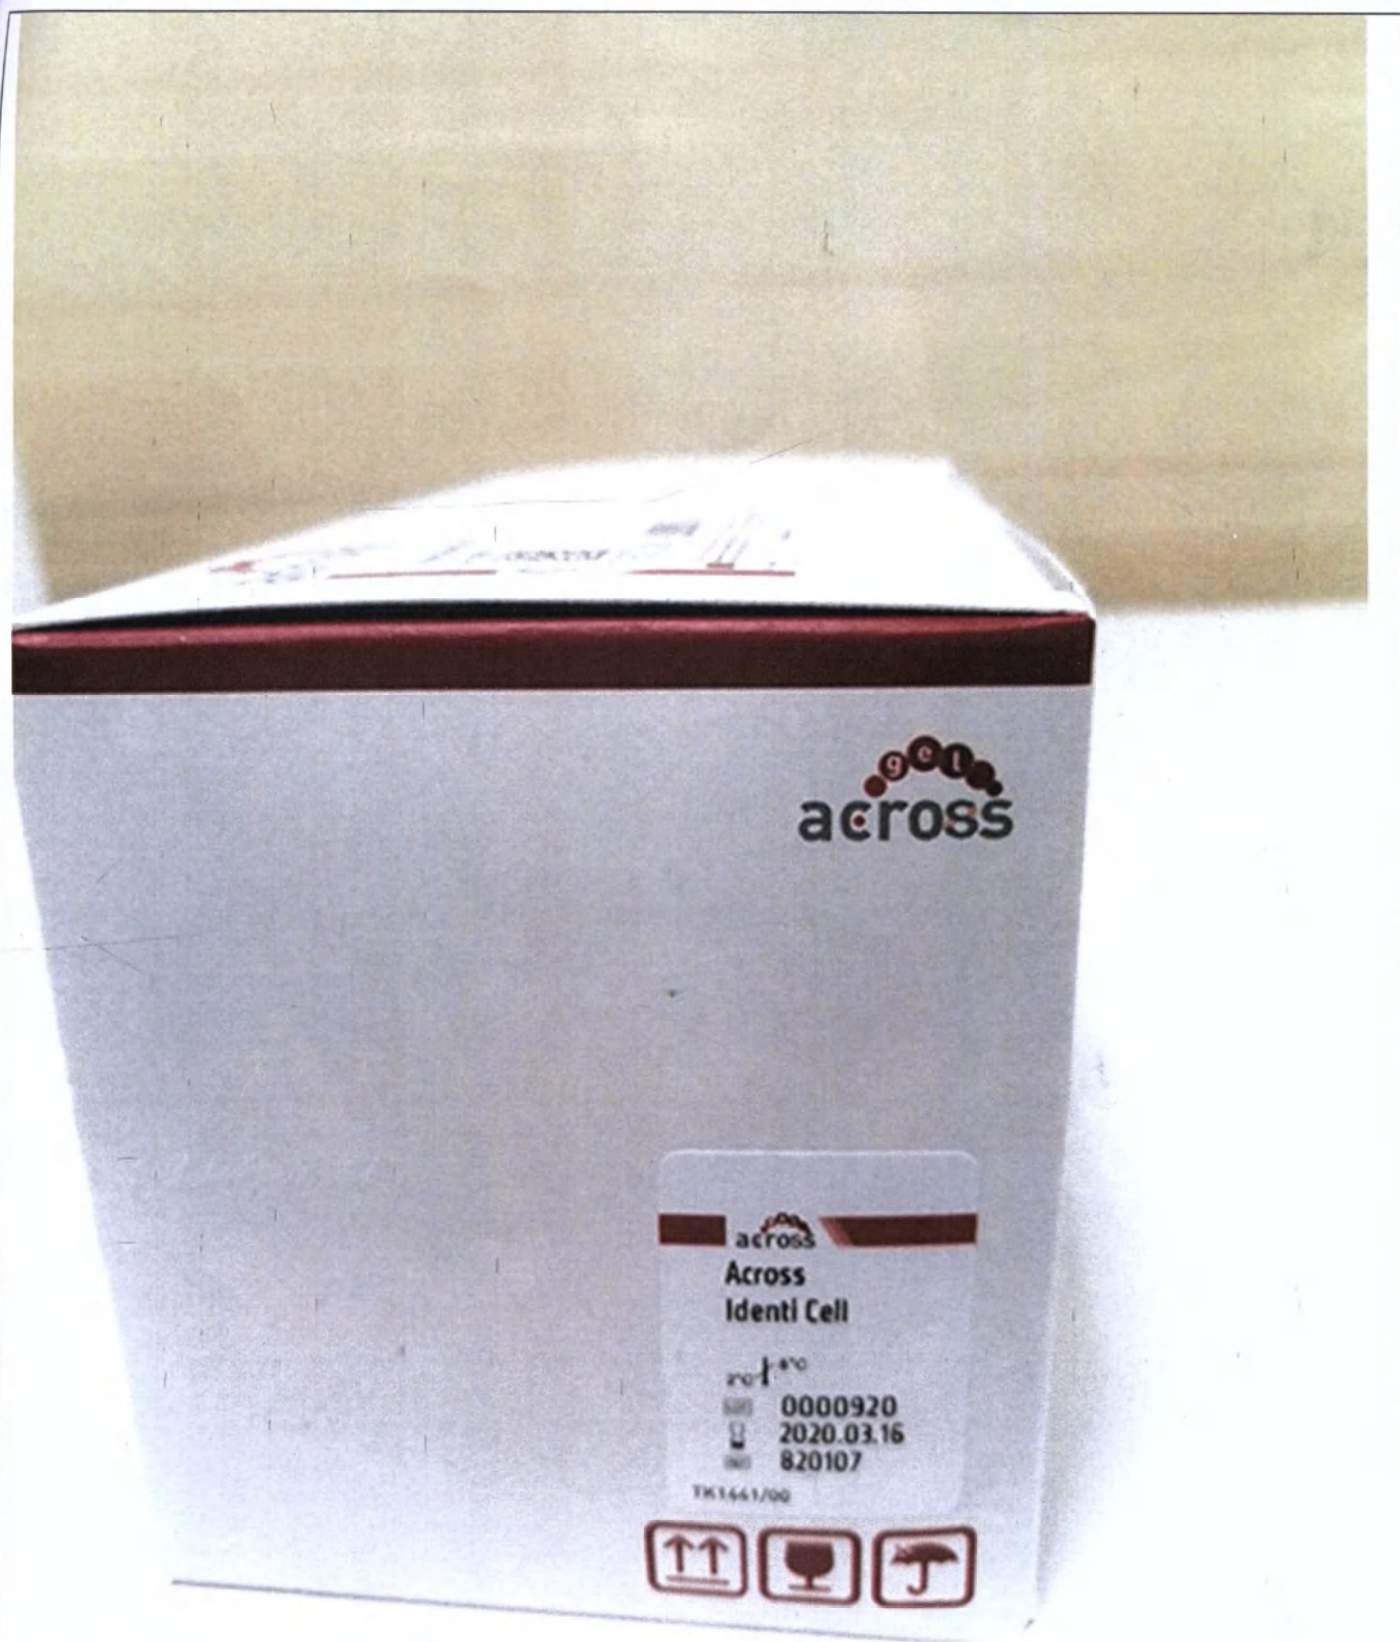


Вторичная упаковка медицинского изделия «Набор эритроцитов стандартных «Across Identi Cell» для идентификации антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro»

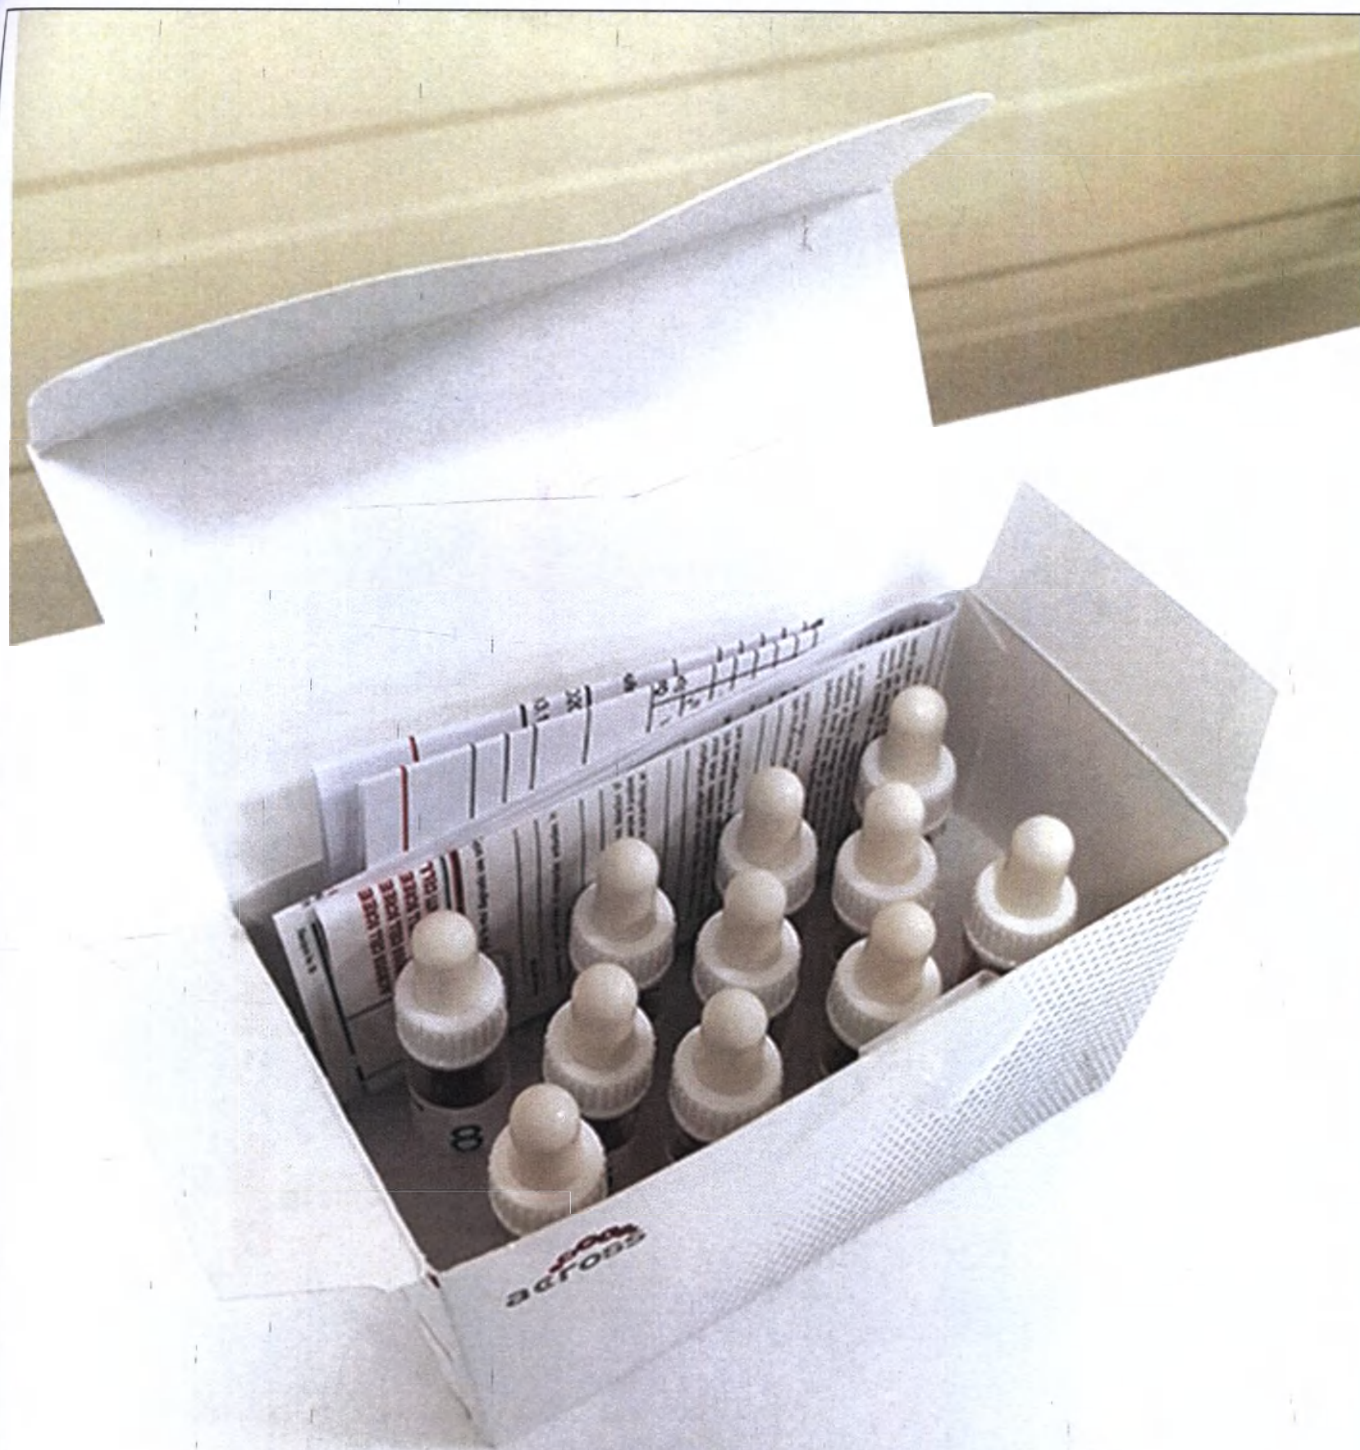

Вторичная упаковка медицинского изделия «Набор эритроцитов стандартных «Across Identi Cell» для идентификации антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro»




Маркировка вторичной упаковки медицинского изделия «Набор эритроцитов стандартных «Across Identi Cell» для идентификации антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro»

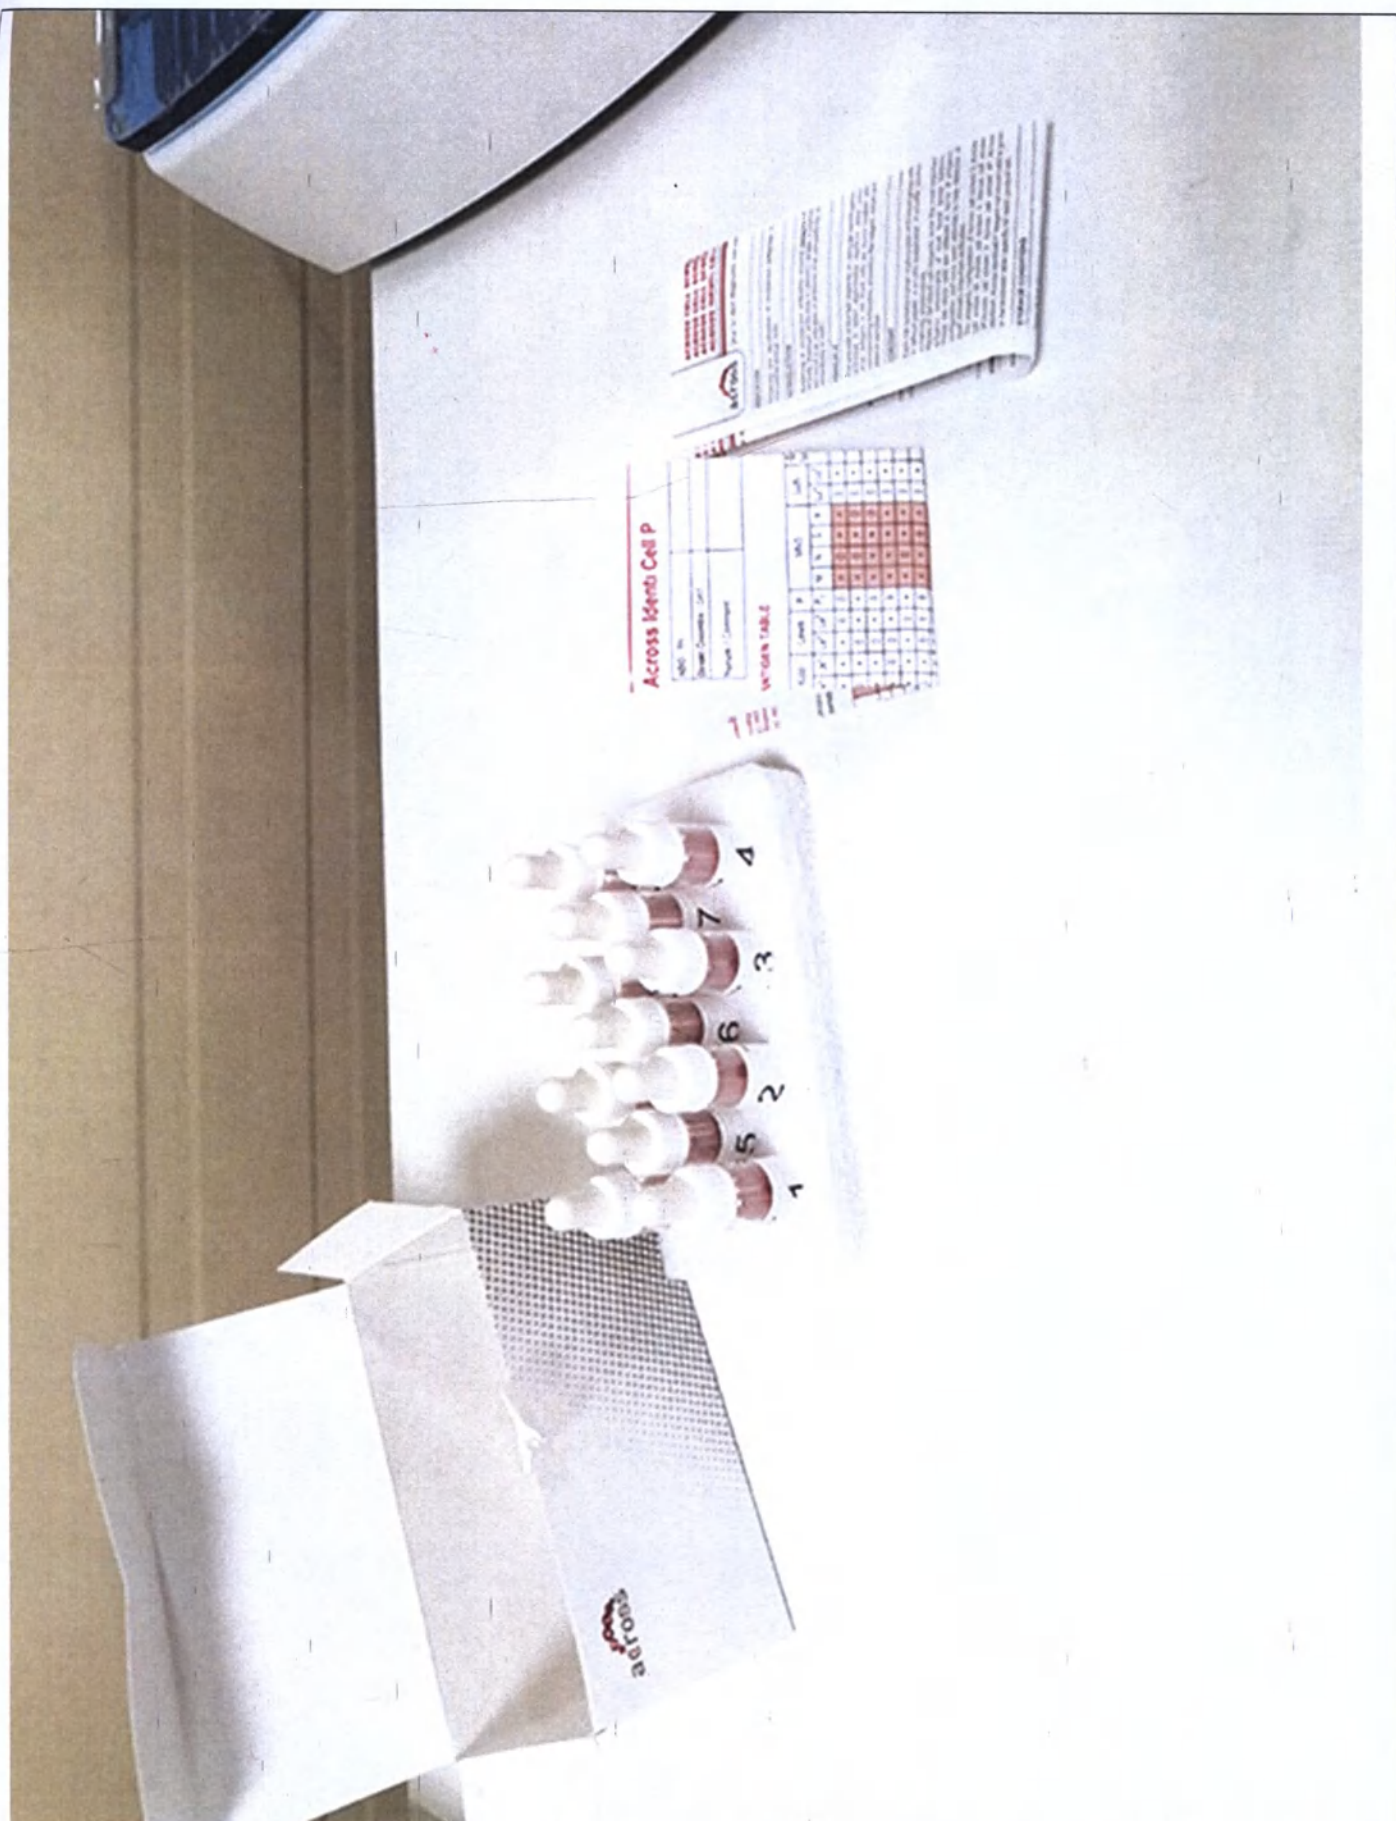

Внешний вид медицинского изделия «Набор эритроцитов стандартных «Across Identi Cell» для идентификации антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro»



Внешний вид медицинского изделия «Набор эритроцитов стандартных «Across Identi Cell» для идентификации антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro»

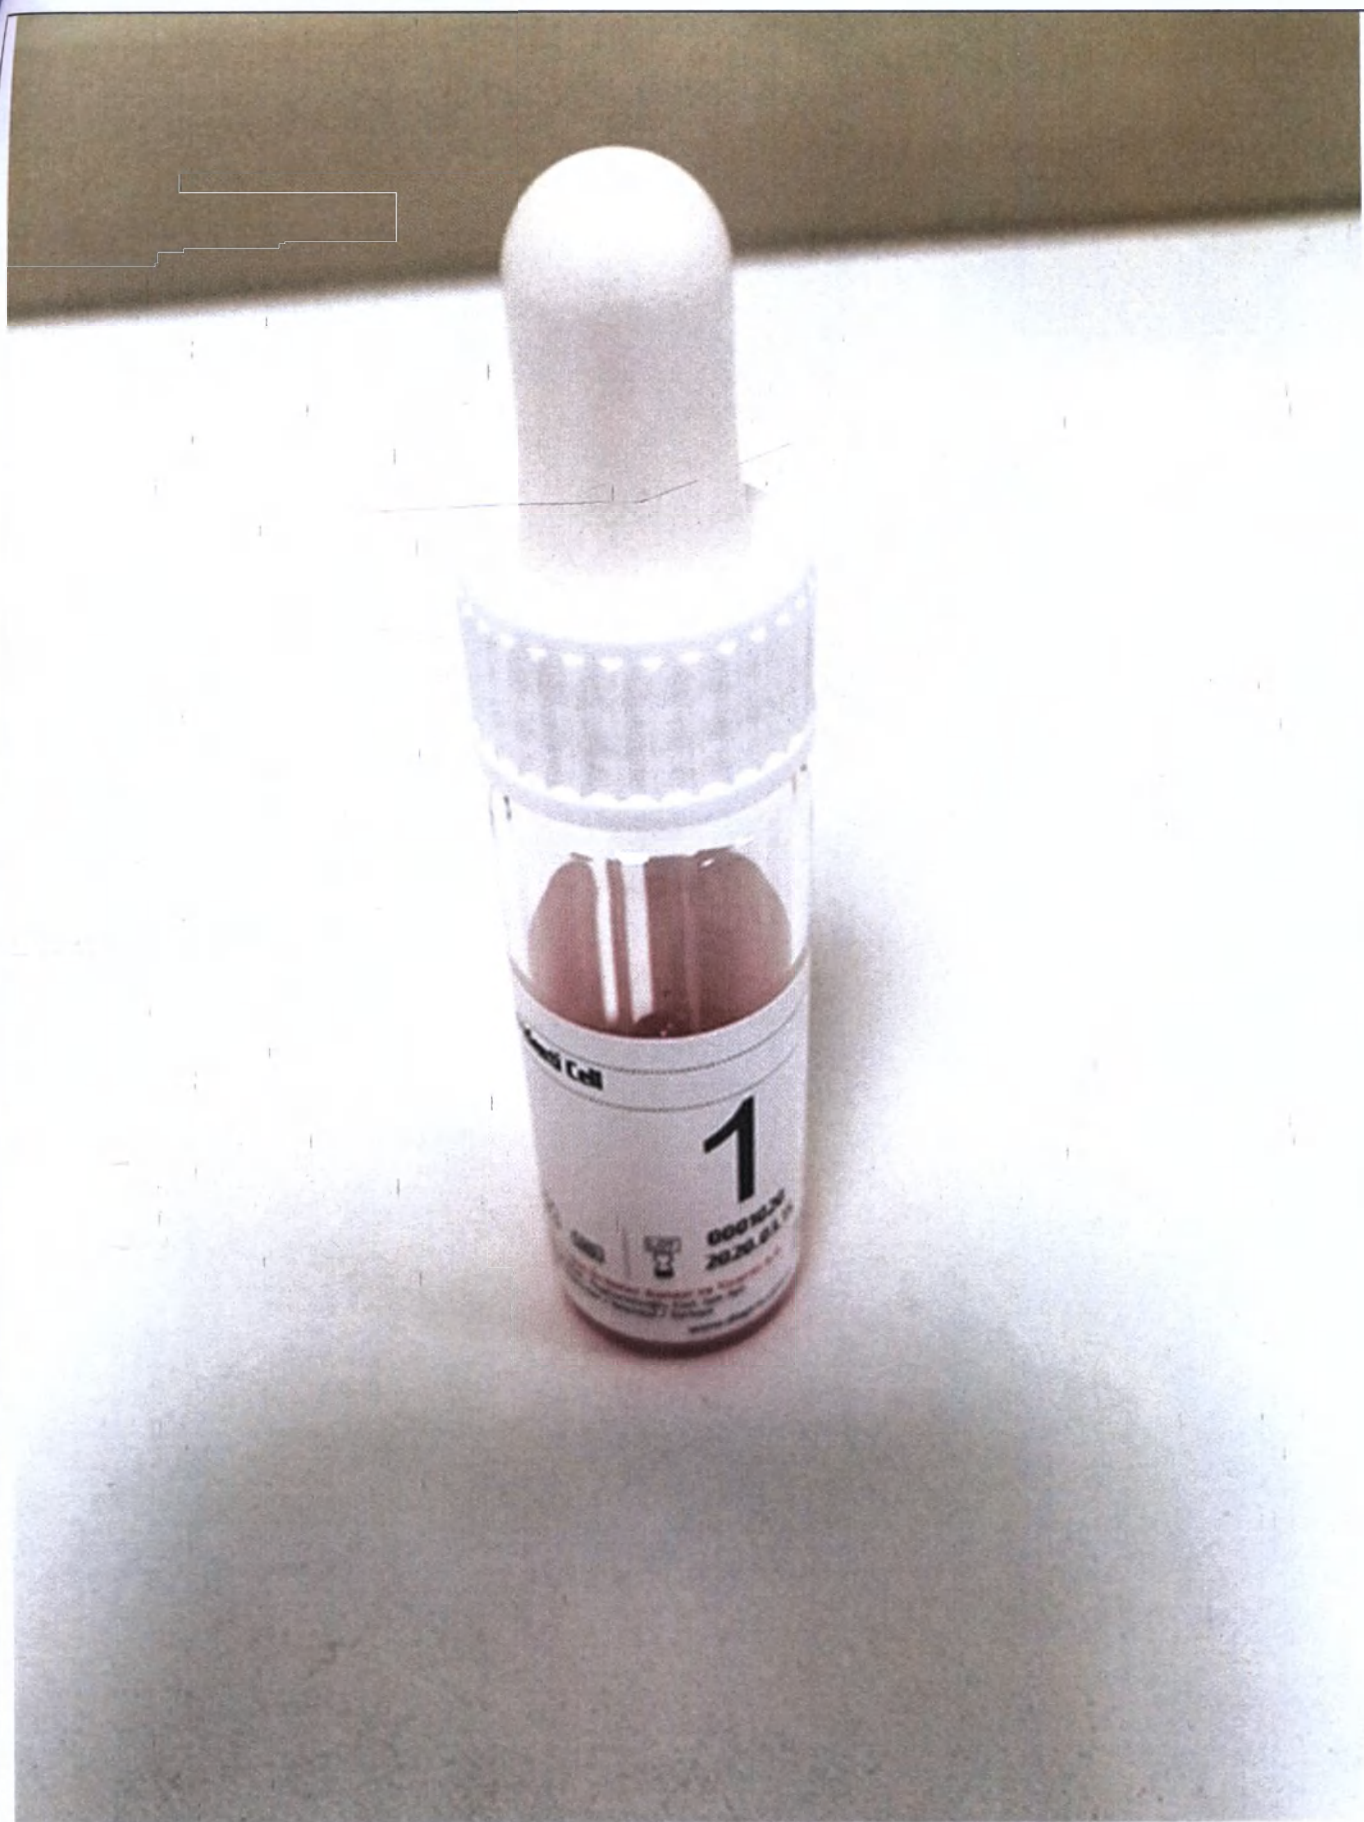

Внешний вид медицинского изделия «Набор эритроцитов стандартных «Across Identi Cell» для идентификации антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro»




Внешний вид медицинского изделия «Набор эритроцитов стандартных «Across Identi Cell» для идентификации антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro»



Внешний вид медицинского изделия «Набор эритроцитов стандартных «Across Identi Cell» для идентификации антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro»



Внешний вид медицинского изделия «Набор эритроцитов стандартных «Across Identi Cell» для идентификации антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации *in vitro*»

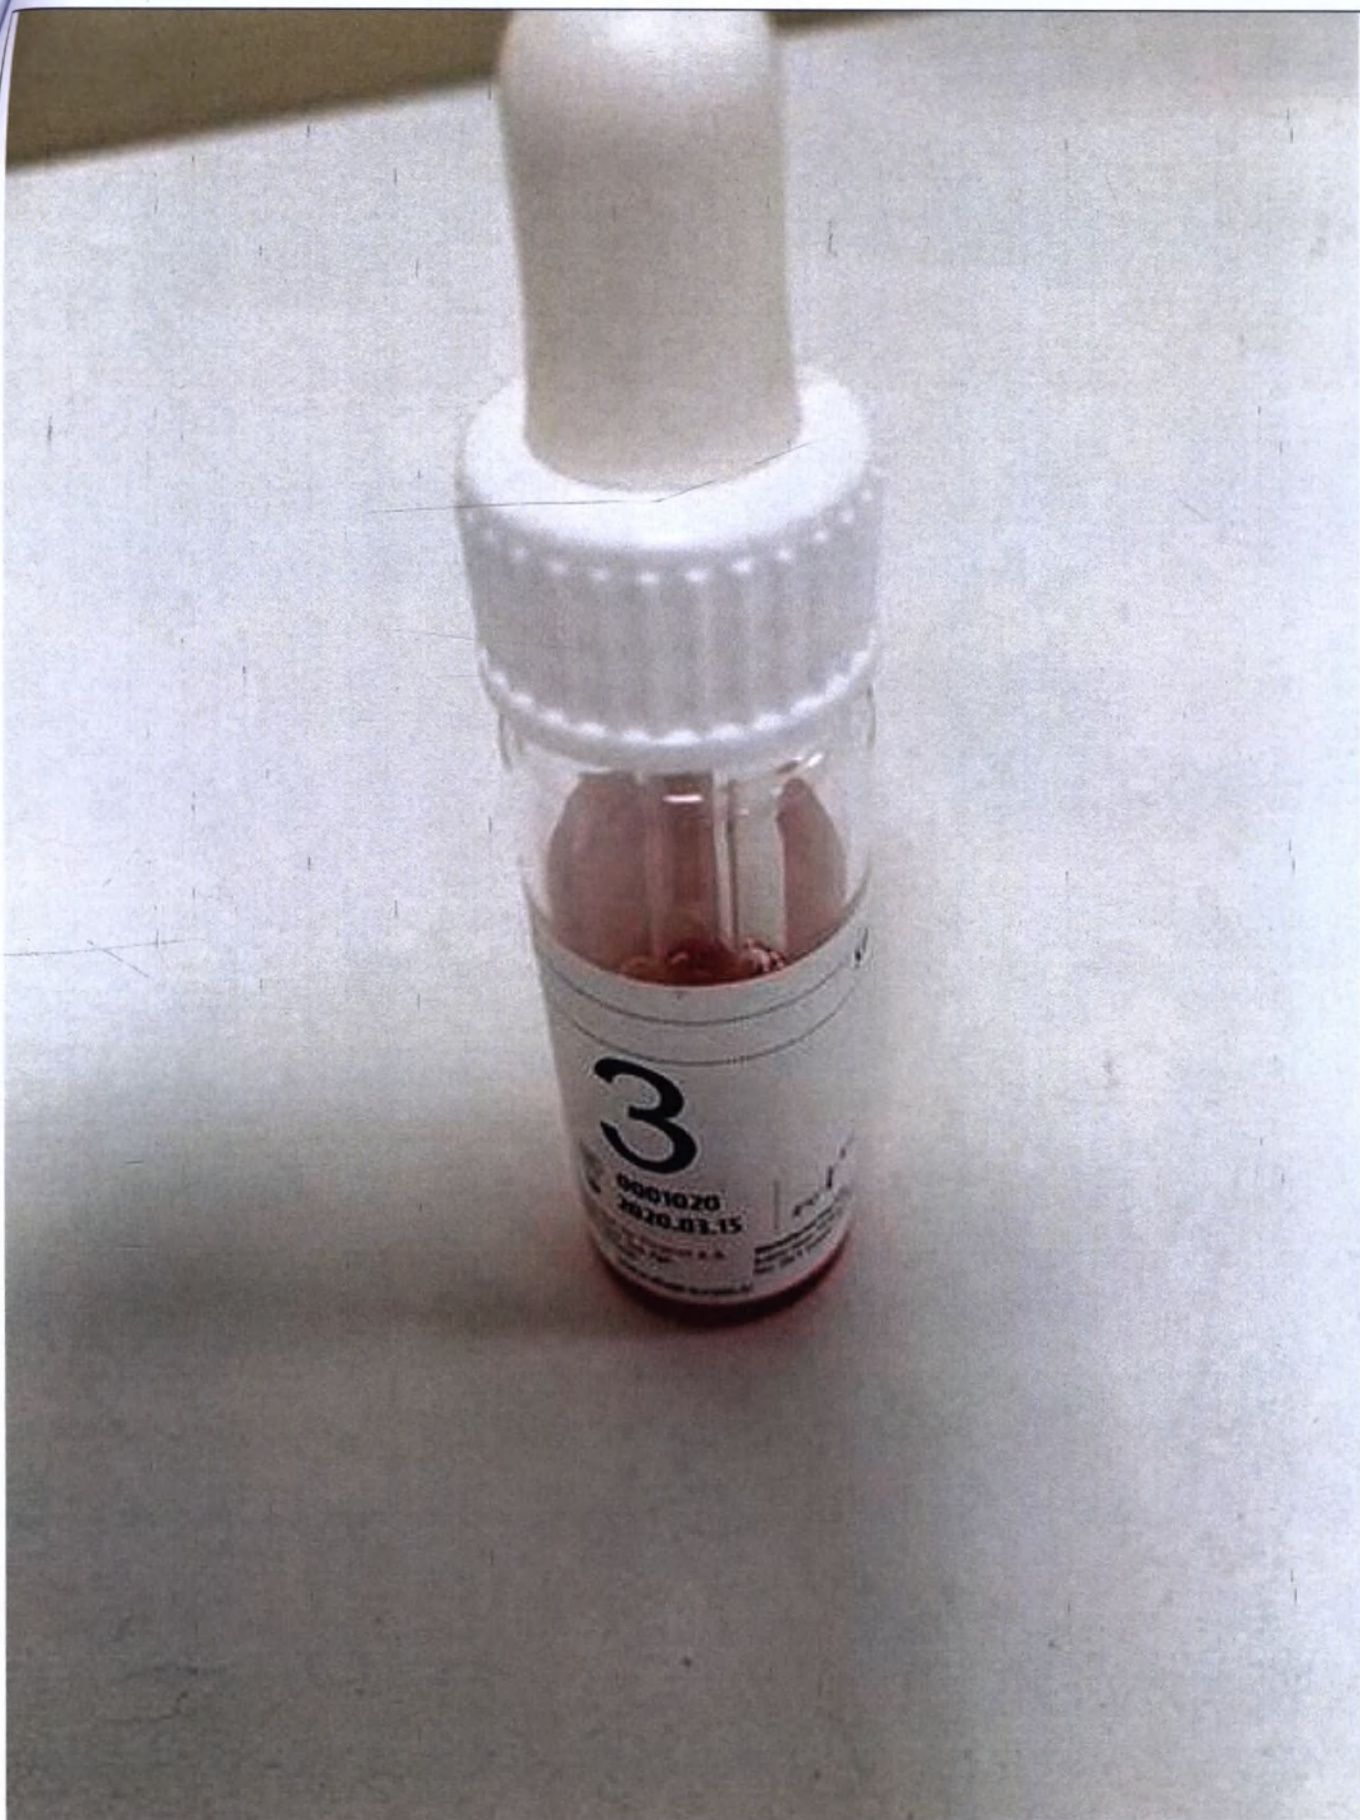

Внешний вид медицинского изделия «Набор эритроцитов стандартных «Across Identi Cell» для идентификации антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro»



Внешний вид медицинского изделия «Набор эритроцитов стандартных «Across Identi Cell» для идентификации антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro»



Внешний вид медицинского изделия «Набор эритроцитов стандартных «Across Identi Cell» для идентификации антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro»



Внешний вид медицинского изделия «Набор эритроцитов стандартных «Across Identi Cell» для идентификации антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro»




Внешний вид медицинского изделия «Набор эритроцитов стандартных «Across Identi Cell» для идентификации антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro»



Внешний вид медицинского изделия «Набор эритроцитов стандартных «Across Identi Cell» для идентификации антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro»




Внешний вид медицинского изделия «Набор эритроцитов стандартных «Across Identi Cell» для идентификации антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro»

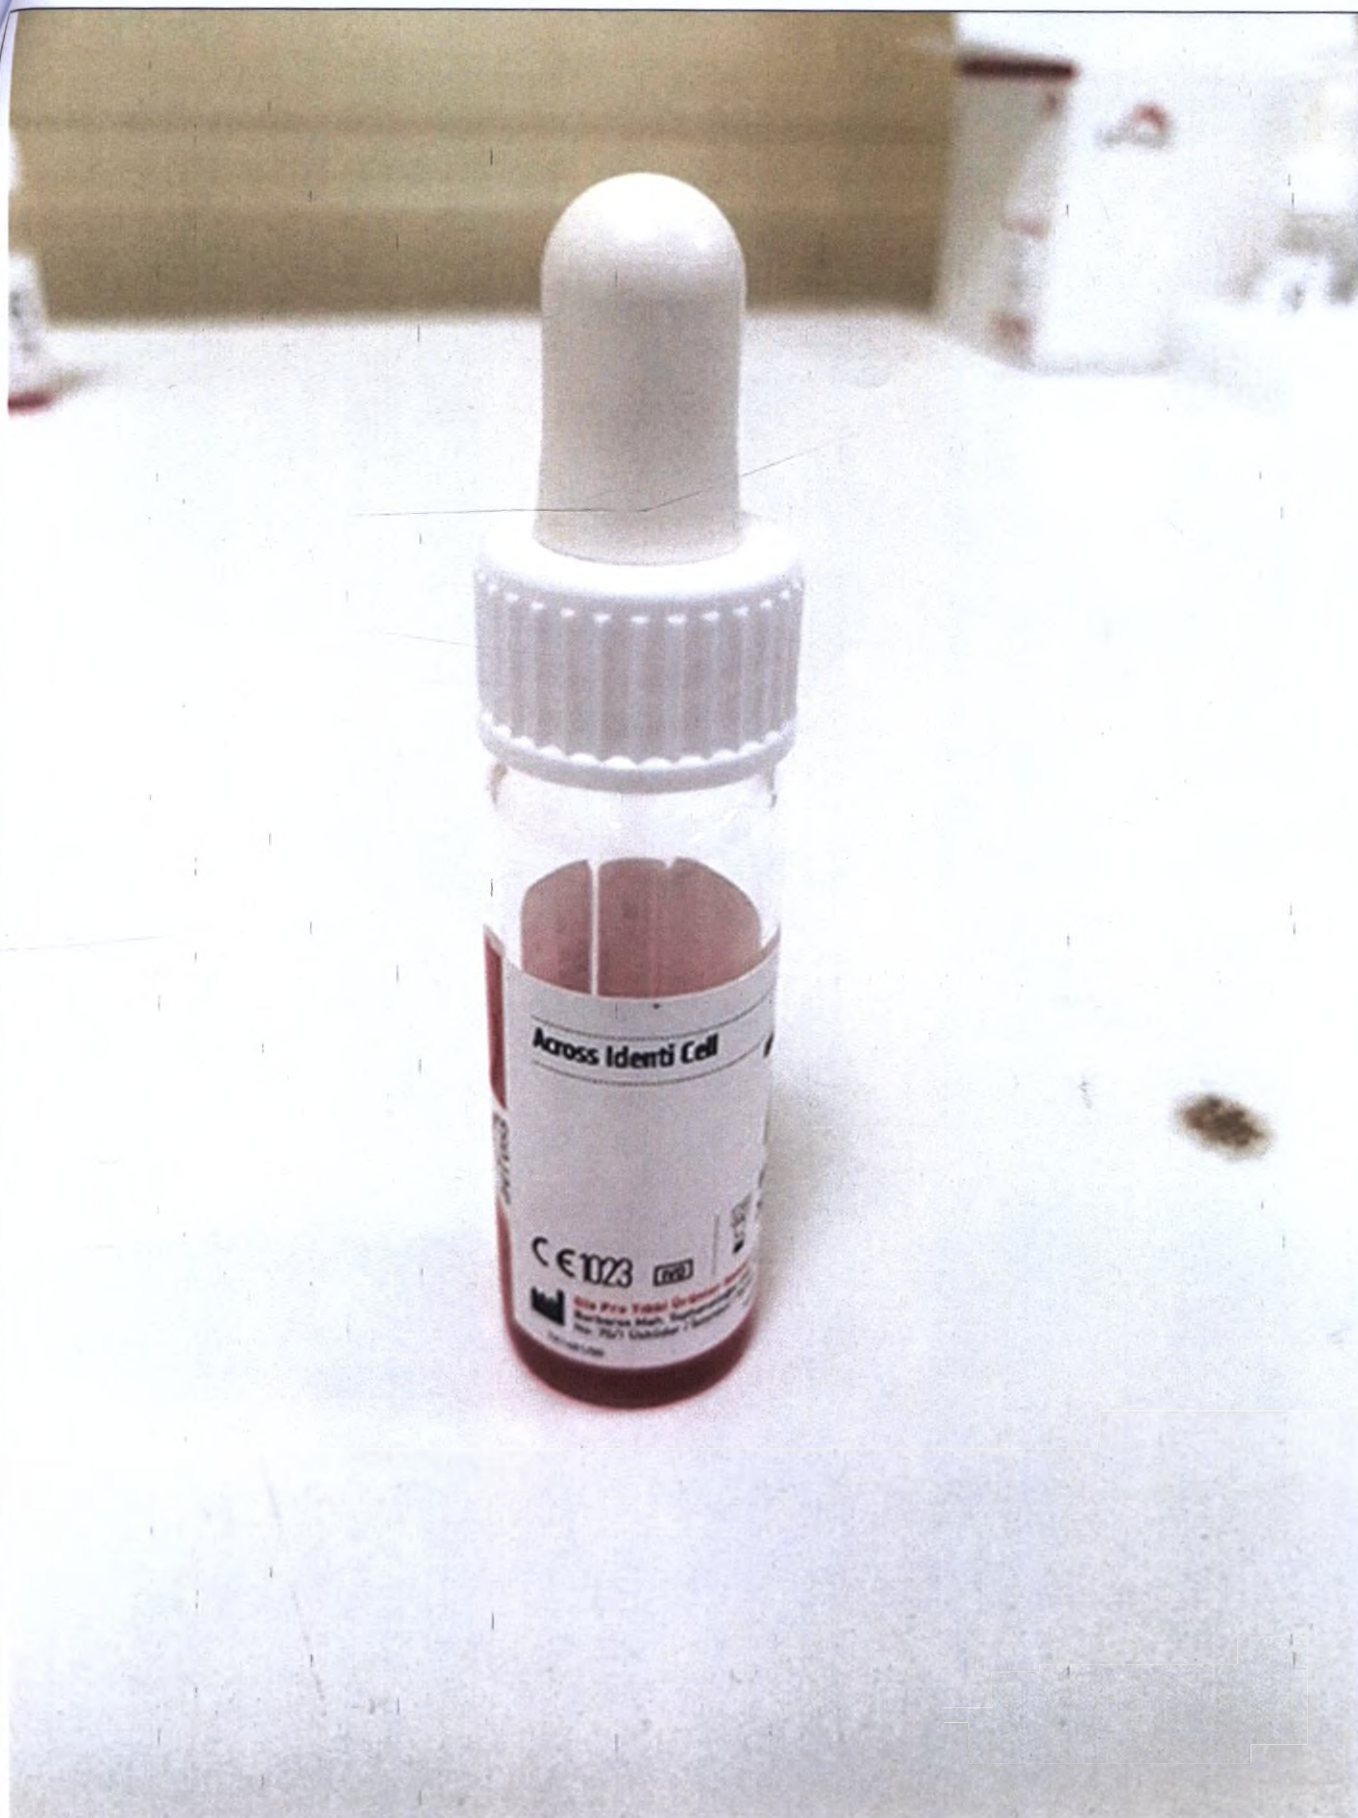

Внешний вид медицинского изделия «Набор эритроцитов стандартных «Across Identi Cell» для идентификации антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro»




Внешний вид медицинского изделия «Набор эритроцитов стандартных «Across Identi Cell» для идентификации антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro»

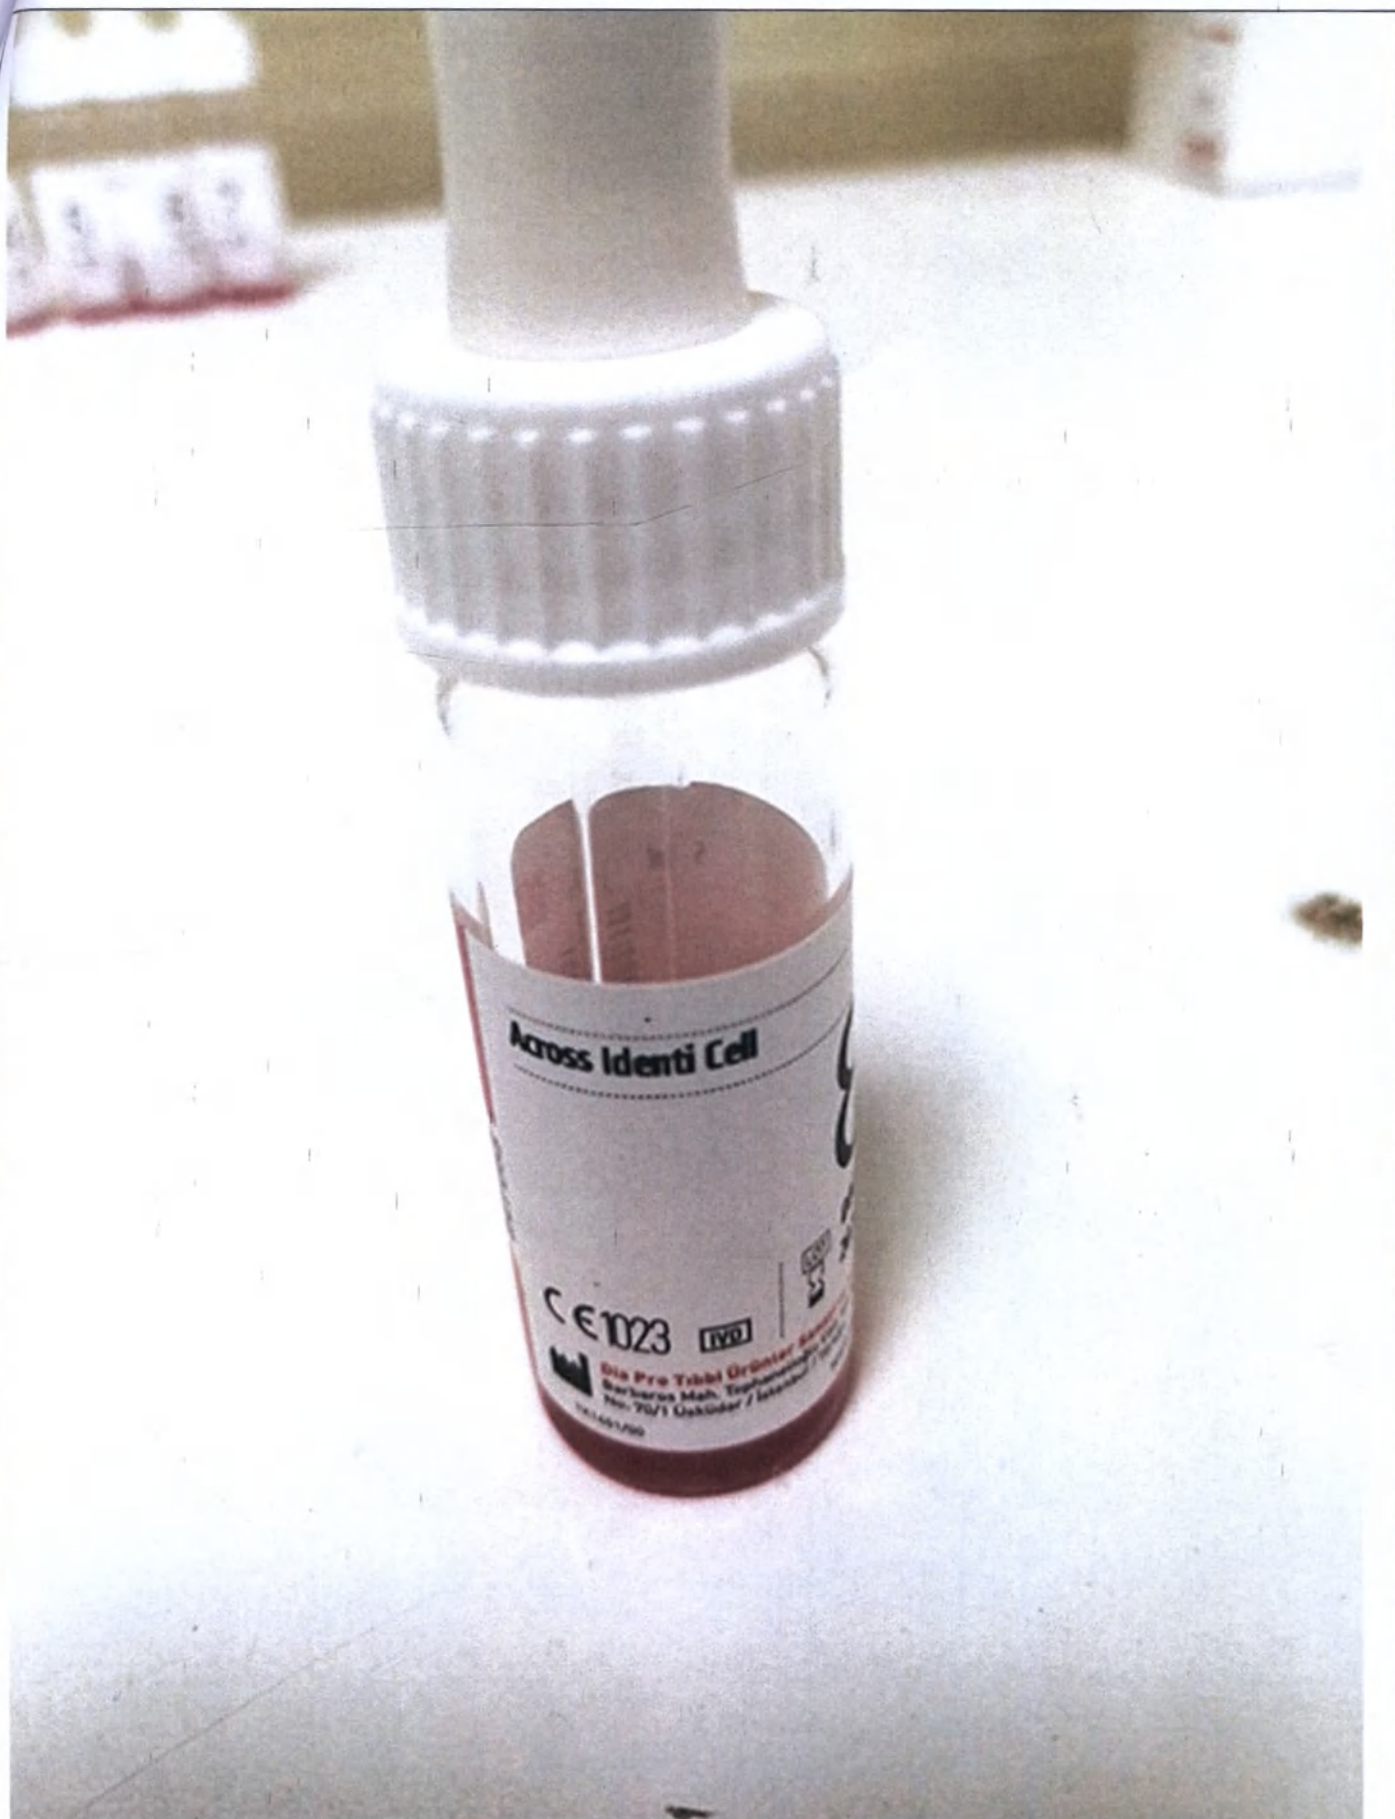

Внешний вид медицинского изделия «Набор эритроцитов стандартных «Across Identi Cell» для идентификации антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro»




Внешний вид медицинского изделия «Набор эритроцитов стандартных «Across Identi Cell» для идентификации антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro»

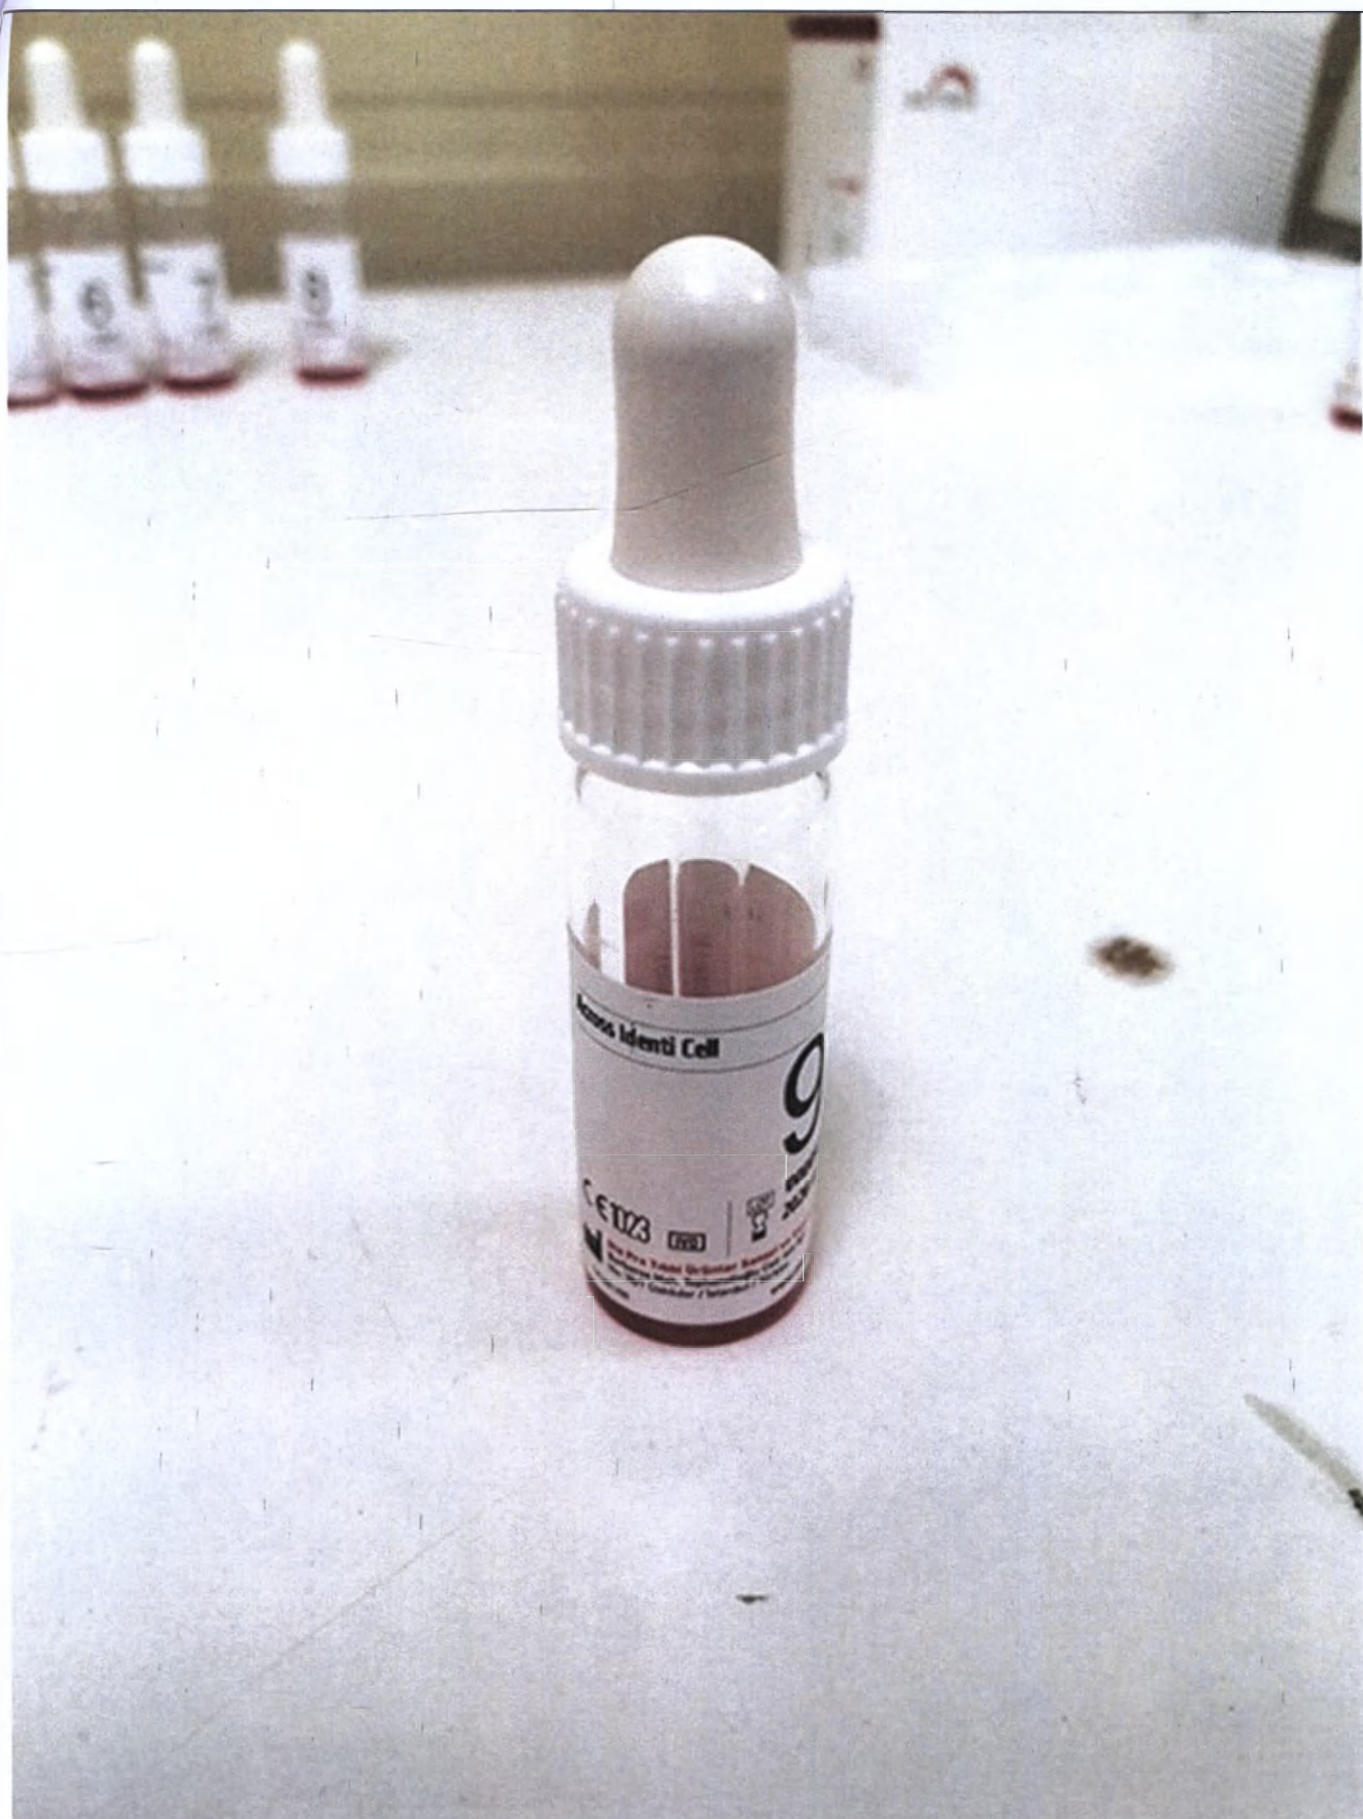

Внешний вид медицинского изделия «Набор эритроцитов стандартных «Across Identi Cell» для идентификации антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro»



Внешний вид медицинского изделия «Набор эритроцитов стандартных «Across Identi Cell» для идентификации антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro»

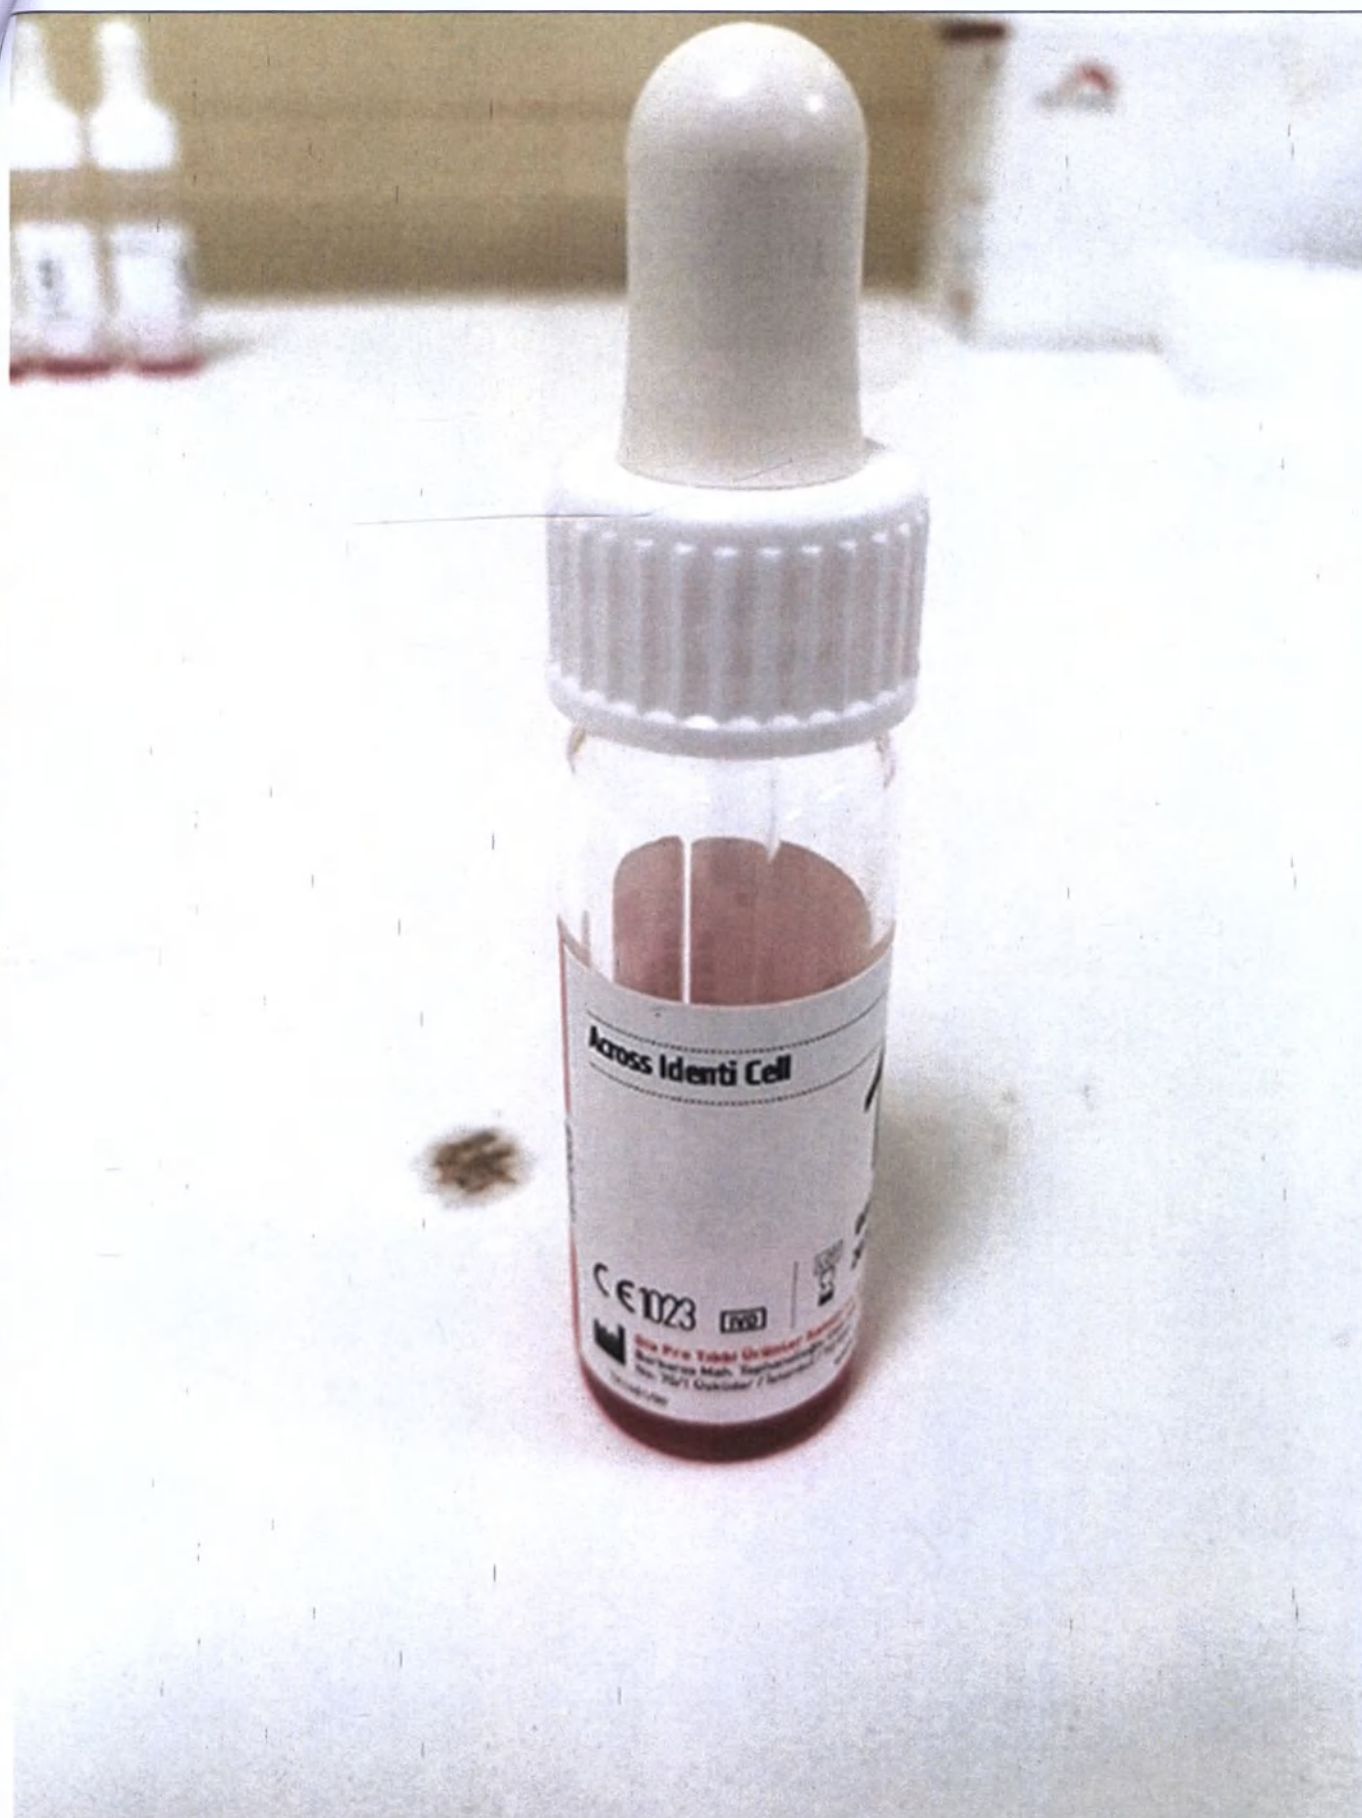

Внешний вид медицинского изделия «Набор эритроцитов стандартных «Across Identi Cell» для идентификации антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro»



Внешний вид медицинского изделия «Набор эритроцитов стандартных «Across Identi Cell» для идентификации антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации *in vitro*»



Внешний вид медицинского изделия «Набор эритроцитов стандартных «Across Identi Cell» для идентификации антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro»



Внешний вид медицинского изделия «Набор эритроцитов стандартных «Across Identi Cell» для идентификации антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации *in vitro*»

Across Identiti Cell / Across Identiti Cell P

Ad ve Soyadı : _____

Doğum Tarihi : _____

Yaşam Yolu : _____

Tarih : _____

ABO / Rh : _____

Direct Coombs : DAT : _____

Yorum / Comment : _____

ANTİGEN TABLOSU / ANTIGEN TABLE

Kod	Duffy		Kidd		Lewis		MNS			Luth		Over Impone Special Antigens	Enzyme Test Result AT 4°C
	Fy ^a	Fy ^b	Jk ^a	Jk ^b	Le ^a	Le ^b	M	N	S	s	Lu ^a		
1	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	1
2	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	2
3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	3
4	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	4
5	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	5
6	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	6
7	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	7
8	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	8
9	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	9
10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	10
11	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	11
Control	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Control

Eğer kurtarılan hücreleri proteolitik enzim ile işlem görmüş ise (Across Identiti Cell P), boyalı sütunlarda bulunan antijenlerin reaksiyonları zayıflamış veya yok olmuştur.
If the isolated cells are treated with proteolytic enzymes (Across Identiti Cell P), the shaded columns indicate antigens whose reactivity is weakened or destroyed.

nt Test edilmedi / not tested
w Zayıf / Weak

CE 1023

0001030 2020.01.15

Diğer Pro Tedi Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Menek / Head Office : Barbaros Mah. Topkapi Cad. 101 Apt. No 20/11 Gebze / İstanbul / Türkiye
Fabrika / Factory : İsmail Mah. Gebze Plazda Q38 Akadik Bx. No 25/11 Gebze / Kocaeli / Türkiye
www.dipro.com.tr

Rev. No / Rev. No : 02

Yayın Tarihi / Release Date : 19.06.2015

Внешний вид составляющей медицинского изделия «Набор эритроцитов стандартных «Across Identiti Cell» для идентификации антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной агглютинации in vitro» - Таблицы антигенного состава



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
медицинского изделия
для диагностики in vitro**

**«Набор эритроцитов стандартных «Across Identi Cell» для идентификации
антиэритроцитарных антител в сыворотке и плазме крови человека методом колоночной
агглютинации in vitro»
производства**

Dia Pro Tibbi Ürünler San. Ve Tic. A.Ş. (Диа Про Тибби Урюнлер Сан. Ве Тик. А.С.), Турция

Инструкция по применению (в комплекте и на официальном сайте производителя)

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 29
(двадцать девять л.

Генеральный директор
ООО «Адвенсум»

Д.В. Мокеев

