





Маркировка осветителя эндоскопического для гибкой эндоскопии

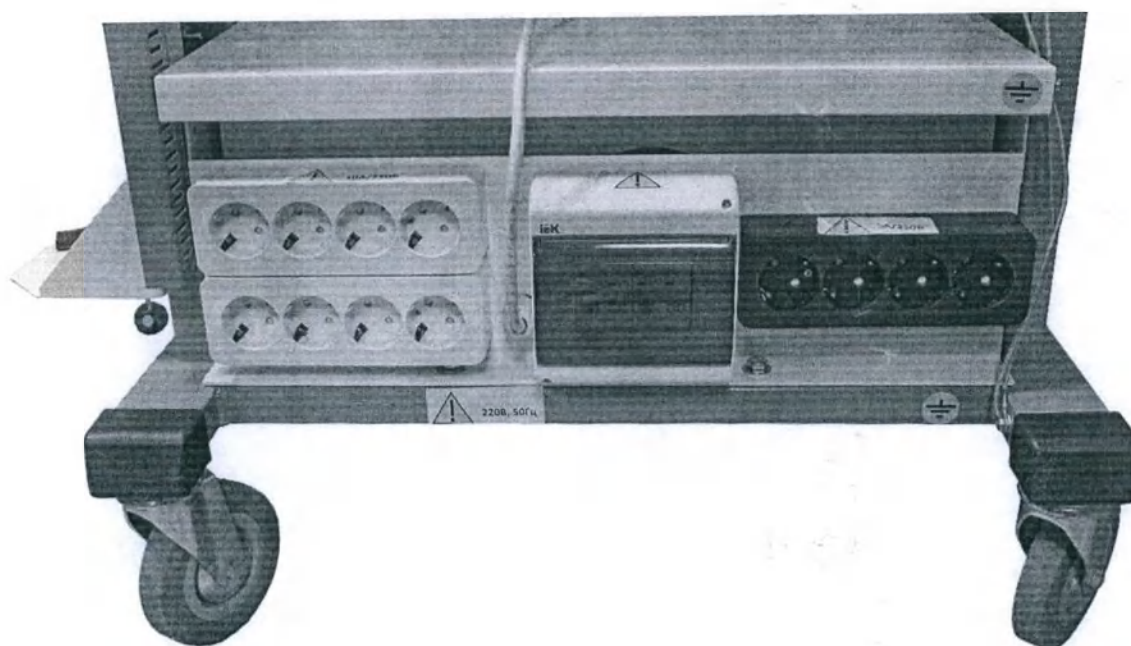

Маркировка стойки аппаратной эндоскопической "НТК Азимут плюс"

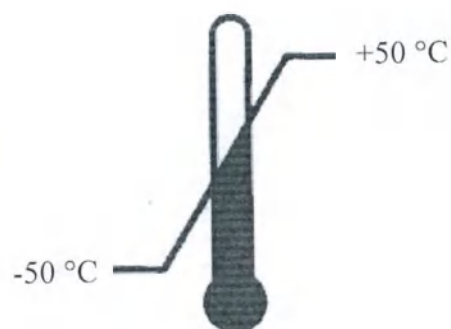

Манипуляционные знаки, наносимые на транспортную упаковку



АО "ЛОМО"
СИСТЕМА ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ СВ -1
ИКШЮ.941123.004ТУ



СДЕЛАНО В РОССИИ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ -1(Л) ПО ГОСТ 15150

ЗАКОНСЕРВИРОВАНО ДО

БРУТТО кг

НОМЕР ГРУЗОВОГО МЕСТА

SN

.....



АО "ЛОМО" ул. Чугунная, д. 20.
Санкт-Петербург, Россия, 194044
телефон 7(812)292-5242, 292-5001,
факс 7(812)542-1839

Этикетка на транспортную упаковку

23.03.2021

23.03.2021

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 21998

23.03.2021

08

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек

ИНН 7804002321	КПП 780401001	Сумма	1500-00
АО "ЛОМО"		Сч. №	40702810980000005627
Платательщик		БИК	044030704
Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ Г.Санкт-Петербург		Сч. №	30101810200000000704
Банк плательщика		БИК	024501901
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ //Межрегиональное операционное УФК г Москва		Сч. №	40102810045370000002
Банк получателя		Сч. №	03100643000000019500
ИНН 7710537160	КПП 770901001	Вид. оп.	01
МОУ ФК (Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения л/сч 04951000600)		Наз. пл.	
Получатель		Код	0
06010807200010039110	45381000	Срок плат.	
	0	Очер.плат.	5
	0	Рез. поле	
	0		

Гос. пошлина за внесение изменений в регистрационное удостоверение на медицинское изделие "Система видеозендоскопическая СВ". НДС не облагается.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
г. Санкт-Петербург
БИК 044030704
ИСПОЛНЕН
23.03.2021
80 Бондаренко Т.В. .

**Монитор
жидкокристаллический**

**Блок формирования,
регистрации и
управления сигналом
БУ-СВ**

**Осветитель
эндоскопический для
гибкой эндоскопии**


Клавиатура

**Стойка аппаратная
эндоскопическая
«НТК Азимут плюс»**

Видеоэндоскоп

**Кабель для
видеоэндоскопа**


**Втулка
(баланс белого)**

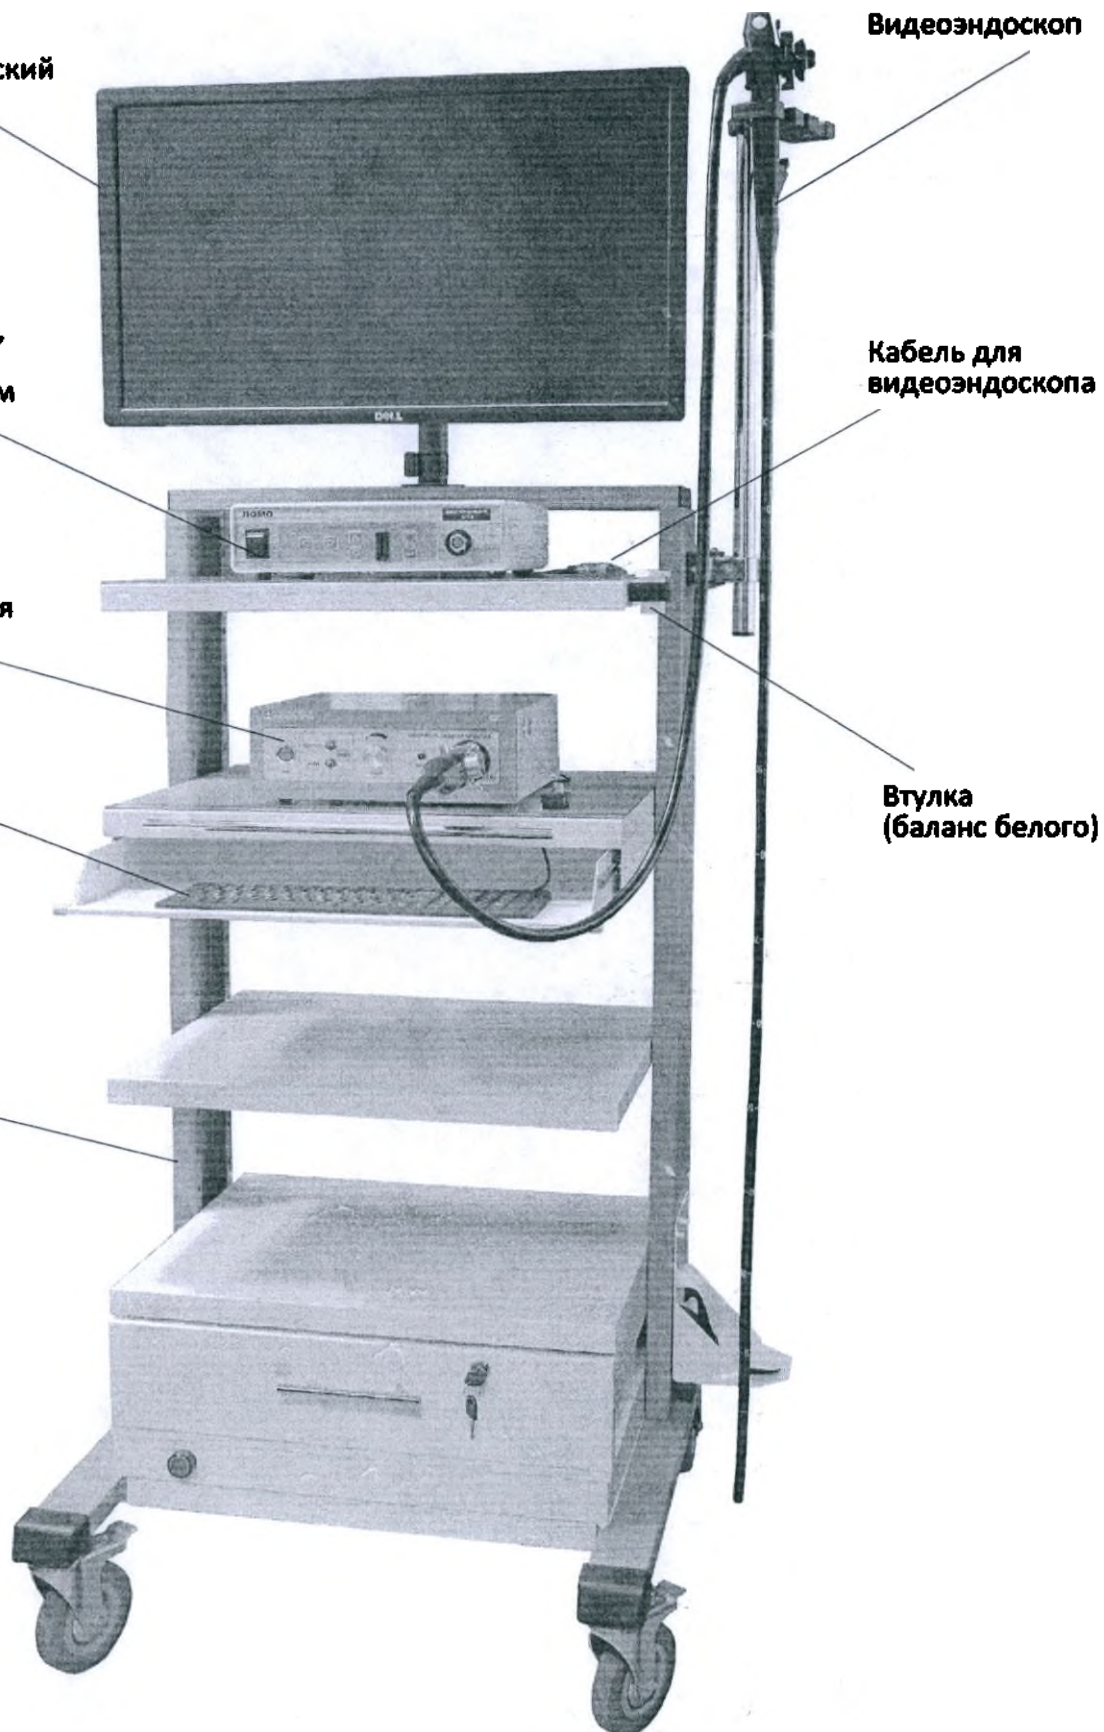

Система видеоэндоскопическая СВ-1



Кабель для видеоэндоскопа VES-00204-00

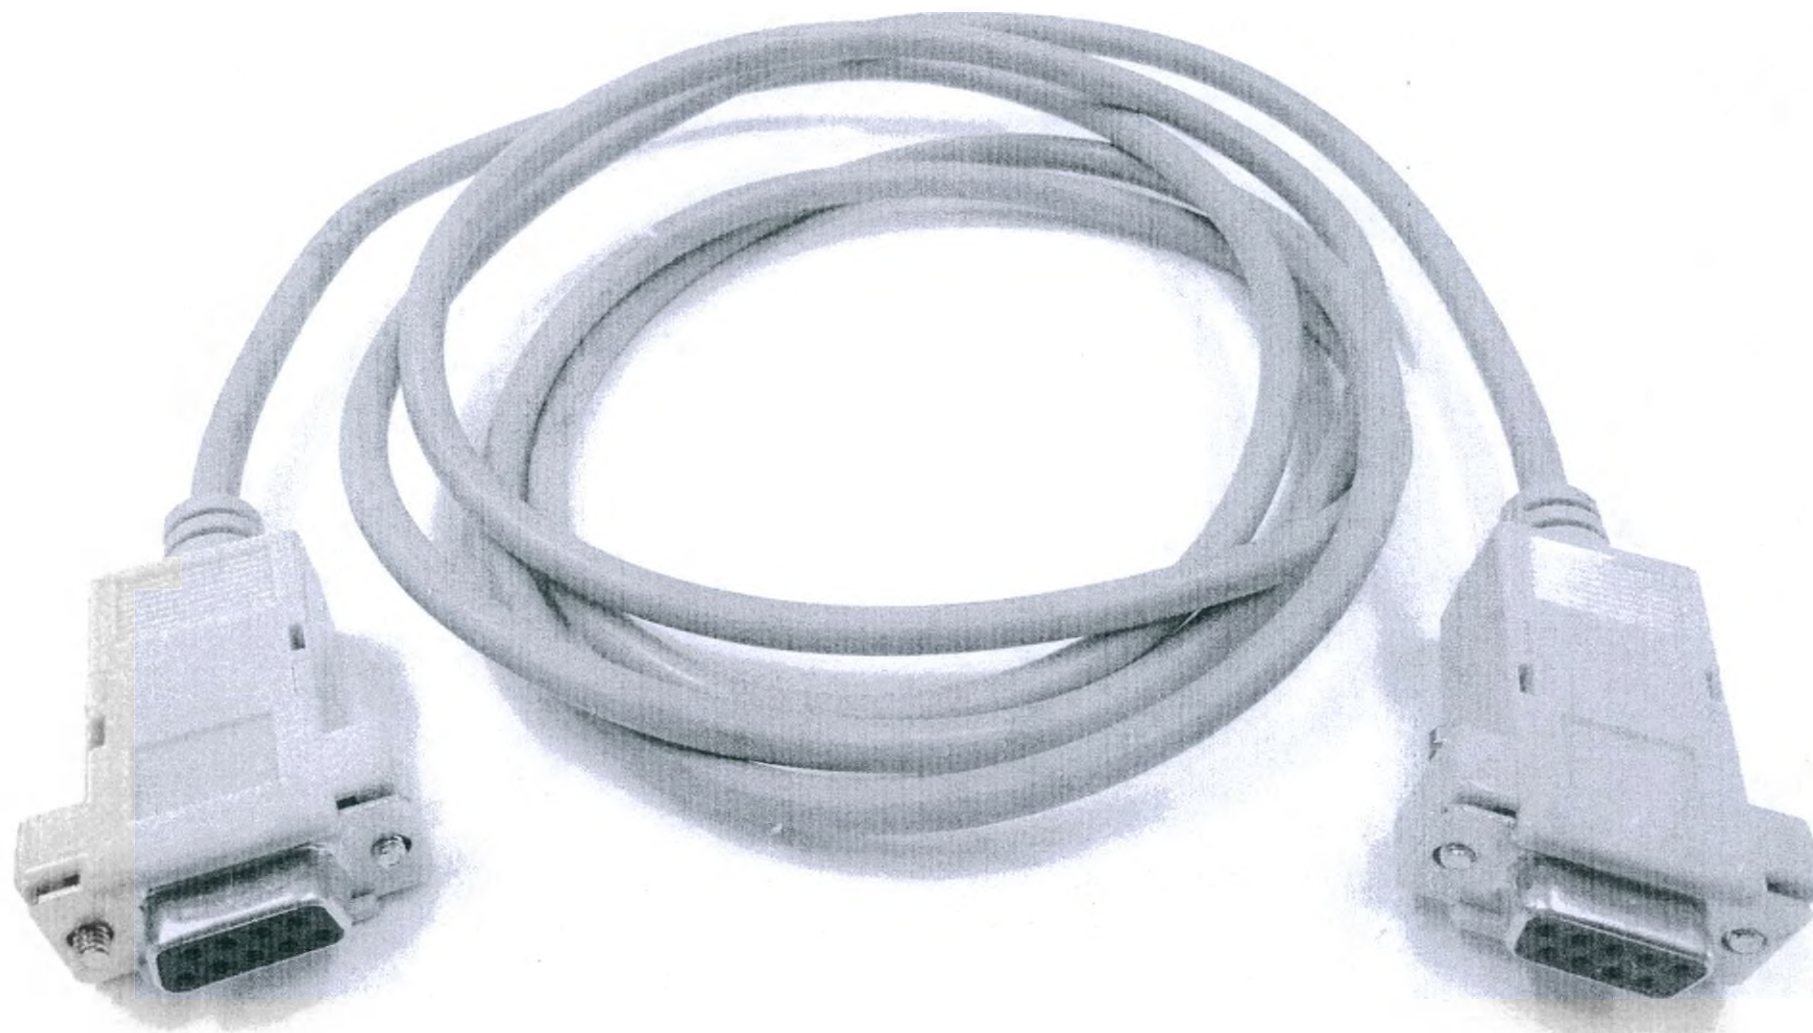

Кабель (нуль-модемный) DB9F-DB9F



Кабель HDMI-HDMI