



Руководитель группы регистрации

Горшкова Н.А.

« 10 » февраля 2021 г.

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для определения C4 компонента комплемента на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Complement C4 (Atellica CH C4))

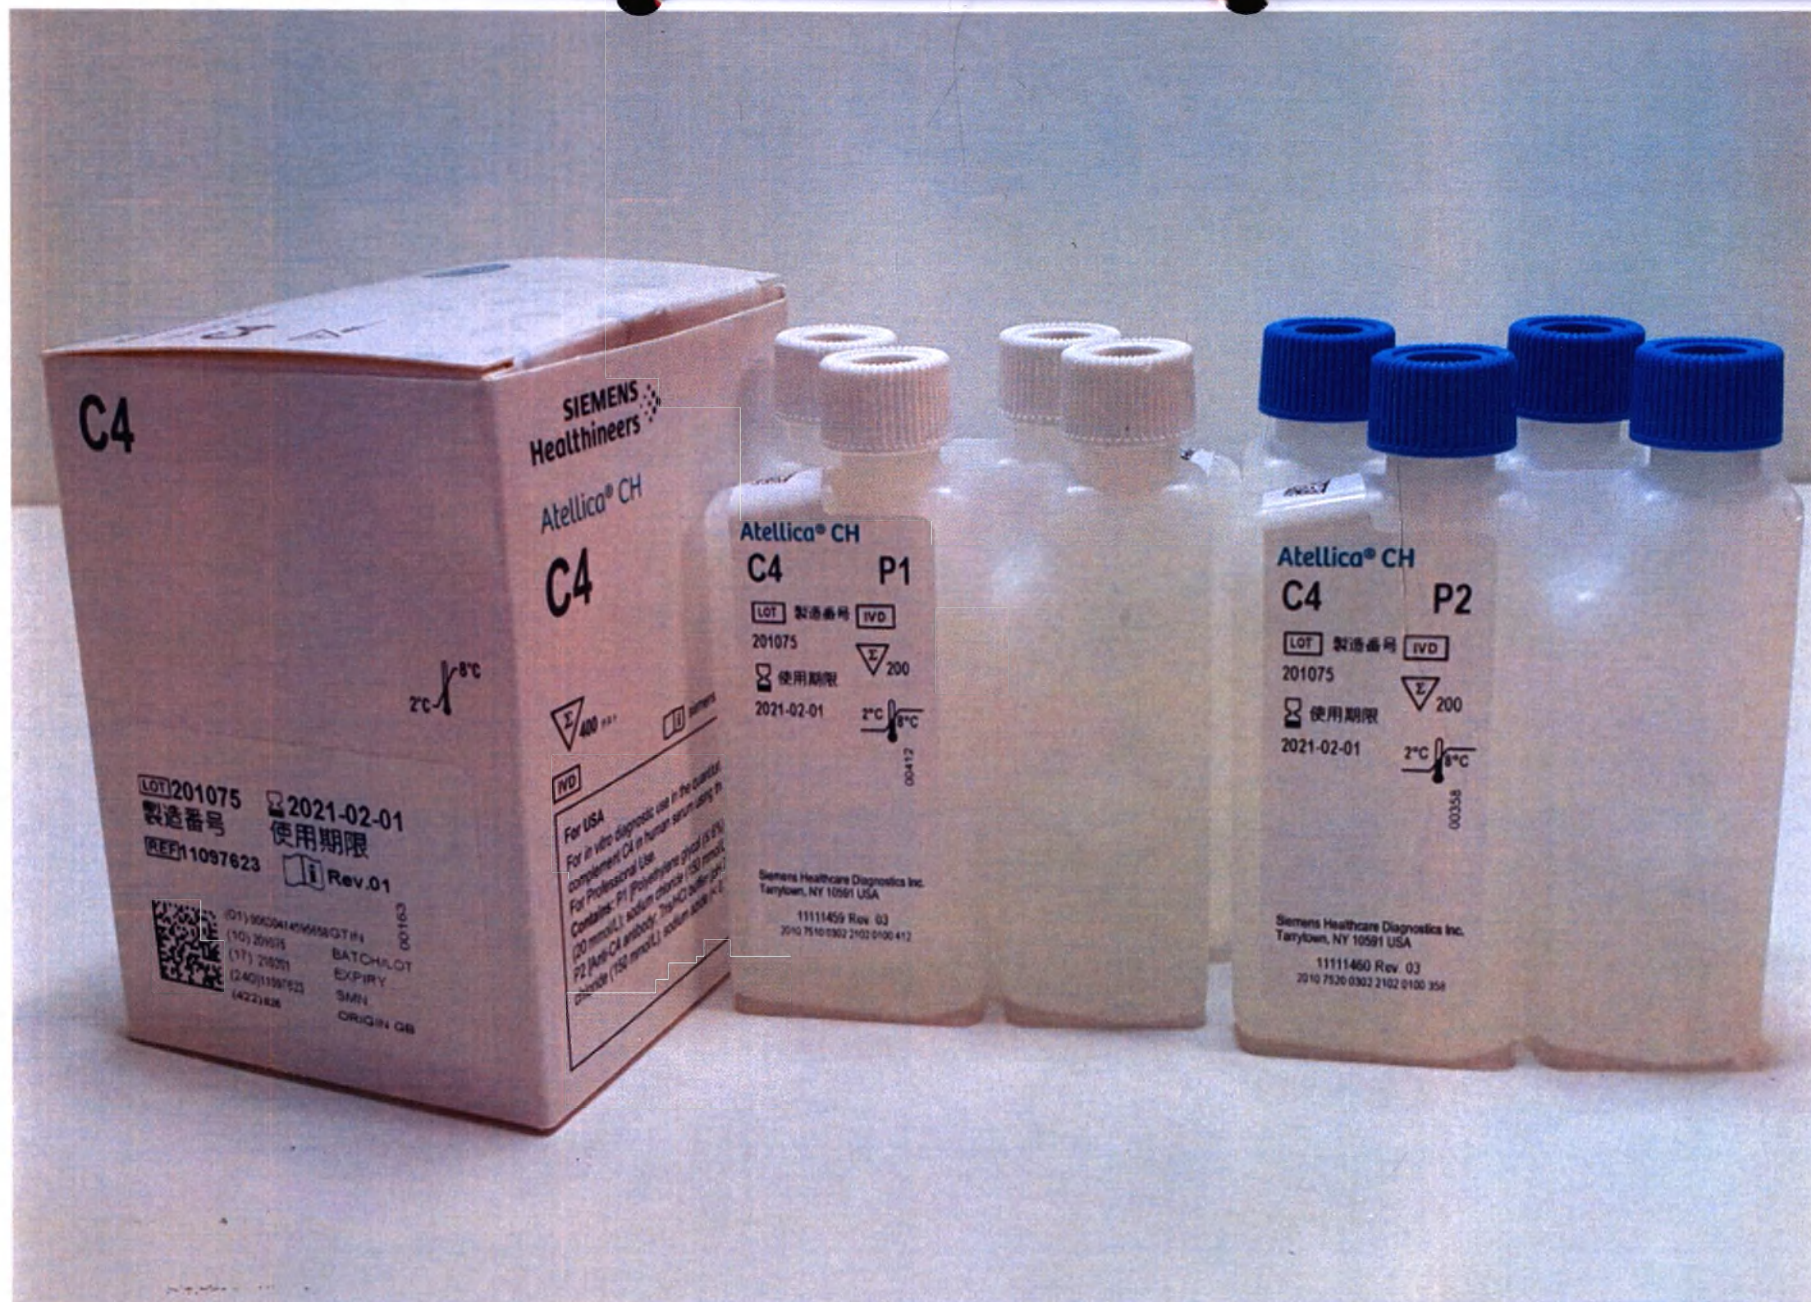


Рисунок 1. Набор реагентов для определения C4 компонента комплемента на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Complement C4 (Atellica CH C4)):

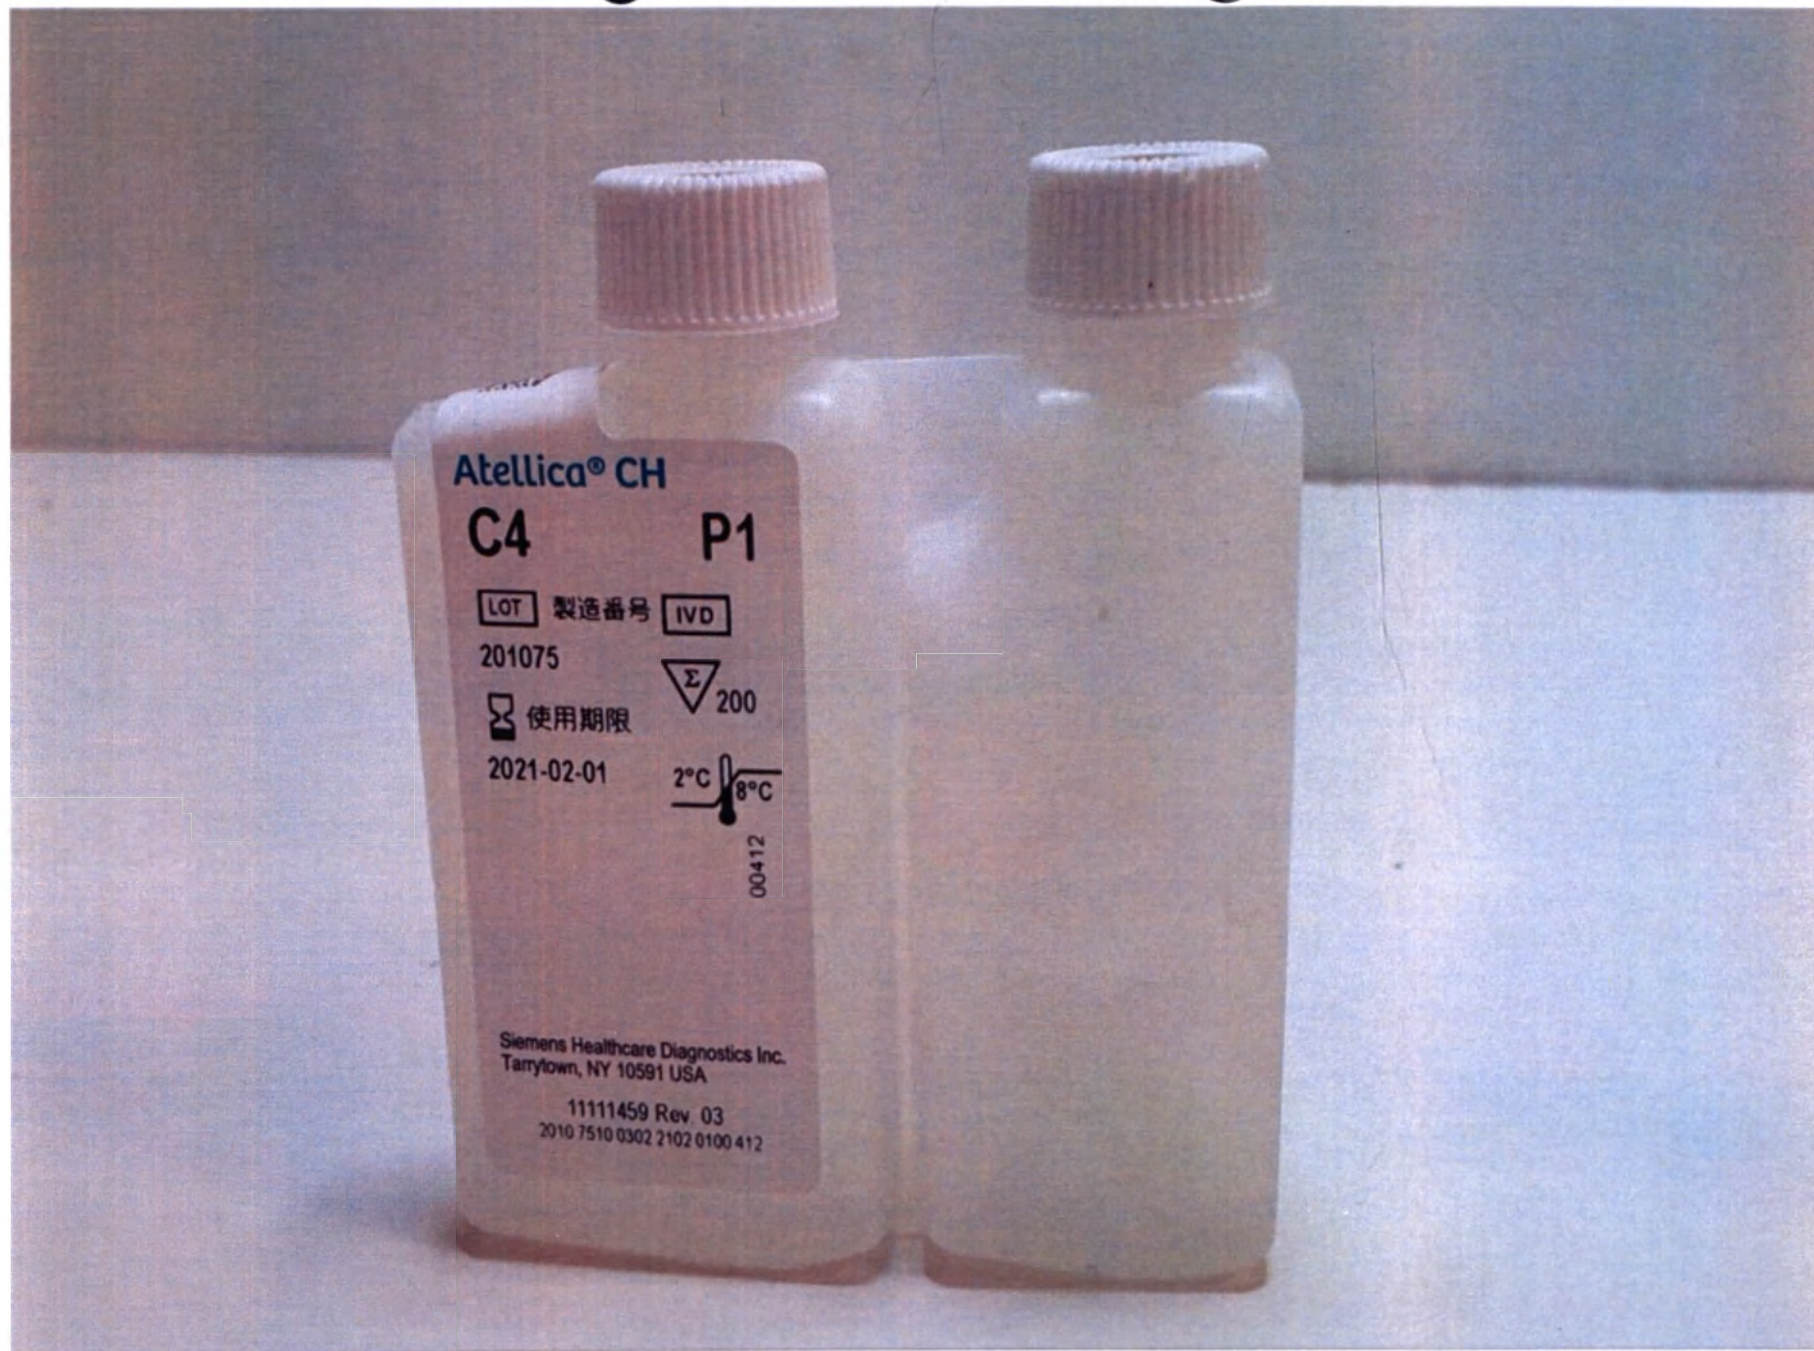


Рисунок 2. Набор реагентов для определения C4 компонента комплемента на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Complement C4 (Atellica CH C4)): пакет с реагентами 1, общий вид

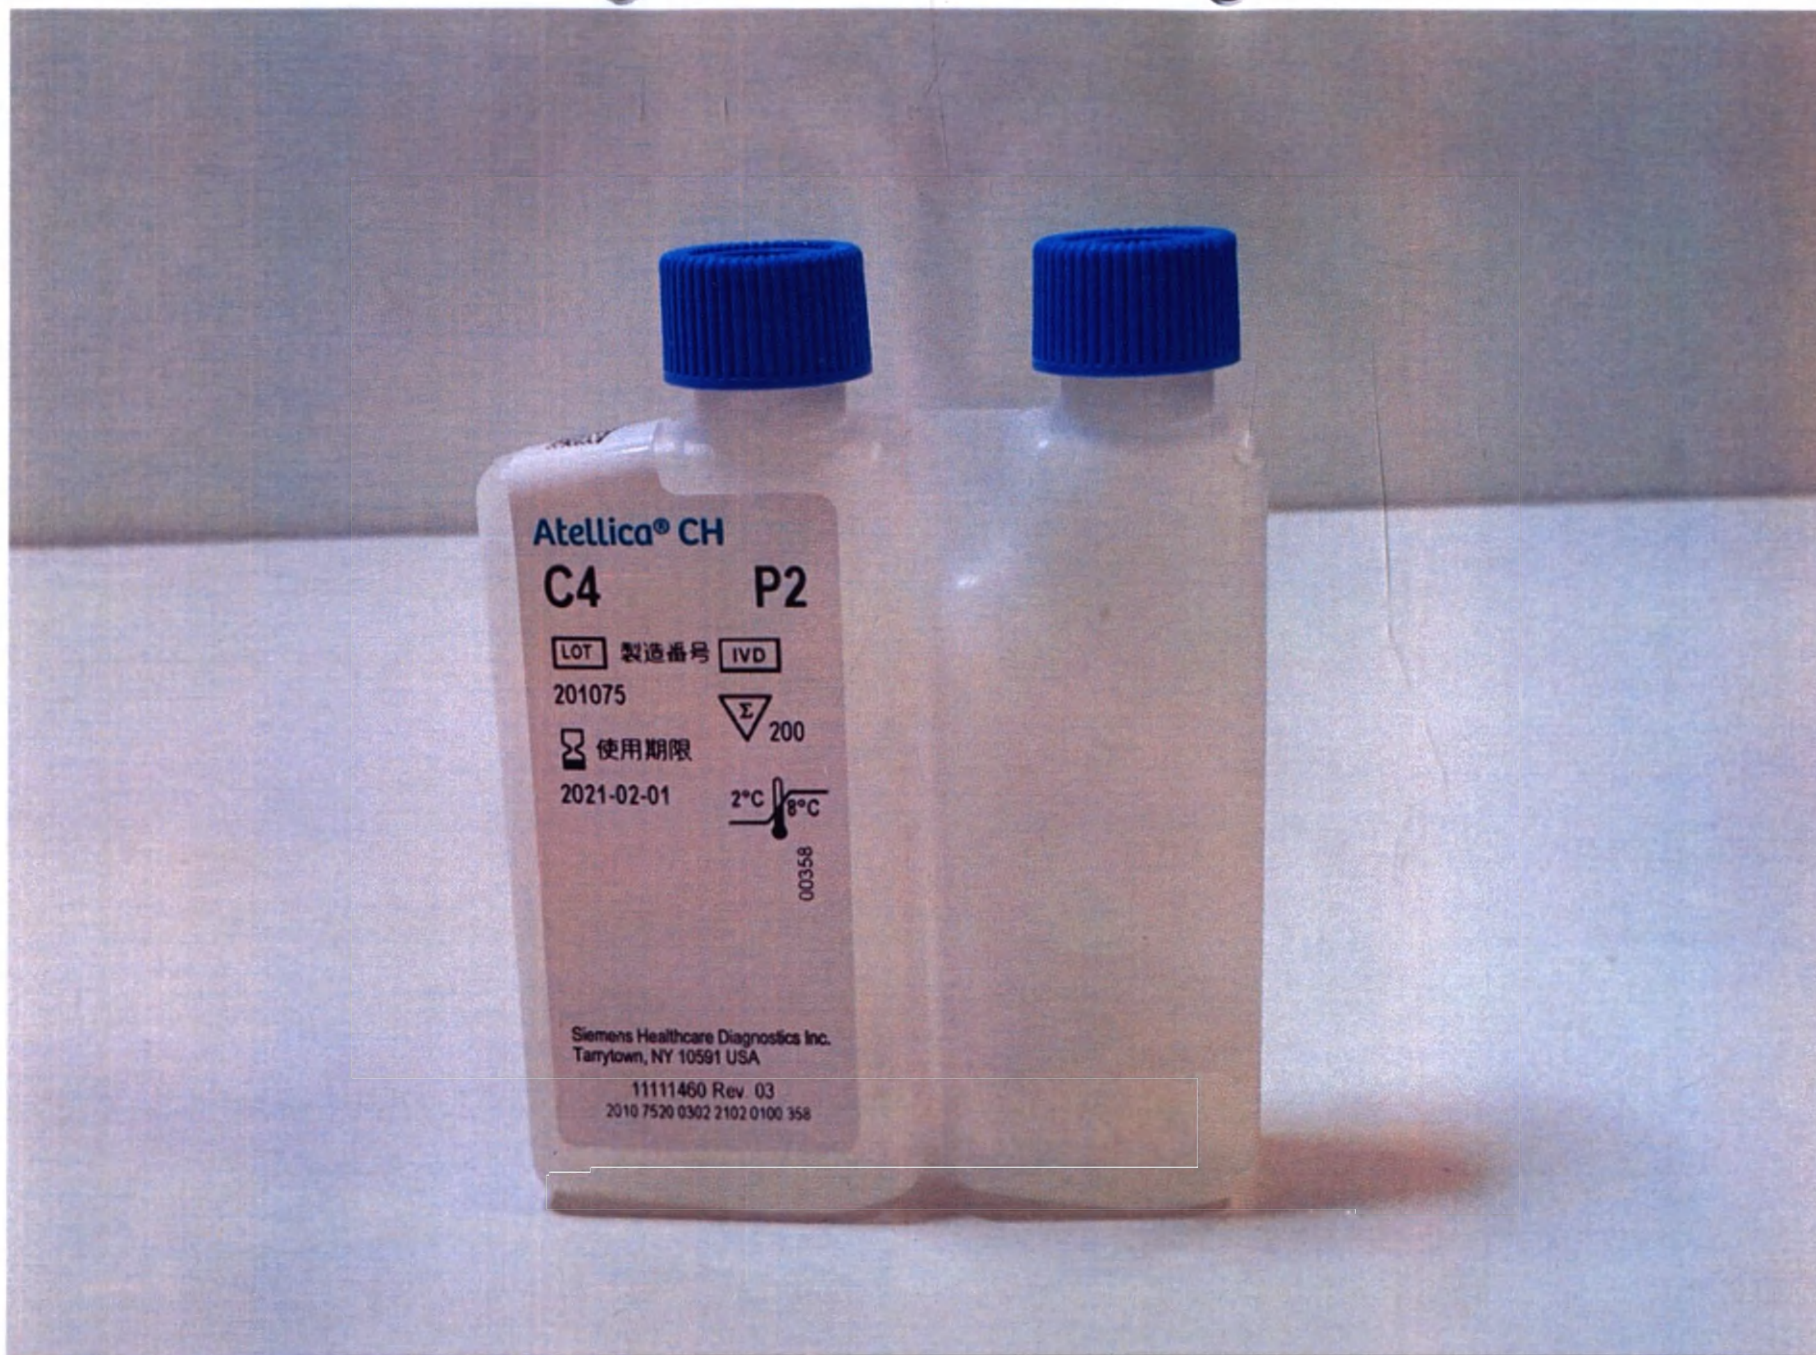


Рисунок 3 Набор реагентов для определения C4 компонента комплемента на анализаторах биохимических серии Atellica (Atellica CH Complement C4 (Atellica CH C4)): пакет с реагентами 2, общий вид



Всего прошито и пронумеровано
4 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

