

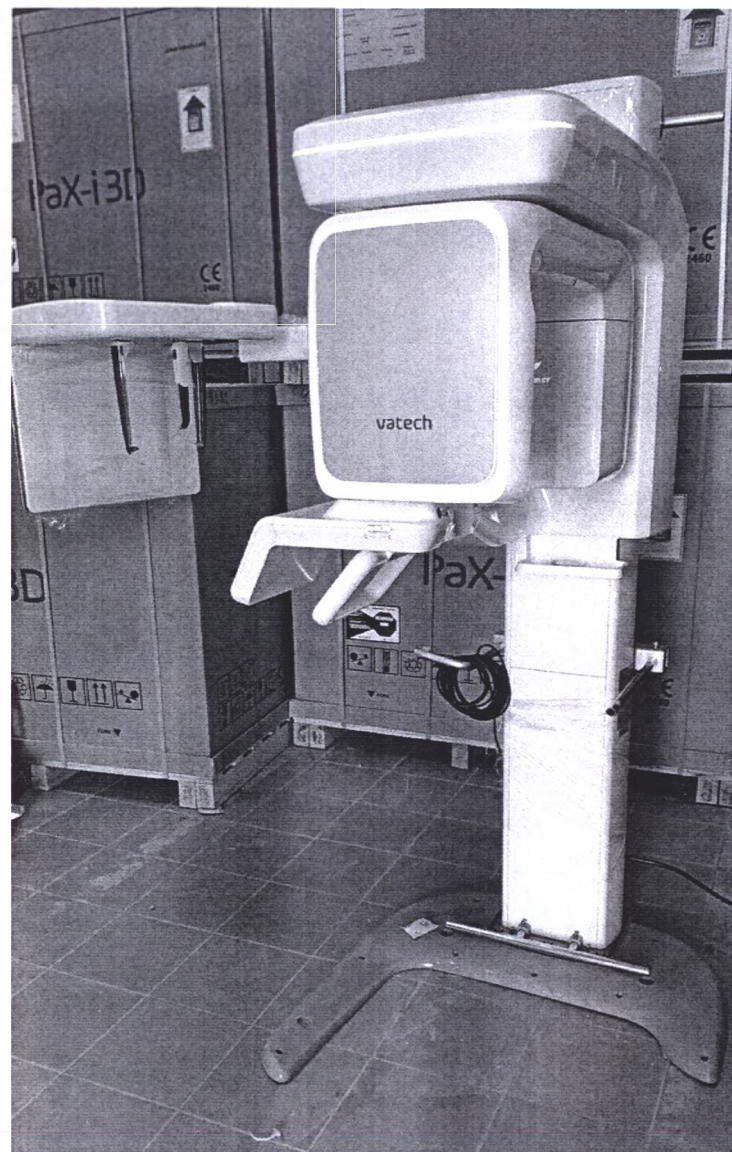


Фотографические материалы медицинского изделия

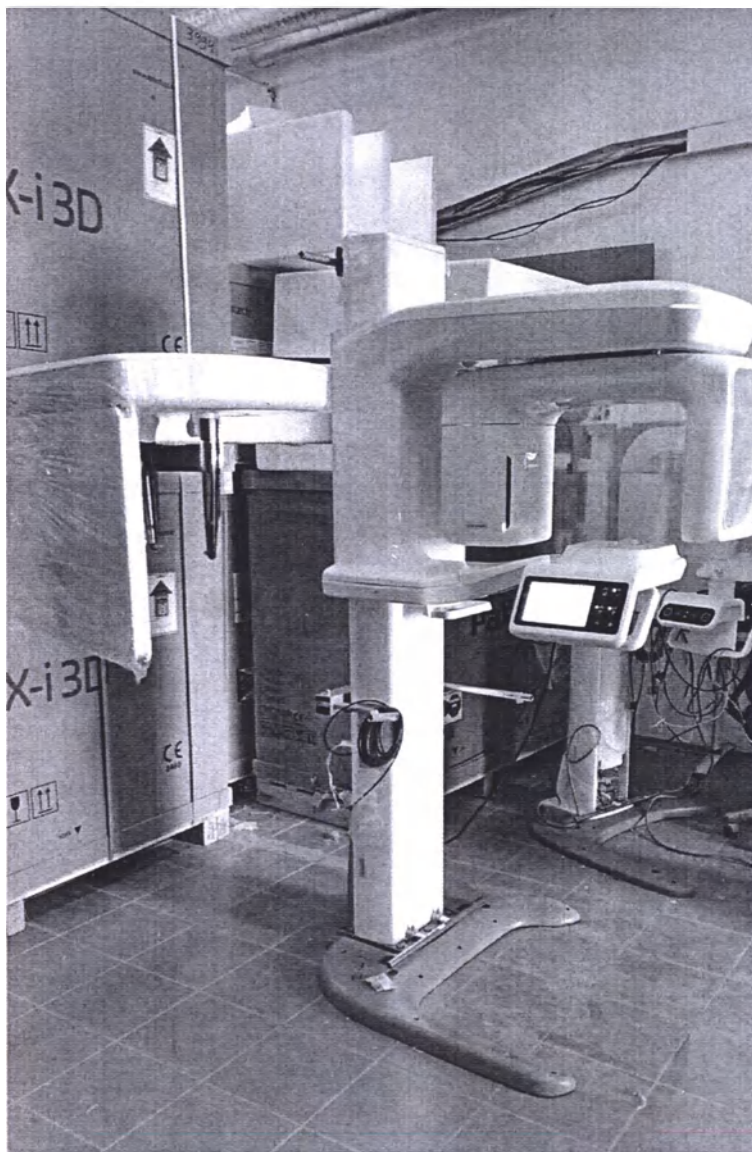

Общий вид медицинского изделия

Вращающийся модуль

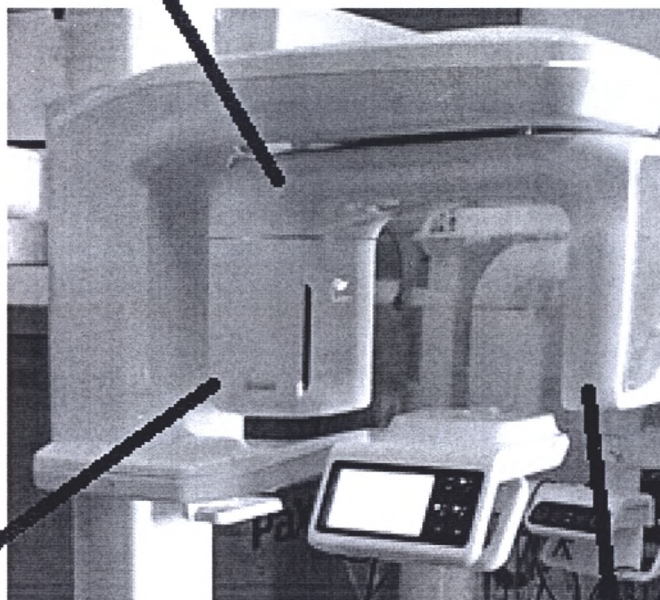


**Рентгеновский генератор
DG-07E22T2 с трубкой
рентгеновской D-052SB Canon**

**Датчик панорамный и
томографический
Хтапу1314CF**


Модуль, вращающийся в составе:

Рентгеновский генератор DG-07E22T2 с трубкой рентгеновской D-052SB Canon;


Датчик панорамный и томографический Хтапу1314CF;

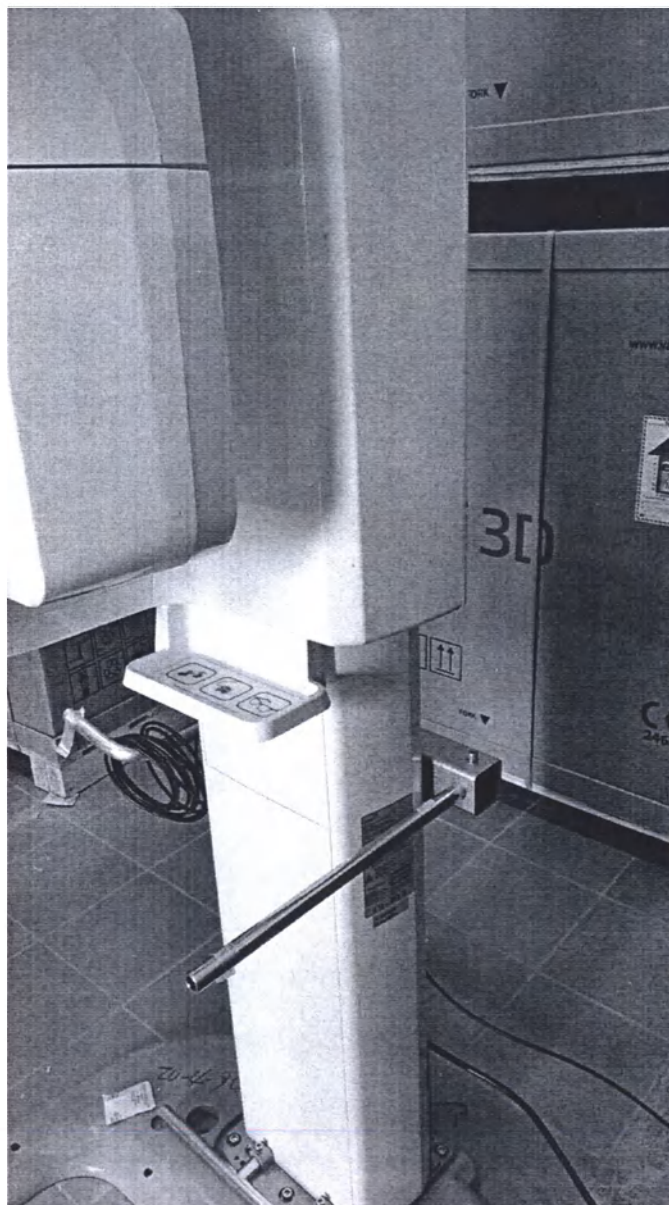


Колонна

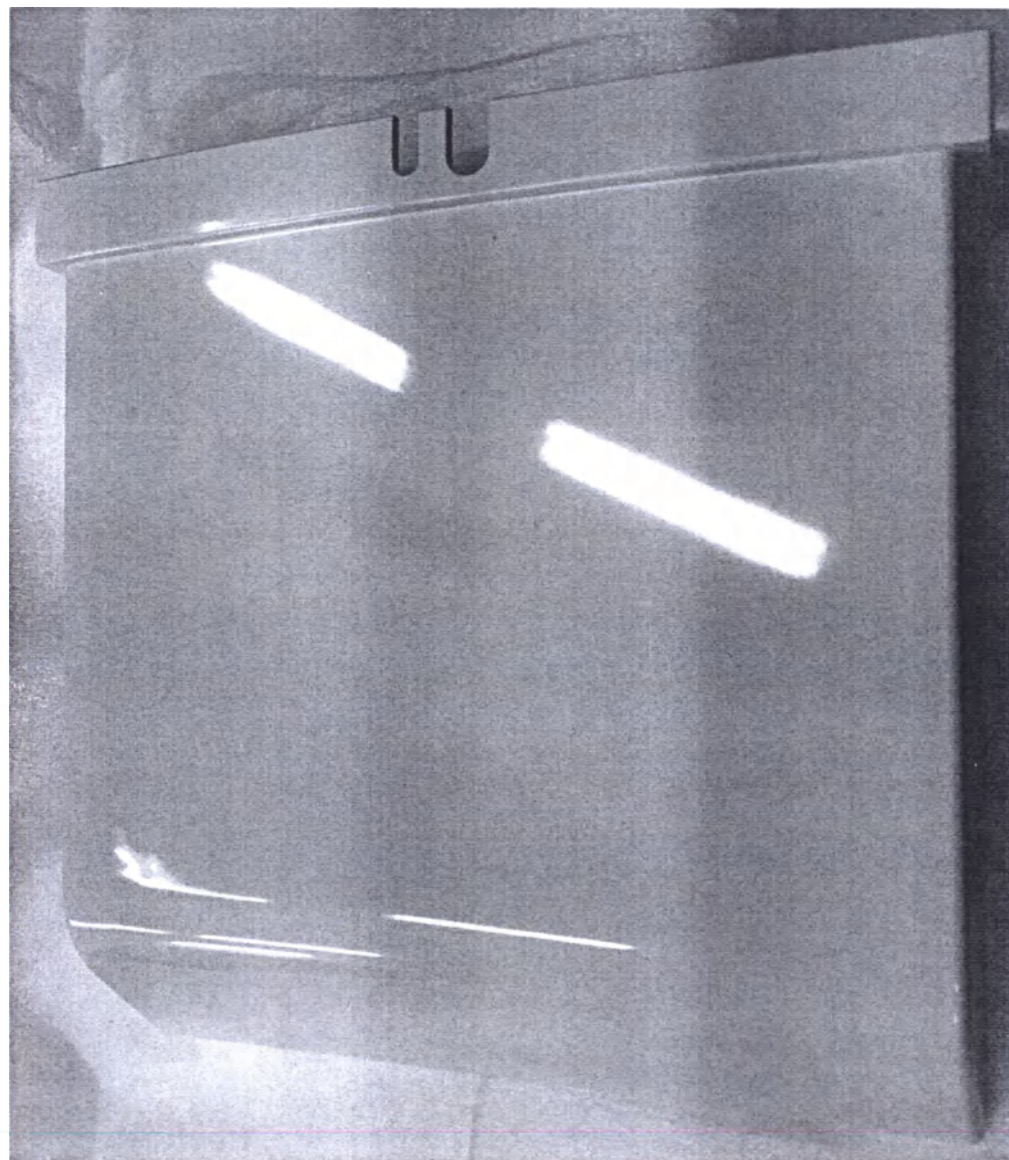


Задняя крышка колонны;

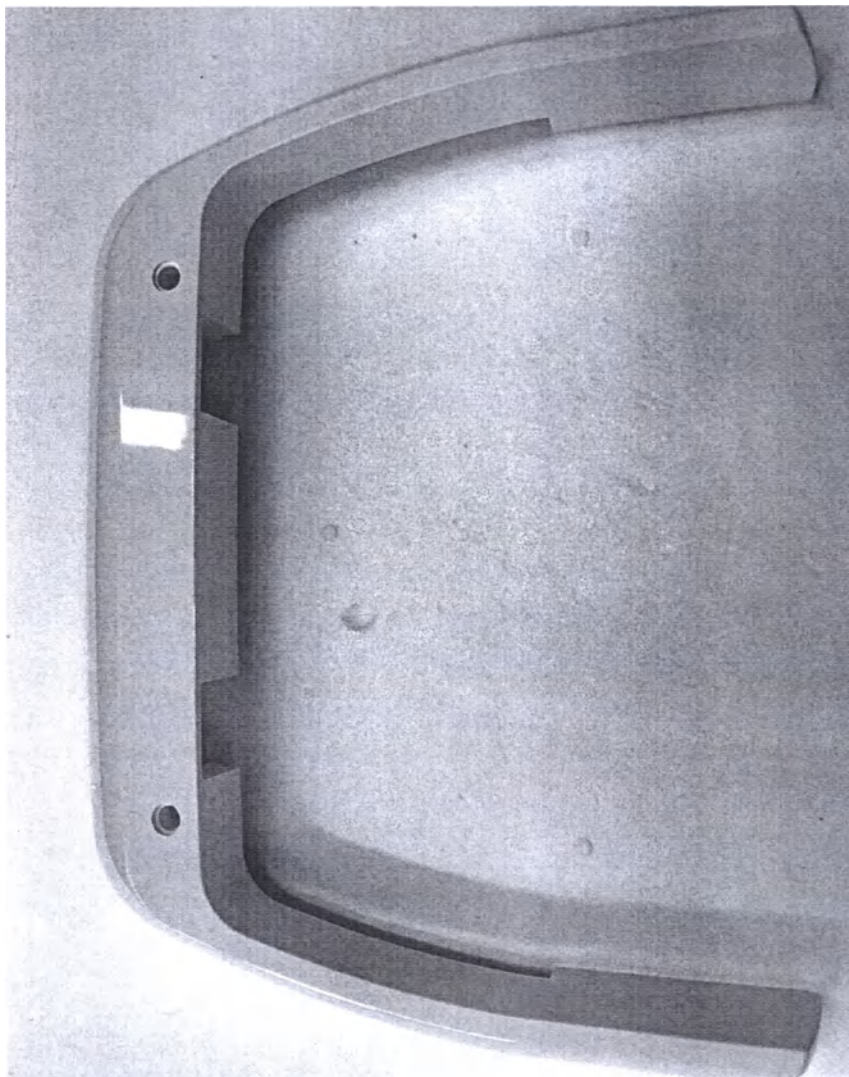


Передняя крышка колонны;

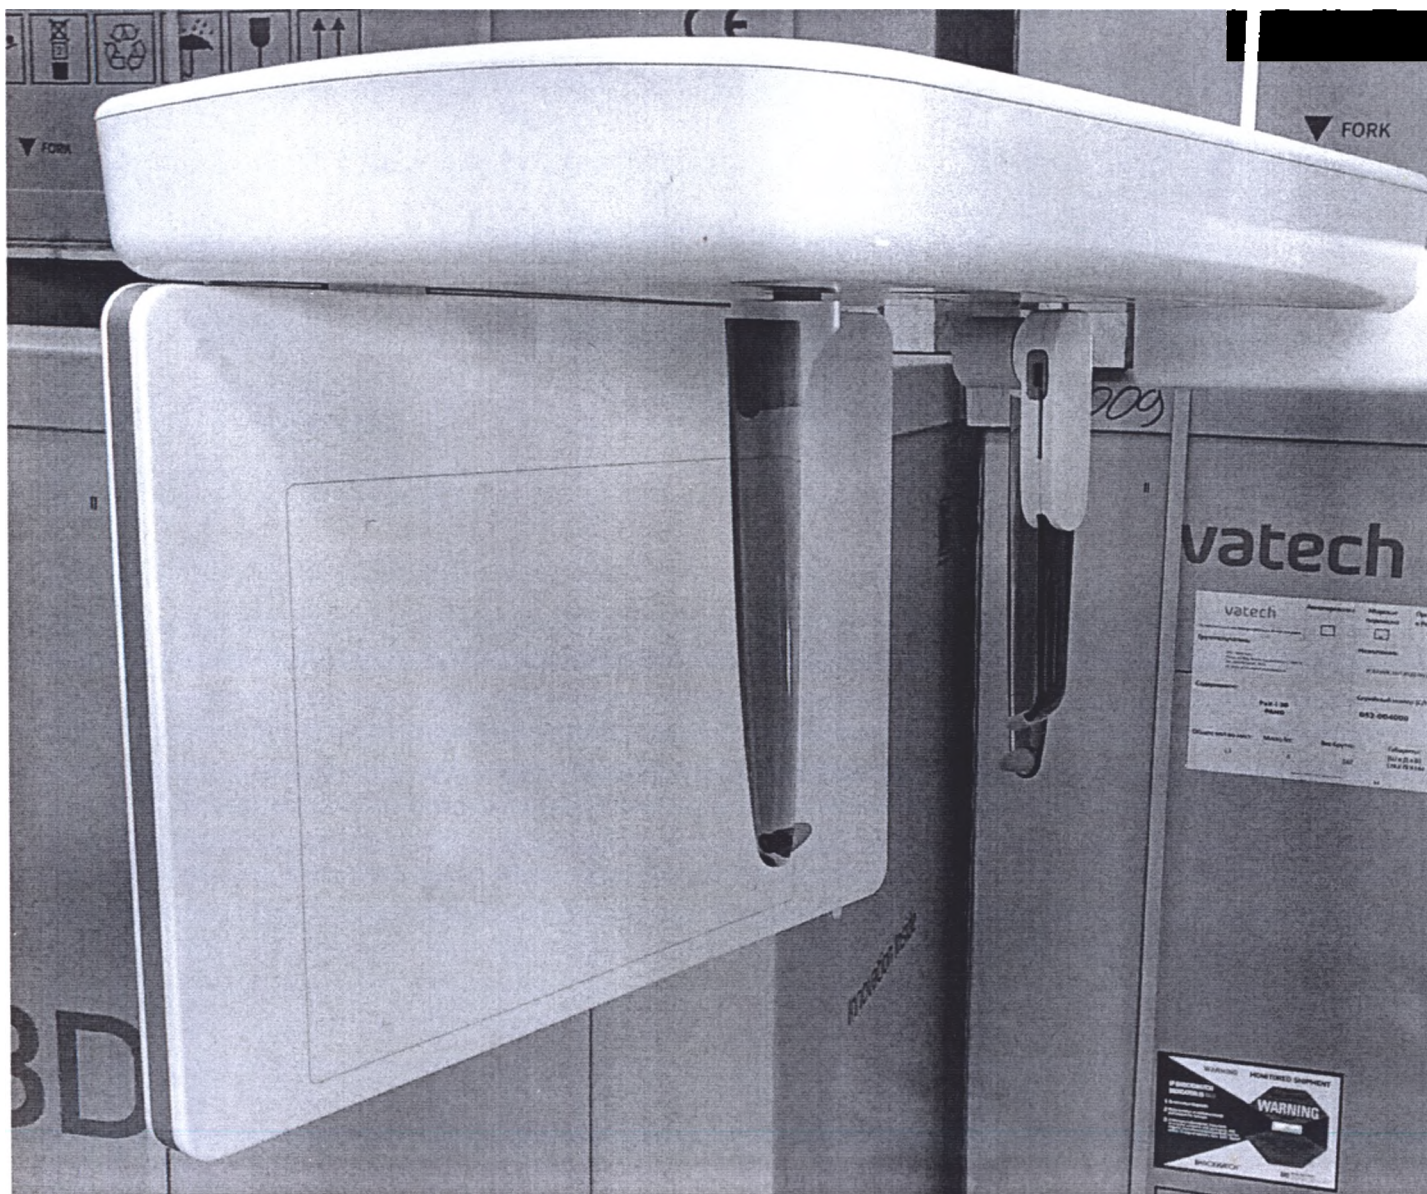

Цефалостат непрерывного сканирования с датчиком рентгеновского излучения цефалометрическим Xmaru2602CF

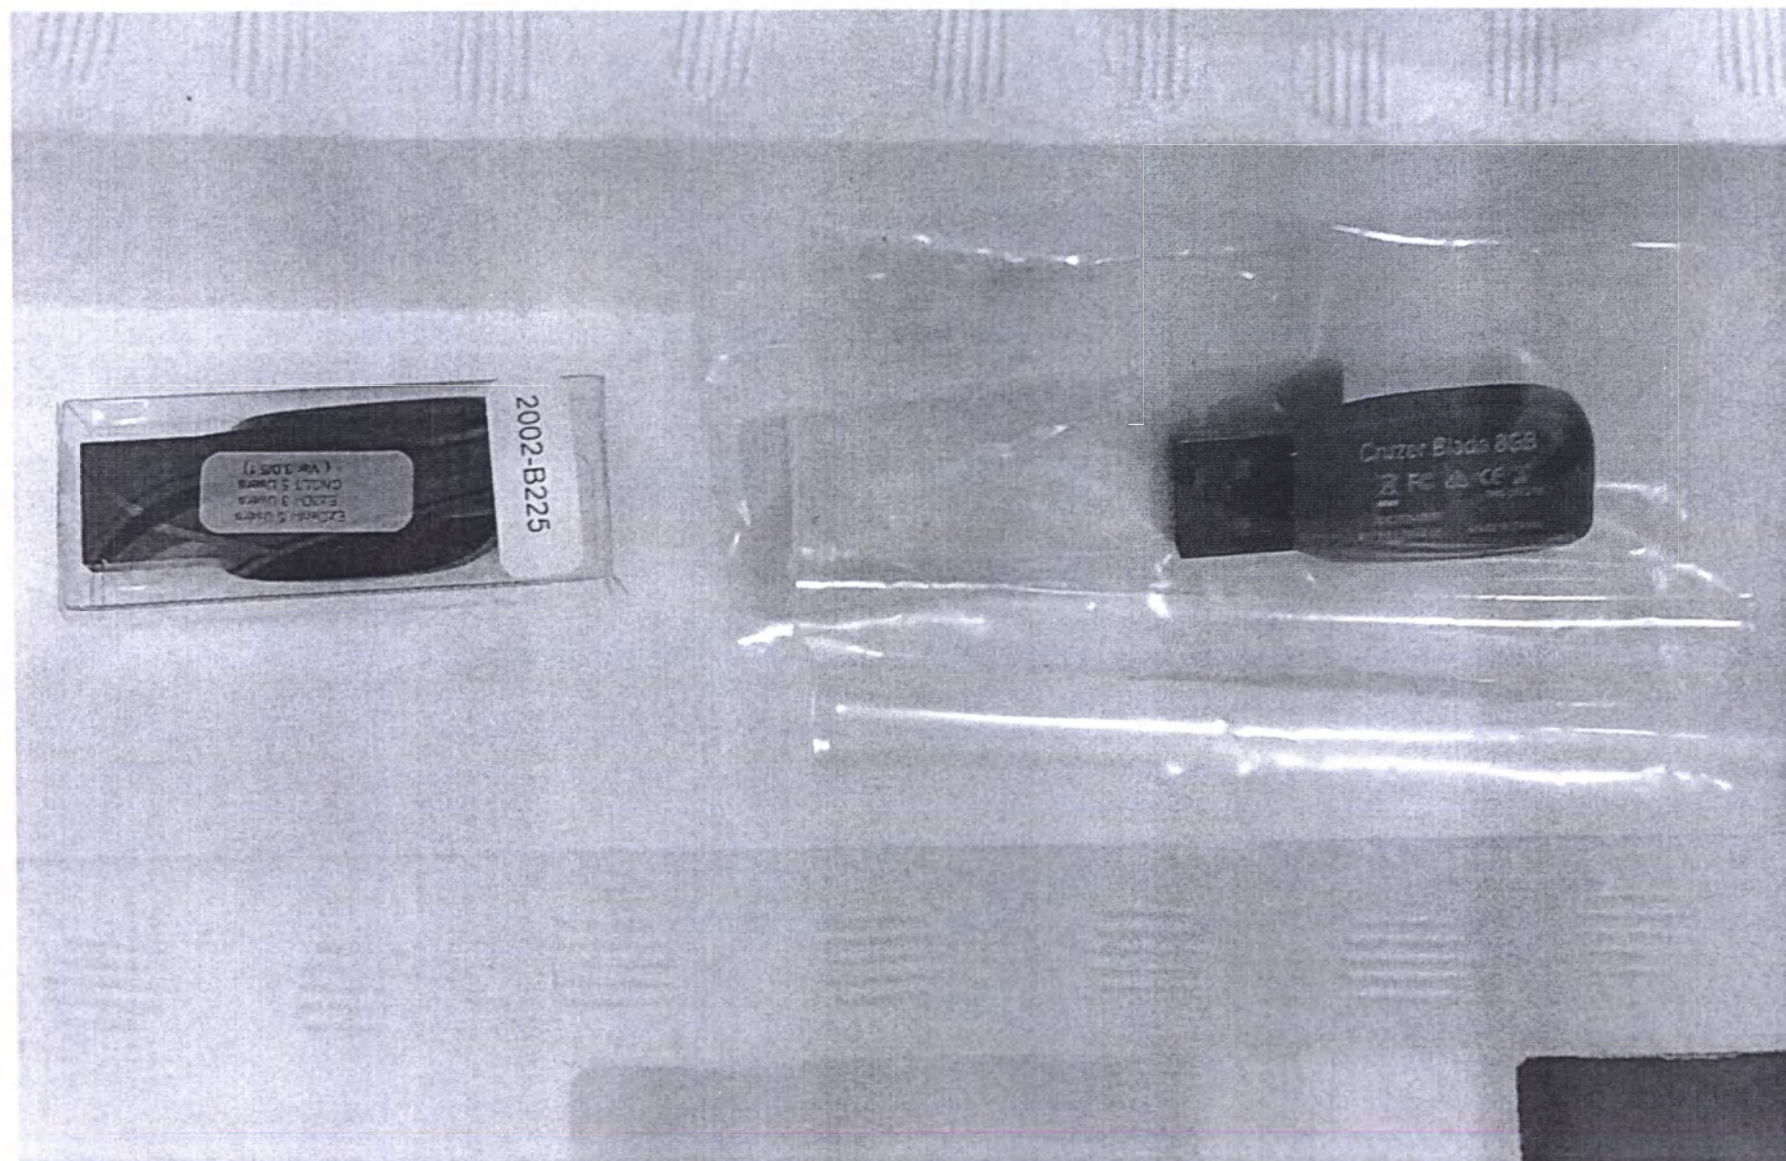


USB с программным обеспечением EzDent-i, Ez3D-i и ключом активации программного обеспечения (слева),
USB с драйверами для работы аппарата (справа)

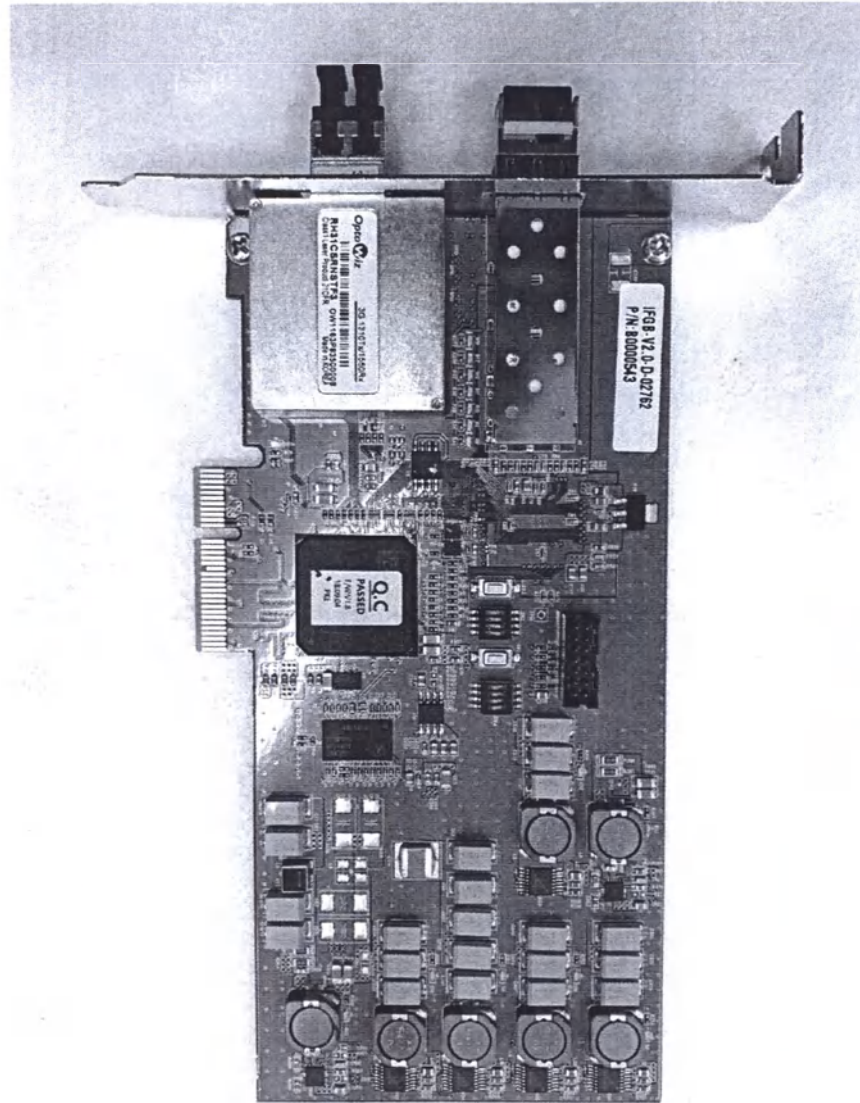


Плата захвата изображения;




Руководство пользователя, Руководство по монтажу, Руководство к программе просмотра двумерных изображений EzDent-i, Руководство к программе просмотра трёхмерных изображений Ez3D-i.

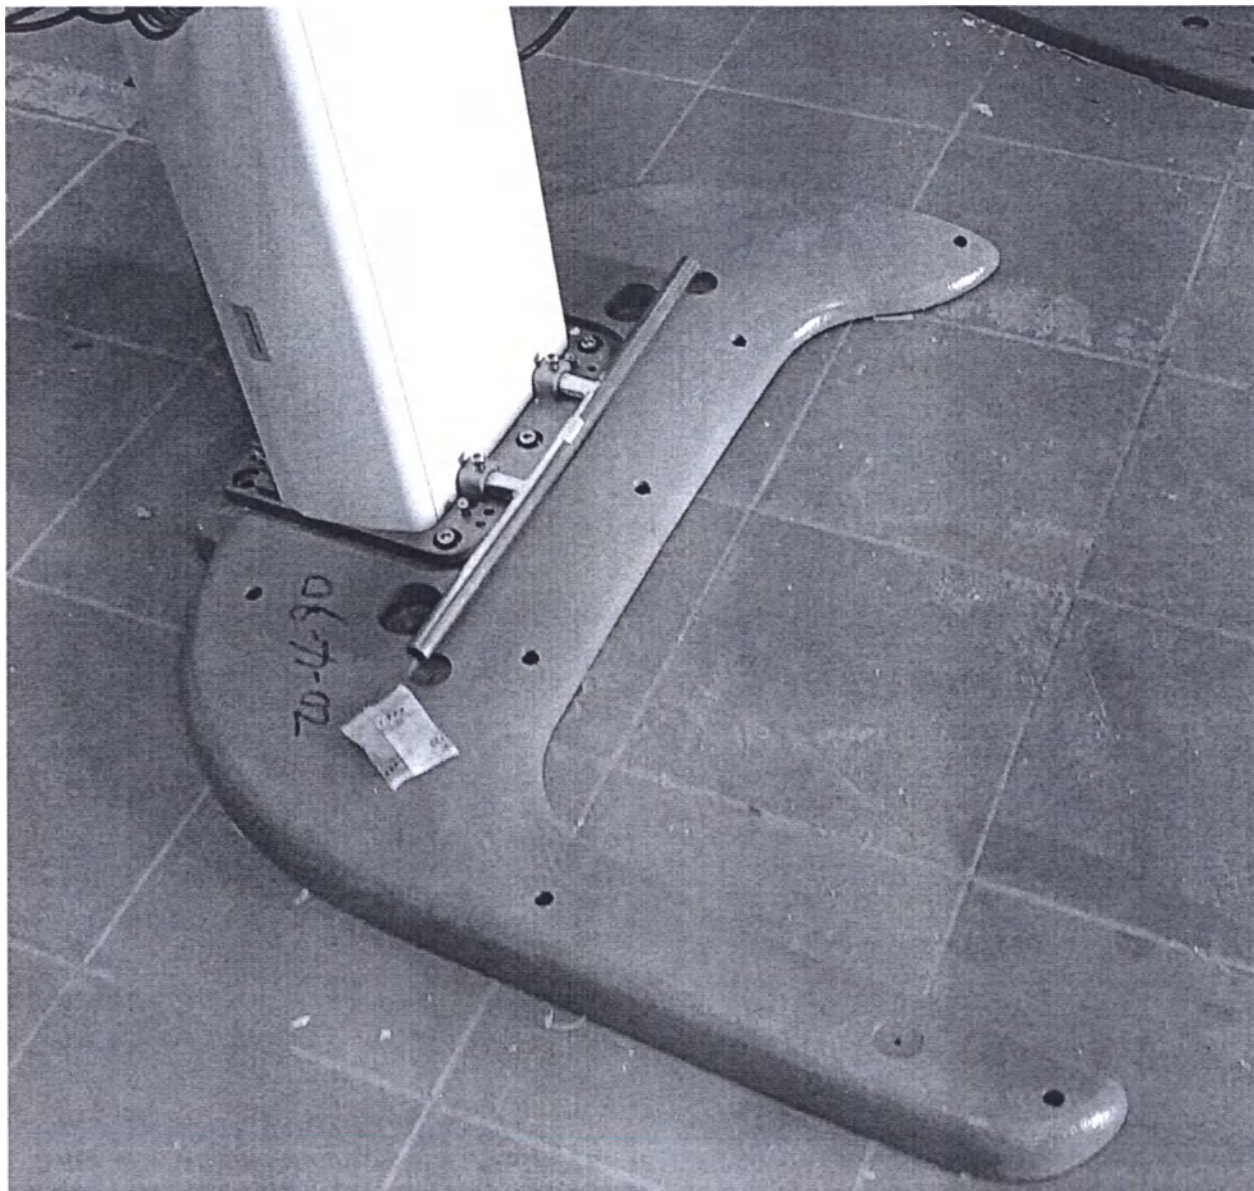


Плита - опора колонны;

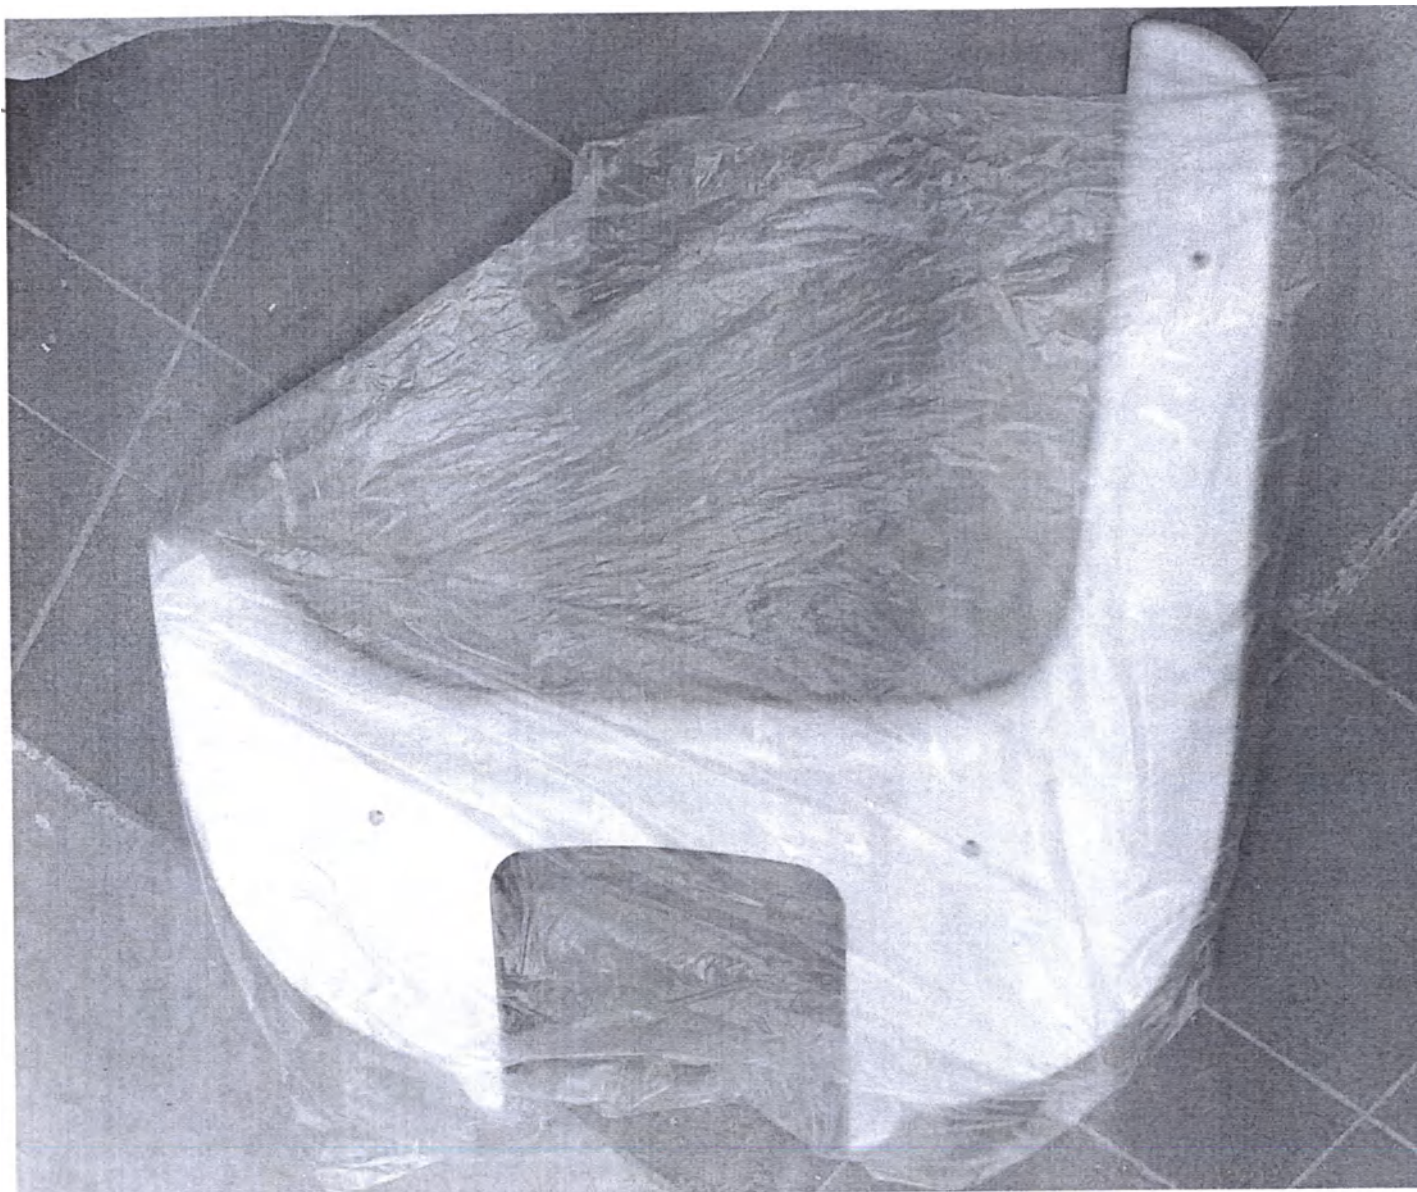

Крышка пластиковая плиты - опоры колонны;

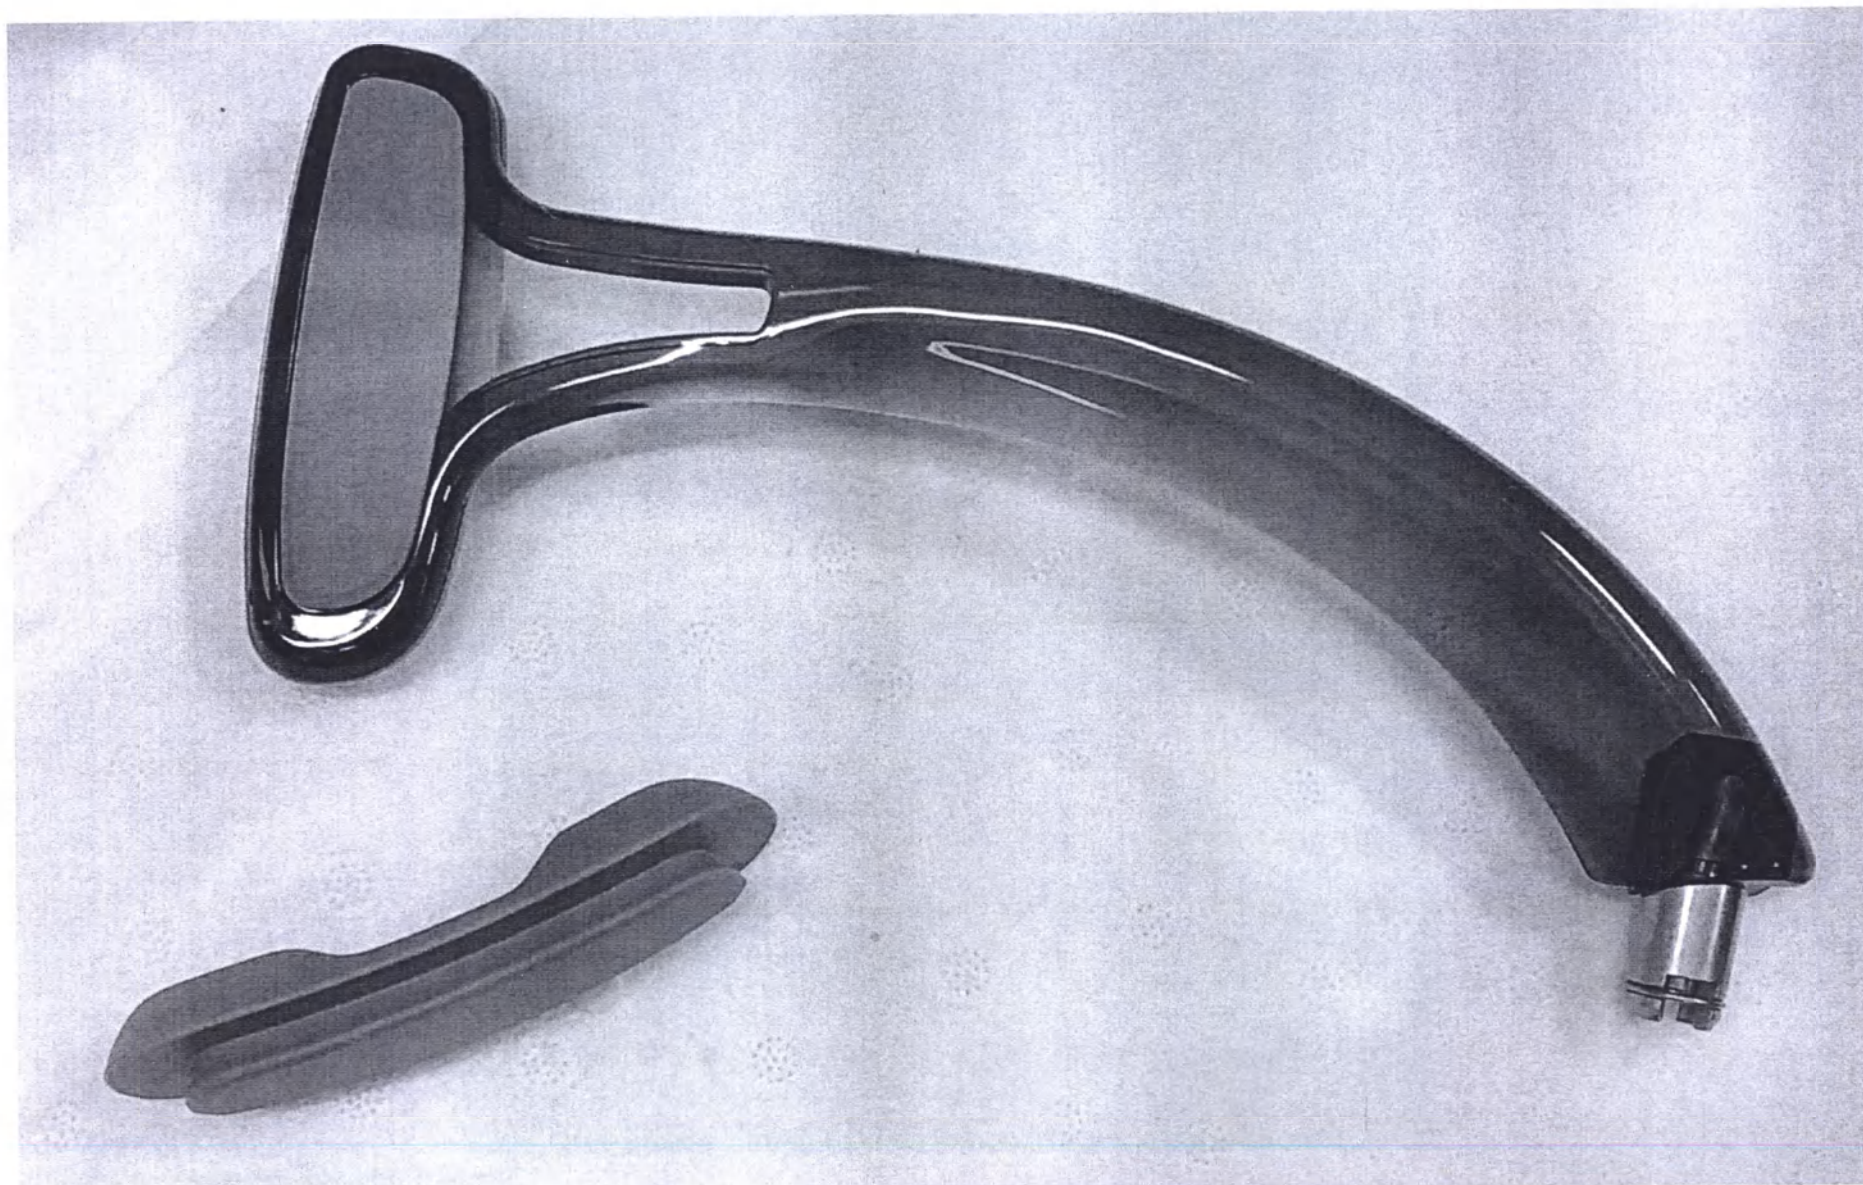

Упоры для висков - не более 6 шт., Накладки силиконовые упоров для висков - не более 6 шт (внизу)

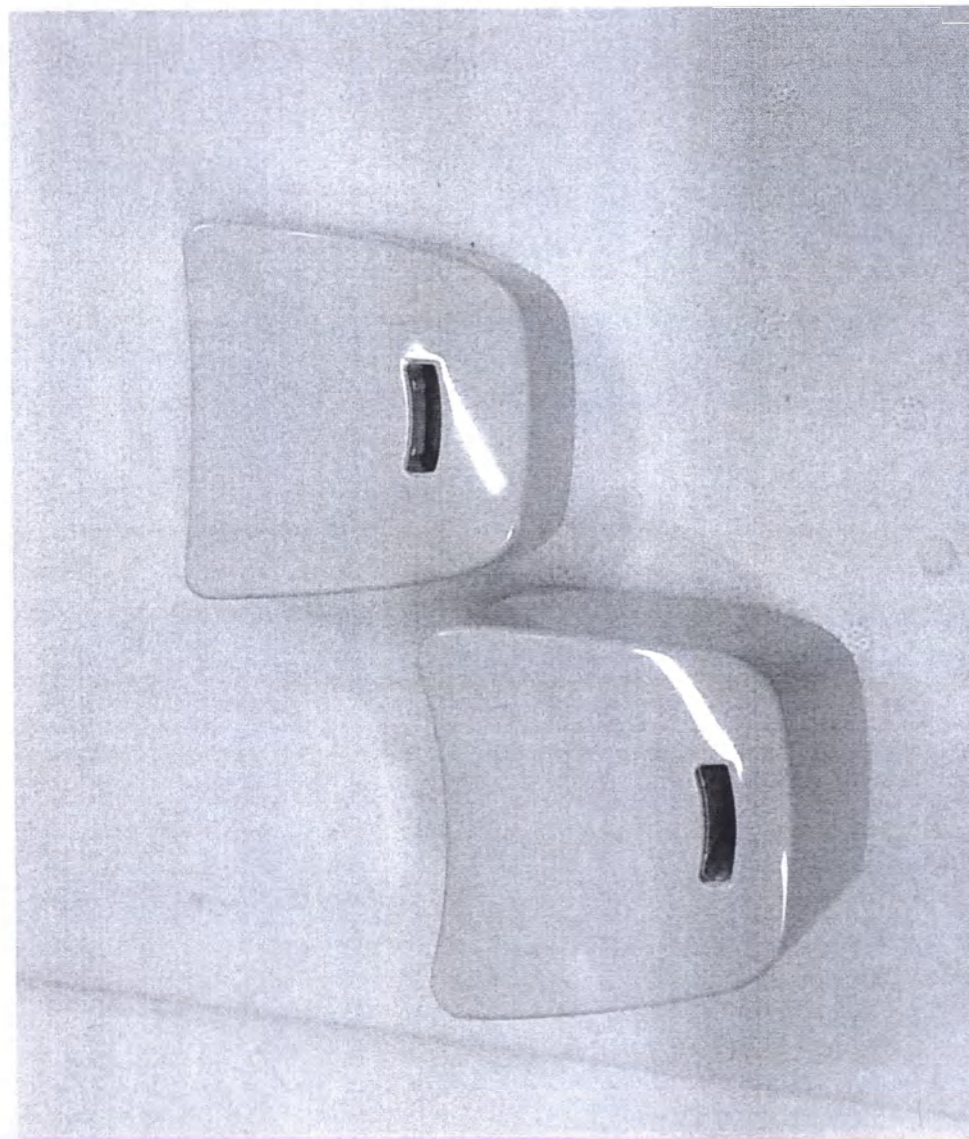


Опора для подбородка высокая (внизу);
Опора для подбородка низкая (вверху);




Упоры для пациентов с адентией - не более 2 шт; (справа)

Упоры для височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) и съемки синусов - не более 2 шт; (слева)


Вилки прикусные - не более 6 шт (внизу);

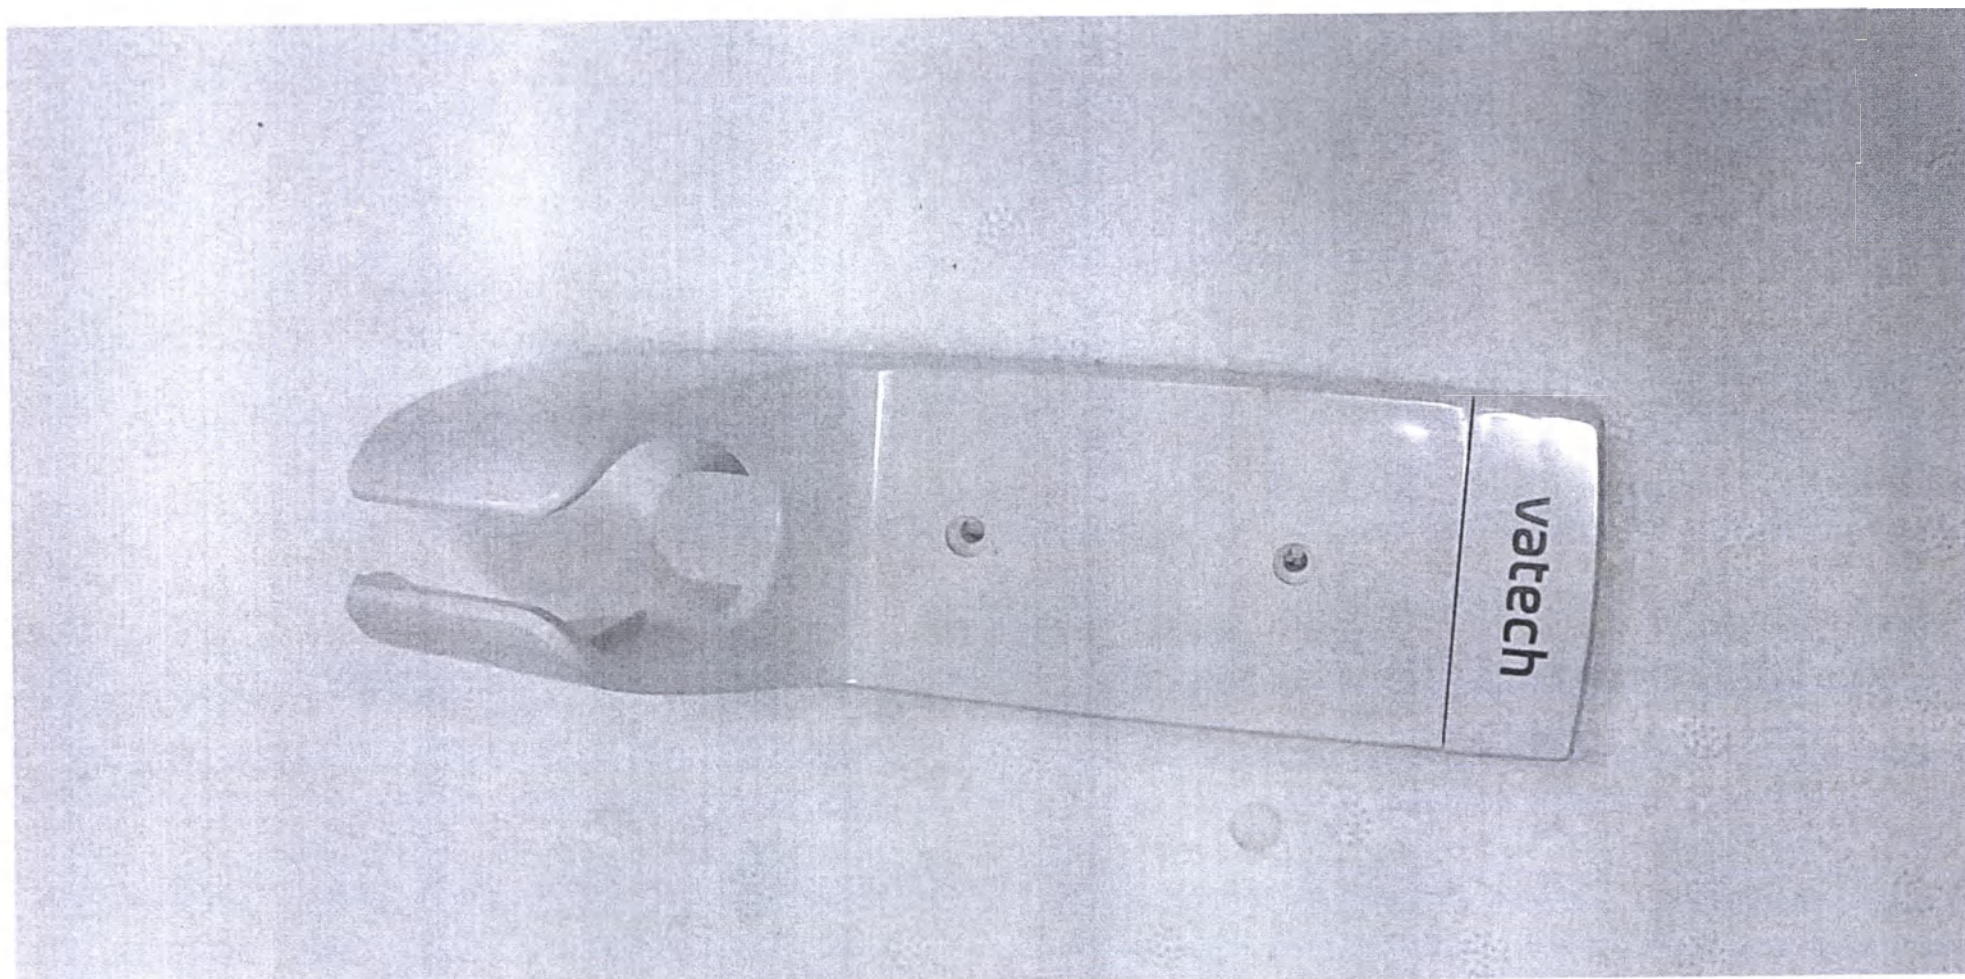


Держатель кнопки экспозиции;

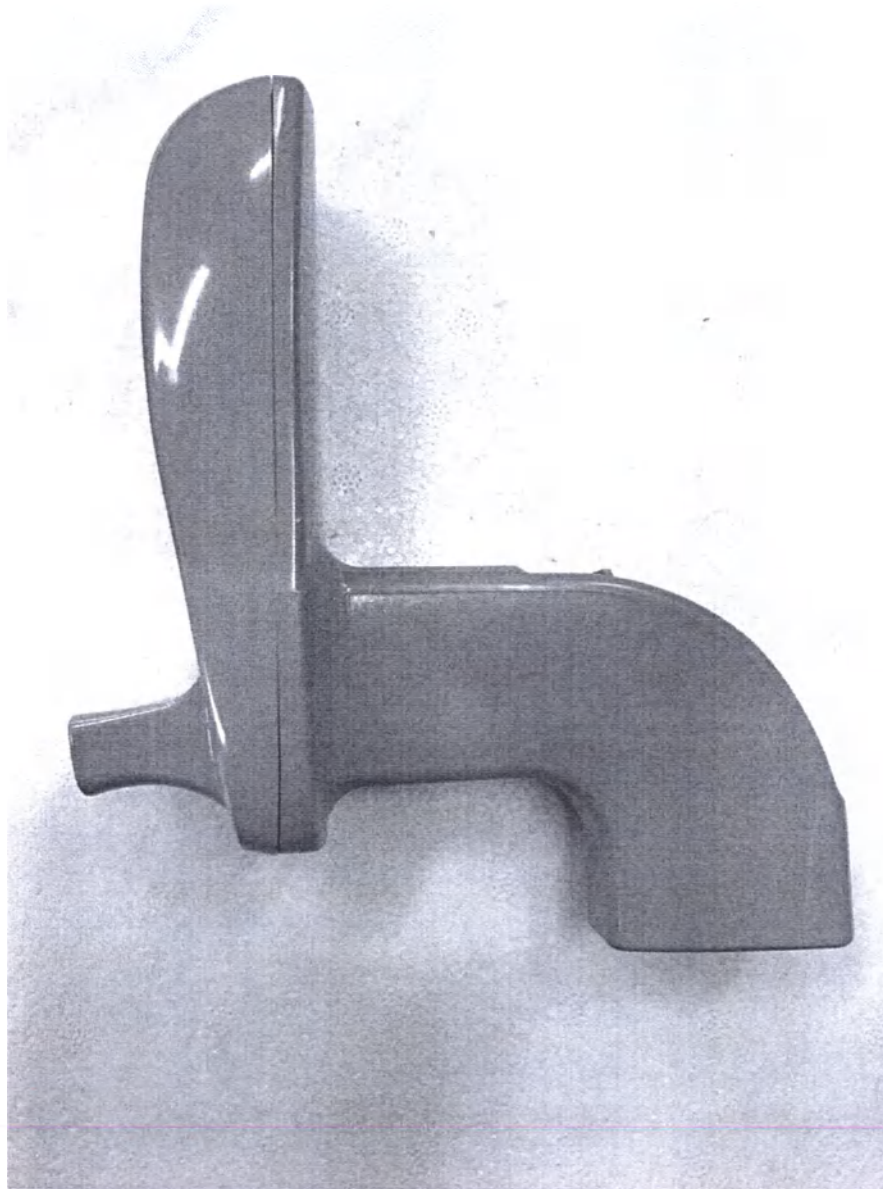


Держатель пульта управления колонной;

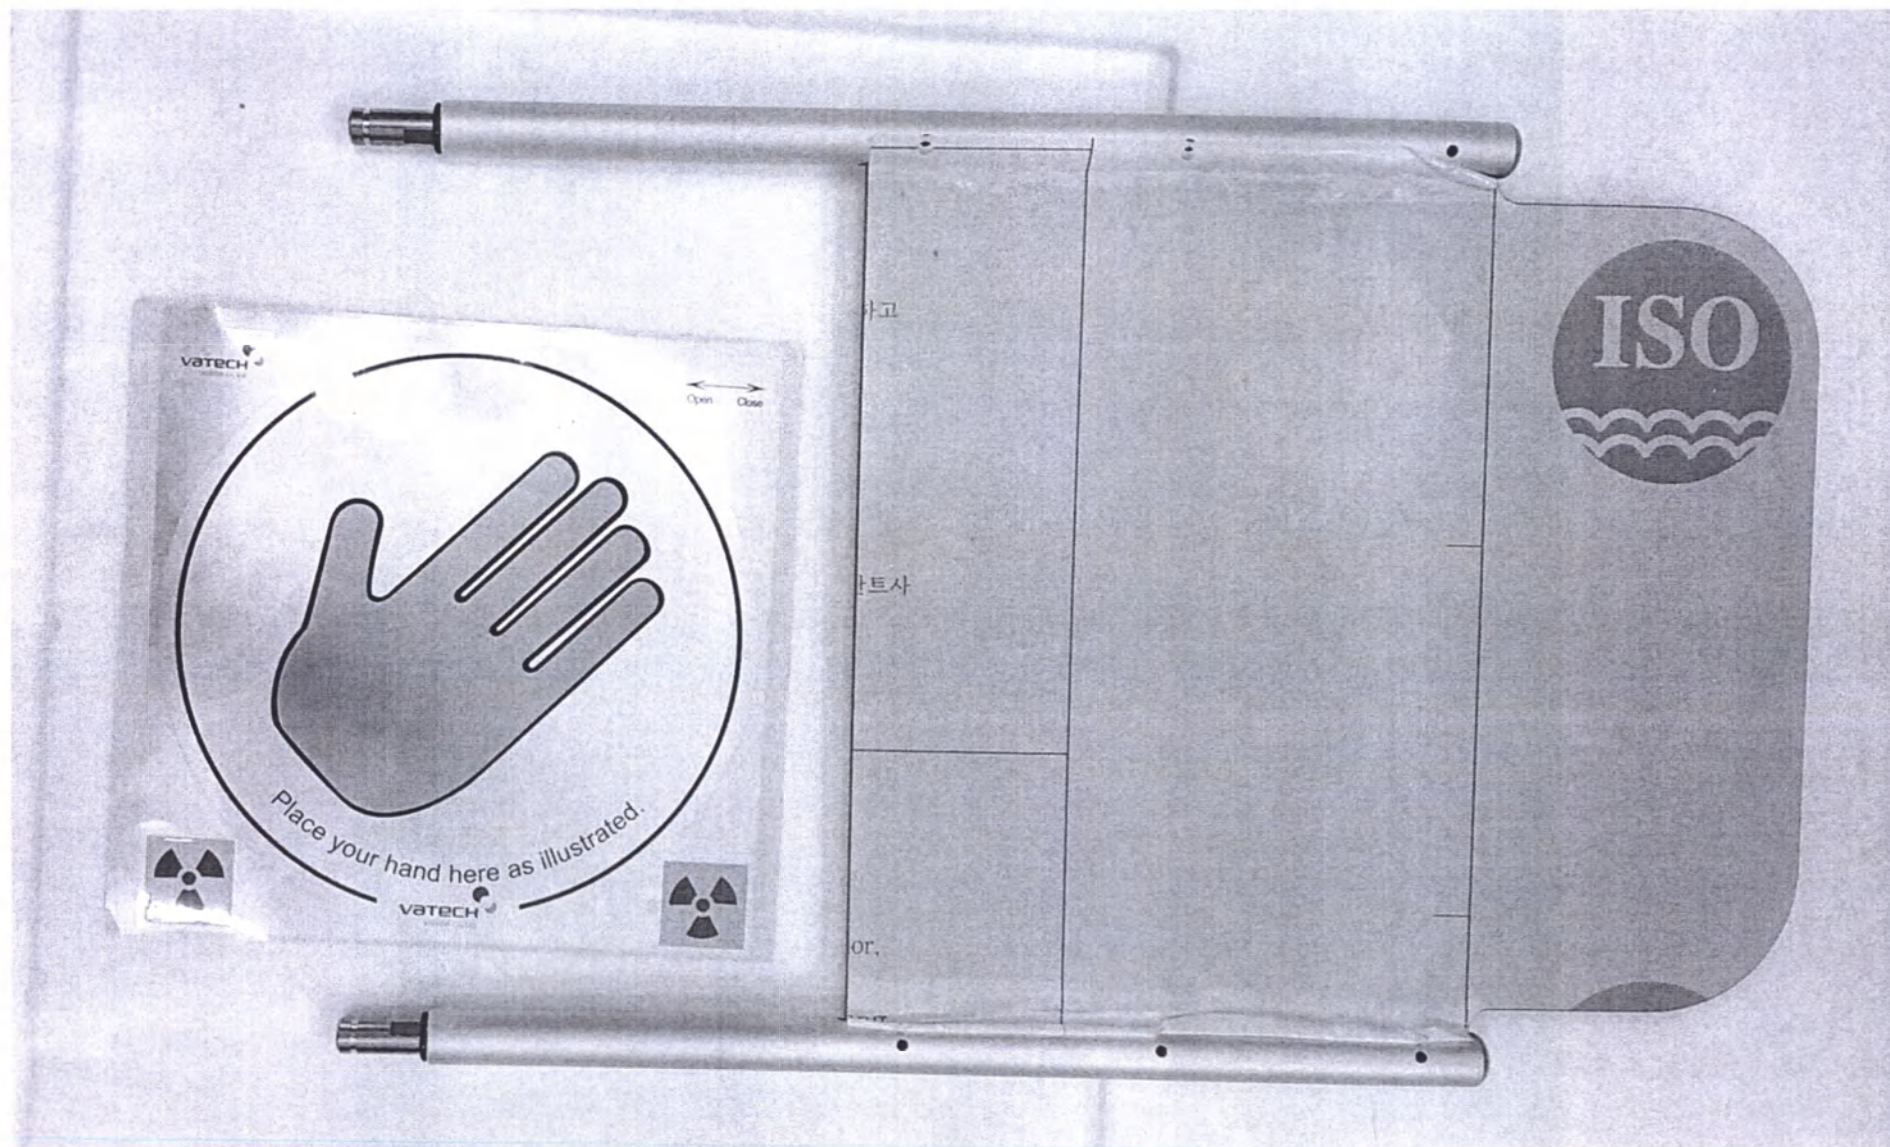


Позиционер запястья (справа)
Наклейка позиционера запястья (слева)

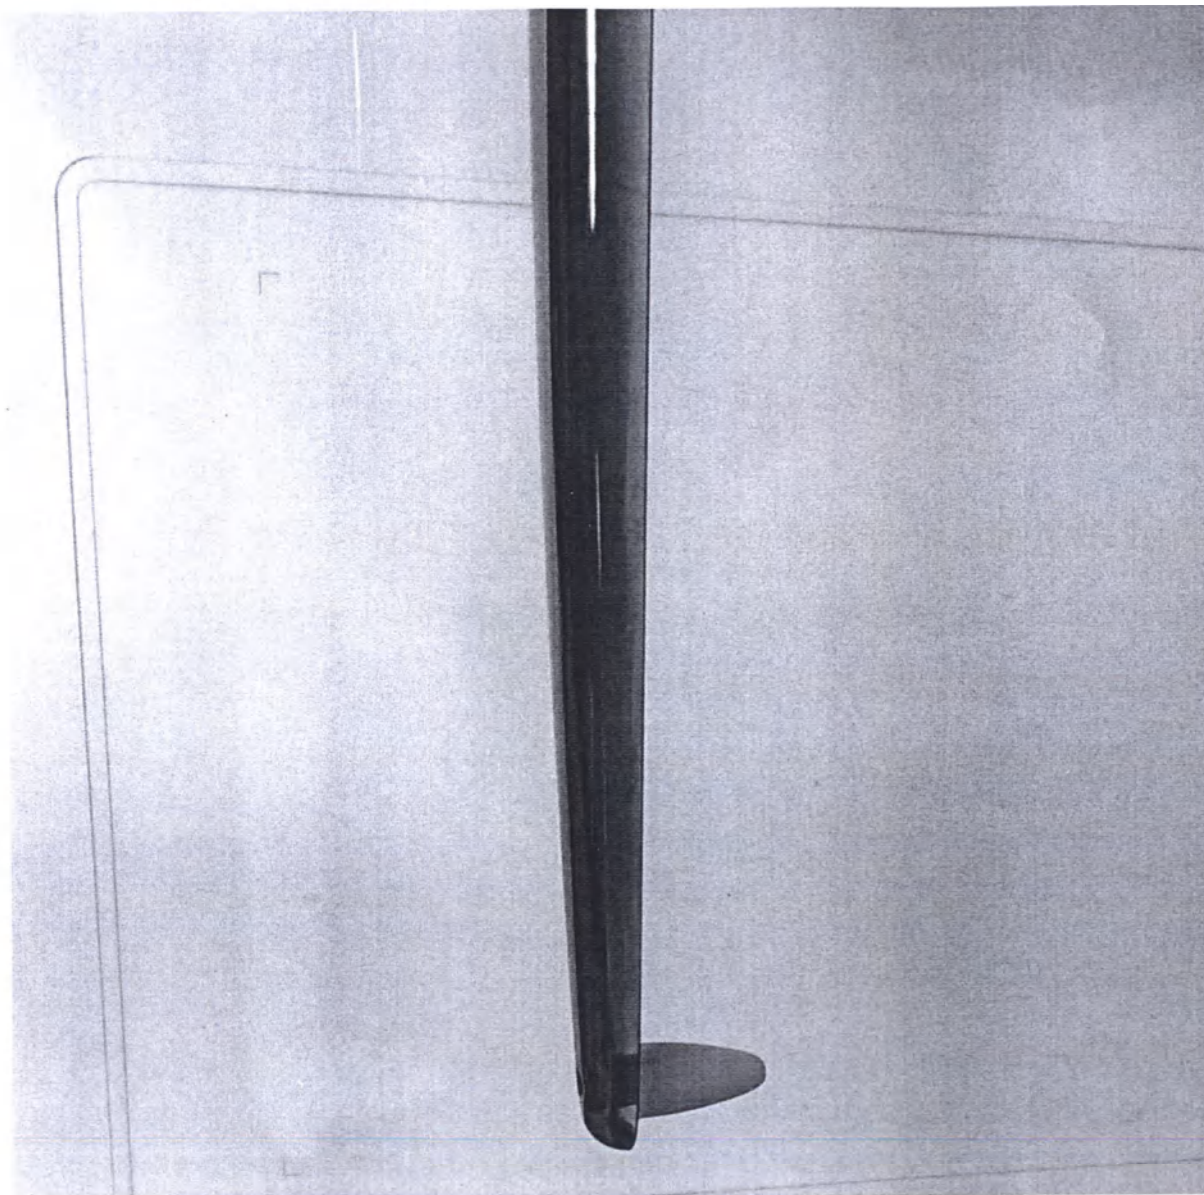


Ушные держатели - не более 4 шт;

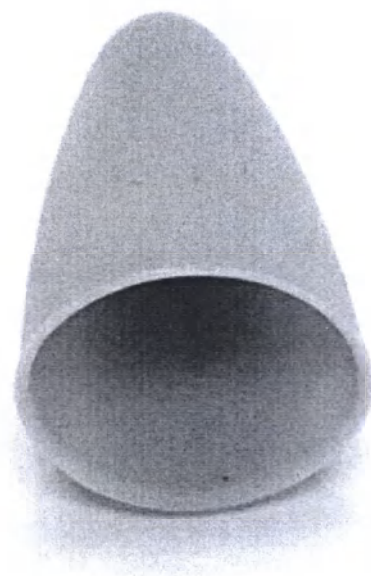


Накладка силиконовая ушных держателей - не более 4 шт;

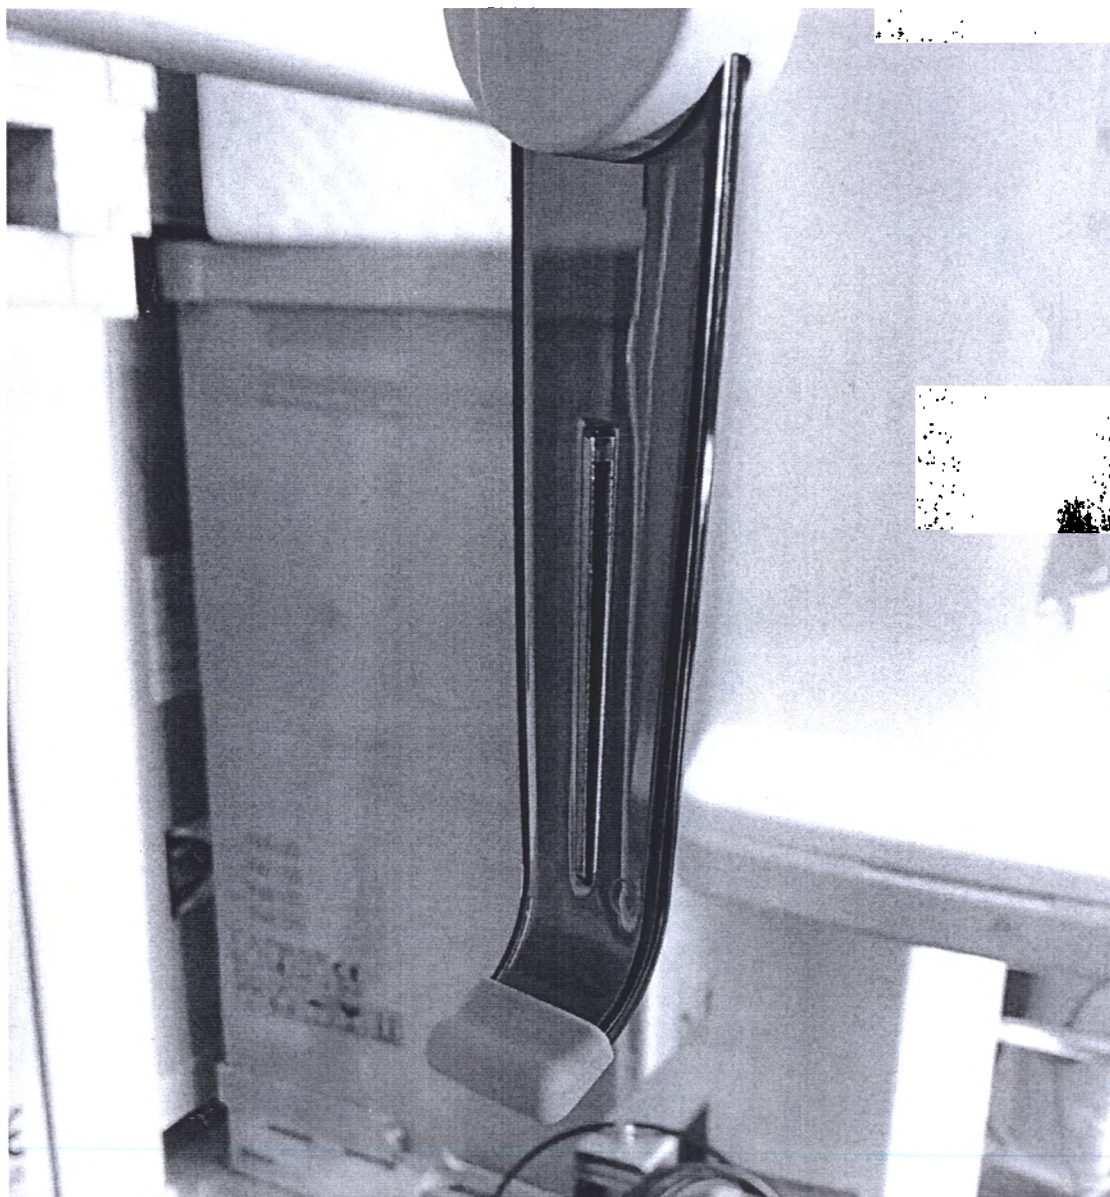


Назальный индикатор;

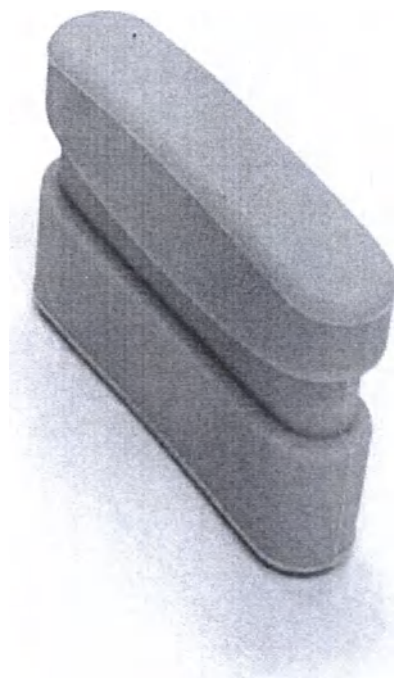


Накладки силиконовые назального индикатора - не более 2 шт;

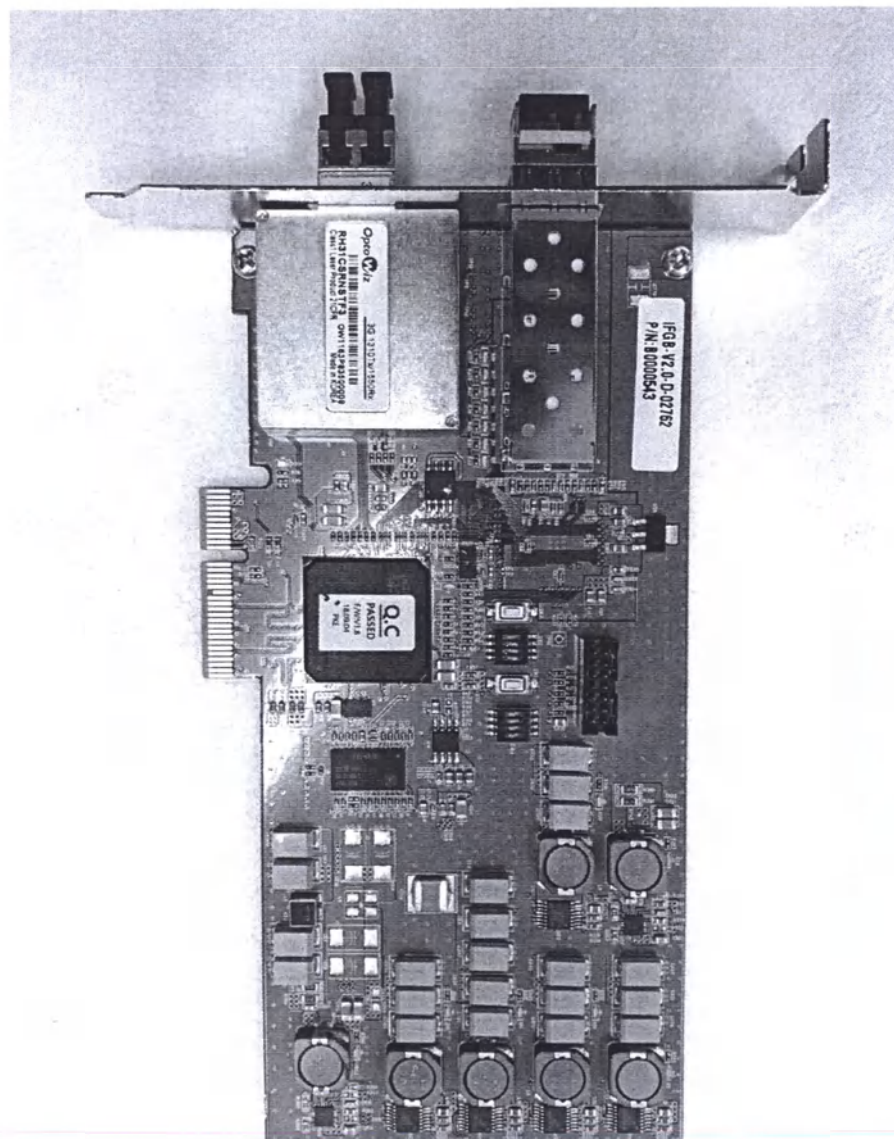


Плата захвата изображения;

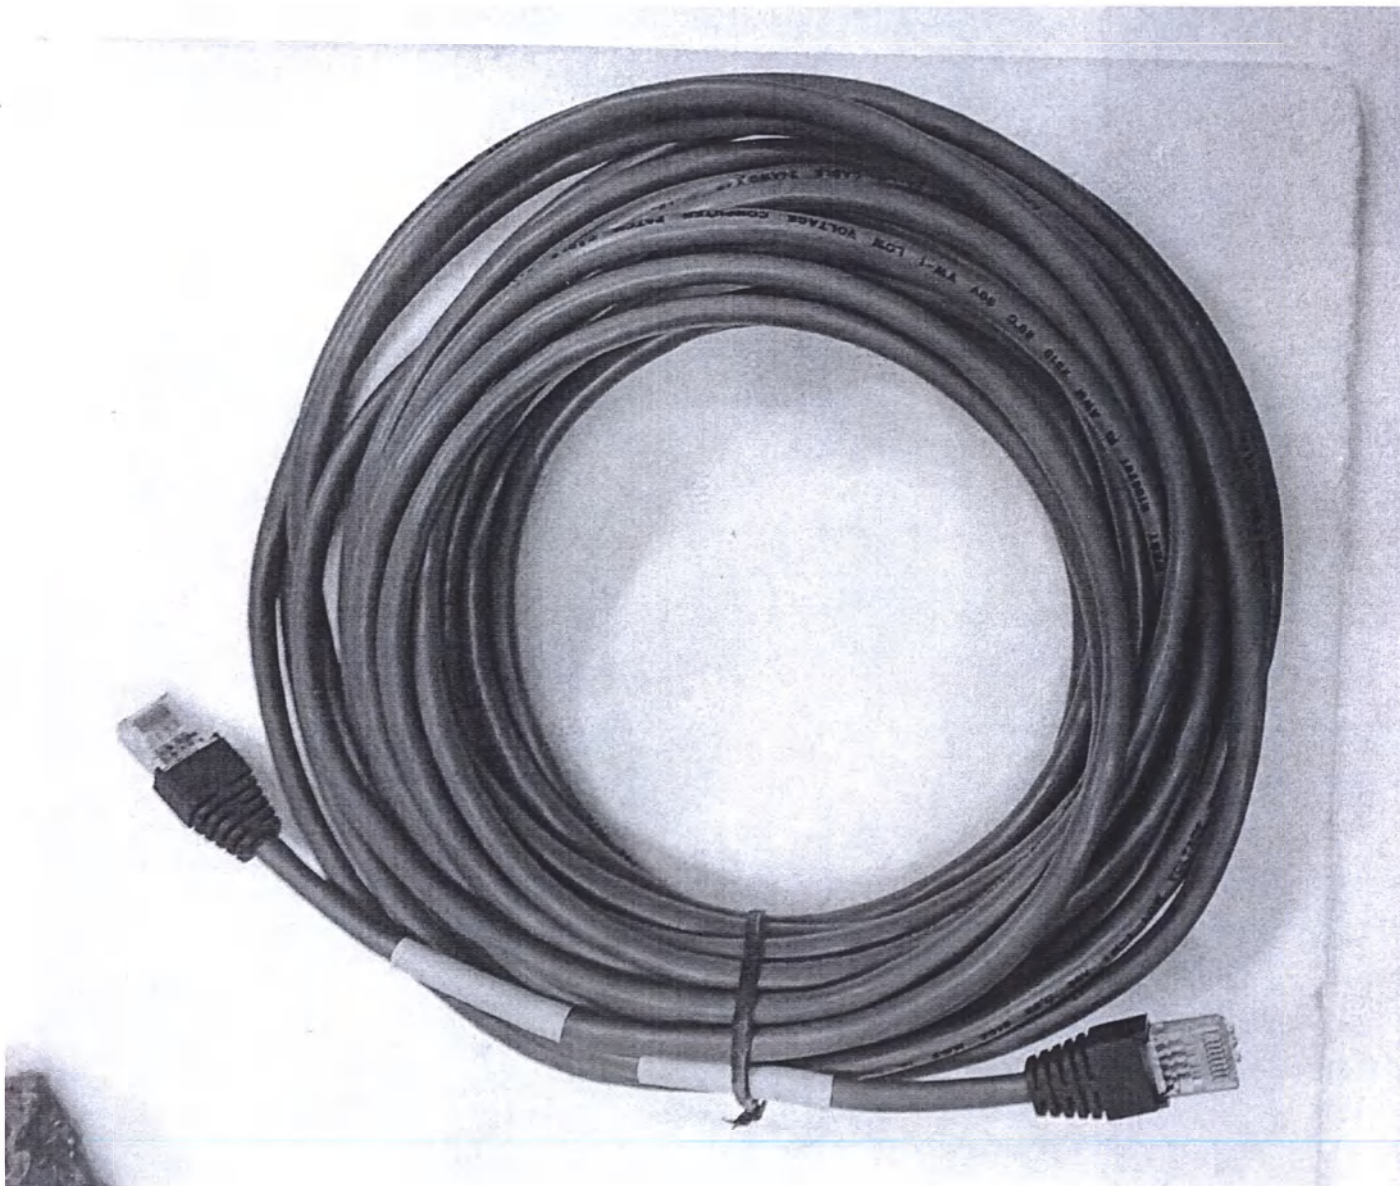


Кабель сигнальный;

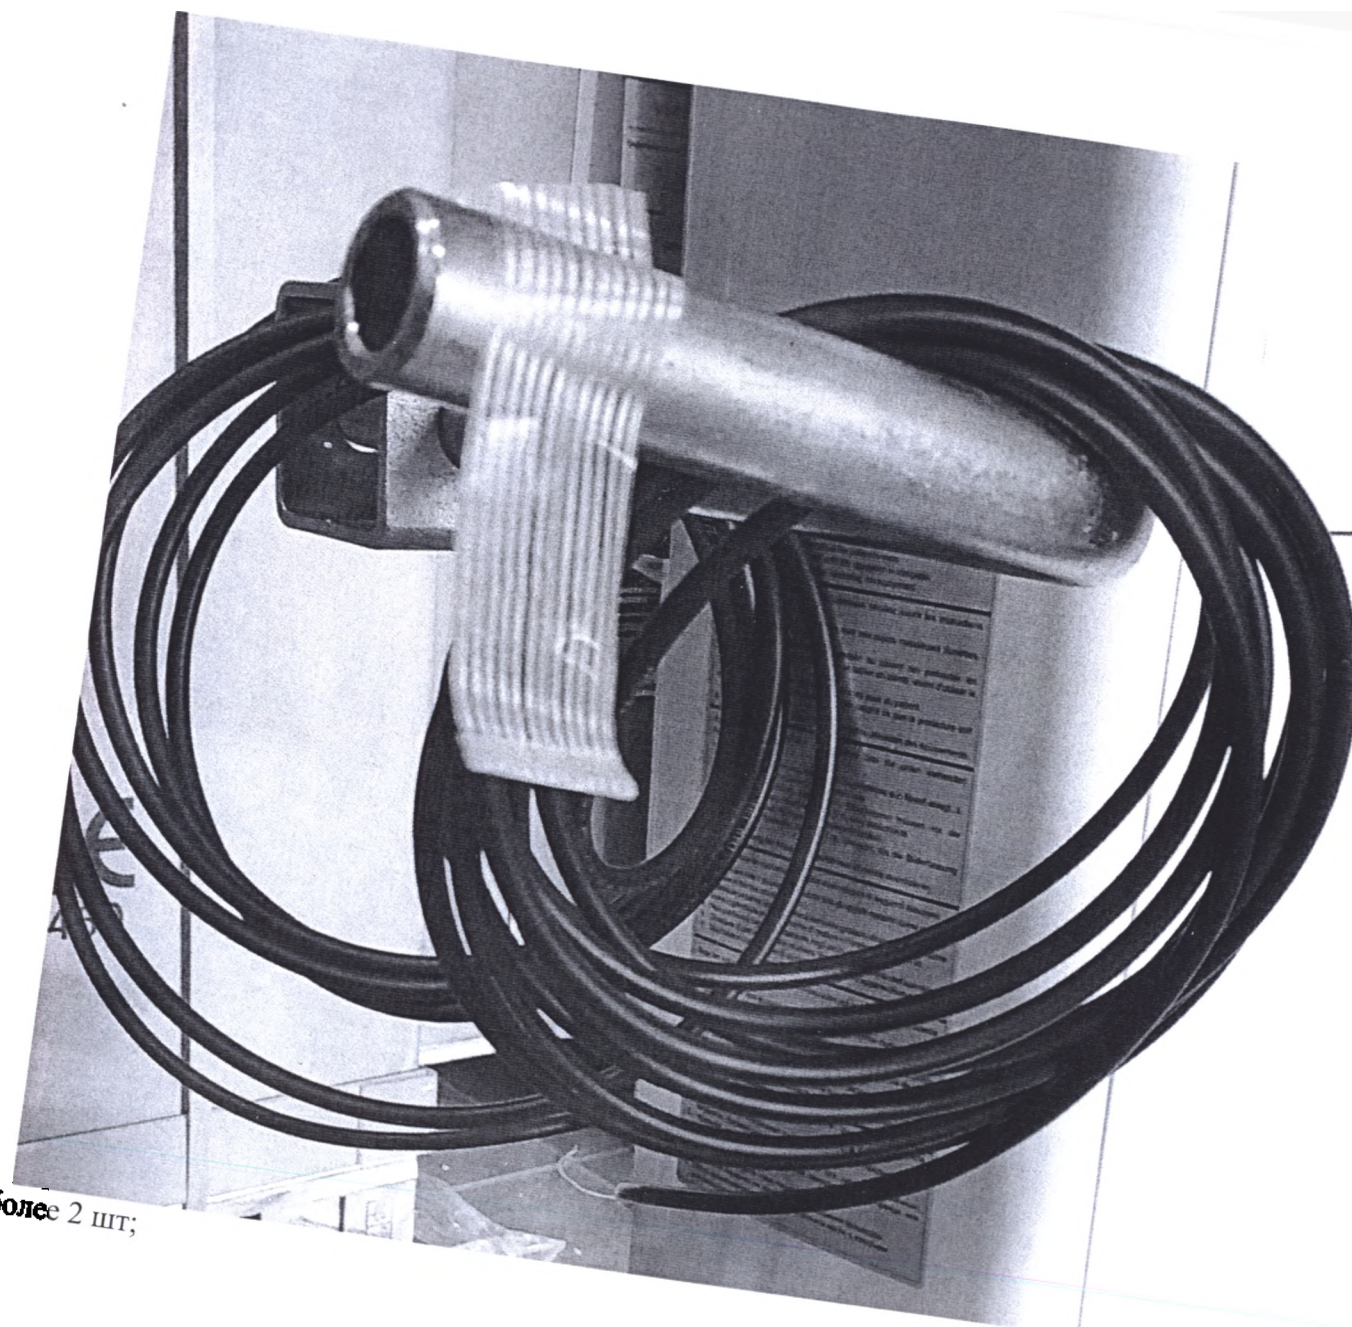


Кабели захвата - не более 2 шт;

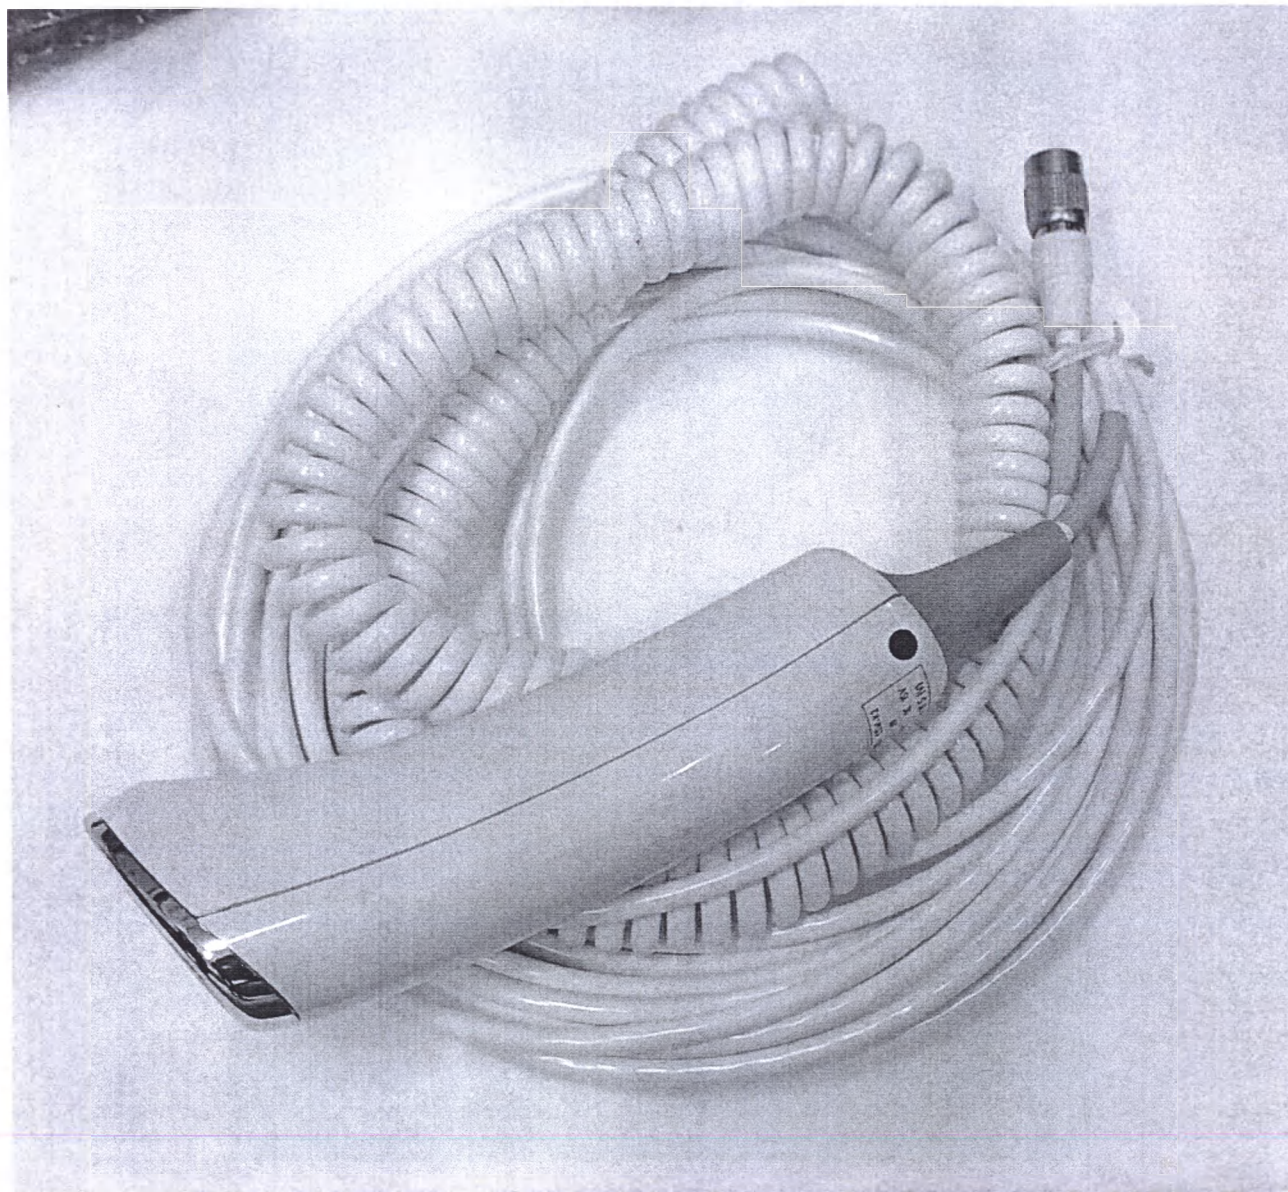

Кнопка включения экспозиции;

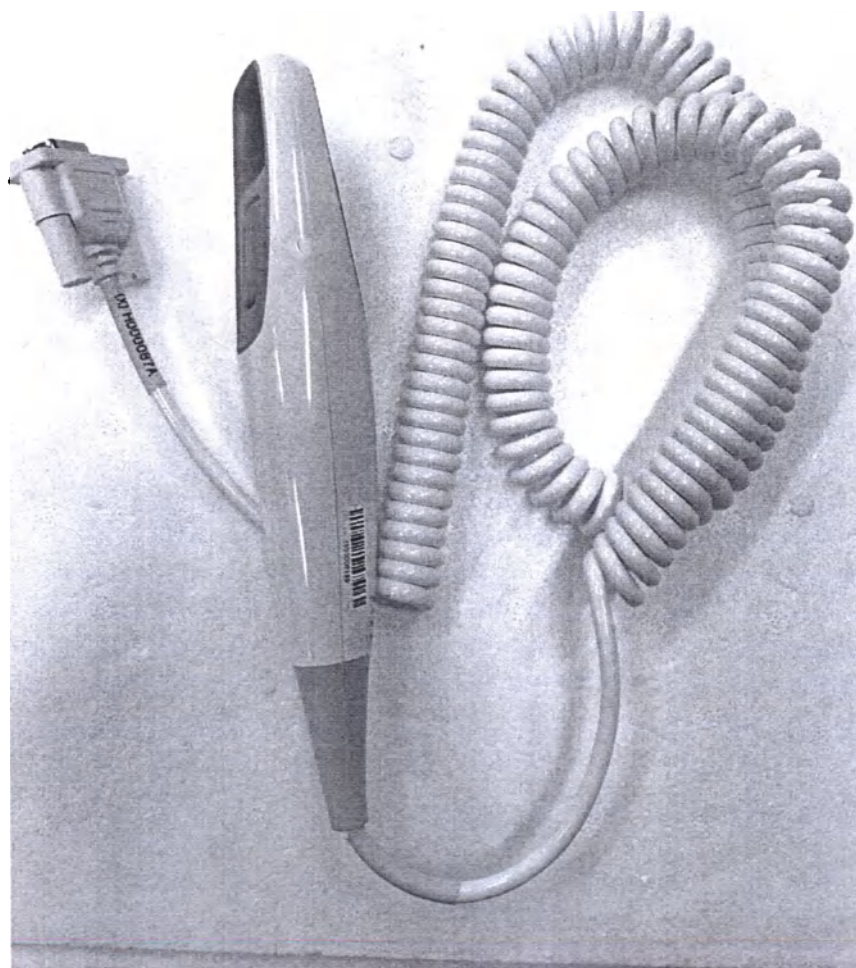


Пульт управления колонной;

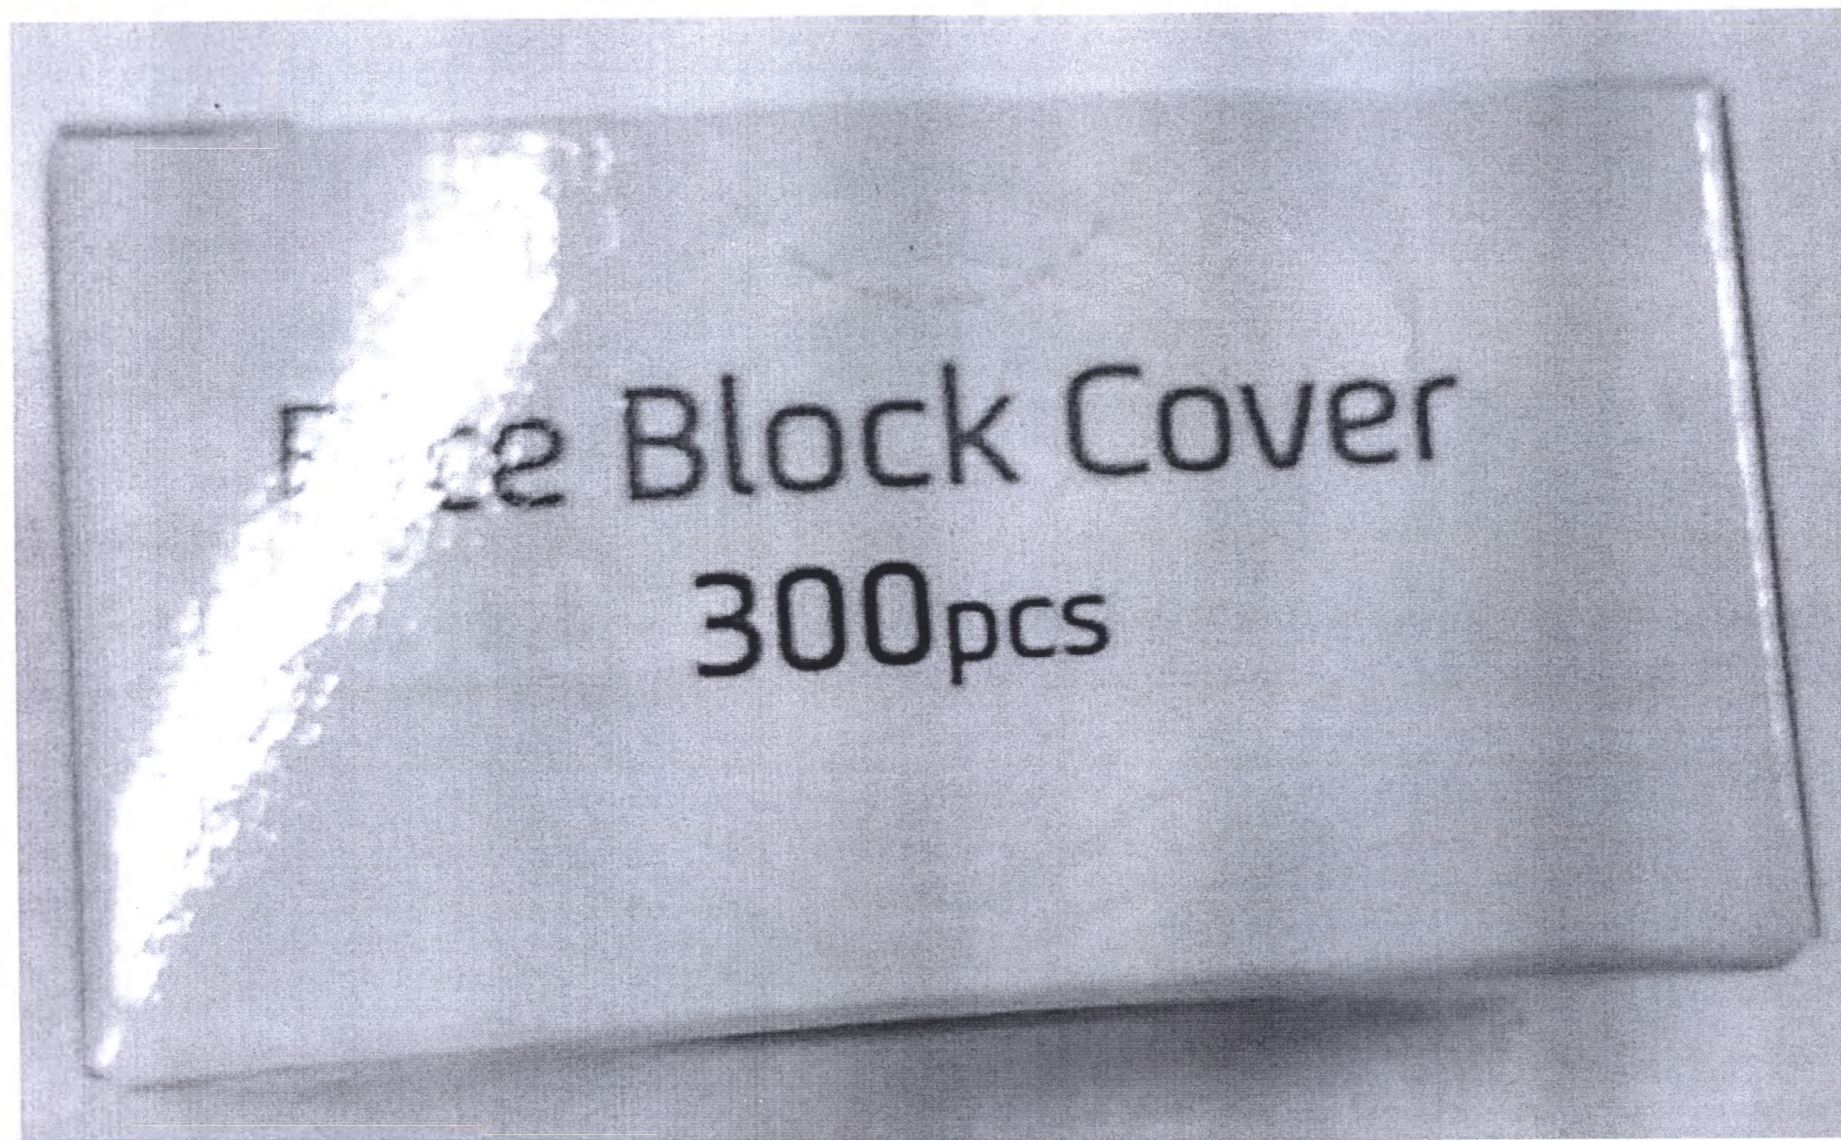


Покрывтия гигиенические - не более 2 уп. (2 x 300 штук.);




Кабель LAN;

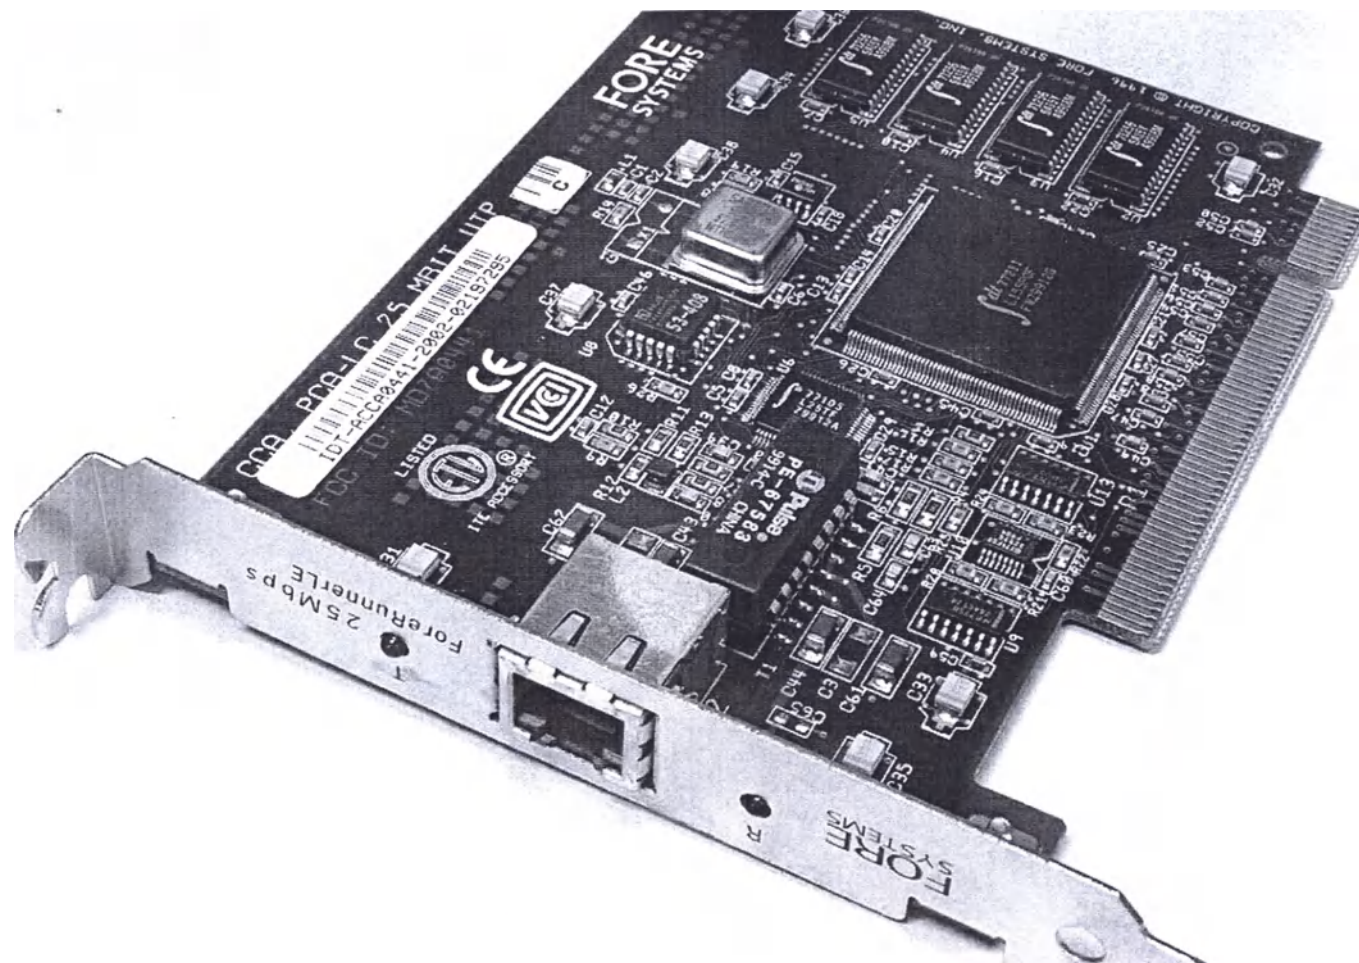


Карта LAN;

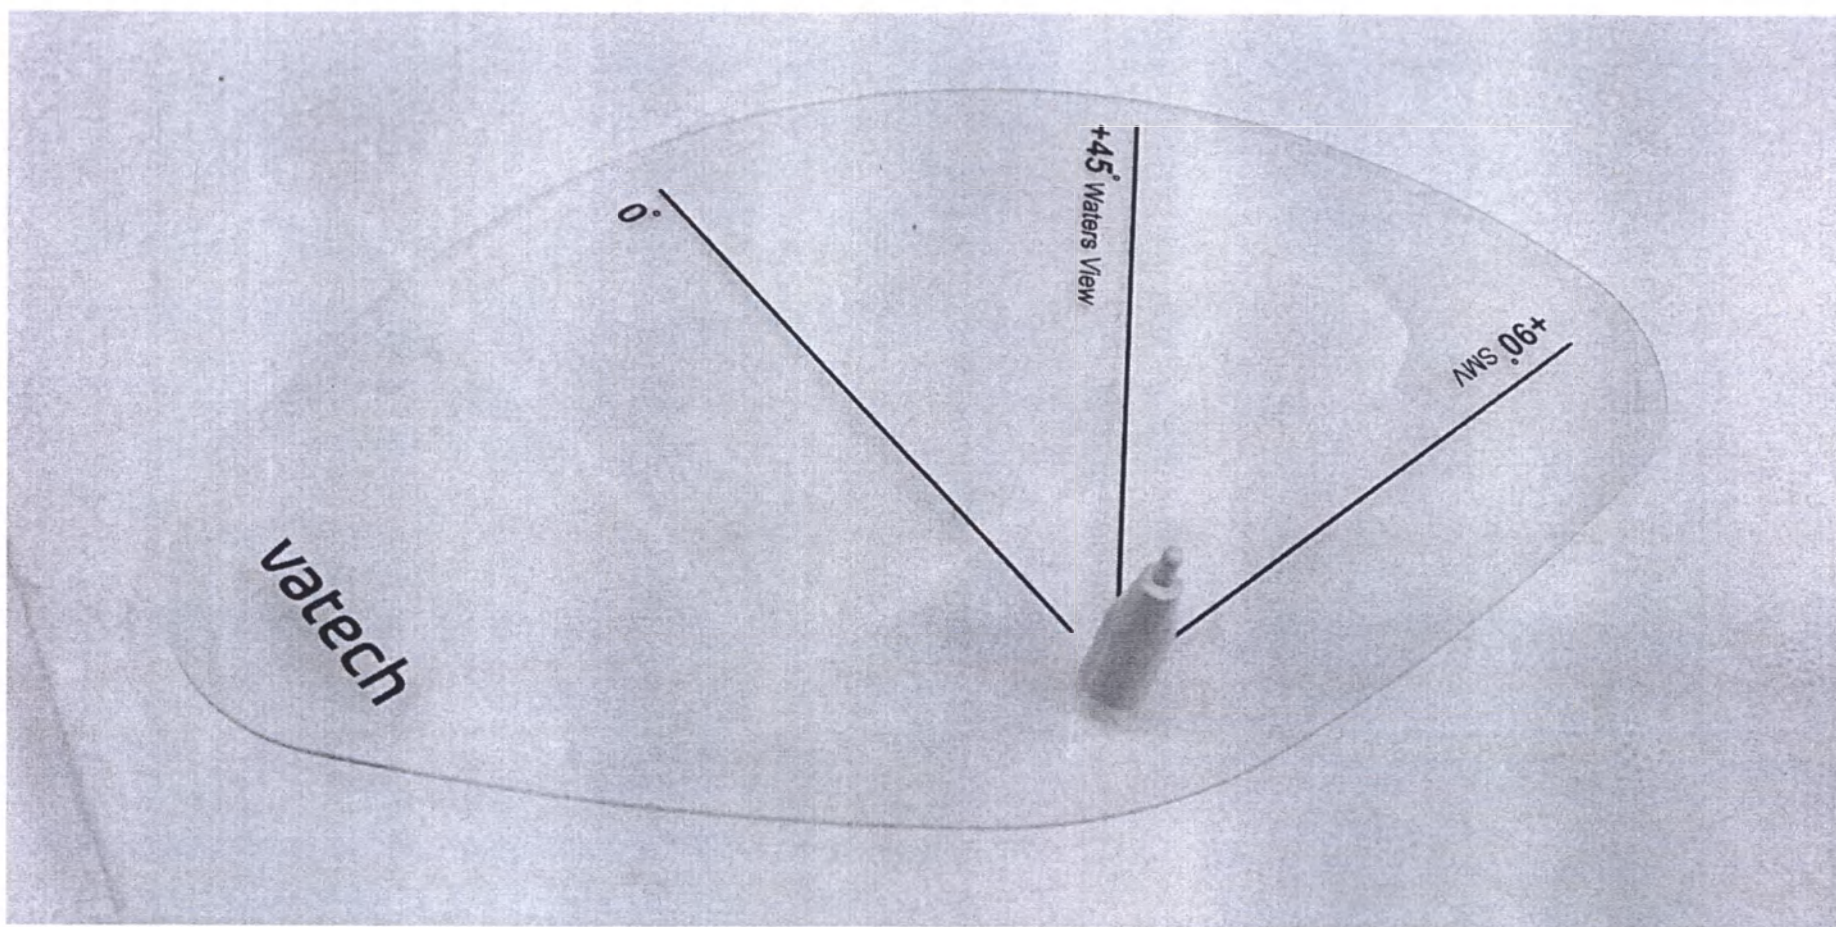

Позиционер цефалометрический;

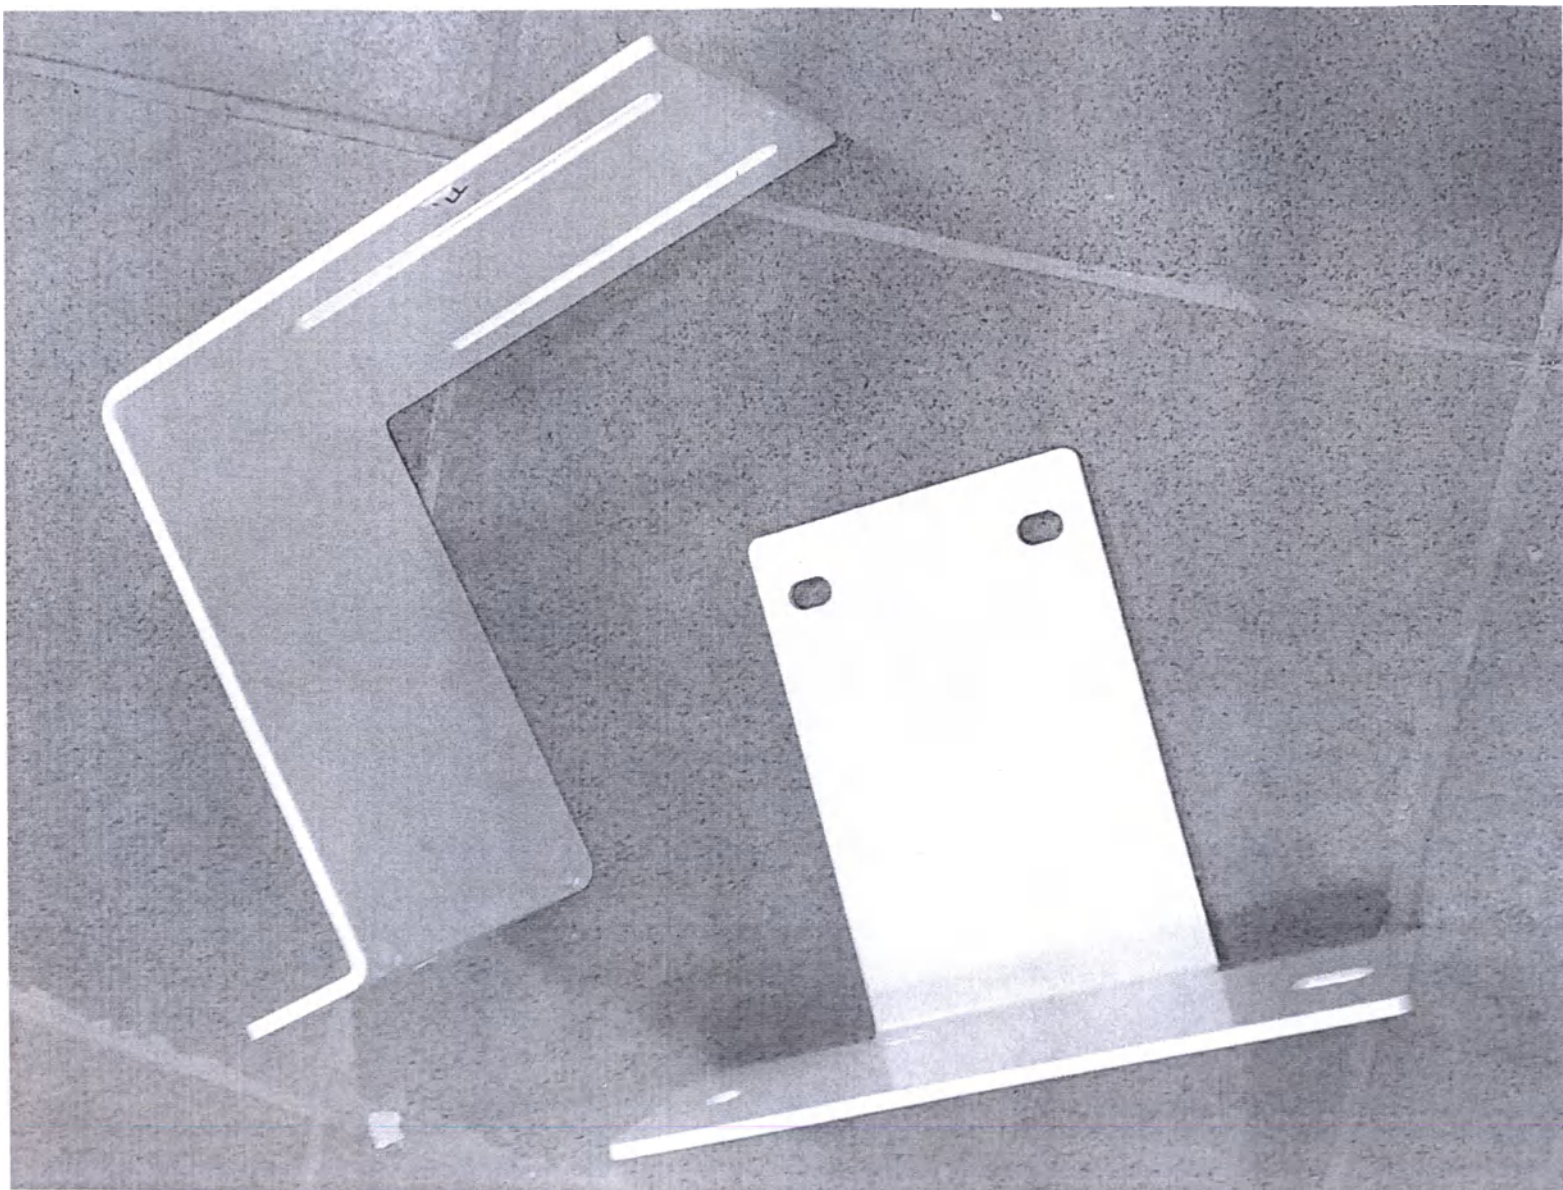

Кронштейны крепления колонны к стене - не более 2 шт;

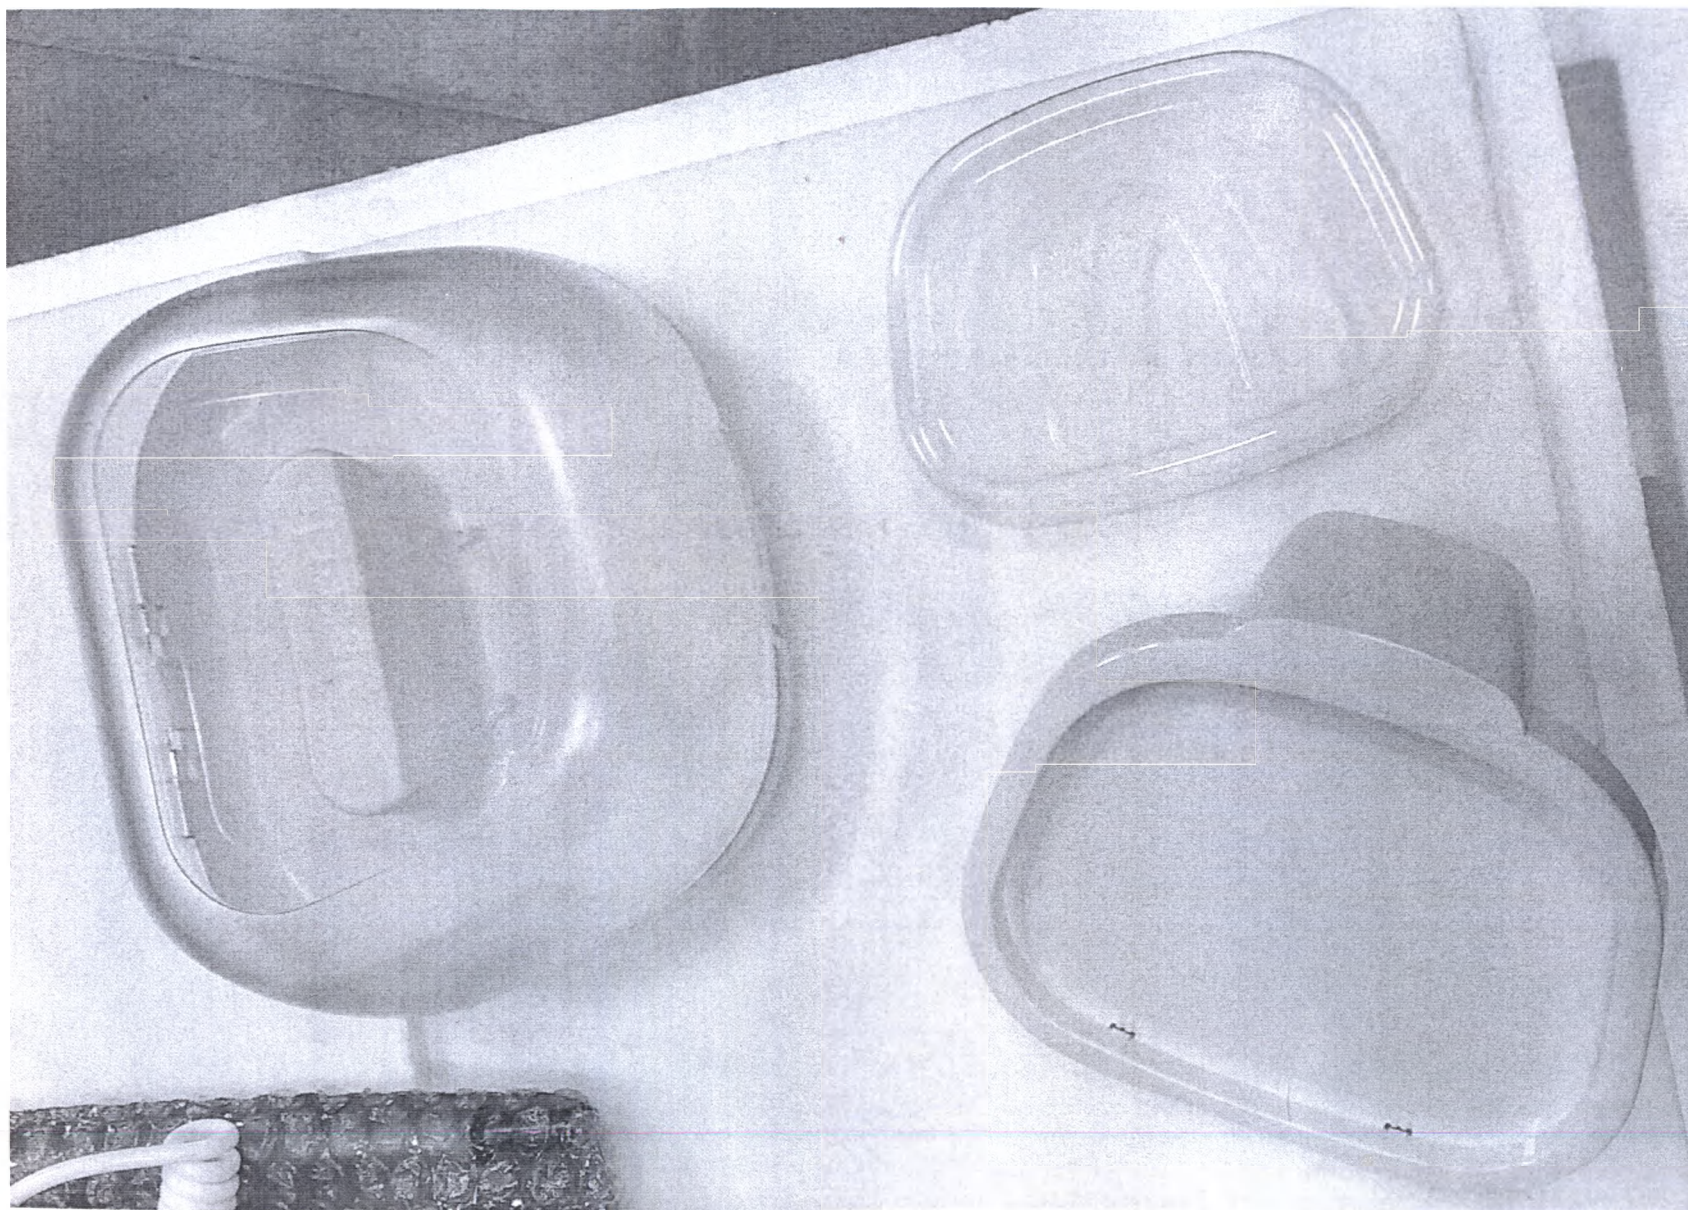

Шаблон для сканирования слепков

Всего прошито и
скреплено печатью



35 _____ листа(ов)