

Фотографические изображения

Медицинское изделие

Набор калибраторов для определения бета-2-микроглобулина на анализаторах биохимических серии BS (β2-Microglobulin Calibrator).

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Миндрей Медикал Рус».

М.П.

ПО ДОЗЕРЕННОСТИ ОТ 20.08.20г
СИЛКИН О.В.



β 2-Microglobulin Calibrator (for Serum)

mindray

P/N: 105-004648-00

REF MS(β 2-MGII)181


LOT 158419001

 2020-12-14

5×0.5 mL




Калибратор β 2-микроглобулина (для сыворотка)
Calibrador β 2-Microglobulina (para soro)
Calibrador β 2-microglobulina (para suero)
Calibratore β 2 Microglobulina (per siero)
 β 2-Mikroglobulin Kalibratörü (Serum için)





Protect from light













SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China








Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

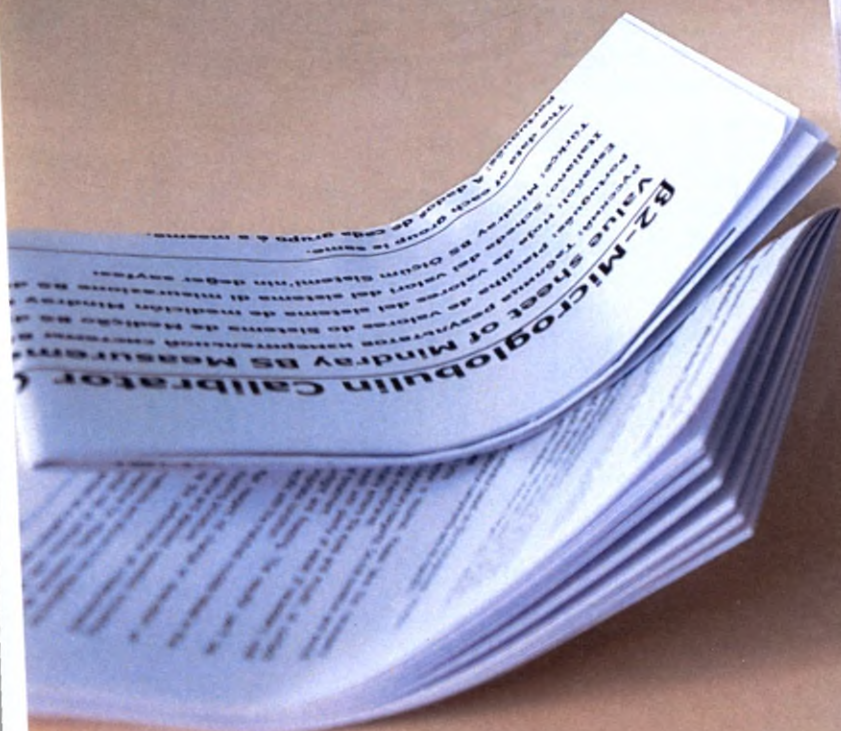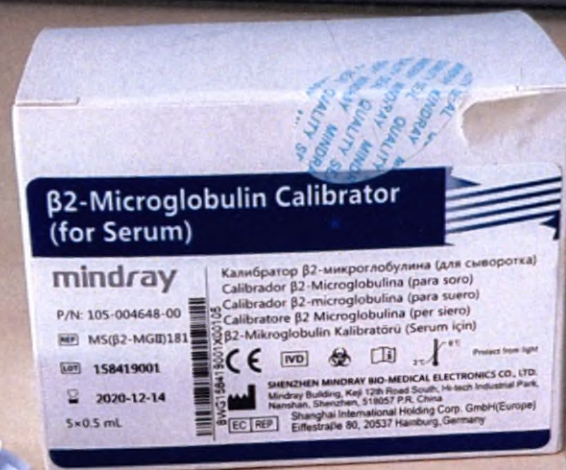

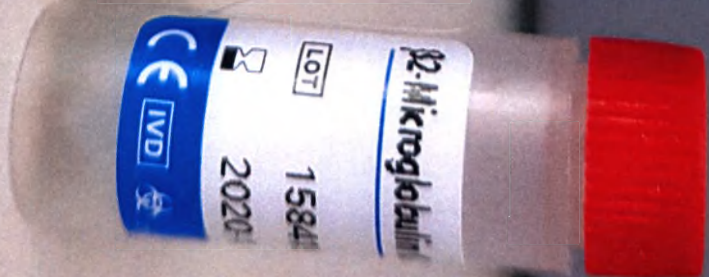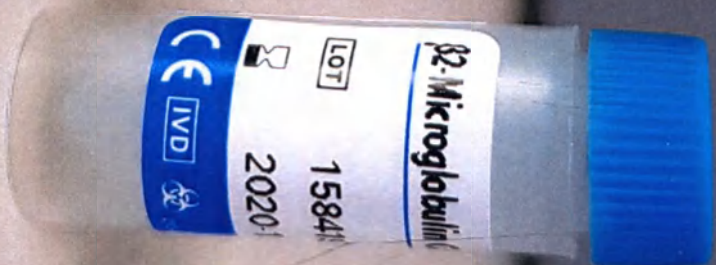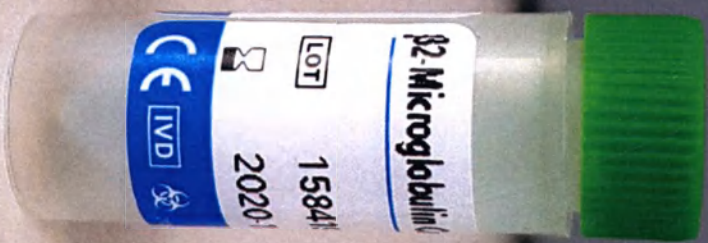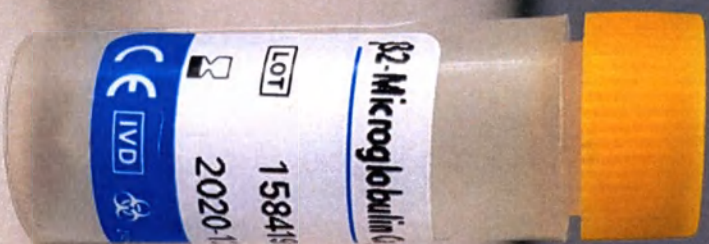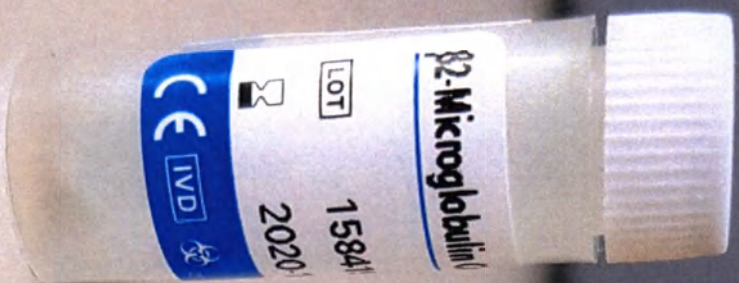

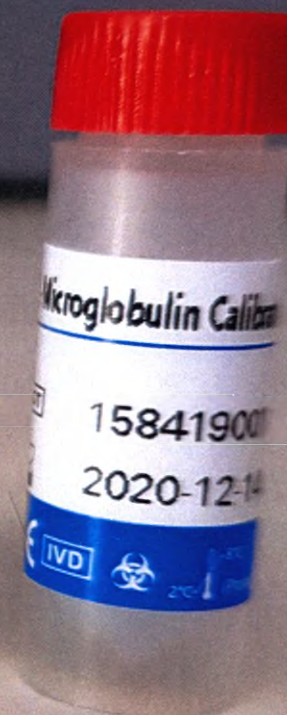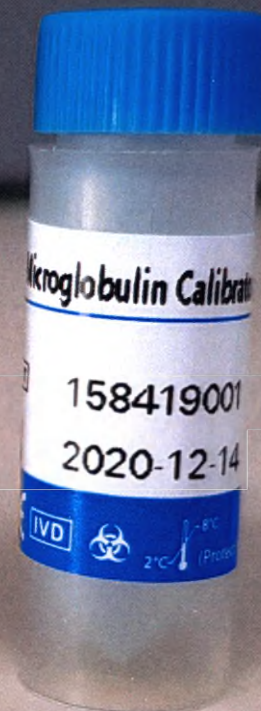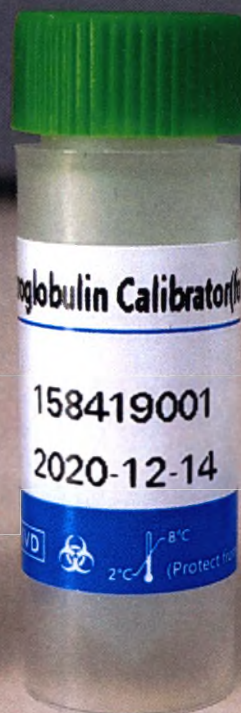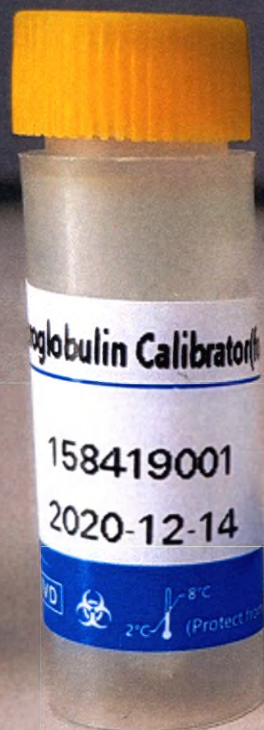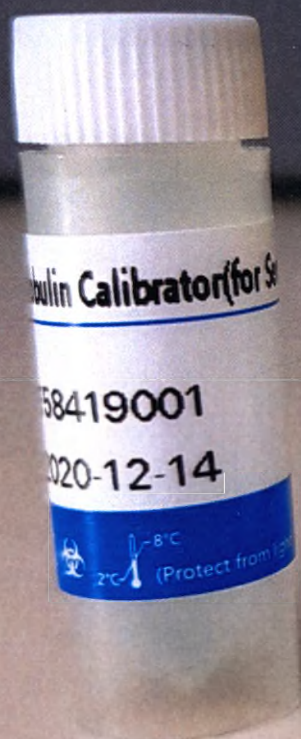

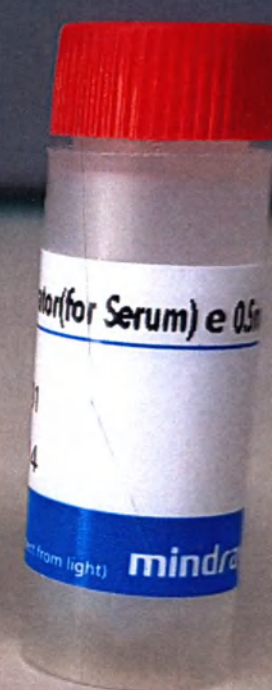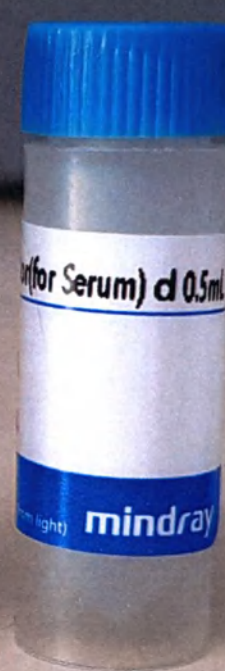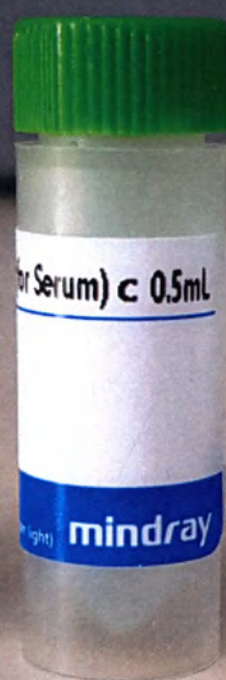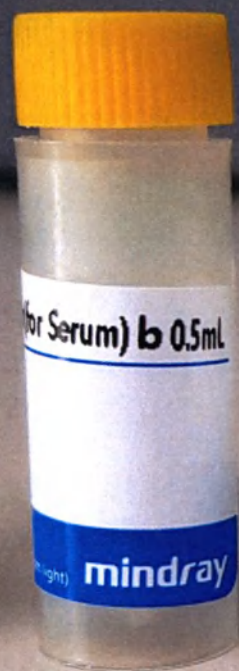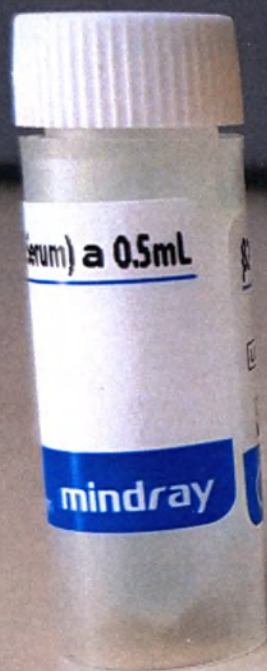

β2-Microglobulin Calibrator (for Urine)

mindray

P/N: 105-004649-00

REF MS(β2-MGII)281

LOT 158520003

2021-09-20

5×0.5 mL




BWH158520003X00006

Калибратор β2-микроглобулина (для моча)
Calibrador β2-Microglobulina (para urina)
Calibrador β2-microglobulina (para orina)
Calibratore β2 Microglobulina (per urina)
β2-Mikroglobulin Kalibratörü (İdrar için)



IVD




Protect from light




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

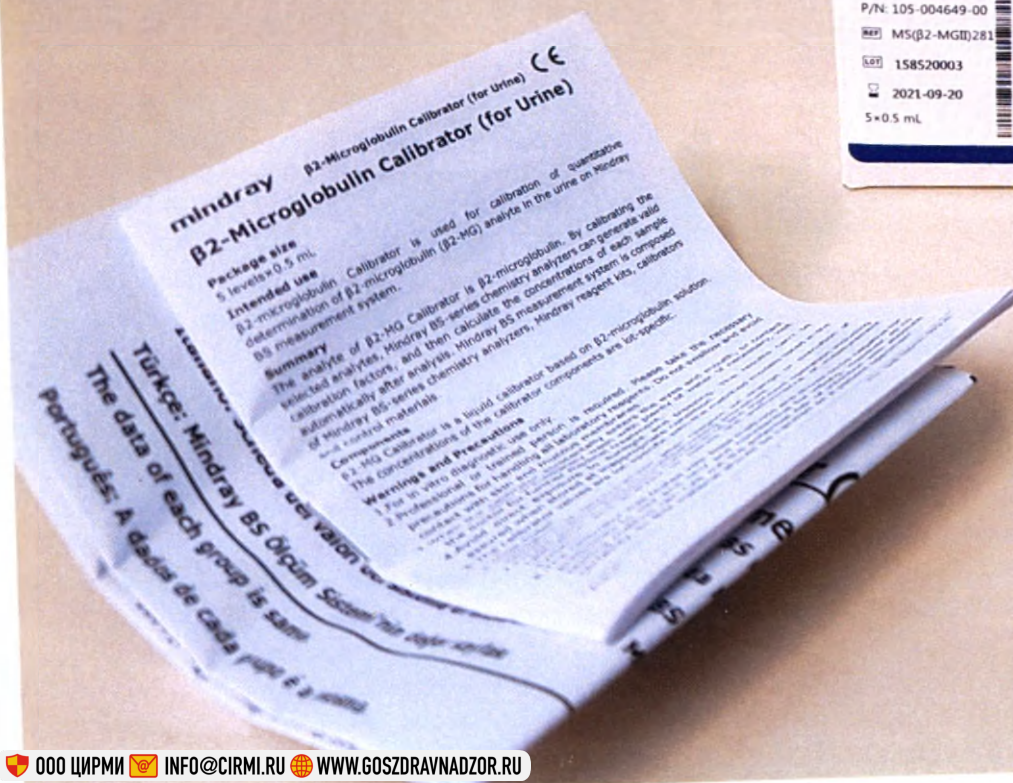



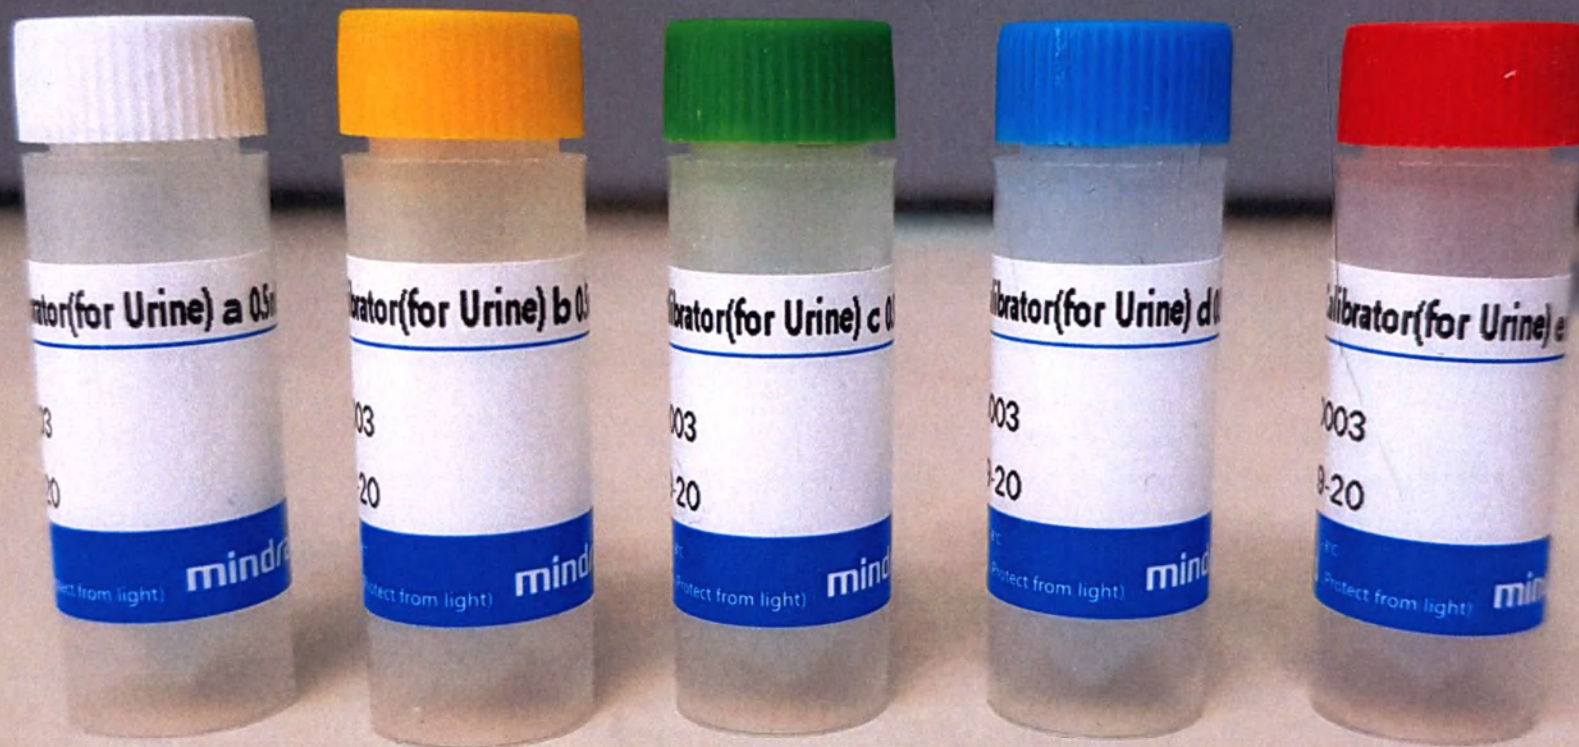





по доверенности от 20.08.2017
Силкин О.В.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
«Миндрей Медикал Рус»

Сюнь Вэй
«26» мая 2021г.
МП «Mindray Company»
Mindray Medical Rus
по доверенности от 11.05.21г.
СЫСОВА Н.В.

Дополнительные фотографические изображения

На Медицинское изделие

**Набор калибраторов для определения бета-2-микроглобулина на анализаторах биохимических
серии BS (β2-Microglobulin Calibrator).**

For In Vitro Diagnostic Use

P/N: 105-004648



Наименование изделия на стикере считать приоритетным

Набор калибраторов для определения бета-2-микроглобулина на анализаторах биохимических серии BS (β 2-Microglobulin Calibrator):

Вариант исполнения:

Набор калибраторов для определения бета-2-микроглобулина (для мочи) на анализаторах биохимических серии BS (β 2-Microglobulin Calibrator (for Urine)):

- калибратор β 2-микроглобулина (для мочи) а (β 2-Microglobulin Calibrator (for Urine) a), 0,5 мл - 1 шт.;
- калибратор β 2-микроглобулина (для мочи) b (β 2-Microglobulin Calibrator (for Urine) b), 0,5 мл - 1 шт.;
- калибратор β 2-микроглобулина (для мочи) c (β 2-Microglobulin Calibrator (for Urine) c), 0,5 мл - 1 шт.;
- калибратор β 2-микроглобулина (для мочи) d (β 2-Microglobulin Calibrator (for Urine) d), 0,5 мл - 1 шт.;
- калибратор β 2-микроглобулина (для мочи) e (β 2-Microglobulin Calibrator (for Urine) e), 0,5 мл - 1 шт.;
- лист значений параметров лота калибратора; - инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Код партии, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Только для диагностики in vitro

Для профессионального применения

Производитель: Шэньчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.), КНР Адрес: Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan,

518057 Shenzhen, People's Republic of China

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Миндрей Медикал Рус». Адрес: 129090, г. Москва,

Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, антресоль 4, помещение I, ком. 7, 11А.

Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39,

info.ru@mindray.com

Этикетка для поставок в РФ на «Набор калибраторов для определения бета-2-микроглобулина (для мочи) на анализаторах биохимических серии BS (β 2-Microglobulin Calibrator (for Urine))»

Миндрей

For In Vitro Diagnostic Use

P/N: 105-004649-00



Наименование изделия на стикере считать приоритетным

Набор калибраторов для определения бета-2-микроглобулина на анализаторах биохимических серии BS (β 2-Microglobulin Calibrator):

Вариант исполнения:

Набор калибраторов для определения бета-2-микроглобулина (для сыворотки) на анализаторах биохимических серии BS (β 2-Microglobulin Calibrator (for Serum)):

- калибратор β 2-микроглобулина (для сыворотки) а (β 2-Microglobulin Calibrator (for Serum) a), 0,5 мл - 1 шт.;
- калибратор β 2-микроглобулина (для сыворотки) б (β 2-Microglobulin Calibrator (for Serum) b), 0,5 мл - 1 шт.;
- калибратор β 2-микроглобулина (для сыворотки) с (β 2-Microglobulin Calibrator (for Serum) c), 0,5 мл - 1 шт.;
- калибратор β 2-микроглобулина (для сыворотки) д (β 2-Microglobulin Calibrator (for Serum) d), 0,5 мл - 1 шт.;
- калибратор β 2-микроглобулина (для сыворотки) е (β 2-Microglobulin Calibrator (for Serum) e), 0,5 мл - 1 шт.;
- лист значений параметров лота калибратора; - инструкция по применению

Регистрационное удостоверение № ____ от ____

Код партии, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Только для диагностики in vitro

Для профессионального применения

Производитель: Шэньчжэнь Миндрей Био-Медикал Электроникс Ко., Лтд. (Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.), КНР Адрес: Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, 518057 Shenzhen, People's Republic of China

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Миндрей Медикал Рус». Адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 16, стр. 5, антресоль 4, помещения 1, ком. 7, 11А.

Тел.: (499) 553-60-36. Факс: (499) 553-60-39.

info.ru@mindray.com

Этикетка для поставок в РФ на «Набор калибраторов для определения бета-2-микроглобулина (для сыворотки) на анализаторах биохимических серии BS (β 2-Microglobulin Calibrator (for Serum))»

Сысоев

по доверенности от 11.05.2016
СЫСОВЕВ Н.В. **Прошито и скреплено**
печатью 3 **листов**

