

Руководитель группы регистрации
ООО «Сименс Здравоохранение»



Н.А. Горшкова
«24» марта 2021 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**«Набор калибраторов для определения глобулина, связывающего половые гормоны для
анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Sex Hormone Binding Globulin
Calibrator (Atellica IM SHBG CAL))»**

производства «Сименс Хелскеа Диагностикс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США

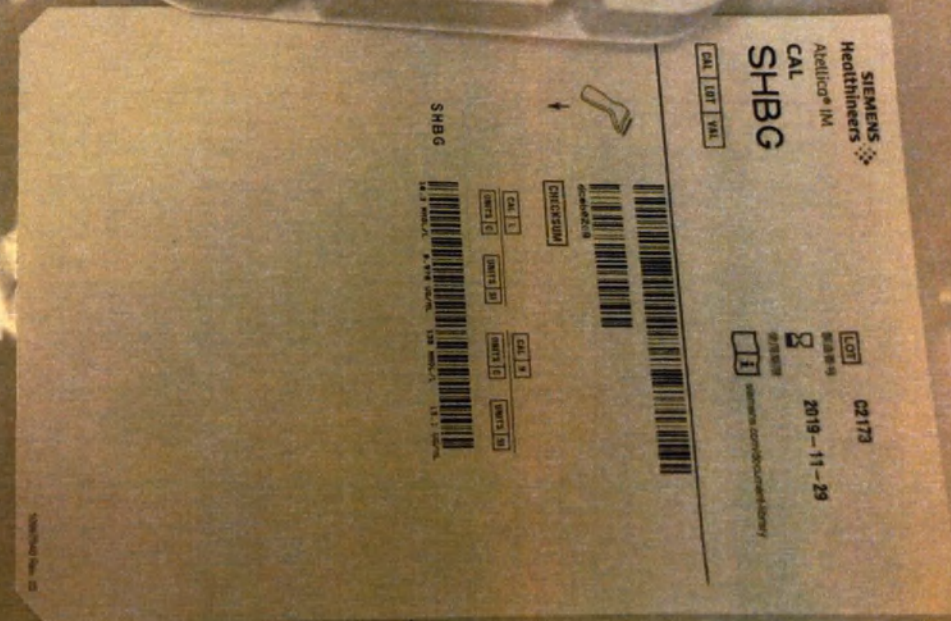
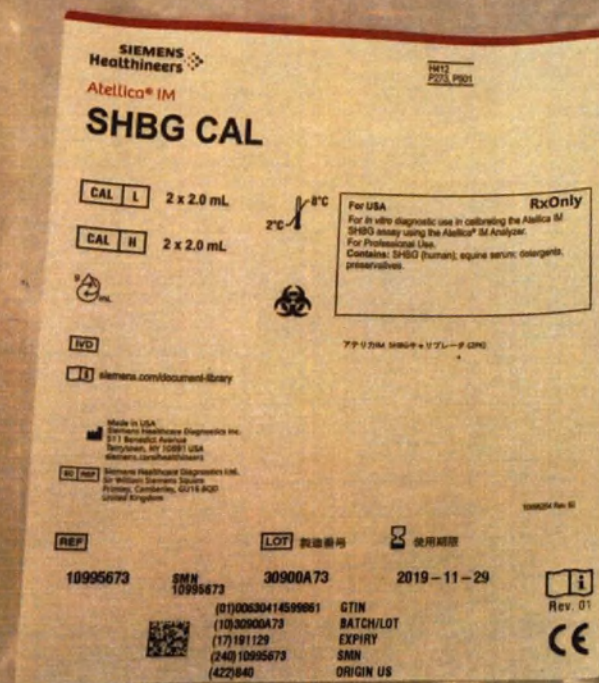


Рисунок 1. Набор калибраторов для определения глобулина, связывающего половые гормоны для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Sex Hormone Binding Globulin Calibrator (Atellica IM SHBG CAL)). Общий вид



Рисунок 2. Набор калибраторов для определения глобулина, связывающего половые гормоны для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Sex Hormone Binding Globulin Calibrator (Atellica IM SHBG CAL)): Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM SHBG CAL L, 2,0 мл – 2 флакона

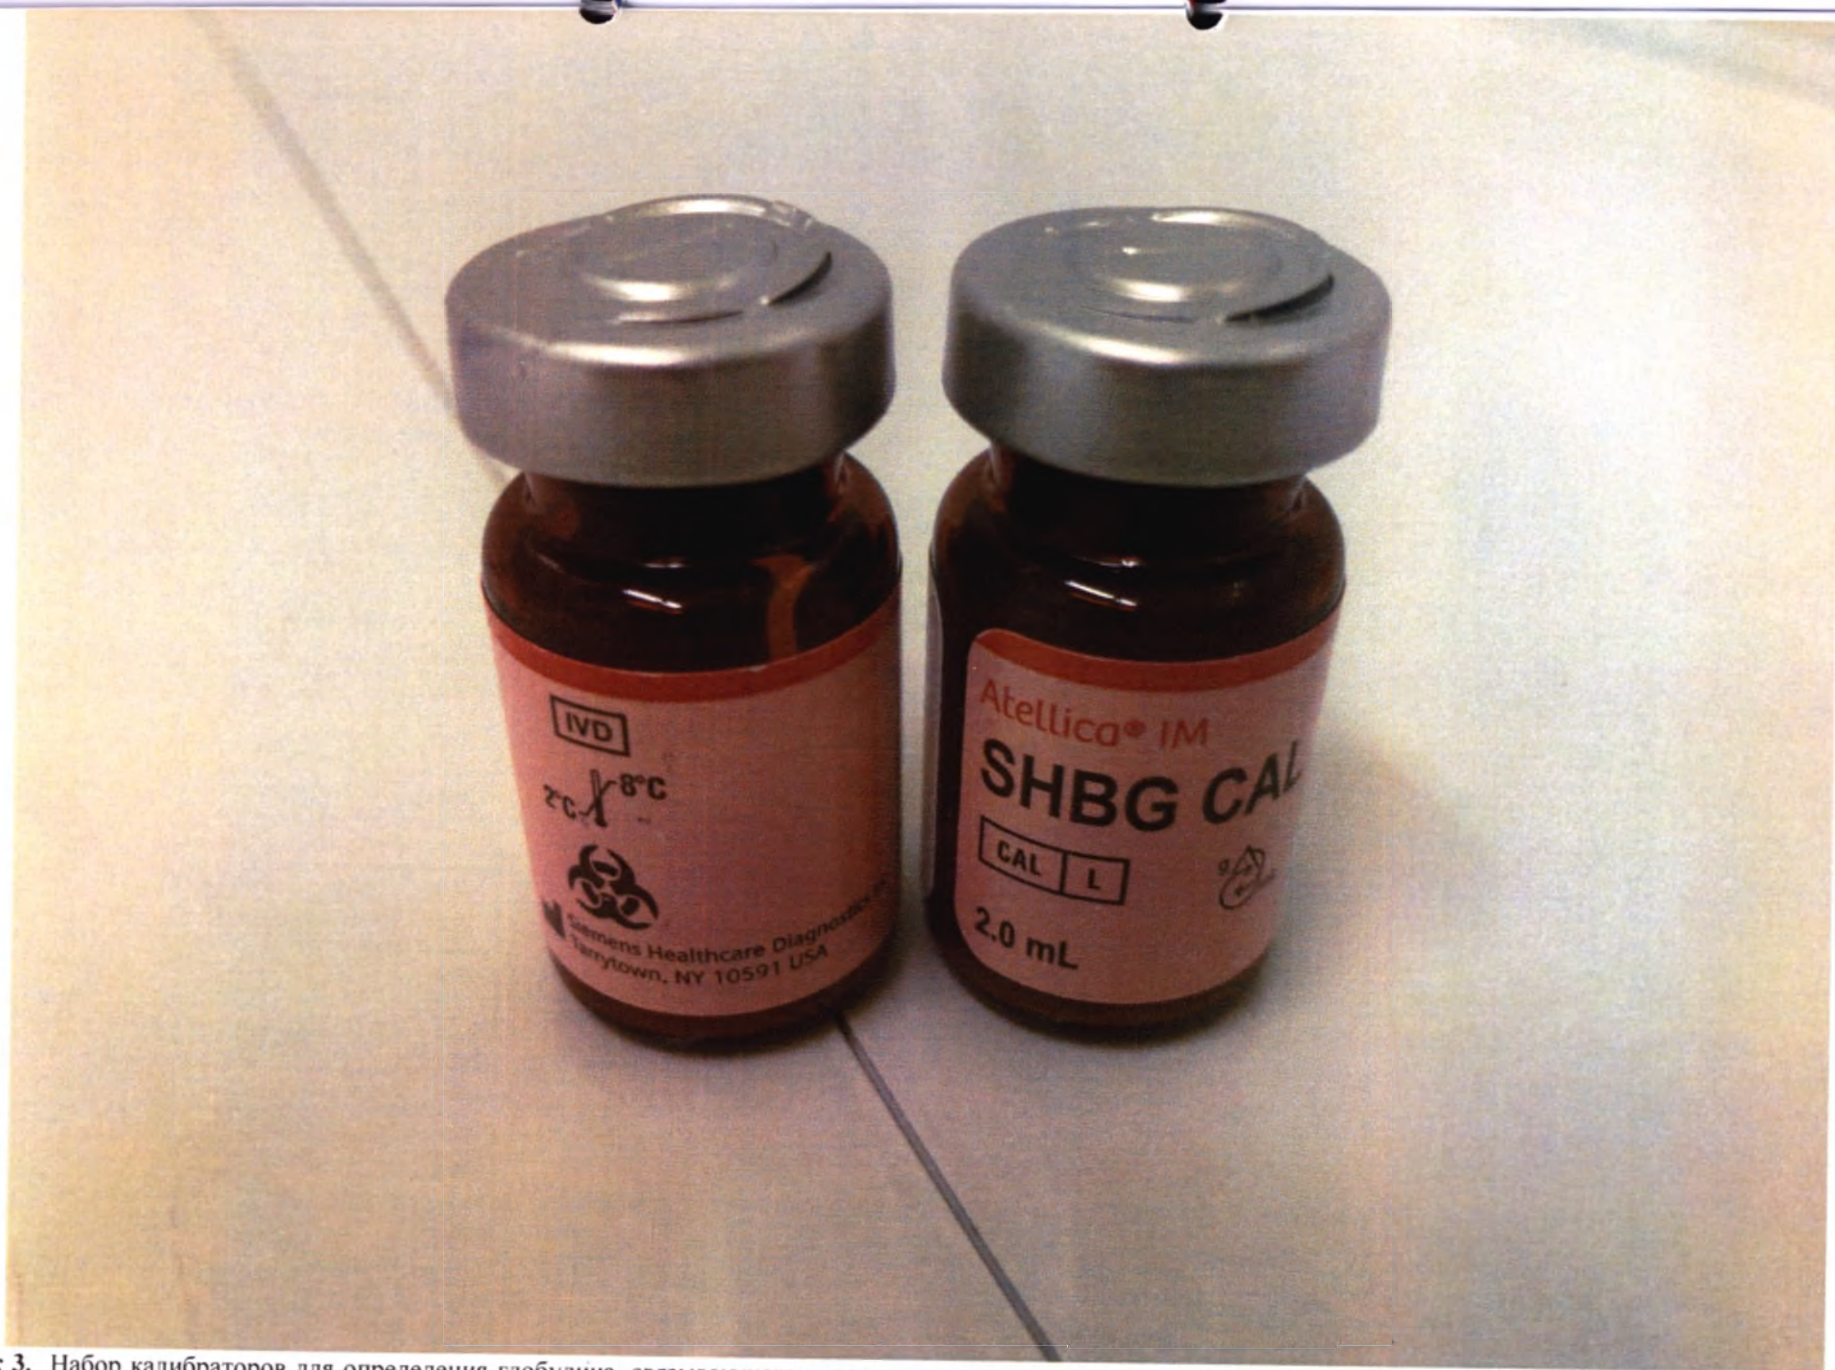


Рисунок 3. Набор калибраторов для определения глобулина, связывающего половые гормоны для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Sex Hormone Binding Globulin Calibrator (Atellica IM SHBG CAL)): Калибратор с низкой концентрацией Atellica IM SHBG CAL L, 2,0 мл – 2 флакона



Рисунок 4. Набор калибраторов для определения глобулина, связывающего половые гормоны для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Sex Hormone Binding Globulin Calibrator (Atellica IM SHBG CAL)): Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM SHBG CAL H, 2,0 мл – 2 флакона

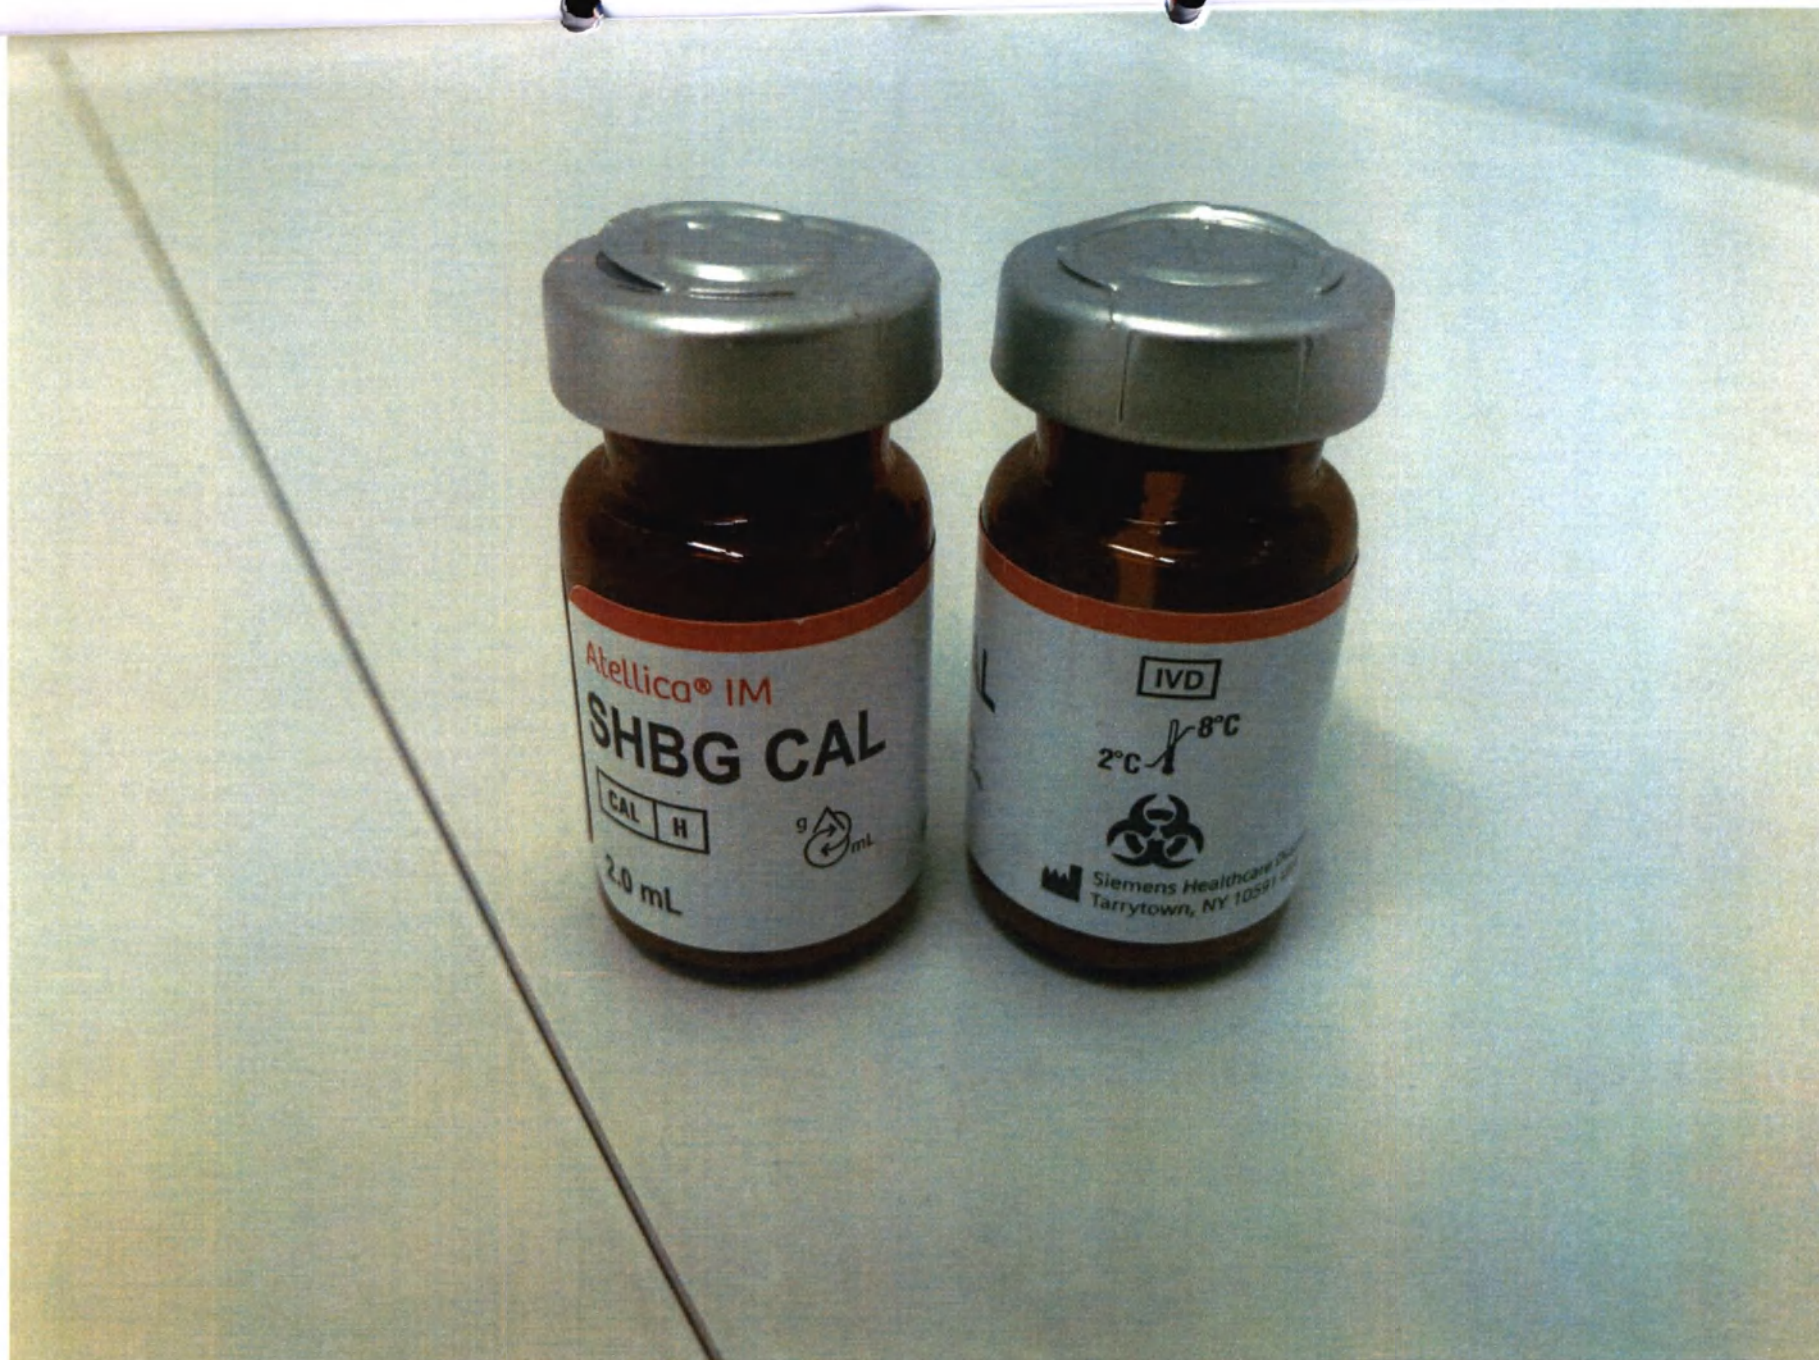


Рисунок 5. Набор калибраторов для определения глобулина, связывающего половые гормоны для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Sex Hormone Binding Globulin Calibrator (Atellica IM SHBG CAL)): Калибратор с высокой концентрацией Atellica IM SHBG CAL H, 2,0 мл – 2 флакона

SIEMENS
Healthineers

Atellica® IM

CAL

SHBG

CAL	LOT	VAL
-----	-----	-----

LOT

製造番号



使用期限



siemens.com/document-library

C2173

2019-11-29



dceb02c8

CHECKSUM

CAL	L
-----	---

UNITS	C
-------	---

UNITS	SI
-------	----

CAL	H
-----	---

UNITS	C
-------	---

UNITS	SI
-------	----

SHBG



10.3 NMOL/L 0.978 UG/ML 138 NMOL/L 13.1 UG/ML

10997640 Rev. 02

Рисунок 6. Набор калибраторов для определения глобулина, связывающего половые гормоны для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Sex Hormone Binding Globulin Calibrator (Atellica IM SHBG CAL)): Лист значений параметров серии калибратора.



Всего прошито и пронумеровано
7 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

