


Фотографические изображения

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-SARS-CoV-2 cobas e analyzers/ACOV2), 200 тестов. Серия: LOT 53923001.

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-SARS-CoV-2 cobas e analyzers/ACOV2), 200 тестов. Серия: LOT 53923001.

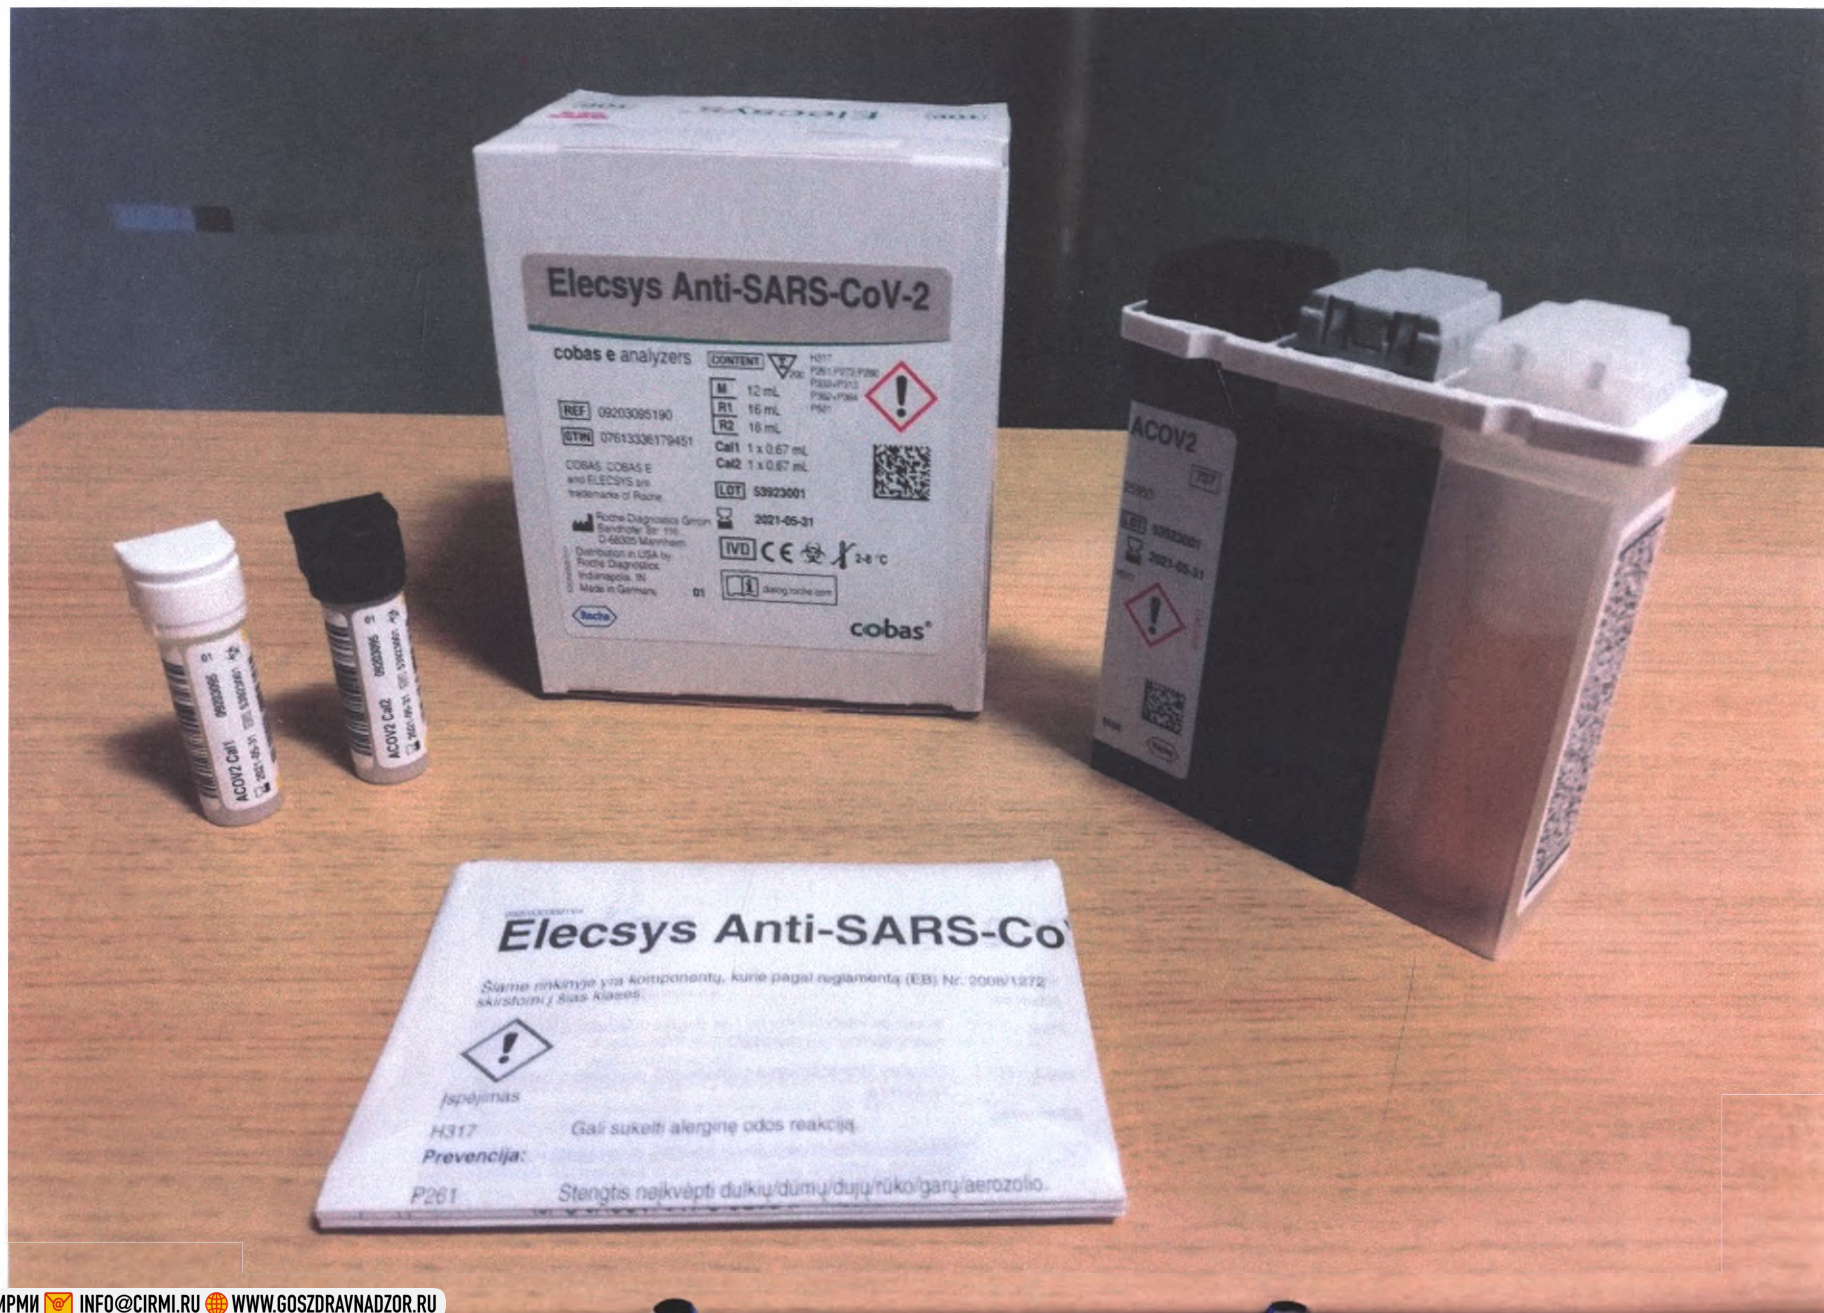

Elecsys Anti-SARS-CoV-2

cobas e analyzers

CONTENT



H317
P261, P272, P280
P333+P313
P362+P364
P501



REF 09203095190

GTIN 07613336179451

COBAS, COBAS E
and ELECSYS are
trademarks of Roche.

 Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:
Roche Diagnostics,
Indianapolis, IN
Made in Germany

01201900011(1)

M 12 mL

R1 16 mL

R2 16 mL

Cal1 1 x 0.67 mL

Cal2 1 x 0.67 mL

LOT 53923001

 2021-05-31

IVD CE   2-8 °C


 dialog.roche.com

01



cobas®

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-SARS-CoV-2 cobas e analyzers/ACOV2), 200 тестов. Серия: LOT 53923001

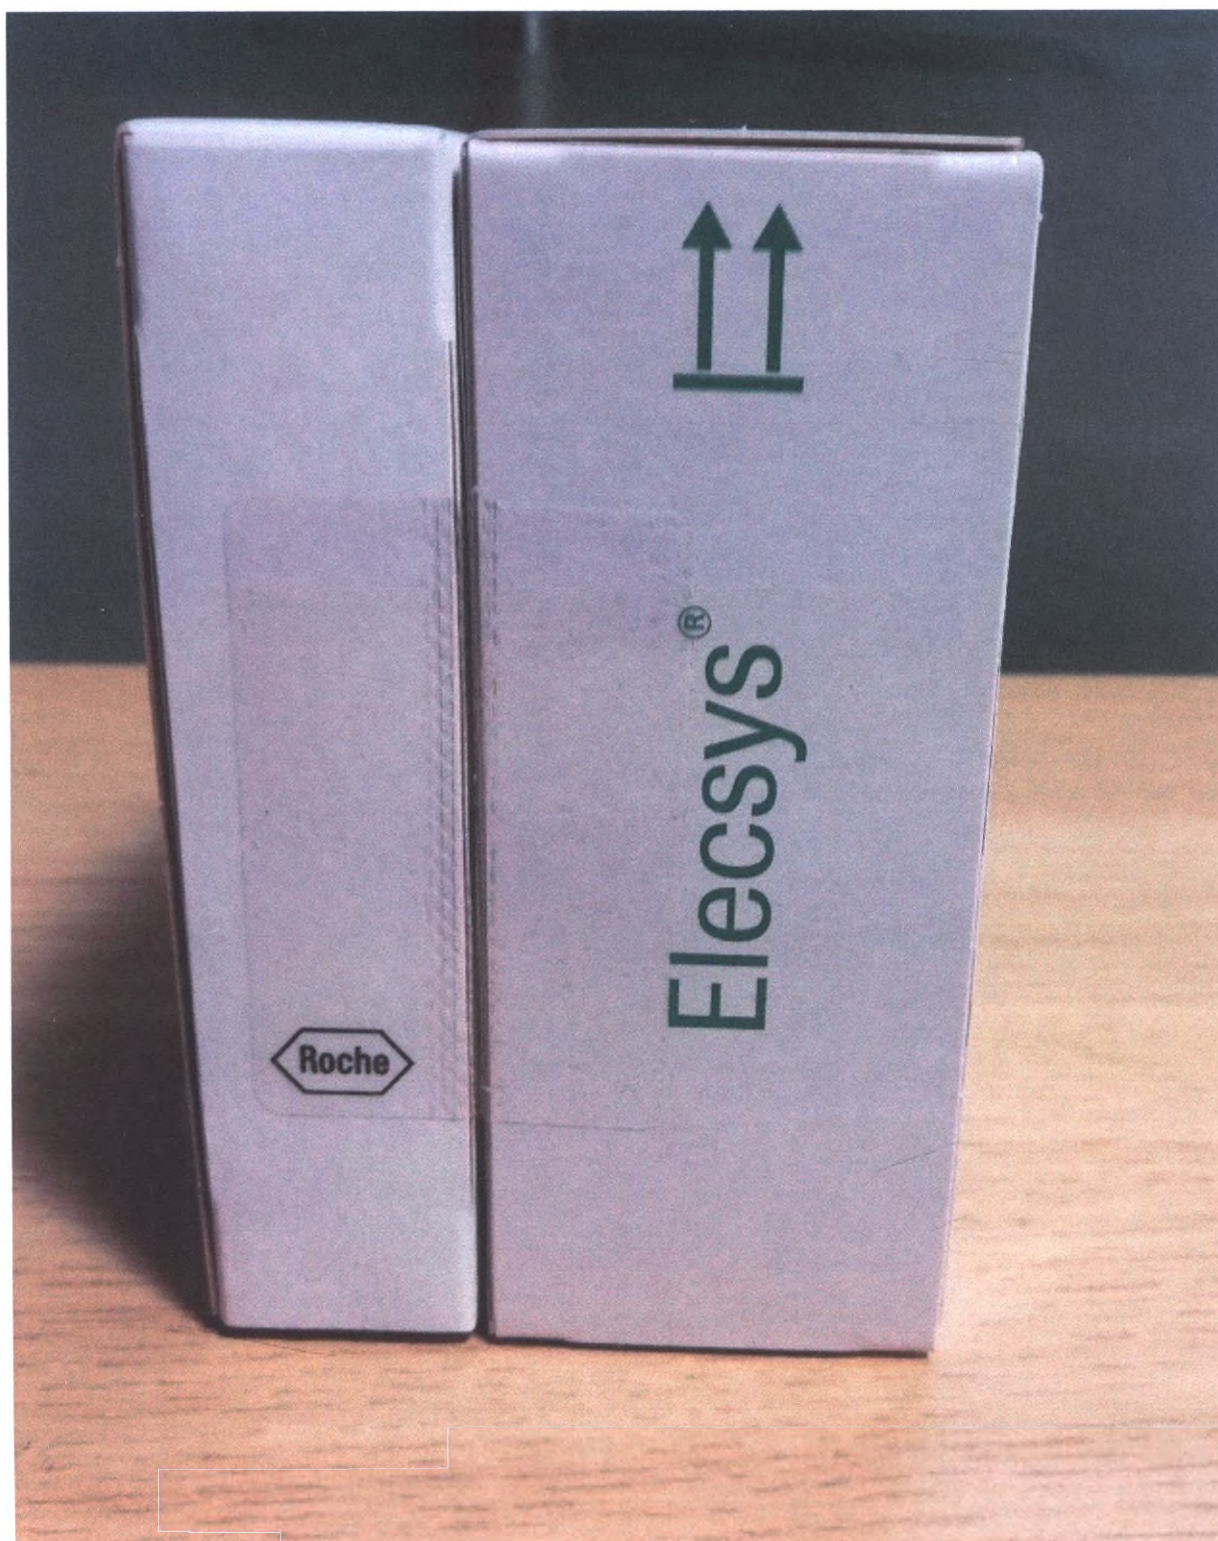

Elecsys Anti-SARS-CoV-2

REF 09203095190

For USA: **CONTENT**

For Emergency Use Authorization only

For professional use

- M** Streptavidin-coated microparticles 0.72 mg/mL
- R1** Biotinylated SARS-CoV-2-specific recombinant antigens (E. coli)
- R2** SARS-CoV-2-specific recombinant antigens labeled with ruthenium complex
- Cal1** Human serum, non-reactive for anti-SARS-CoV-2 antibodies
- Cal2** Human serum, reactive for anti-SARS-CoV-2 antibodies



Rx only

02



Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-SARS-CoV-2 cobas e analyzers/ACOV2), 200 тестов. Серия: LOT 53923001



Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-SARS-CoV-2 cobas e analyzers/ACOV2), 200 тестов. Серия: LOT 53923001.

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-SARS-CoV-2 cobas e analyzers/ACOV2), 200 тестов. Серия: LOT 53923001

Состав:

1. Капота с реагентами на три определения (флакон) (ACOV2): M, R1, R2 – 1 шт;
2. Калибратор 1 (ACOV2 Cal1), флакон, объем 0,67 мл – 1 шт;
3. Калибратор 2 (ACOV2 Cal2), флакон, объем 0,67 мл – 1 шт;
4. Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке. Температура хранения см. на упаковке. Номер лота см. на упаковке

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HbSAg отсутствуют

Сыворотку, содержащую антитела против SARS-CoV-2 (ACOV2 Cal2), инактивировали теплом в течение 30 минут при 56°C.

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» («Рох Диагностикс ГмбХ»), Sandhofer Strasse 116, 68306 Mannheim, Germany, Германия

Идентифицировано только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Рох Диагностикс Рус» (ООО «Рох Диагностикс Рус»), 107031, Москва, Трубиня площадь, д.2 Тел: +7 495 229-88-88, факс: +7 495 229-82-84

E-mail: ruccom@roche-dia.com

Kat номер 09203086180

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-SARS-CoV-2 cobas e analyzers/ACOV2), 200 тестов. Серия: LOT 53923001

1. Кассета с реагентами на три отделения (флакона) (ACoV2): M, R1, R2 – 1 шт.




Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-SARS-CoV-2 cobas e analyzers/ACOV2), 200 тестов. Серия: LOT 53923001

1. Кассета с реагентами на три отделения (флакона) (ACoV2): M, R1, R2 – 1 шт.




Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-SARS-CoV-2 cobas e analyzers/ACOV2), 200 тестов. Серия: LOT 53923001

2. Калибратор 1 (ACOV2 Cal1), флакон, объем 0,67 мл – 1 шт.

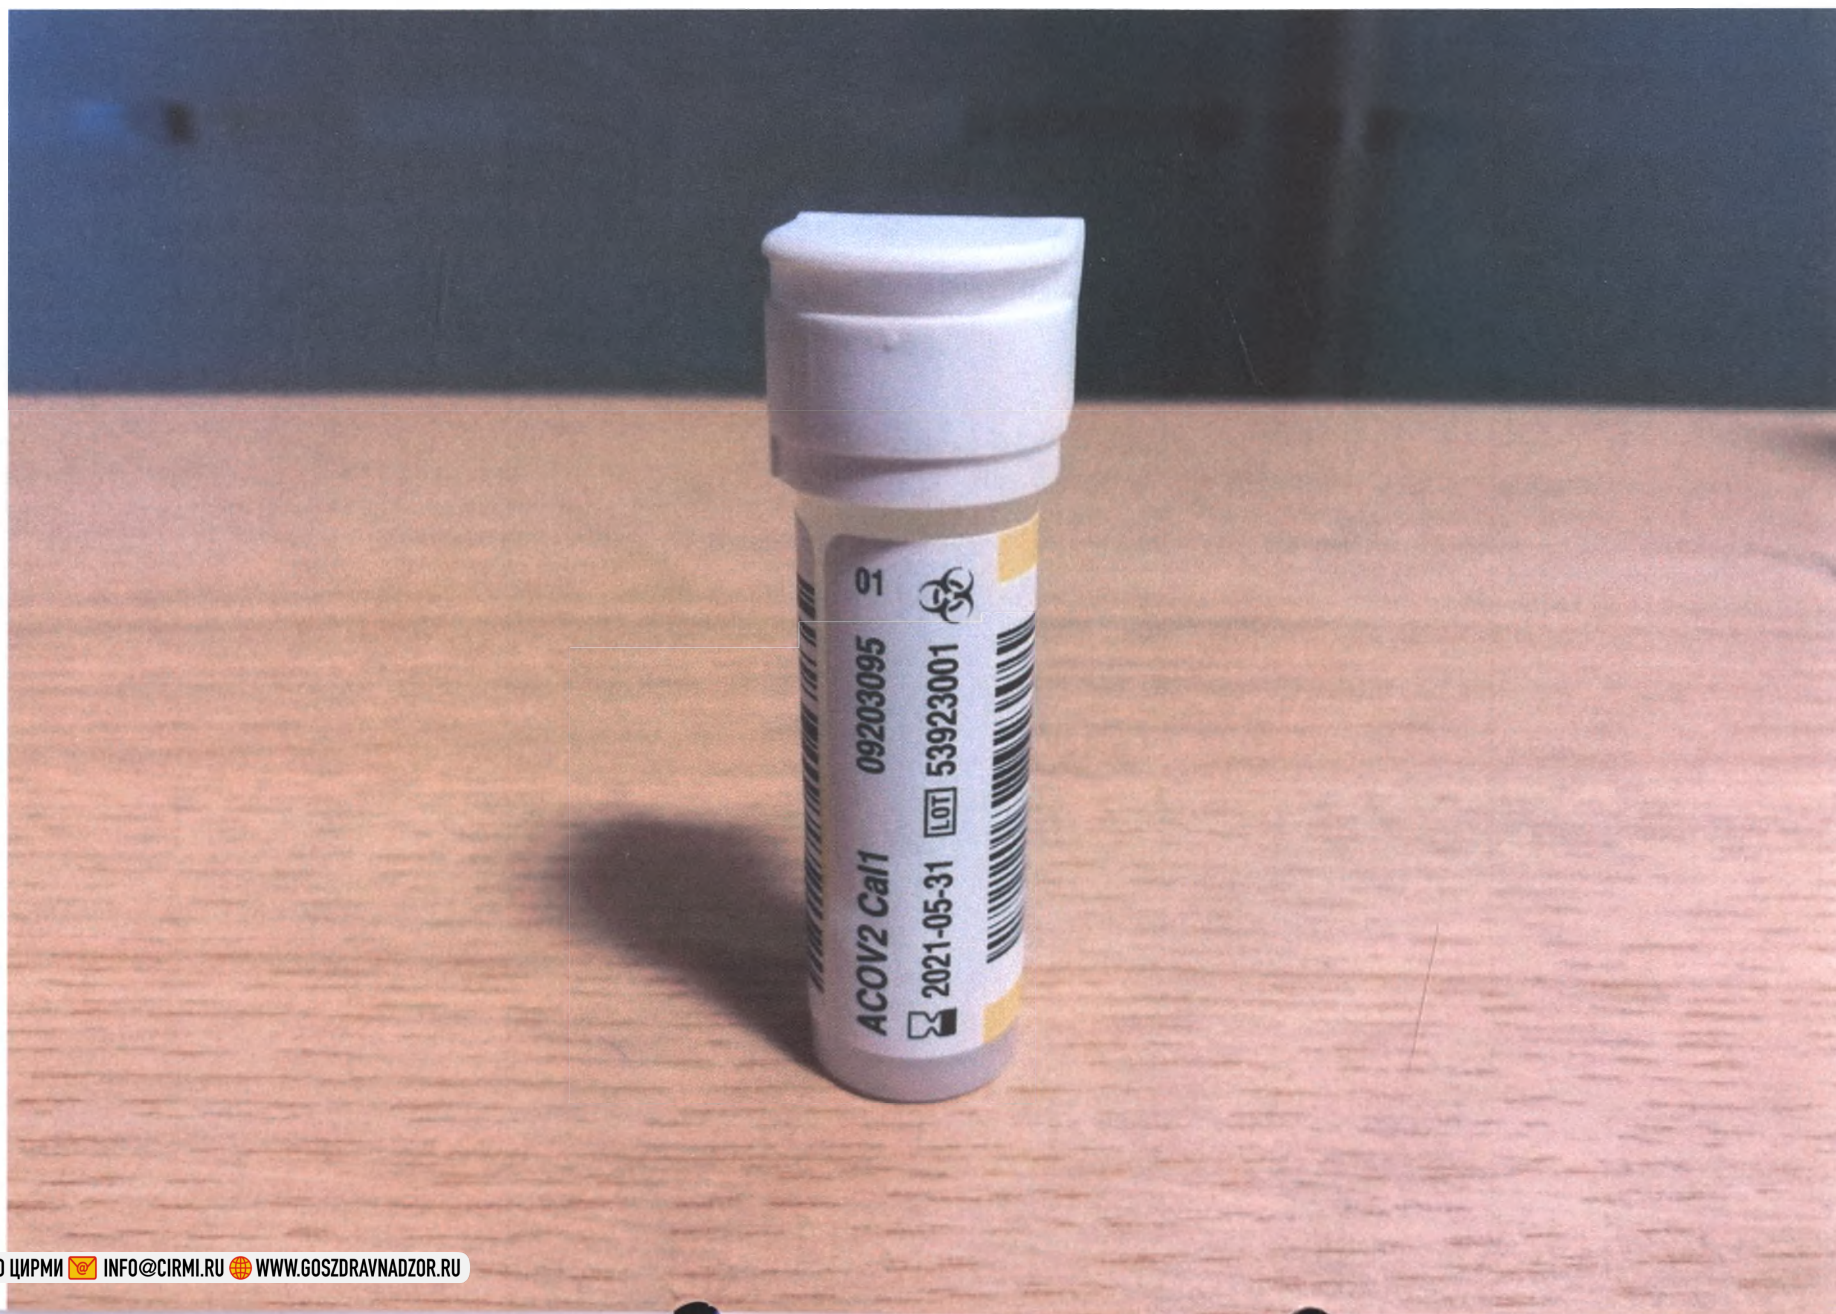

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител IgM/IgG к SARS-CoV-2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-SARS-CoV-2 cobas e analyzers/ACOV2), 200 тестов. Серия: LOT 53923001

3. Калибратор 2 (ACOV2 Cal2), флакон, объем 0,67 мл – 1 шт.

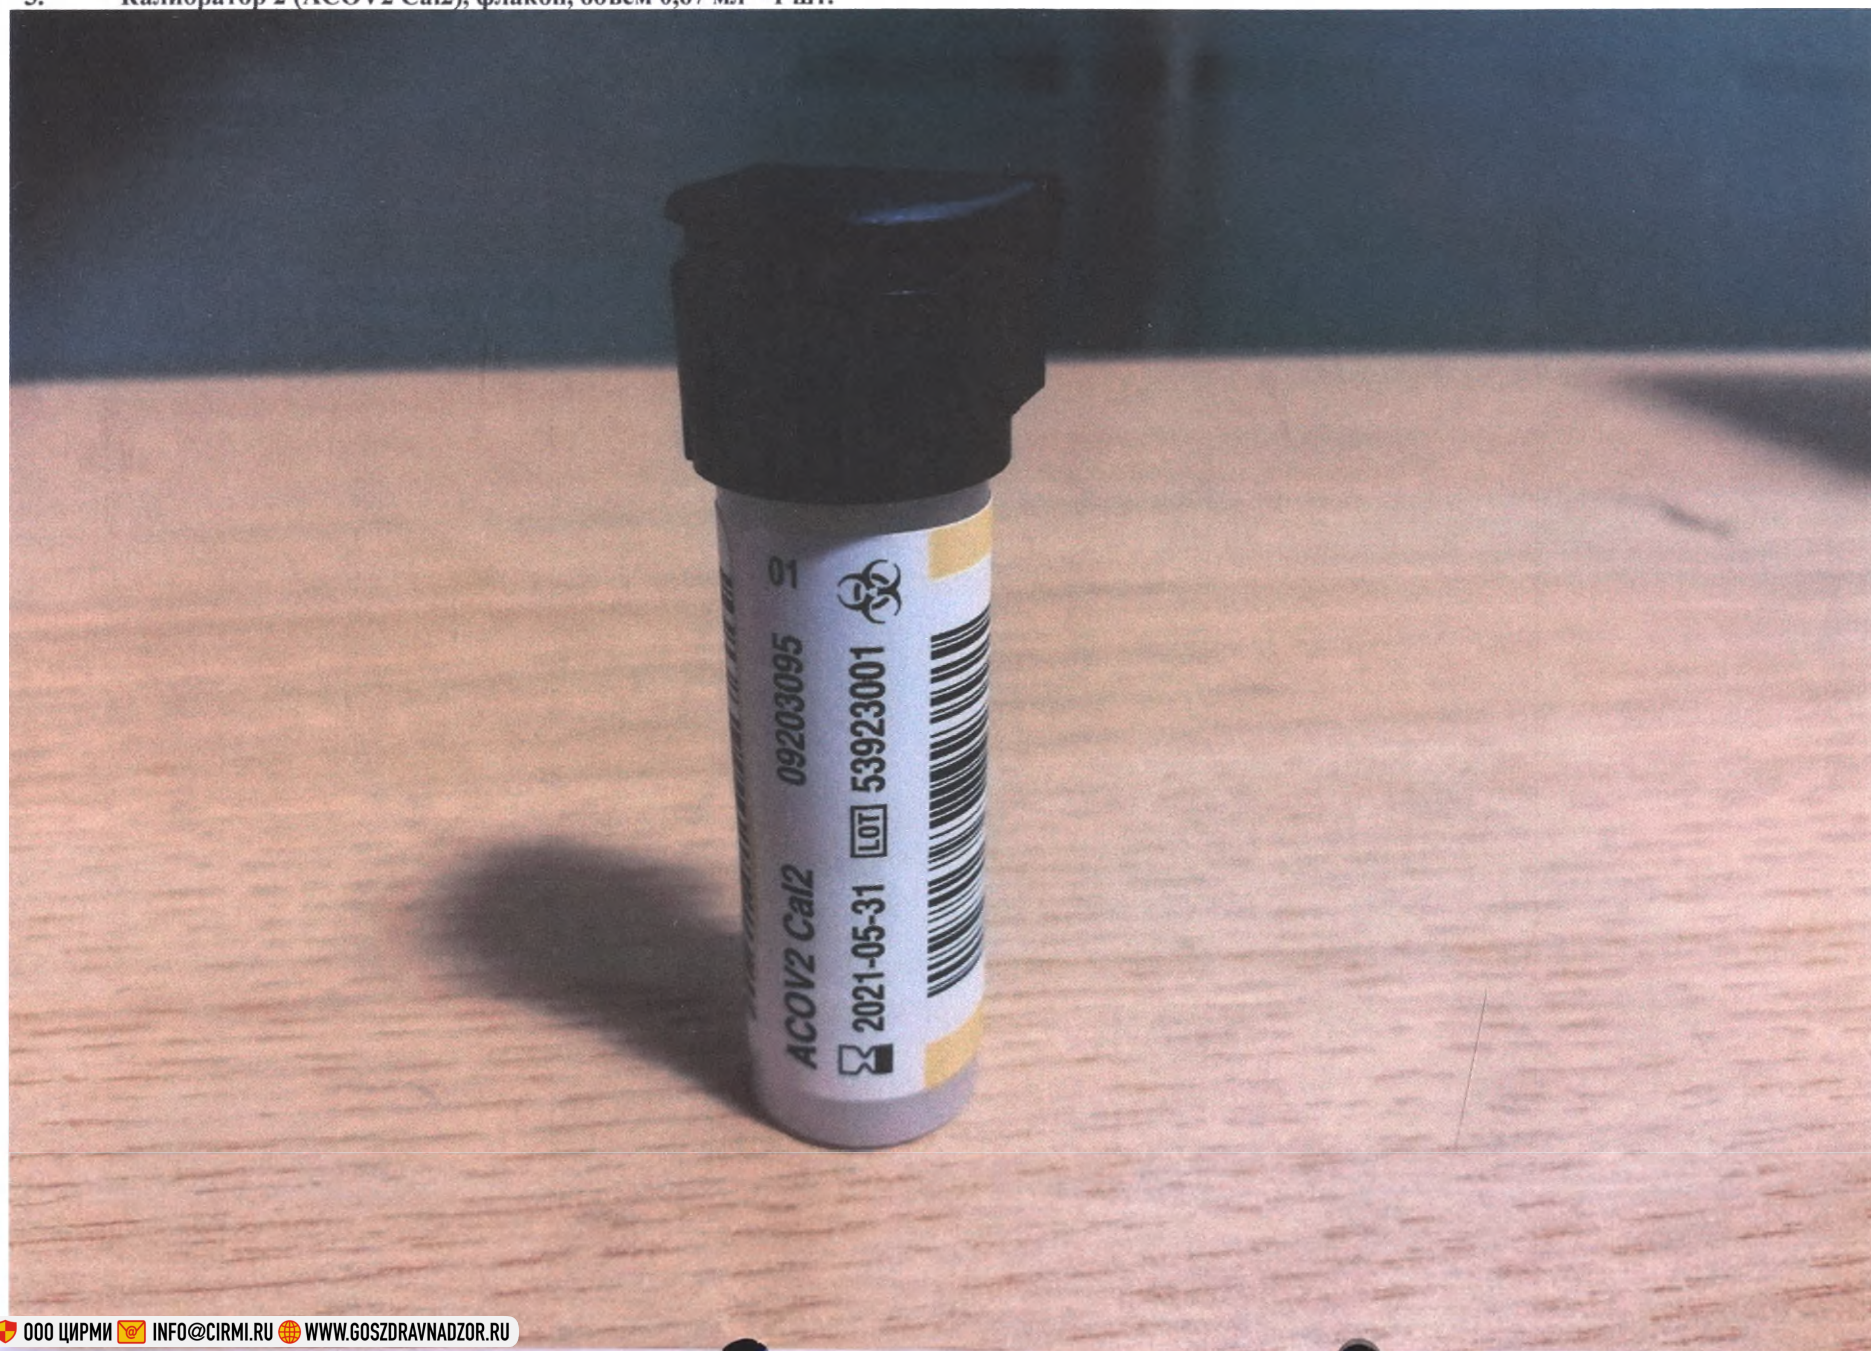

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
12 листа (ов)

