

НЕГАТОСКОПЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ НР- «ПОНИ»

В исполнениях

«Негатоскоп общего назначения НР1-01»

«Негатоскоп общего назначения НР2-01»

«Негатоскоп общего назначения НР3-01»

«Негатоскоп общего назначения НР4-01»

«Негатоскоп общего назначения НР1-02»


«Негатоскоп общего назначения НР2-02»

«Негатоскоп общего назначения НР3-02»

«Негатоскоп общего назначения НР4-02»

**ГЕН. ДИРЕКТОР
ЗАО ПОНИ
ХАРЧЕНКОВ С.В.**




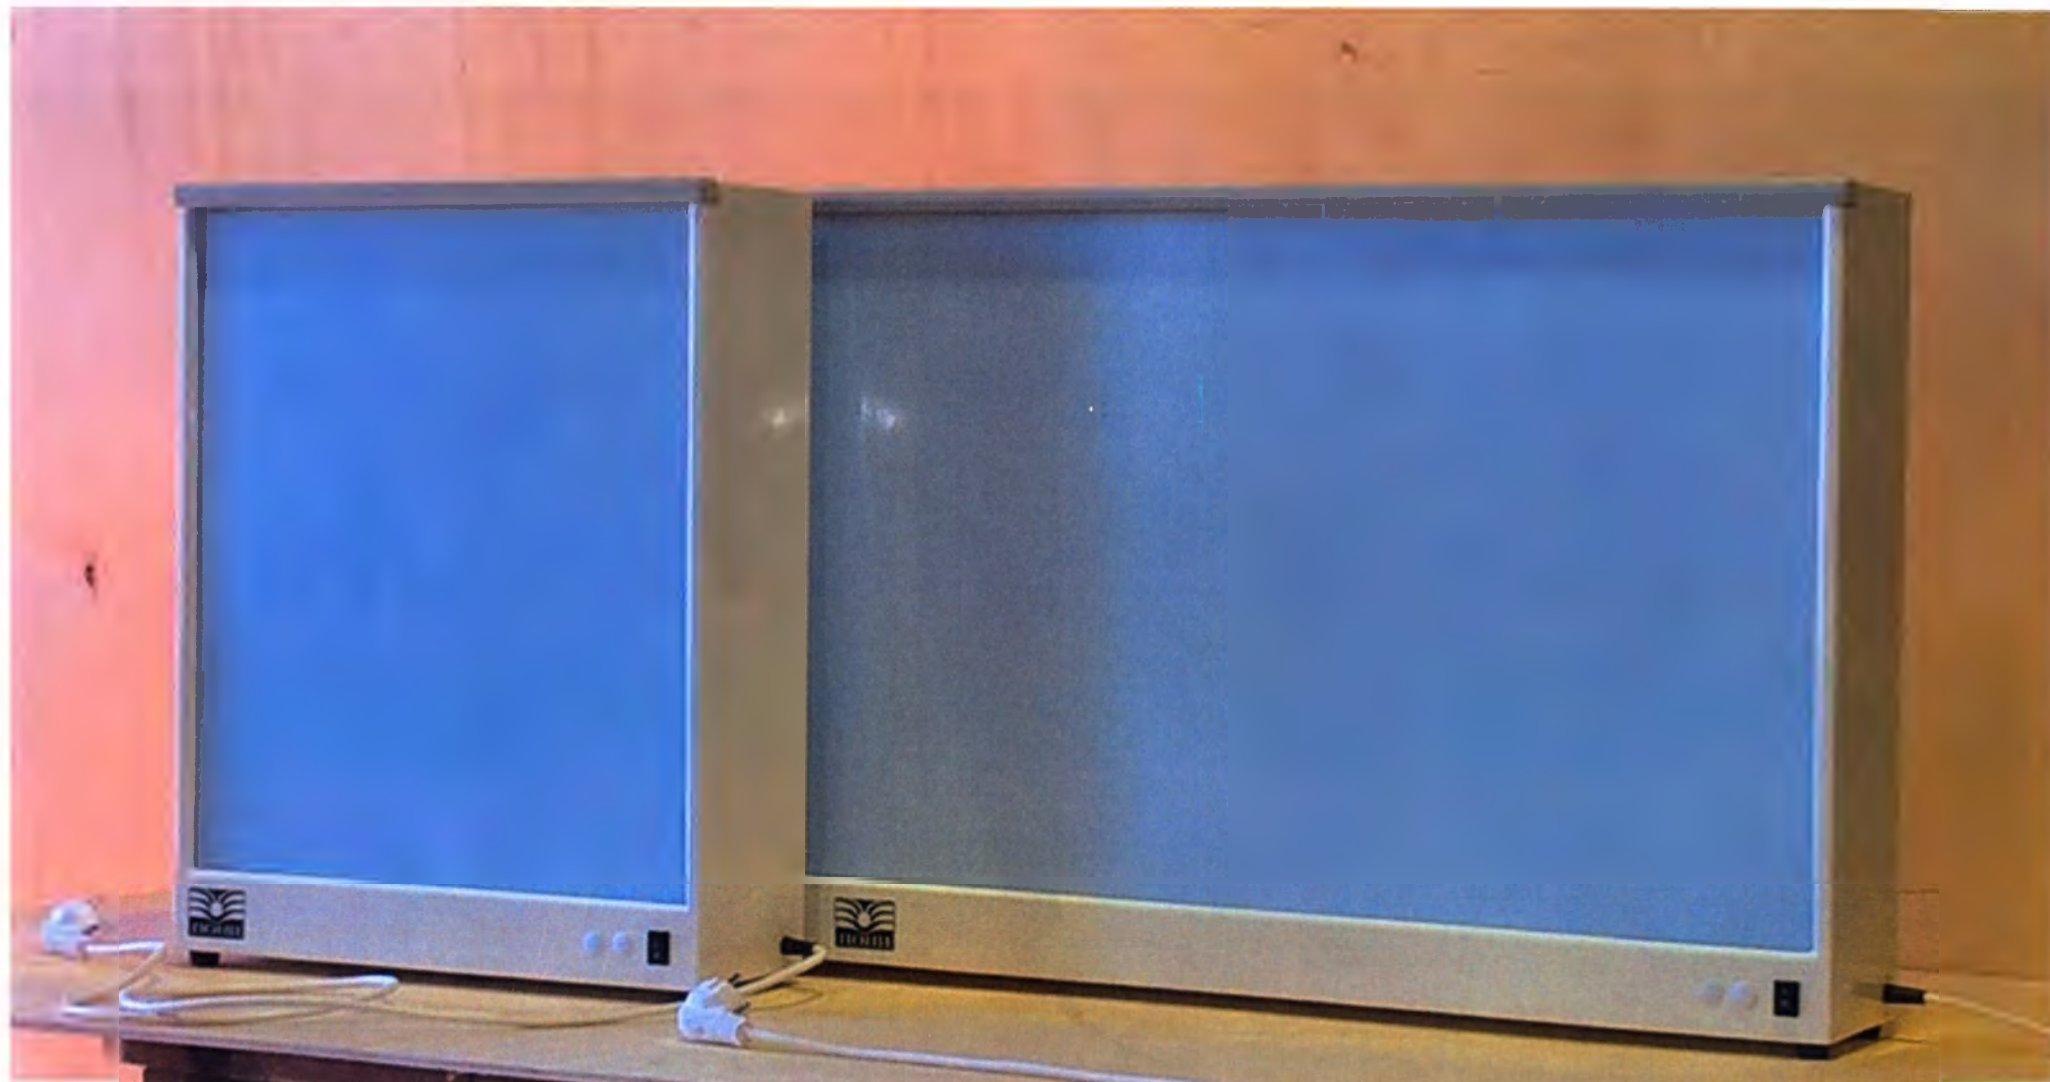


HP1-01

HP2-01

Негатостопы общего назначения

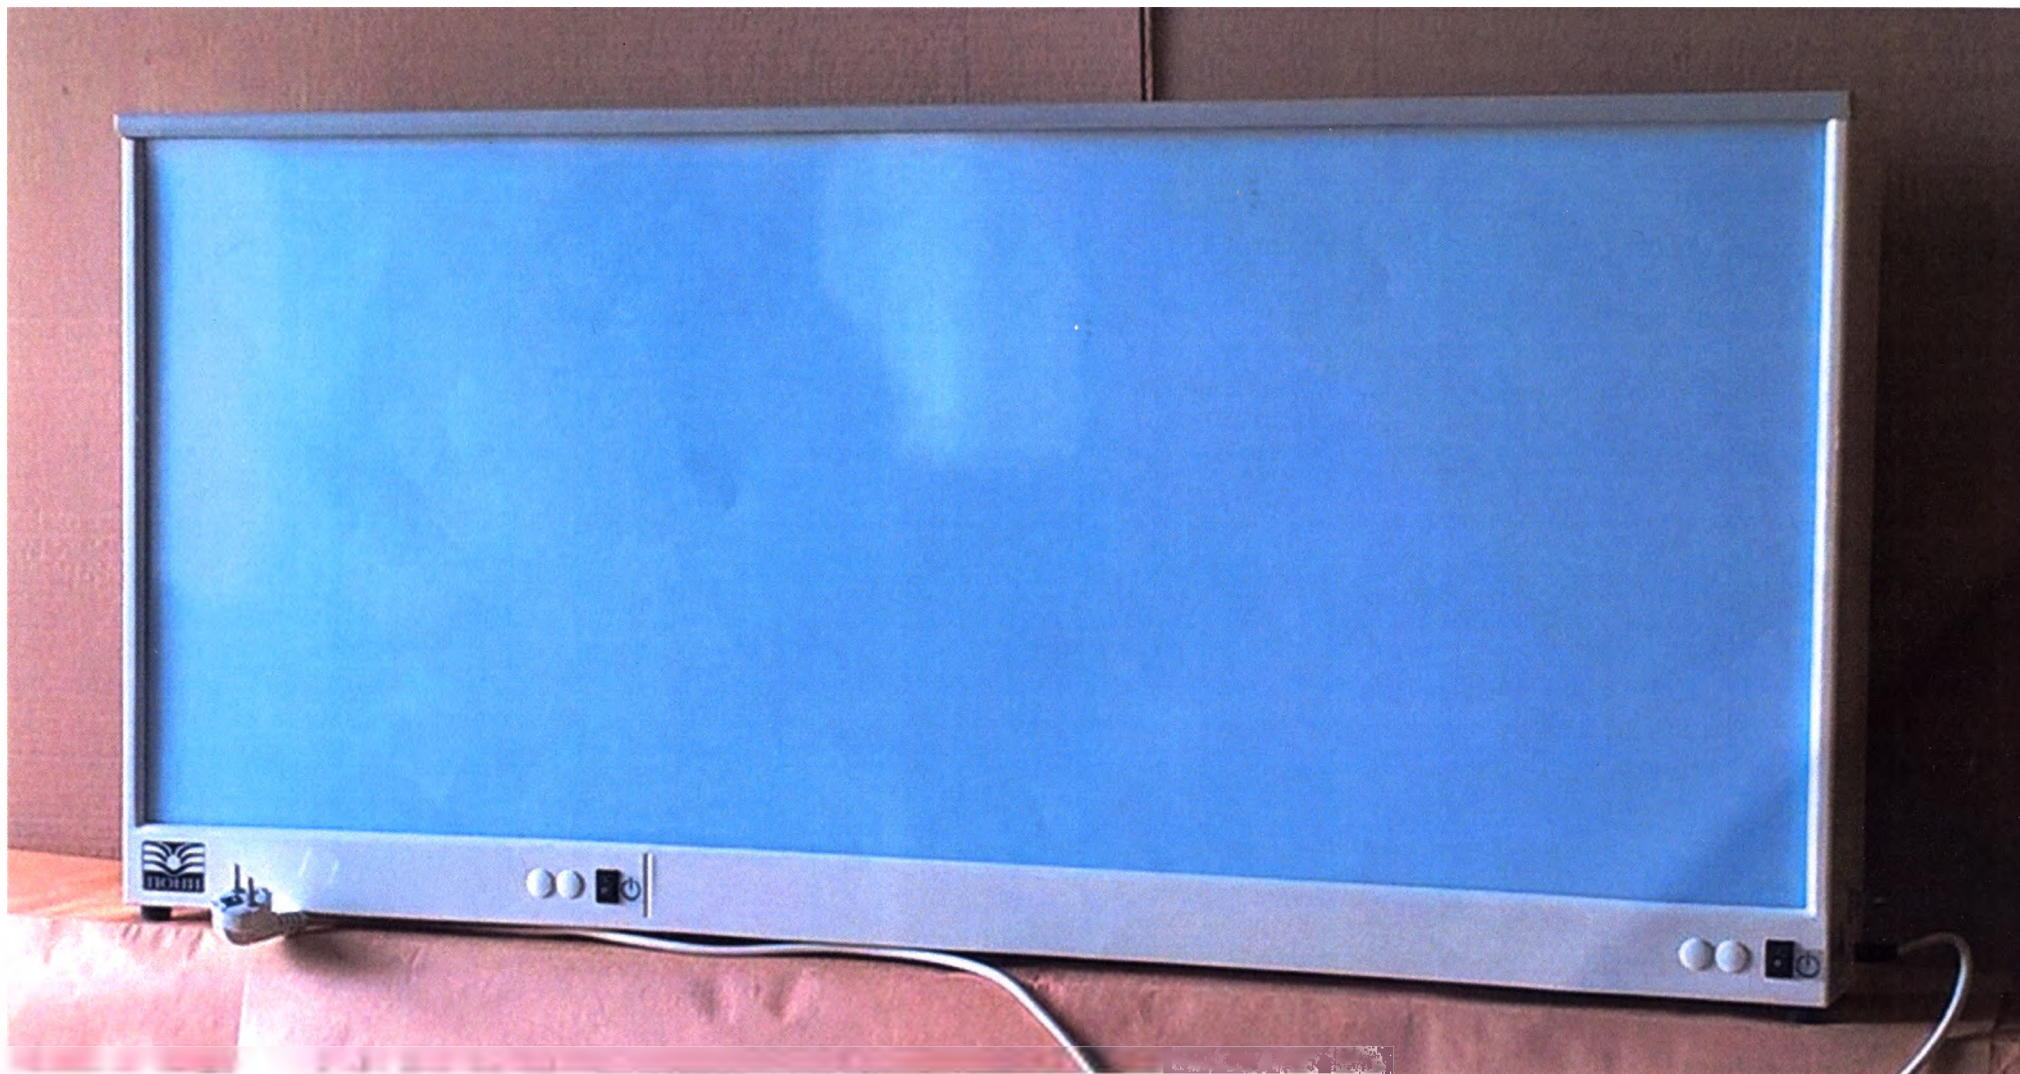

Негатостоп общего назначения HP3-01

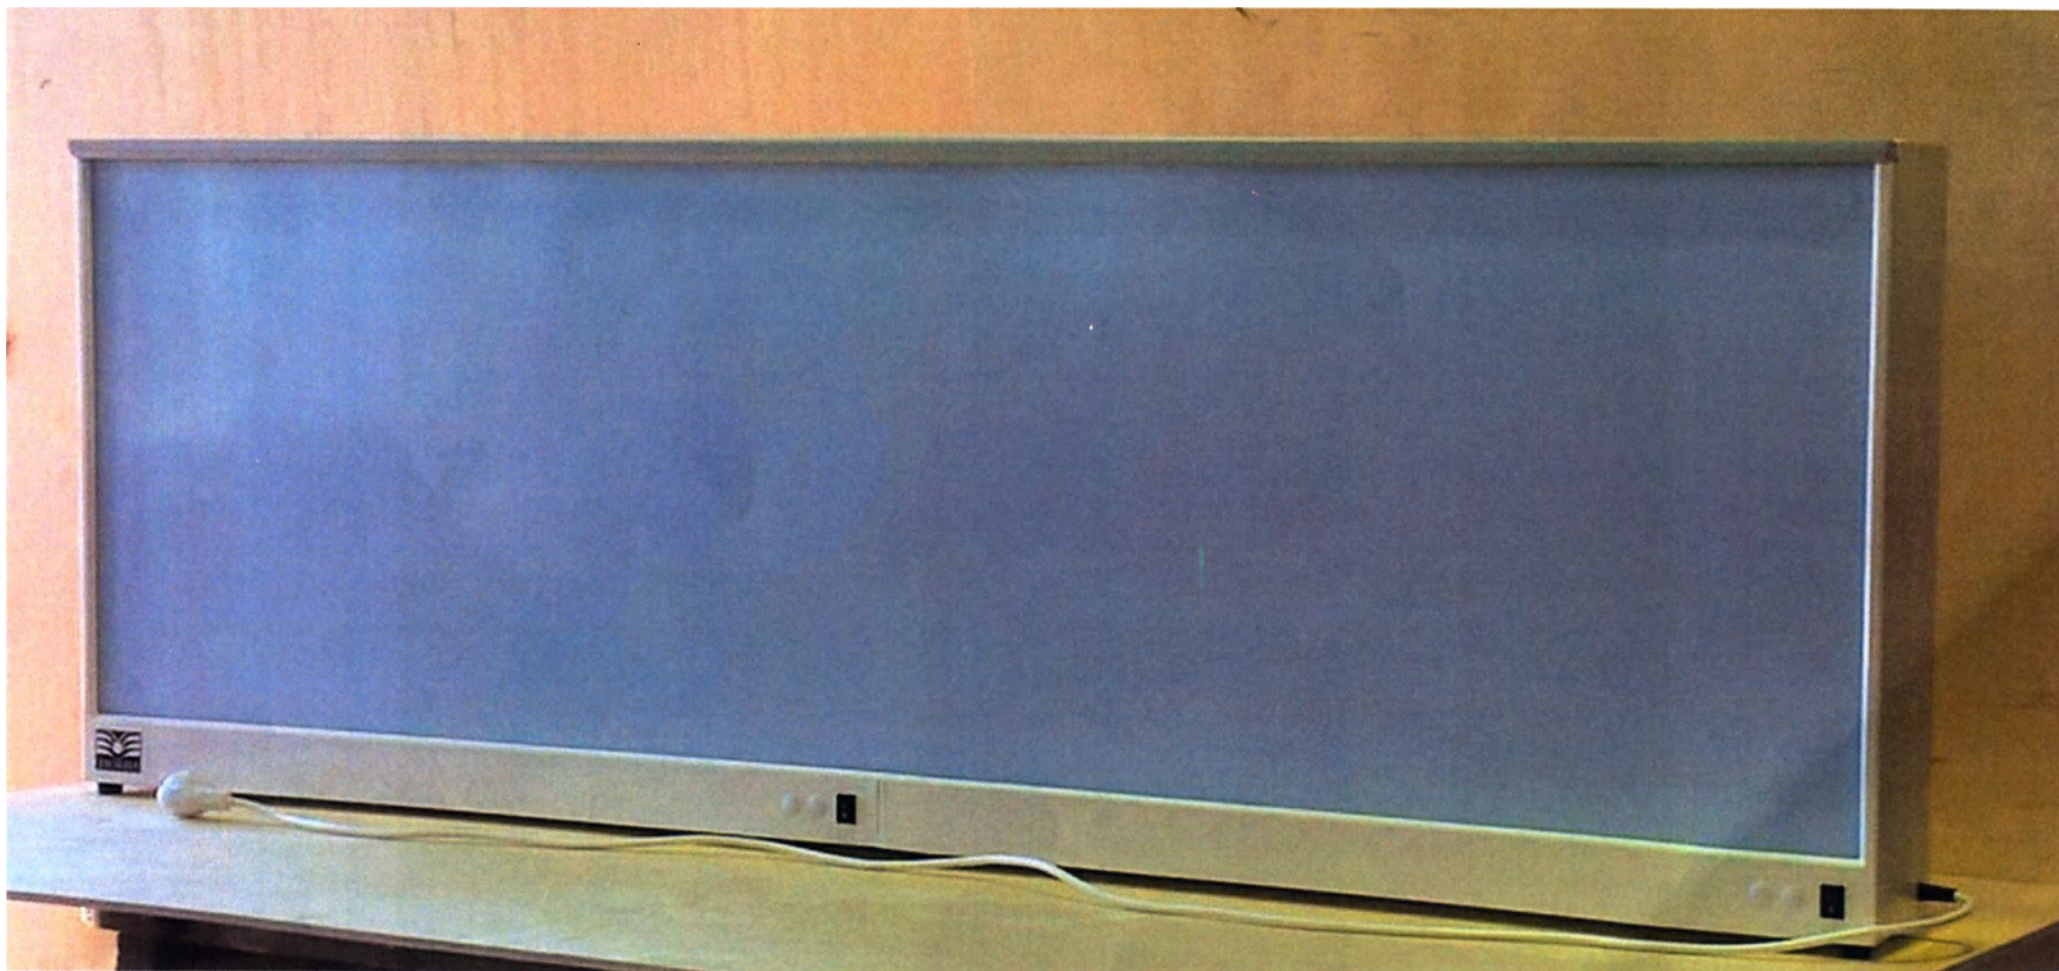

Негатостоп общего назначения НР4-01





HP1-02

HP2-02

Негатостопы общего назначения

Негатив общего назначения НРЗ-02

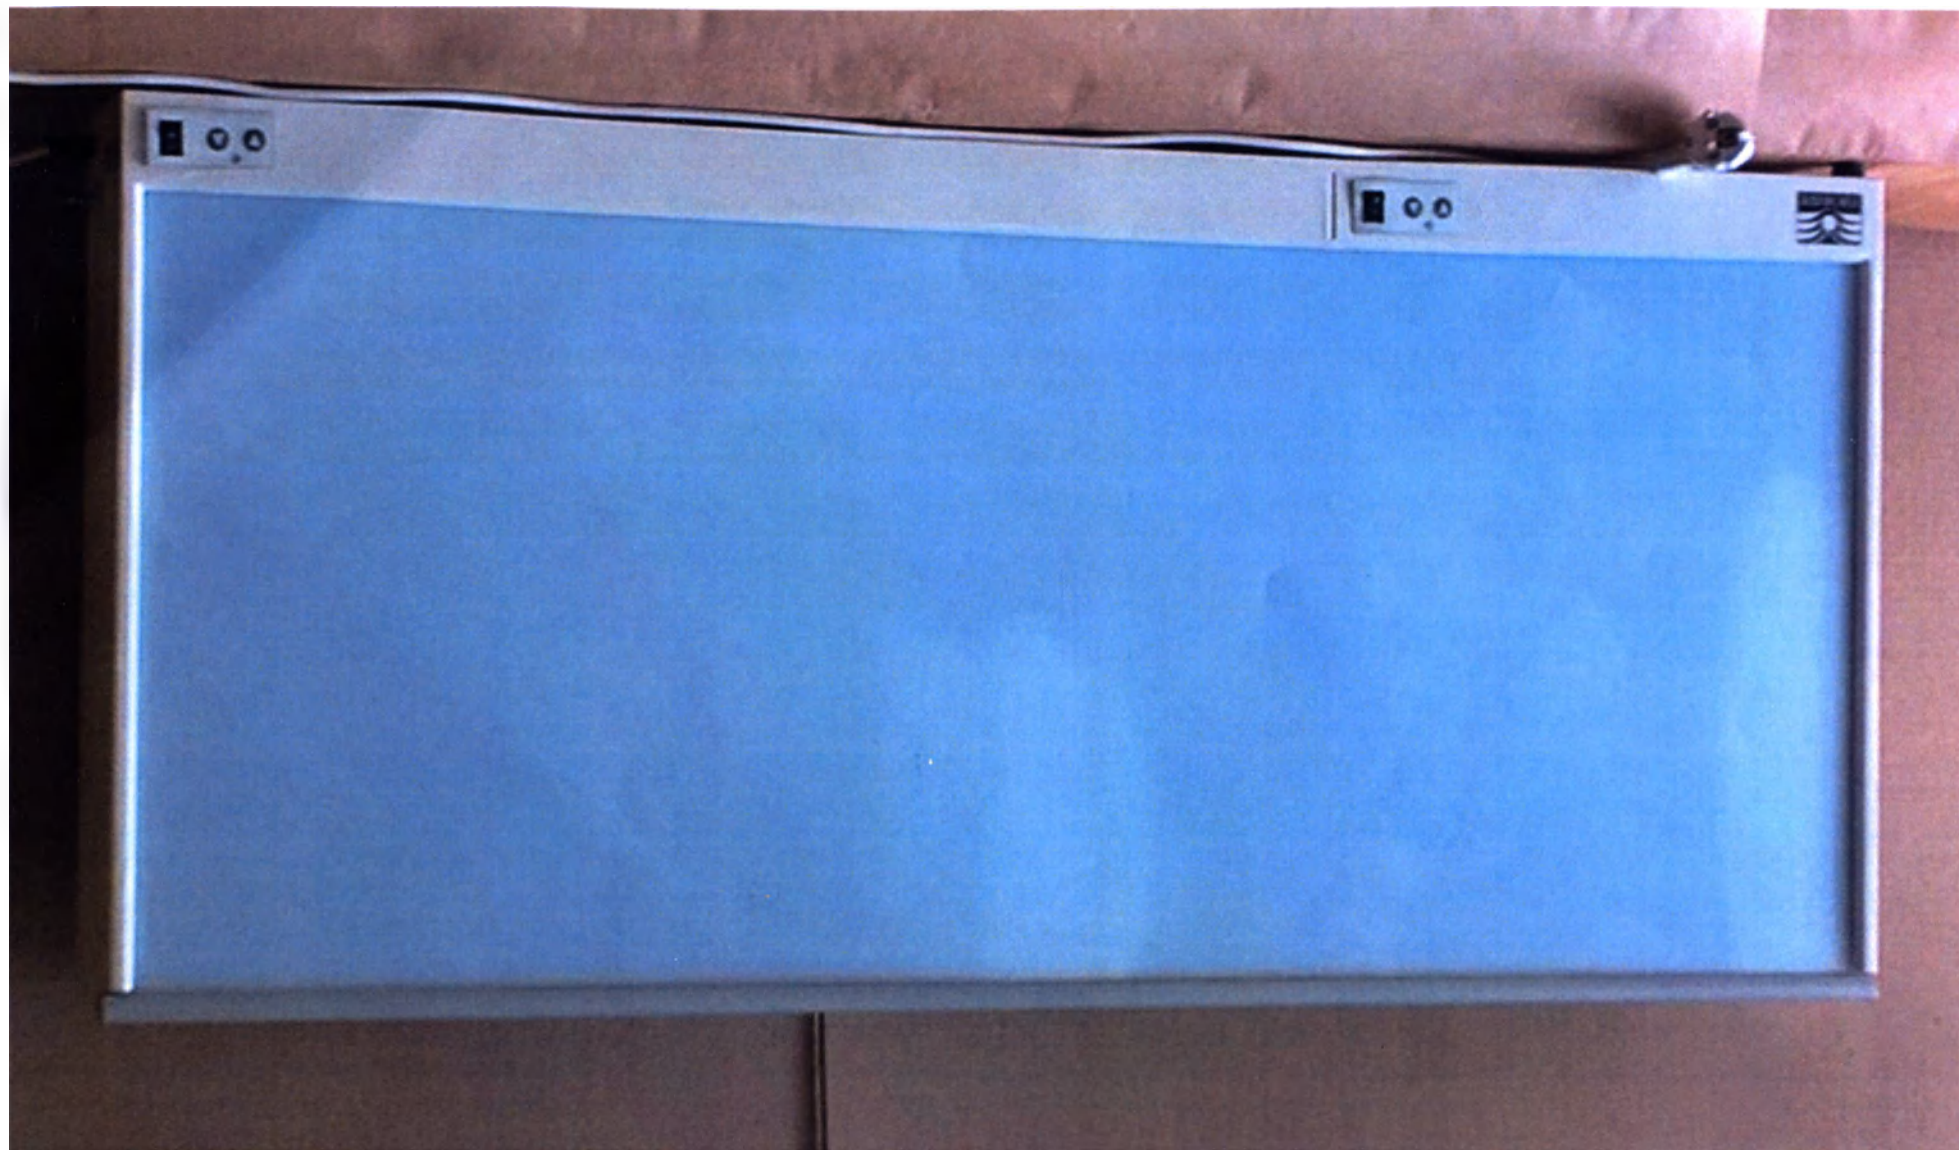

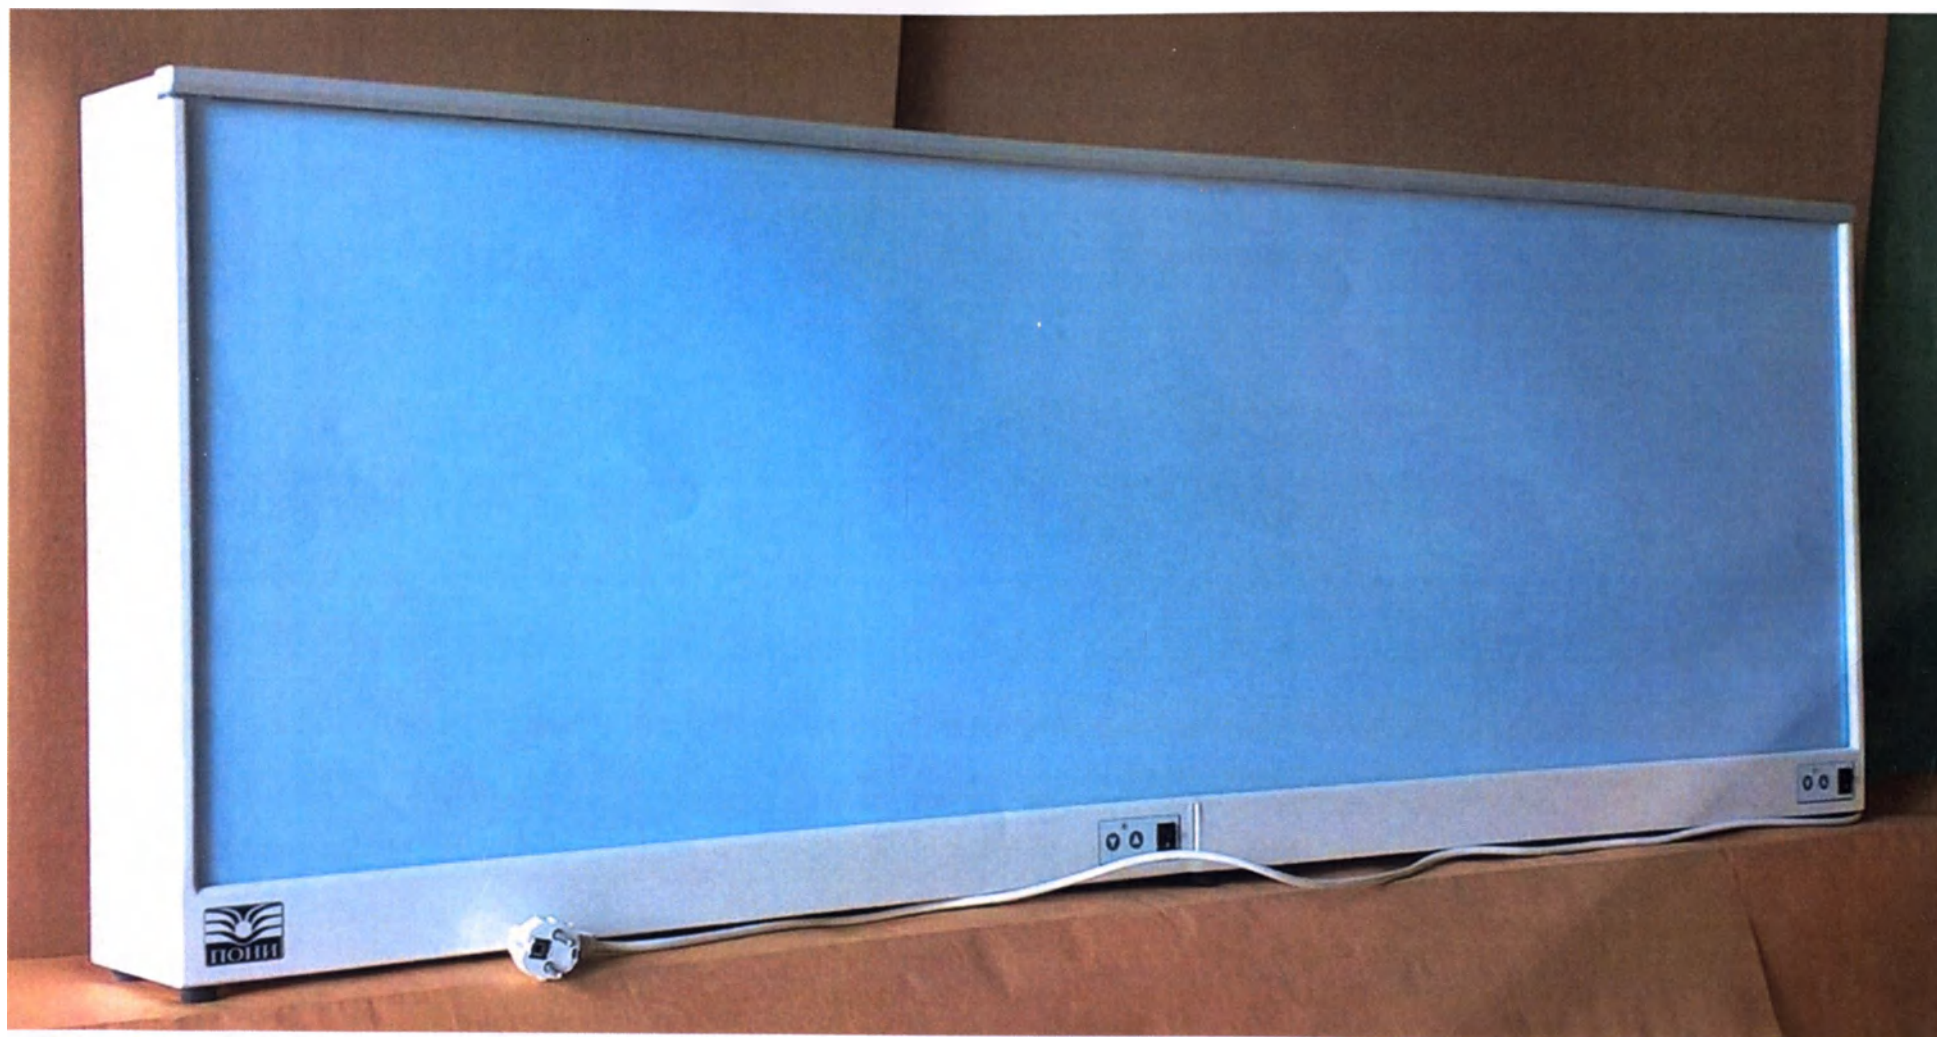

Негатостоп общего назначения HP4-02

Прошнуровано, пронумеровано

и скреплено печатью 7 листов.

Ген. Директор

ЗАО ЦИМИ

Карченков С.В.

