

Макет маркировки на медицинское изделие

**Калибраторы для обеспечения правильности количественного
определения антигена «е» вируса гепатита В
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i**

**«HBeAg Количественный Калибраторы
(Alinity i HBeAg Quantitative Calibrators)»**

Макет маркировки медицинского изделия для пользователей Российской Федерации

RU REF 09P1001

IVD



Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения антигена «е» вируса гепатита В иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i

«HBeAg Количественный Калибраторы (Alinity i HBeAg Quantitative Calibrators)».

В составе: Калибратор А (Alinity i HBeAg Quant CAL A) - 1 флакон х 3,0 мл; Калибратор В (Alinity i HBeAg Quant CAL B) - 1 флакон х 3,0 мл; Калибратор С (Alinity i HBeAg Quant CAL C) - 1 флакон х 3,0 мл; Калибратор D (Alinity i HBeAg Quant CAL D) - 1 флакон х 3,0 мл; Калибратор Е (Alinity i HBeAg Quant CAL E) - 1 флакон х 3,0 мл; Калибратор F (Alinity i HBeAg Quant CAL F) - 1 флакон х 3,0 мл; Инструкция по применению / Производитель: Abbott GmbH & Co. KG (Эбботт ГмбХ и Ко. КГ), Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany / Место производства: Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany / Страна происхождения: Германия / РУ № ____/____ от ____ г. / Инструкция по применению на русском языке:

www.abbottiagnostics.com/IFU / Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1
Тел.: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Маркировка медицинского изделия HBeAg Количественный Калибраторы (Alinity i HBeAg Quantitative Calibrators)

G70279R03

LOT	EXP.	REF	CONC	PEI U/mL	U/mL	1 x	3.0 mL	0.00	0.70	1.50	10.00	150.00	200.00
CAL F	1 x	3.0 mL	0.00	0.70	1.50	10.00	150.00	200.00					
CAL E	1 x	3.0 mL	0.00	0.70	1.50	10.00	150.00	200.00					
CAL D	1 x	3.0 mL	0.00	0.70	1.50	10.00	150.00	200.00					
CAL C	1 x	3.0 mL	0.00	0.70	1.50	10.00	150.00	200.00					
CAL B	1 x	3.0 mL	0.00	0.70	1.50	10.00	150.00	200.00					
CAL A	1 x	3.0 mL	0.00	0.70	1.50	10.00	150.00	200.00					

CONTAINS AZOB

Alinity i HBeAg Quantitative Calibrators
Abbott

Abbott GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580


PRODUCT OF GERMANY

CE 0123


HBeAg Quant
Cals

Маркировка компонентов медицинского изделия


- Калибратор А (Alinity i HBeAg Quant CAL A)

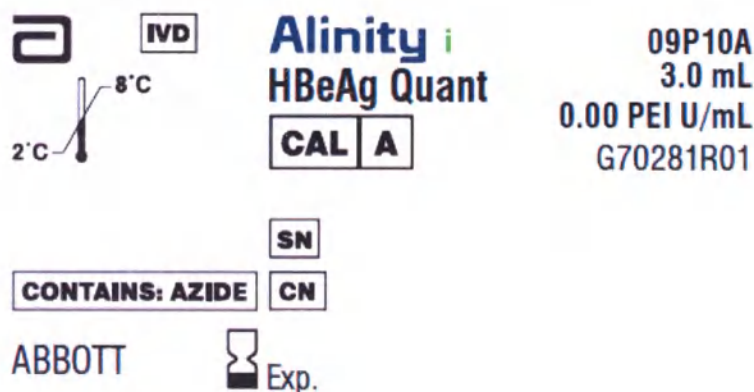


- Калибратор В (Alinity i HBeAg Quant CAL B)

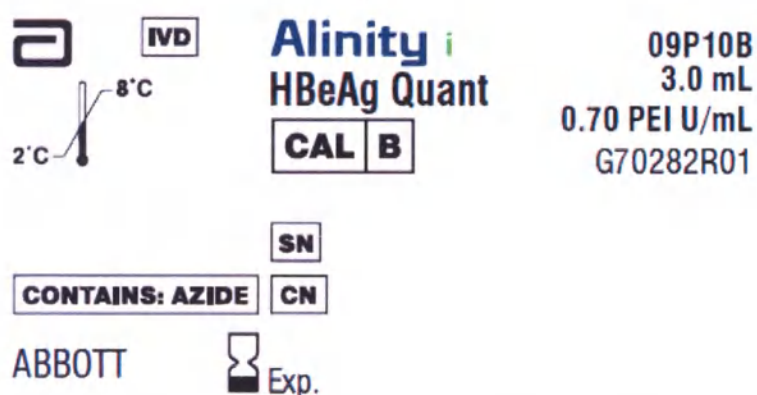

- Калибратор С (Alinity i HBeAg Quant CAL C)

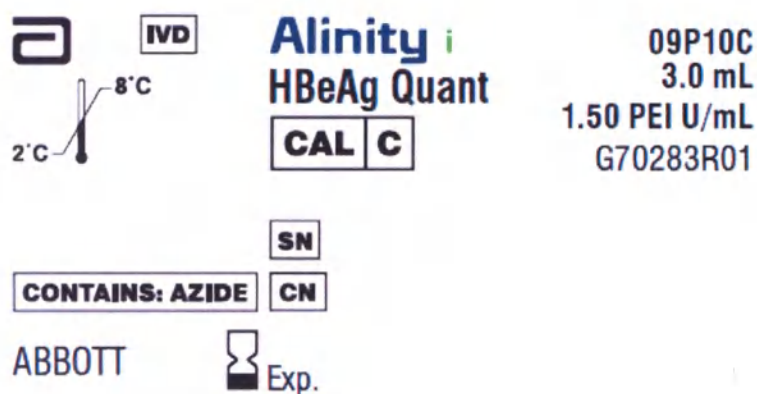

- Калибратор D (Alinity i HBeAg Quant CAL D)



Alinity i
HBeAg Quant

CAL D

09P10D
3.0 mL
10.00 PEI U/mL
G70284R01

SN


CONTAINS: AZIDE

CN

ABBOTT



- Калибратор E (Alinity i HBeAg Quant CAL E)



Alinity i
HBeAg Quant

CAL E

09P10E
3.0 mL
150.00 PEI U/mL
G70285R01

SN


CONTAINS: AZIDE

CN

ABBOTT



- Калибратор F (Alinity i HBeAg Quant CAL F)



Alinity i
HBeAg Quant

CAL F

09P10F
3.0 mL
700.00 PEI U/mL
G70286R01

SN

CONTAINS: AZIDE

CN

ABBOTT



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 листов




**Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия**

**Калибраторы для обеспечения правильности количественного
определения антигена «е» вируса гепатита В
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i
«HBeAg Количественный Калибраторы
(Alinity i HBeAg Quantitative Calibrators)»**





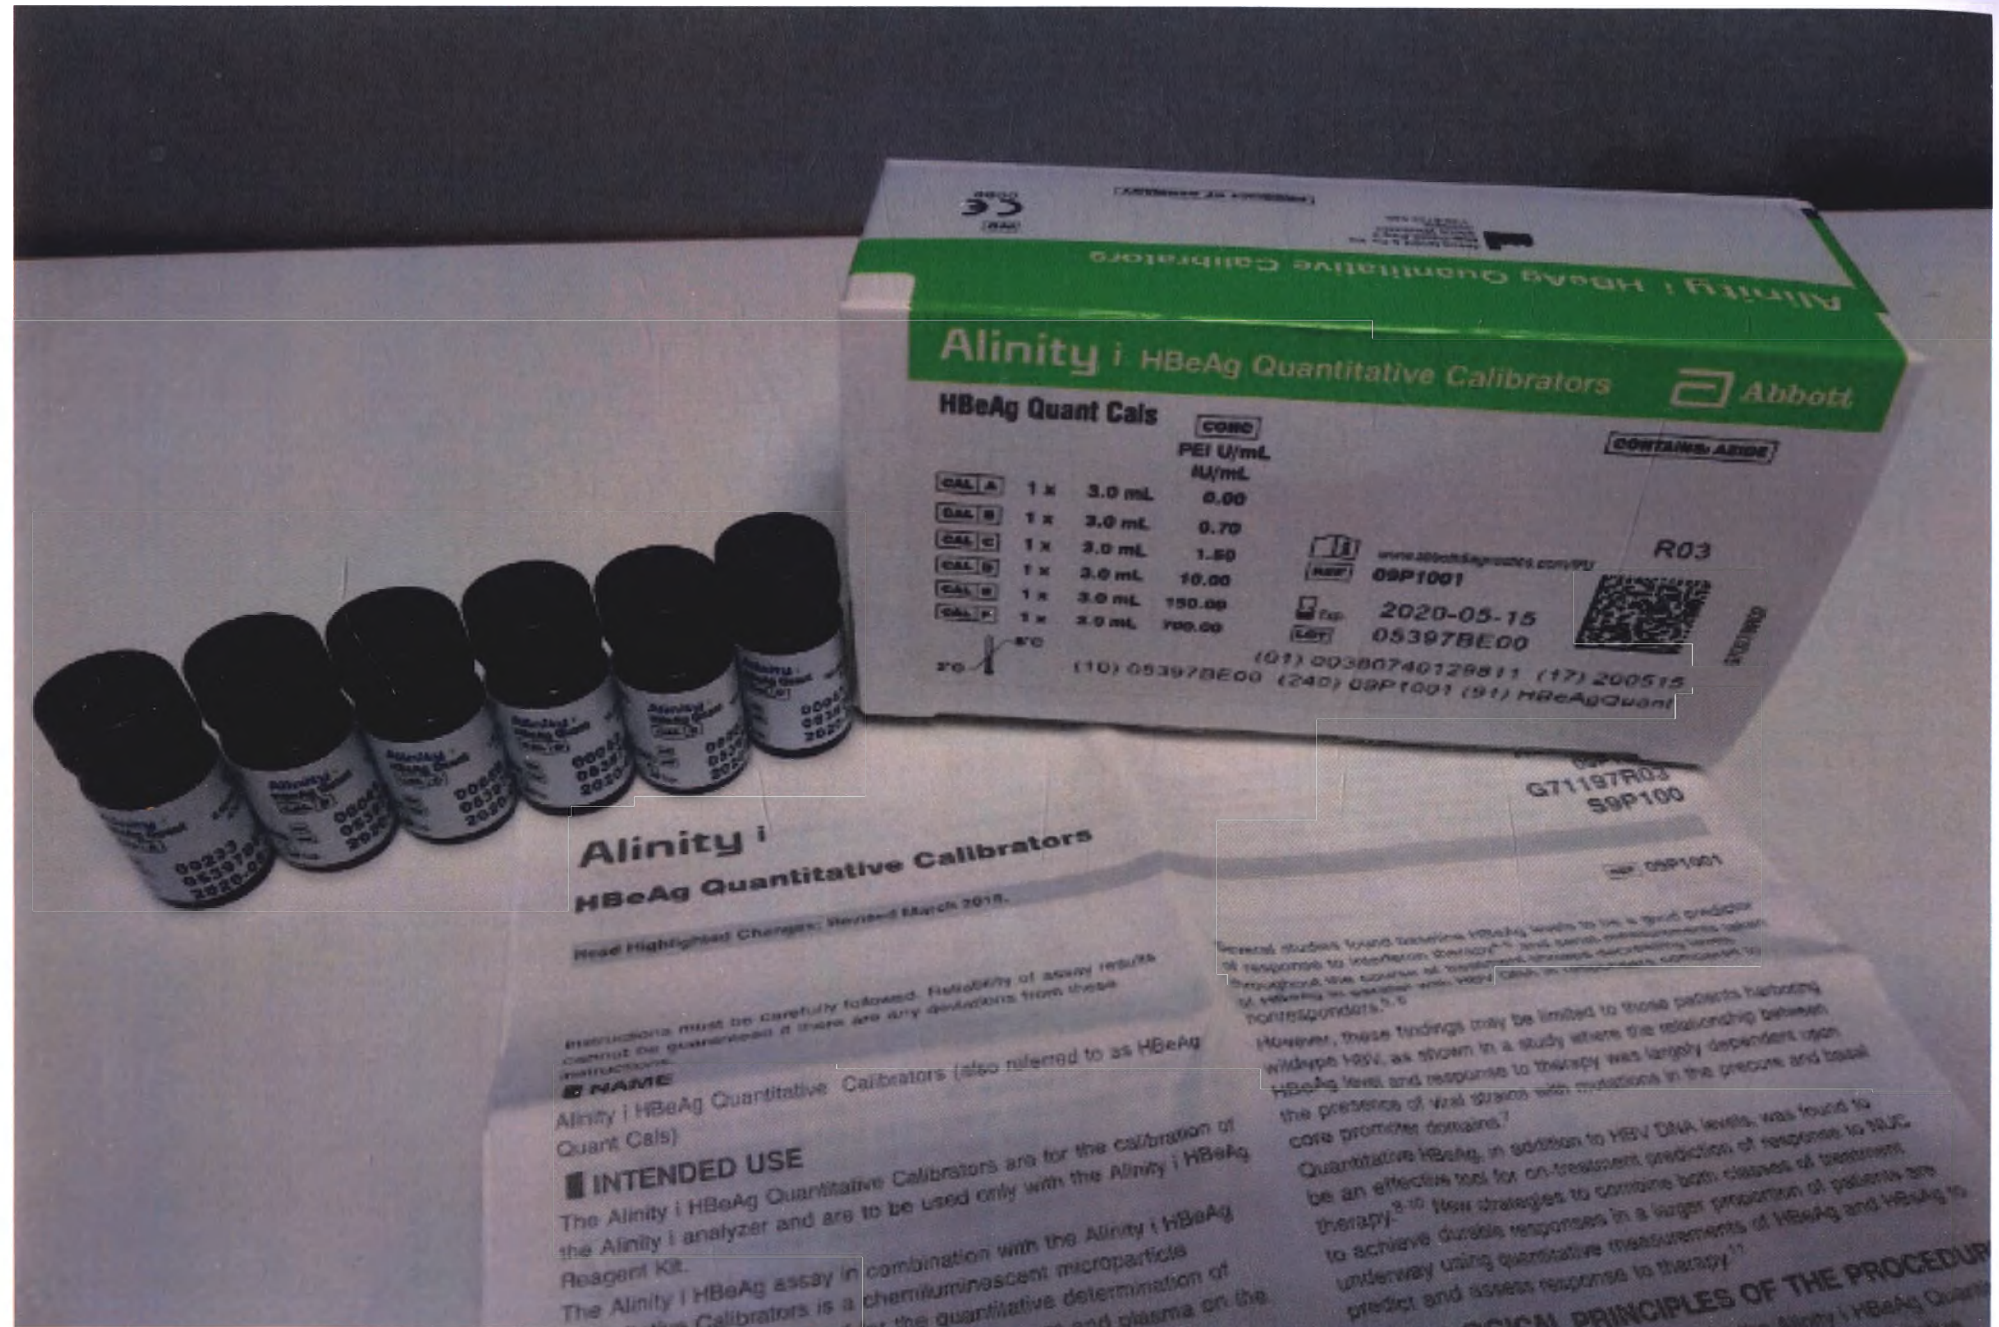



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5 листов

