



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“Билирубин общий”
 вариант комплектации 1, серия 3

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 2020 г.

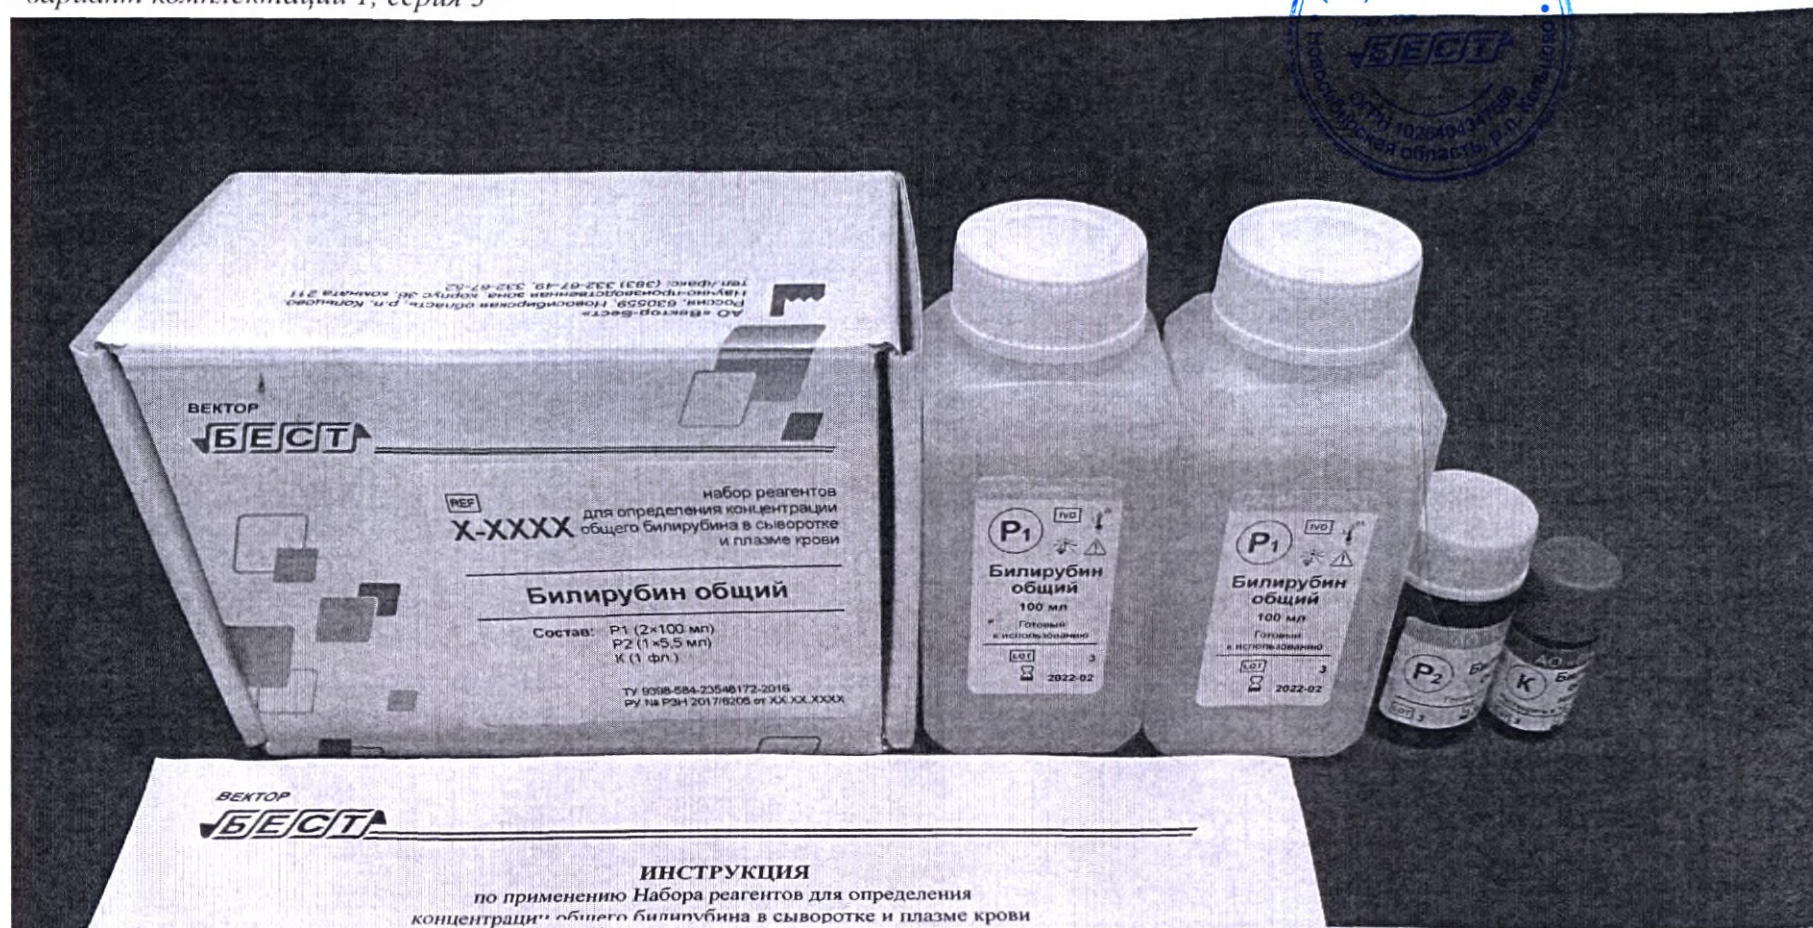


ВЕКТОР BEST			
ИНСТРУКЦИЯ по применению Набора реагентов для определения концентрации общего билирубина в сыворотке и плазме крови			
1. НАЗНАЧЕНИЕ 1.1. Набор реагентов для определения концентрации билирубина в сыворотке и плазме крови «Билирубин по тексту» — набор предназначен для количественного определения общего билирубина в сыворотке человека методом Иендрашика-Грофа. 1.2. Набор выпускается в двух вариантах ко			
Вариант комплектации	Количество определяемый	Расход P1 на одно определение, мл	Фасовка
200		0,5	2×100 мл (P1); 1×5,5 мл (P2); 1 фла. (K);
500		0,5	2×250 мл (P1); 1×14 мл (P2);
Россия, 630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, к. 211, АО «Вектор-Бест» Для писем: 630117, г. Новосибирск, а/я 492 Приемная: тел. (383)-227-60-30, факс (383)-332-94-44 www.vector-best.ru vbobtk@vector-best.ru			
ПАСПОРТ № 11-20 Билирубин общий Набор реагентов для определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови Номер серии 3 Хранить при температуре 2-8°C Дата изготовления 2020-02 Дата выдачи паспорта 2020-02-19 Срок годности наборов до 2022-02 Транспортировать при температуре 2-8°C. Допускается транспортирование при температуре до 25°C не более 10 суток.			
Состав		Внешний вид	Рез-ты

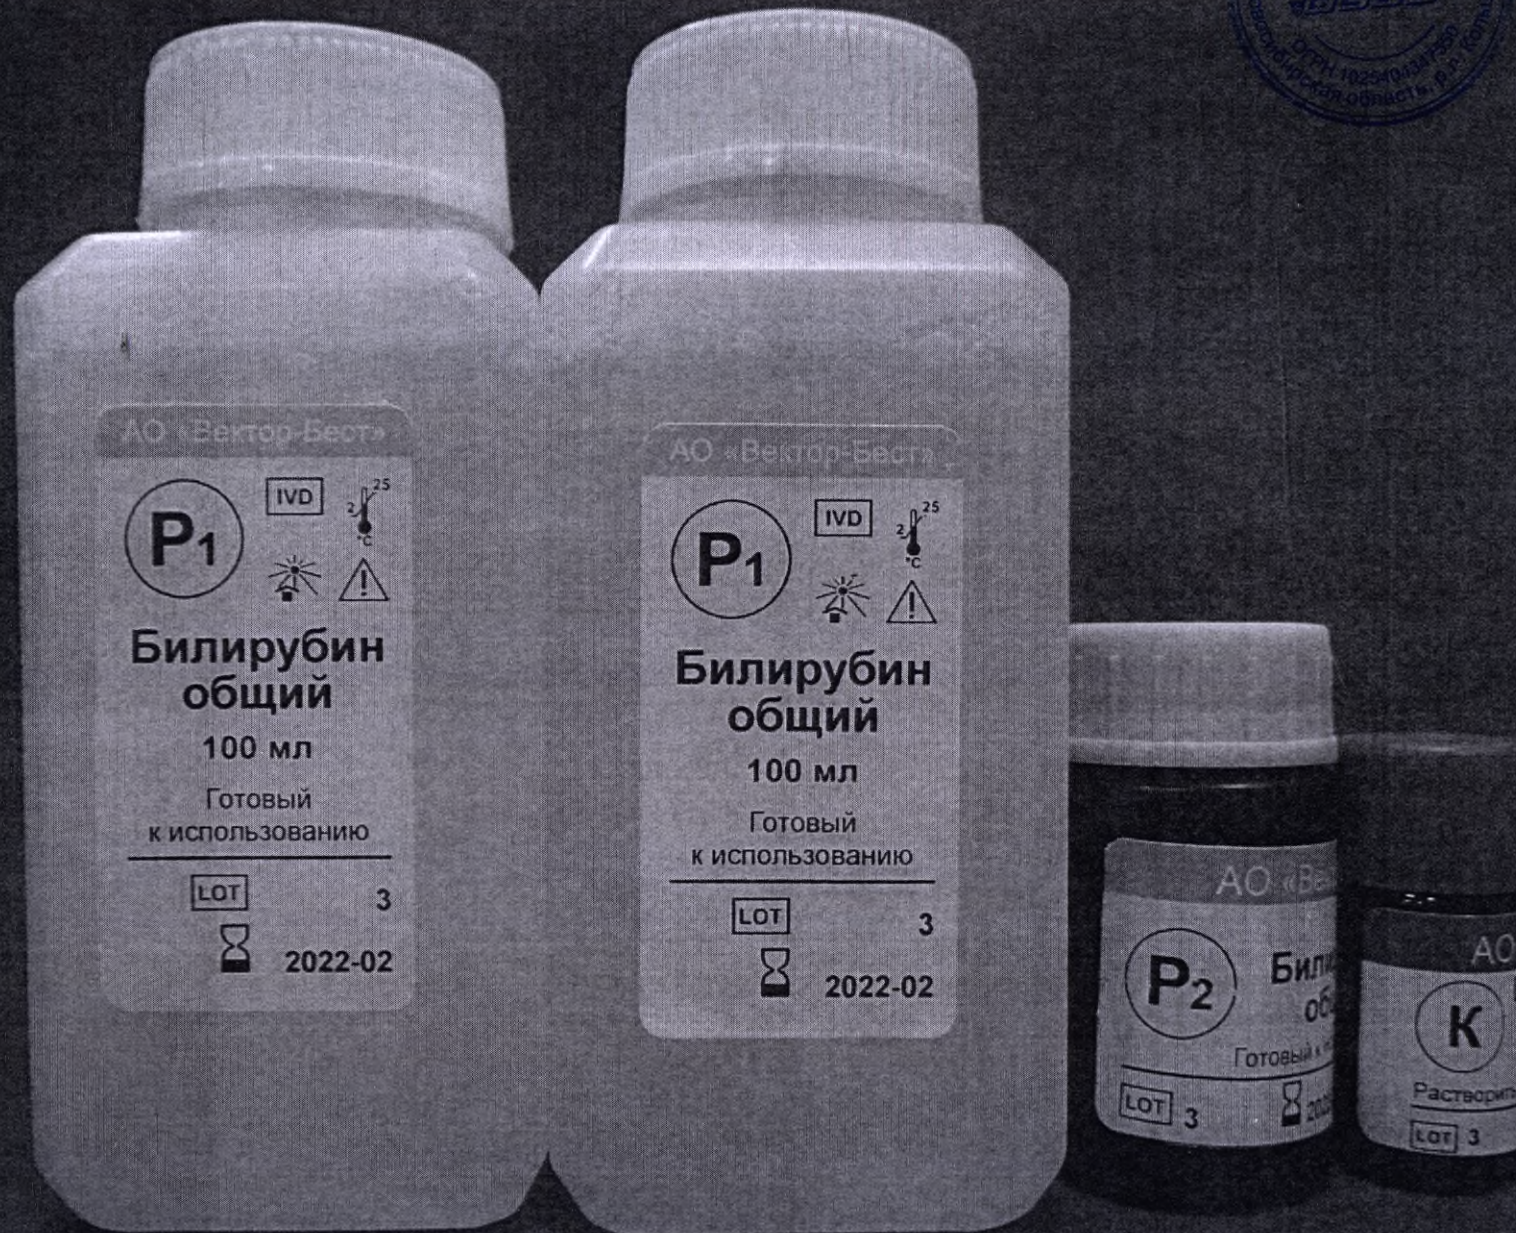


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Билирубин общий” №2
вариант комплектации 1, серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2020 г.

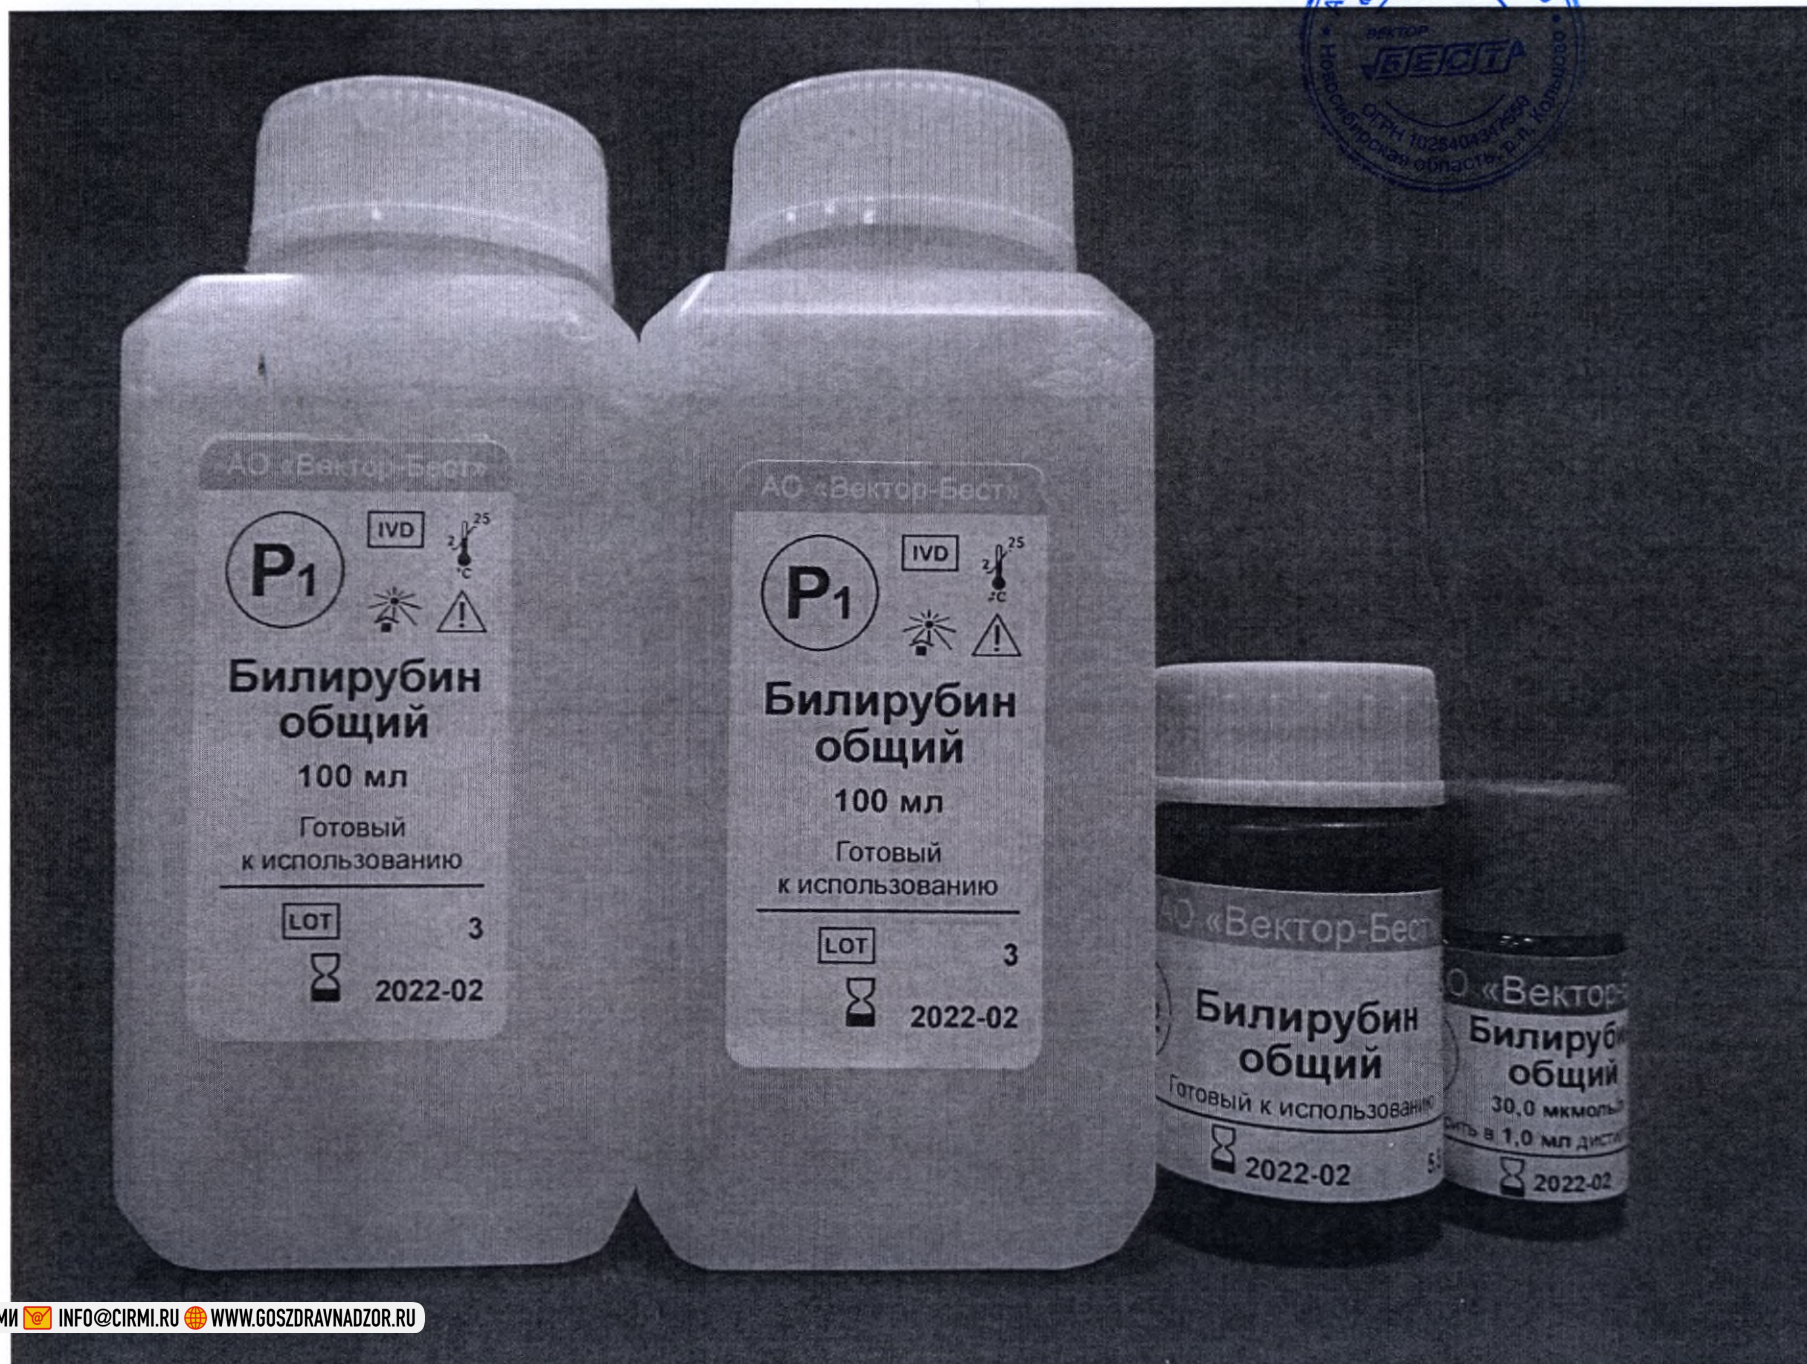

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"Билирубин общий" №3
вариант комплектации 1, серия 3

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2020 г.

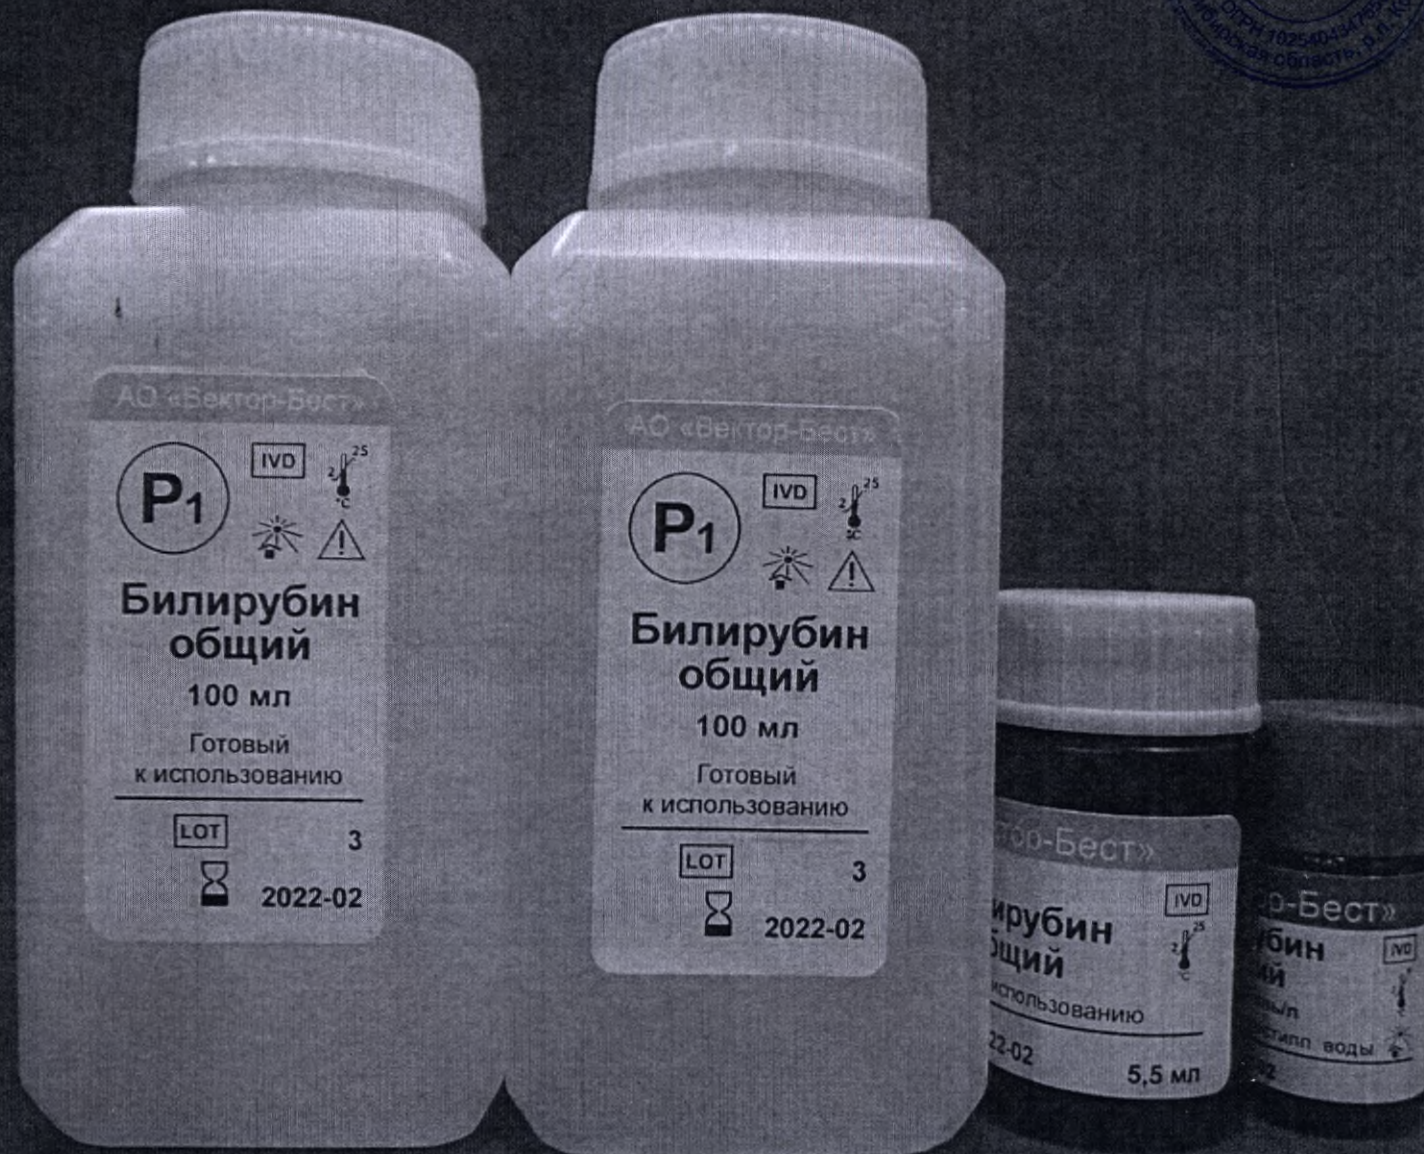



ВЕКТОР
БЕСТ

REF

X-XXXX

набор реагентов
для определения концентрации
общего билирубина в сыворотке
и плазме крови

Билирубин общий

Состав: P1 (2×100 мл)
P2 (1×5,5 мл)
K (1 фл.)

ТУ 9398-584-23548172-2016
ПУ № РЗН 2017/6365 от XX.XX.XXXX

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Билирубин общий" №2
вариант комплектации 1, серия 3

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2020 г.



REF

X-XXXX

LOT

3




2020-02



2022-02

Билирубин общий



IVD





XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Для профессионального применения

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“Билирубин общий”
 вариант комплектации 2, серия 4

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест”

М.Д. Хусаинов
 2020 г.

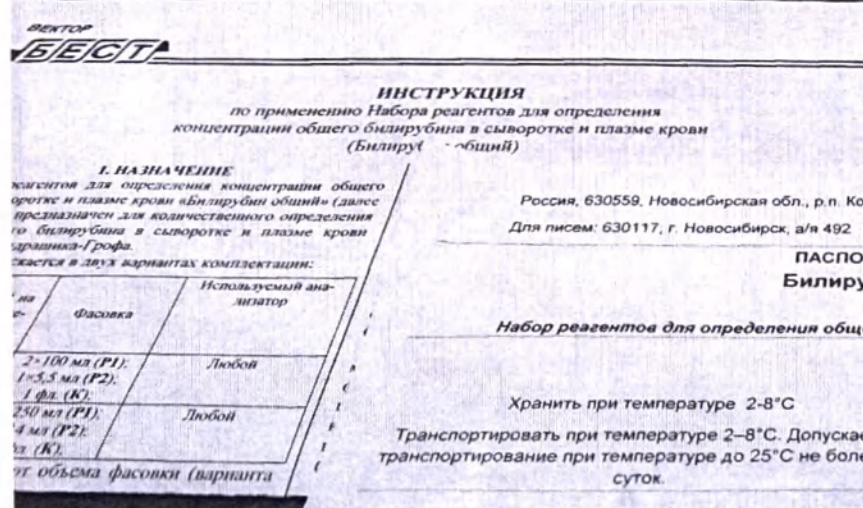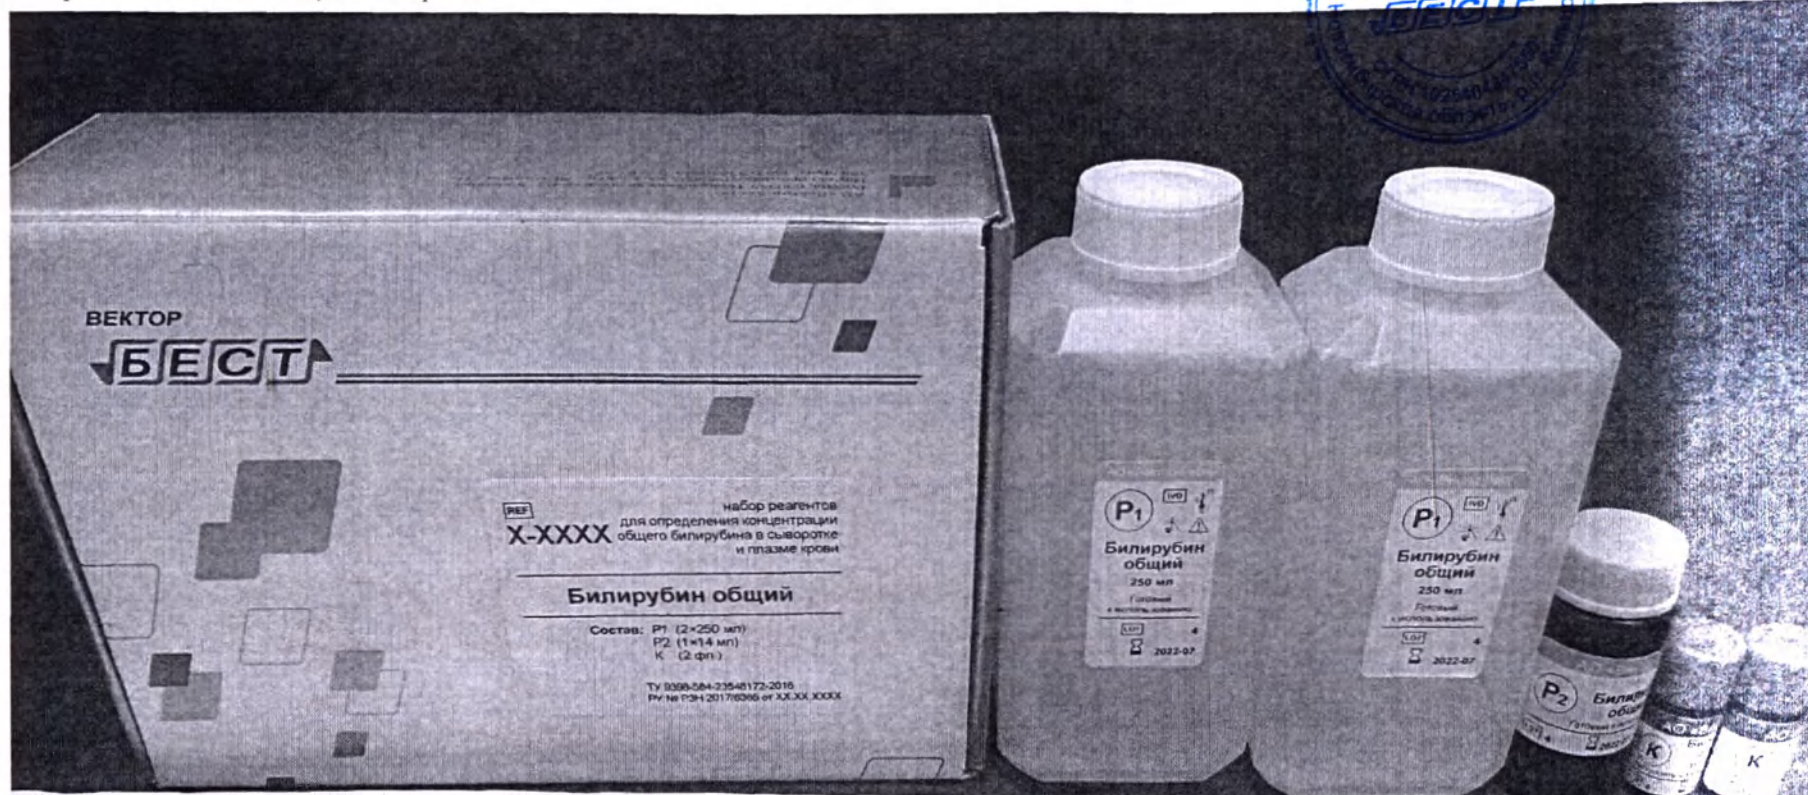

Россия, 630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, к. 211, АО «Вектор-Бест»
 Для писем: 630117, г. Новосибирск, а/я 492
 Приемная: тел. (383)-227-60-30, факс (383)-332-94-44
www.vector-best.ru
vbobtk@vector-best.ru

ПАСПОРТ № 22-20
Билирубин общий

X-XXXX

Набор реагентов для определения общего билирубина в сыворотке и плазме крови

Номер серии 4

Хранить при температуре 2-8°C

Дата изготовления 2020-07

Транспортировать при температуре 2-8°C. Допускается транспортирование при температуре до 25°C не более 10 суток.

Дата выдачи паспорта 2020-07-19

Срок годности наборов до 2022-07


Состав

Внешний вид

Рез-ты контроля

Прозрачная бесцветная жидкость (возможно выпадение осадка белого цвета)

Соответствует

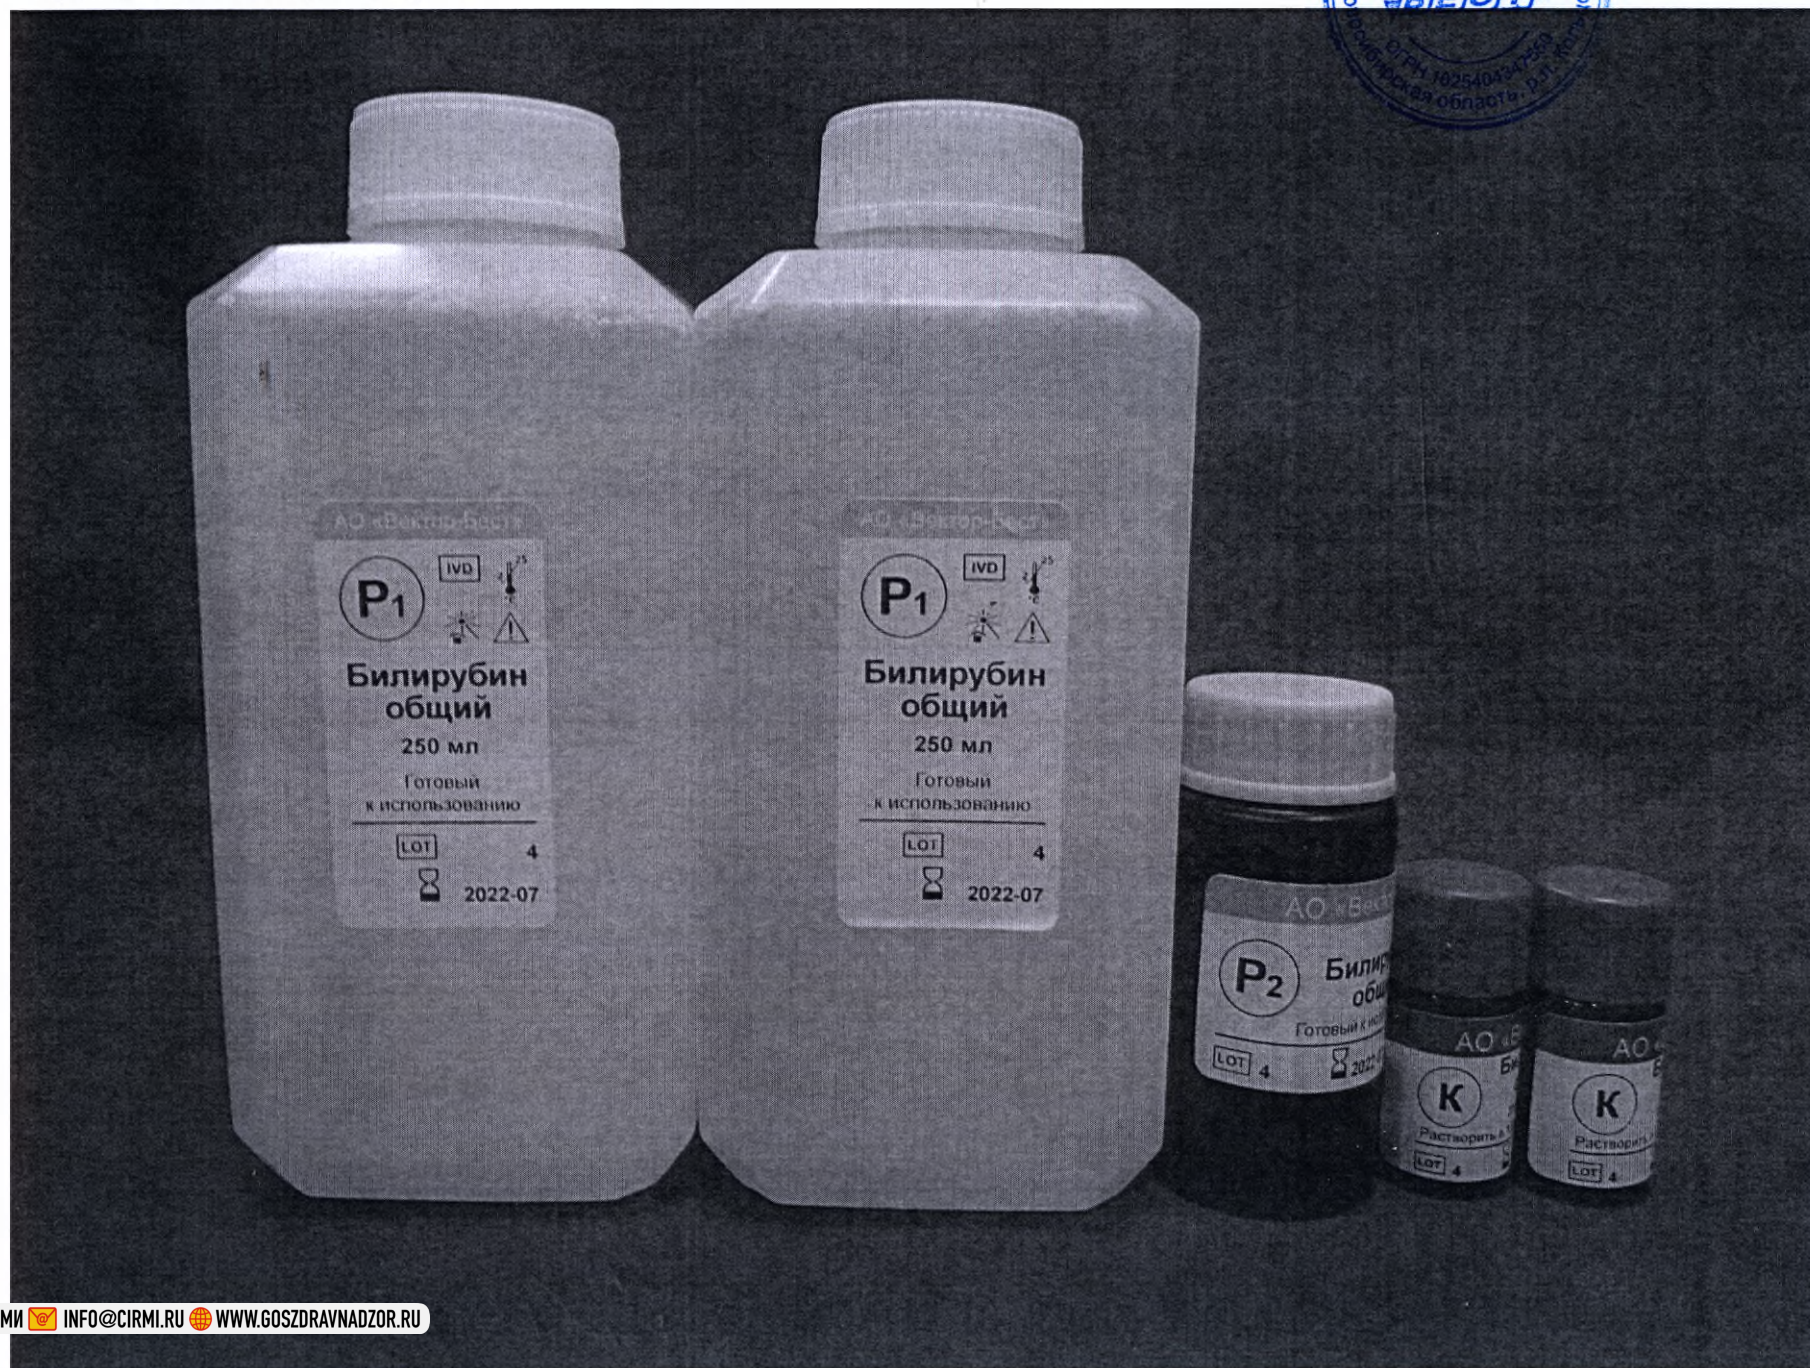


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Билирубин общий” №2
вариант комплектации 2, серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” “12” 11/2020 г. М.Д. Хусаинов



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Билирубин общий» №3
вариант комплектации 2, серия 4



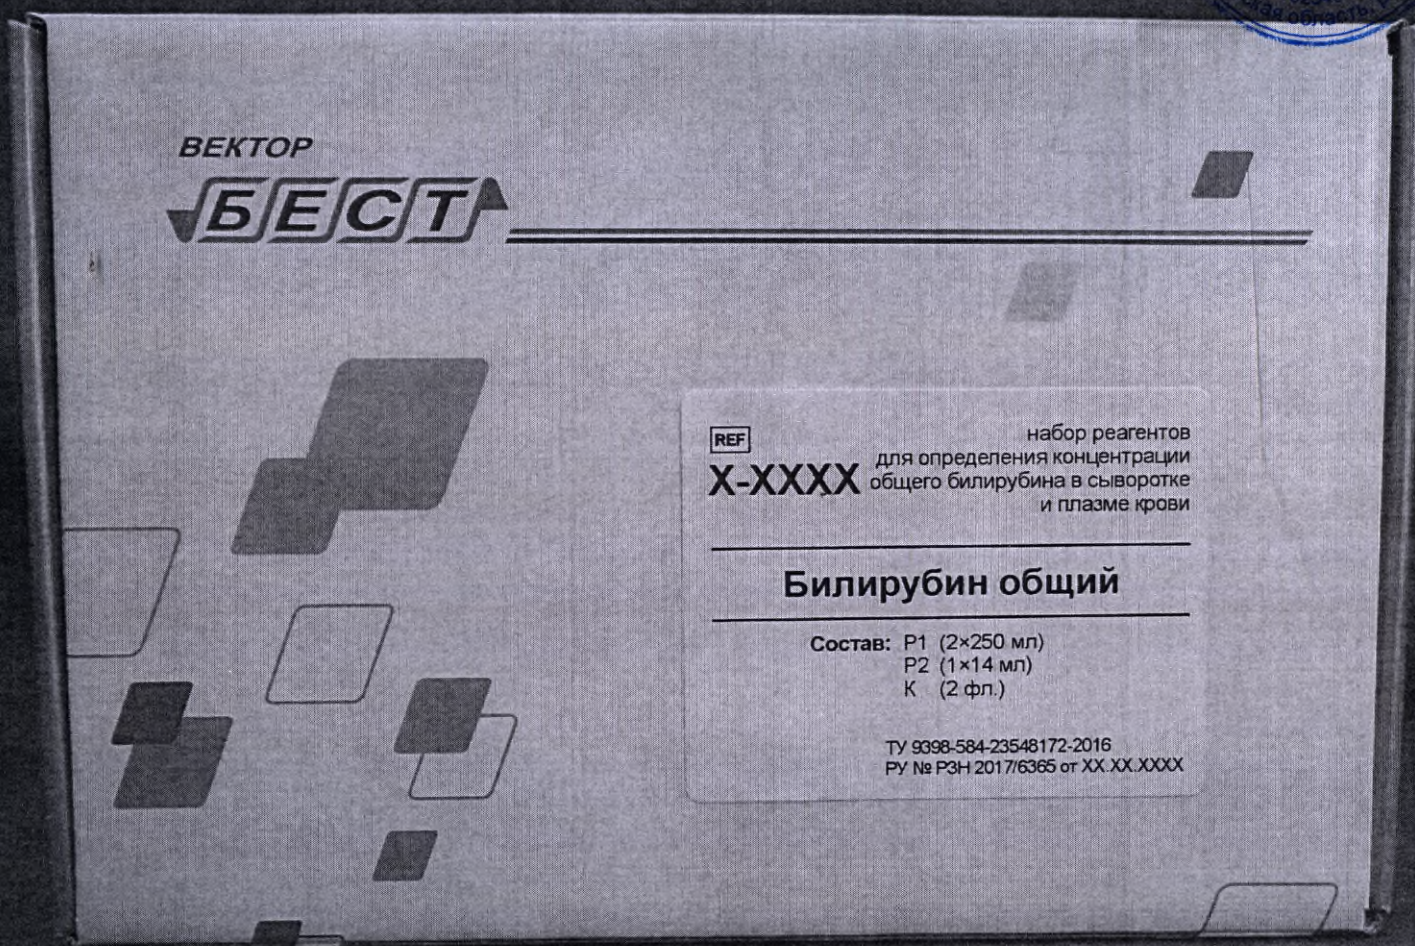

ВЕКТОР

БЕСТ

REF

X-XXXX

набор реагентов
для определения концентрации
общего билирубина в сыворотке
и плазме крови

Билирубин общий

Состав: P1 (2×250 мл)
P2 (1×14 мл)
K (2 фл.)

ТУ 9398-584-23548172-2016
ПУ № РЗН 2017/6365 от XX.XX.XXXX

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Билирубин общий” №2
вариант комплектации 2, серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“12” 2020 г.

