



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“Калибратор гликогемоглобин”
 серия 5

Генеральный директор АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
 2020 г.



ИНСТРУКЦИЯ по применению набора калибраторов гликозилированного гемоглобина A _{1c} (Калибратор гликогемоглобин)	
1. НАЗНАЧЕНИЕ Набор калибраторов гликозилированного гемоглобина (далее – калибраторы) предназначен для проведения калибровки лабораторных методов определения гликогемоглобина набором реагентов АО «Вектор-Бест», рассчитан на приготовление флакона. Калибратор	Россия, 630559, Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, к. 211, АО «Вектор-Бест» Для писем: 630117, г. Новосибирск, а/я 492 Приемная: тел. (383)-227-60-30, факс (383)-332-94-44 www.vector-best.ru vbobitk@vector-best.ru
ПАСПОРТ № 101-19 Калибратор гликогемоглобин	X-XXXX
Набор калибраторов гликозилированного гемоглобина A_{1c}	Номер серии 5
Хранить при температуре 2-8°C	Дата изготовления 2019-12
Транспортировать при температуре 2-8°C. Допускается транспортирование при температуре до 25°C не более 10 суток.	Дата выдачи паспорта 2019-12-08
Срок годности наборов до 2021-08	Срок годности наборов до 2021-08
Состав	Внешний вид

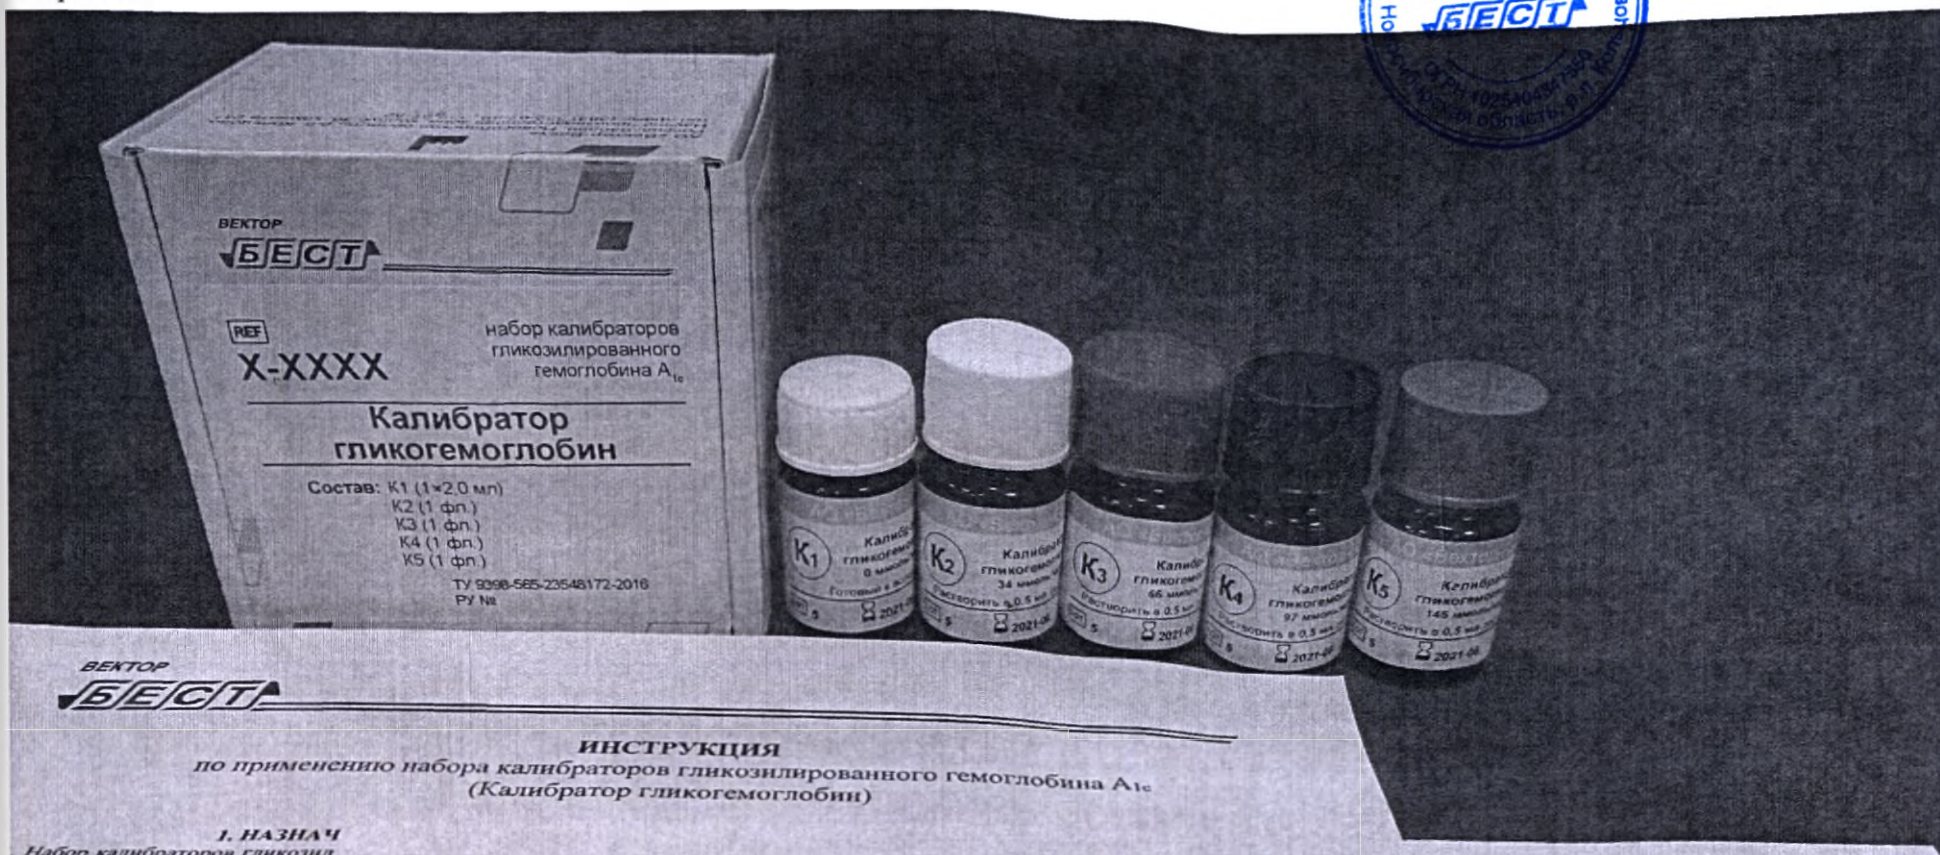

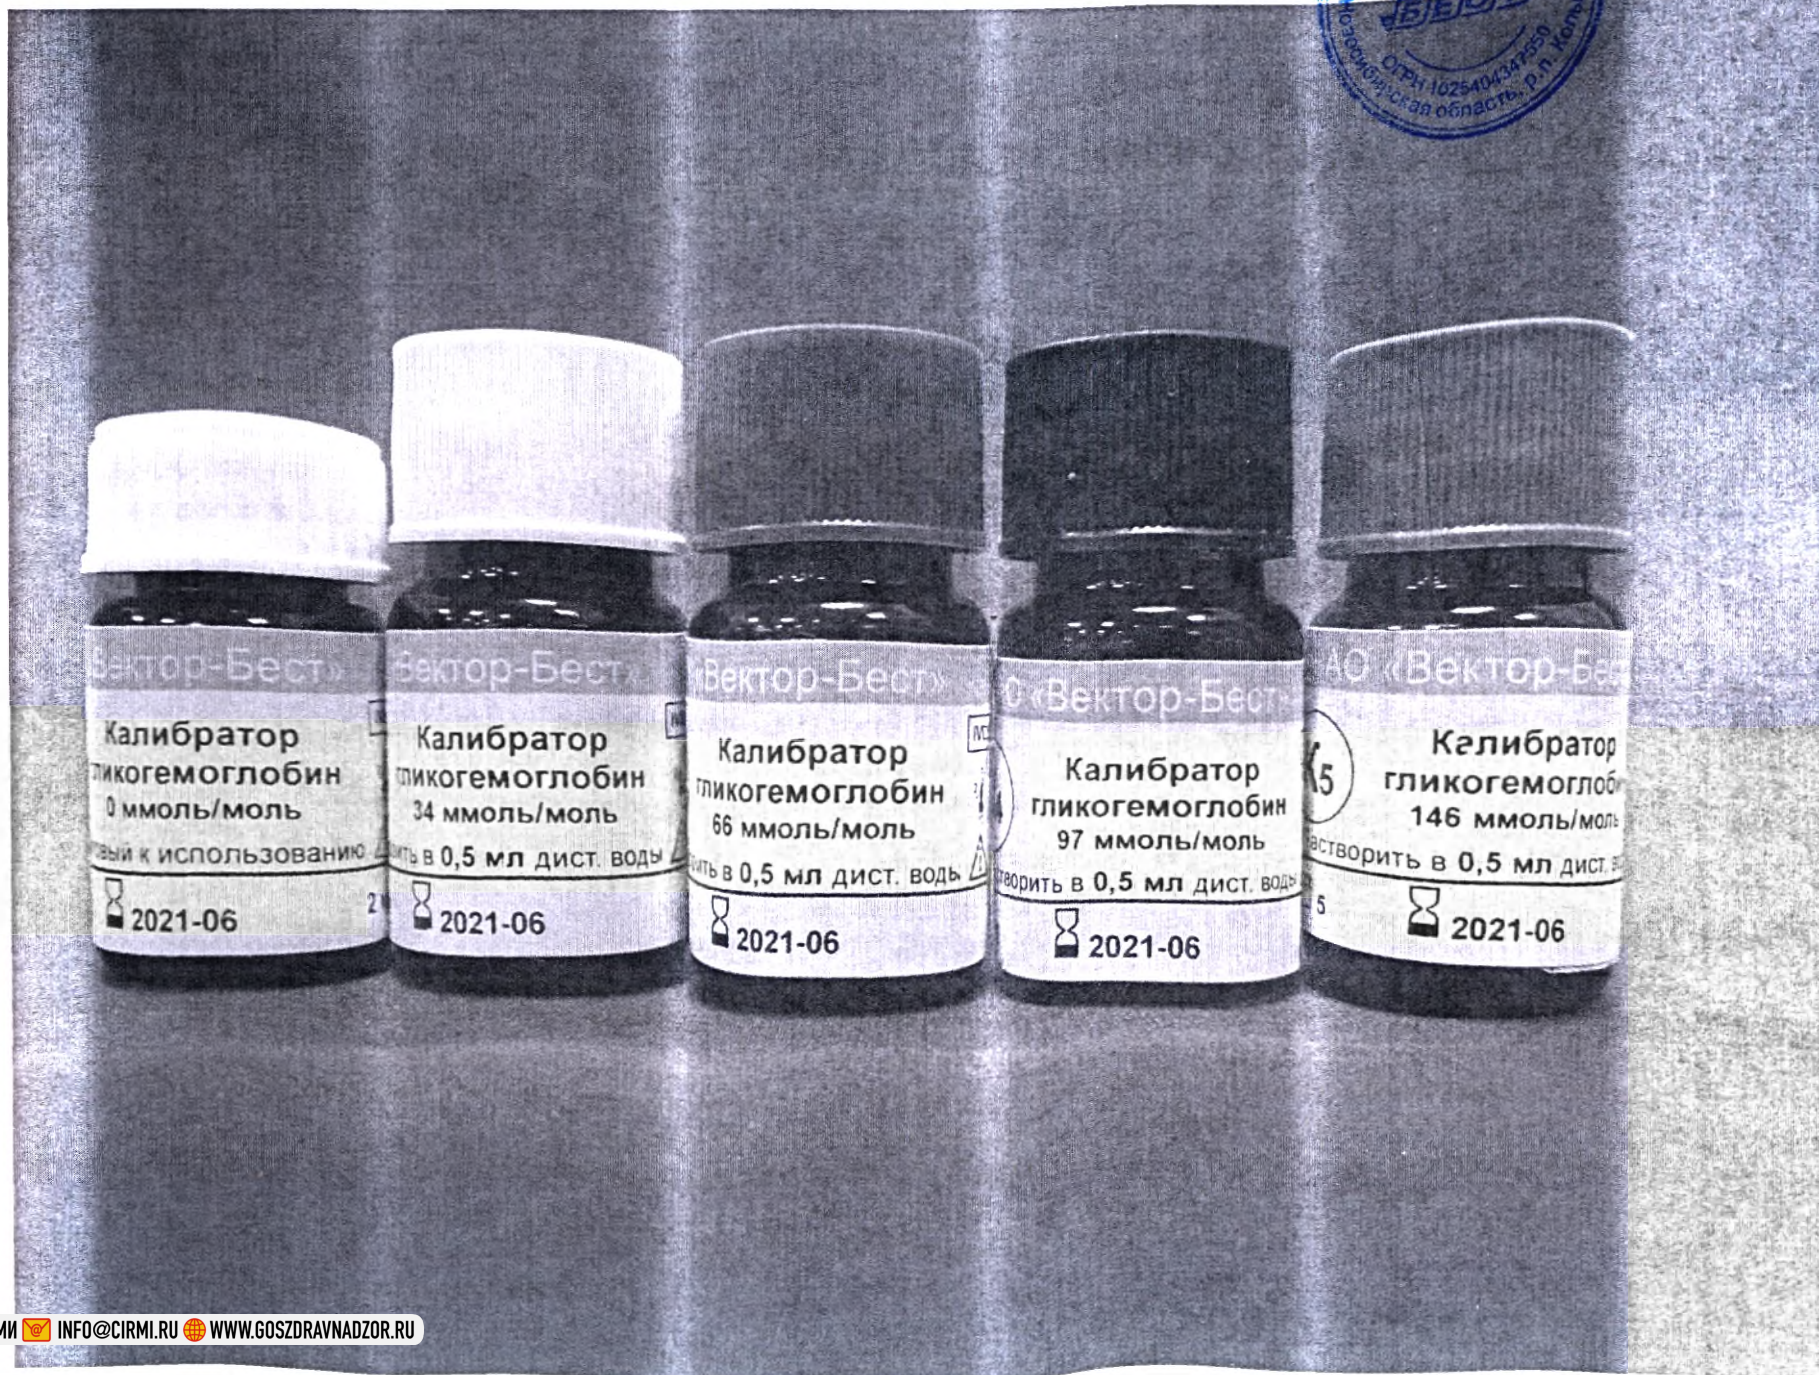

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"Калибратор гликогемоглобин" №3
серия 5

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусанов
11/2020 г.

