

Фотографические изображения

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 200 тестов. Код партии: LOT 53838701.

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 200 тестов. Код партии: LOT 53838701.



Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 200 тестов. Код партии: LOT 53838701



Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzer/COV2AC) 200-тестов. Код партии: LOT: 53838701

Elecsys SARS-CoV-2 Antigen

REF 09345272190

For USA: CONTENT

For Emergency Use Authorization only

- M Streptavidin-coated microparticles 0.72 mg/mL
- R1 Biotinylated monoclonal anti-SARS-CoV-2 antibody (mouse) <1.4 mg/L; HEPES buffer
- R2 Two monoclonal anti-SARS-CoV-2 antibodies (rabbit) labeled with ruthenium complex < 2.3 mg/L (each); HEPES buffer
- Cal1 Non-reactive for SARS-CoV-2 antigen, buffer
- Cal2 Reactive for SARS-CoV-2 antigen, buffer



Rx only

01



Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 200 тестов. Код партии: LOT 53838701



Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 200 тестов. Код партии: LOT 53838701



[illegible]

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 200 тестов. Код партии: LOT 53838701

1. Кассета с реагентами на три отделения (флакона) COV2AG: M, R1, R2 – 1 шт.;




Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 200 тестов. Код партии: LOT 53838701

1. Кассета с реагентами на три отделения (флакона) COV2AG: M, R1, R2 – 1 шт.;




Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 200 тестов. Код партии: LOT 53838701

2. Калибратор 1 (COV2AG Cal1), флакон, объем 1 мл – 2 шт.;

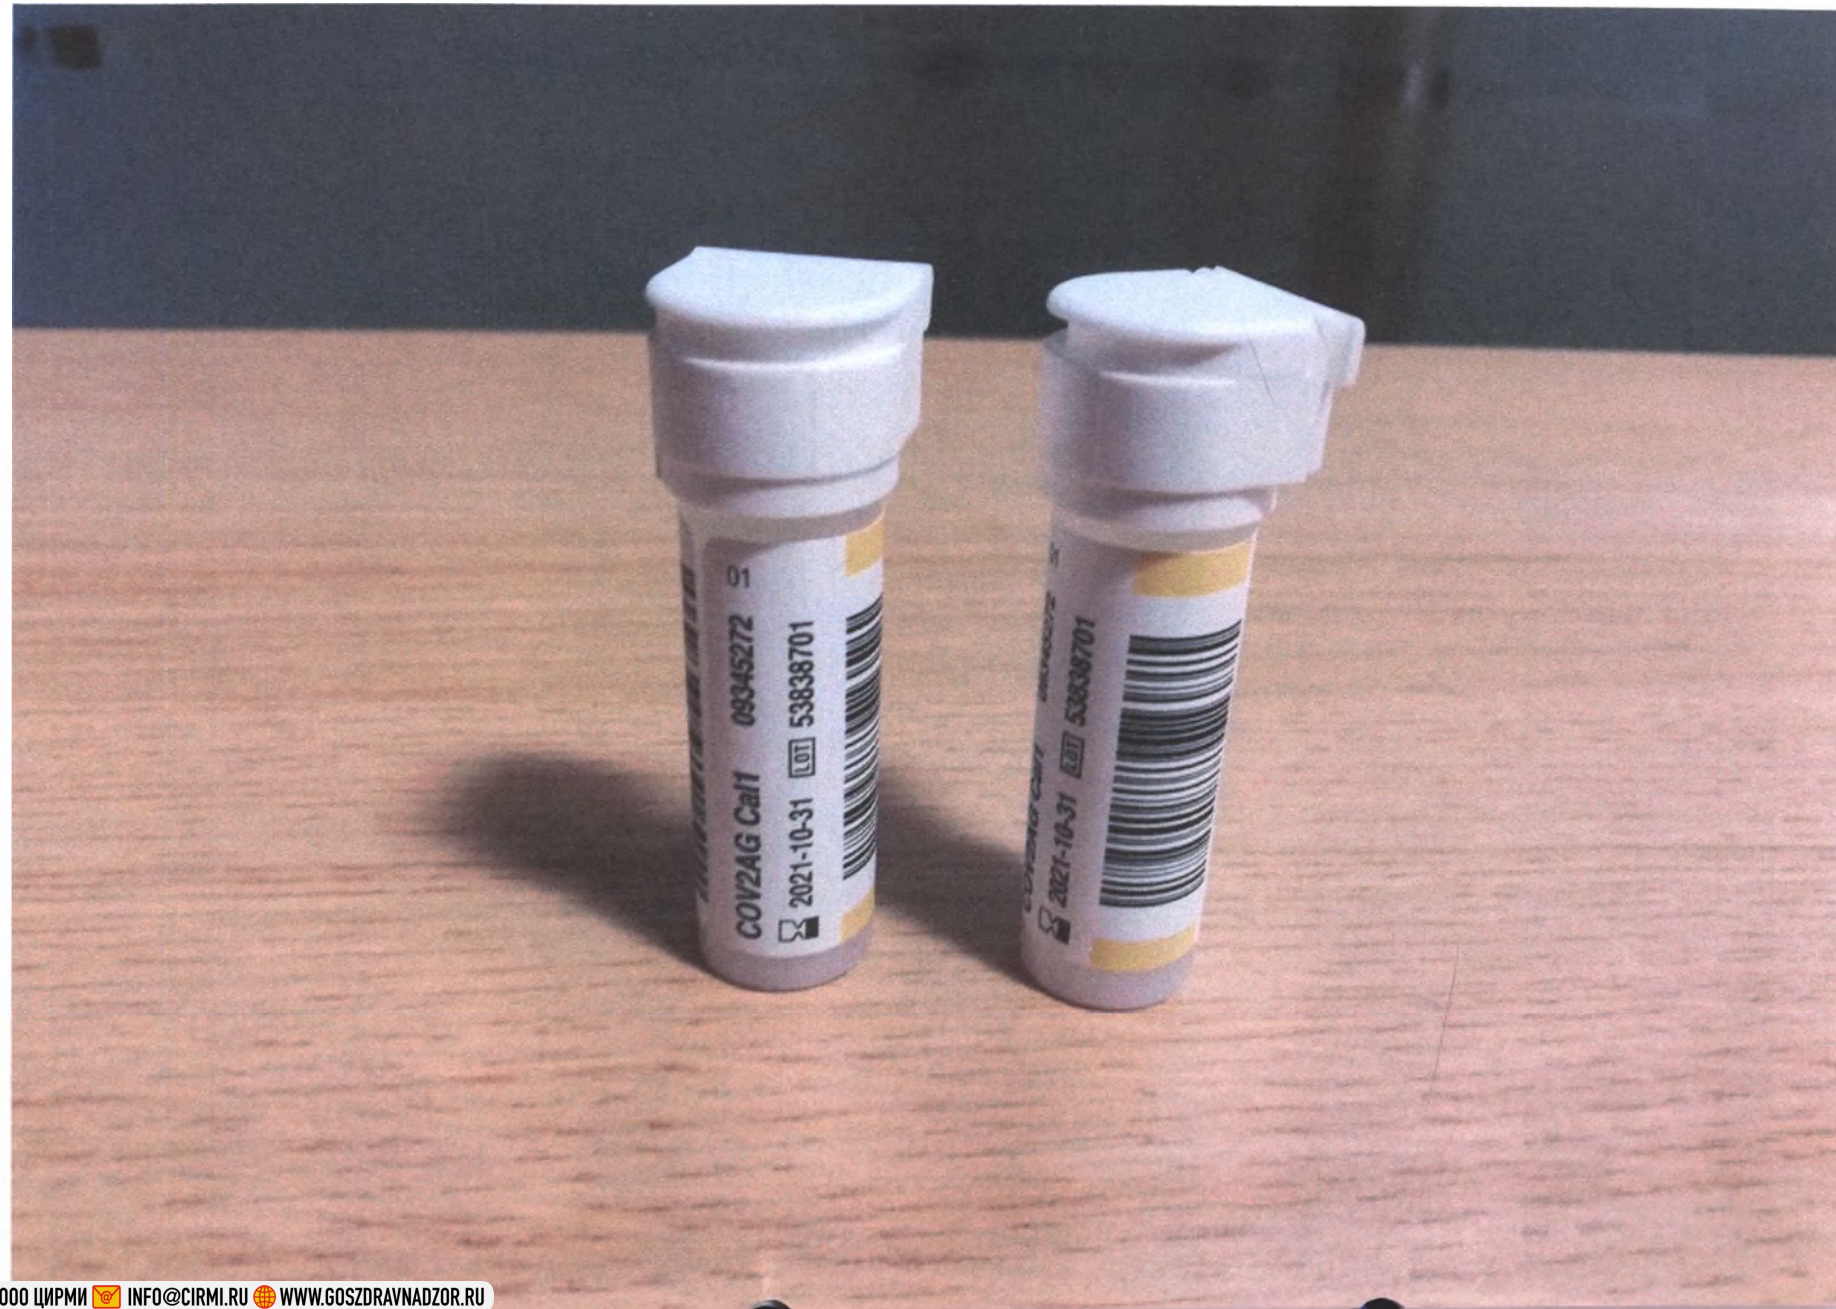

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 200 тестов. Код партии: LOT 53838701

3. Калибратор 2 (COV2AG Cal2), флакон, объем 1 мл – 2 шт.;

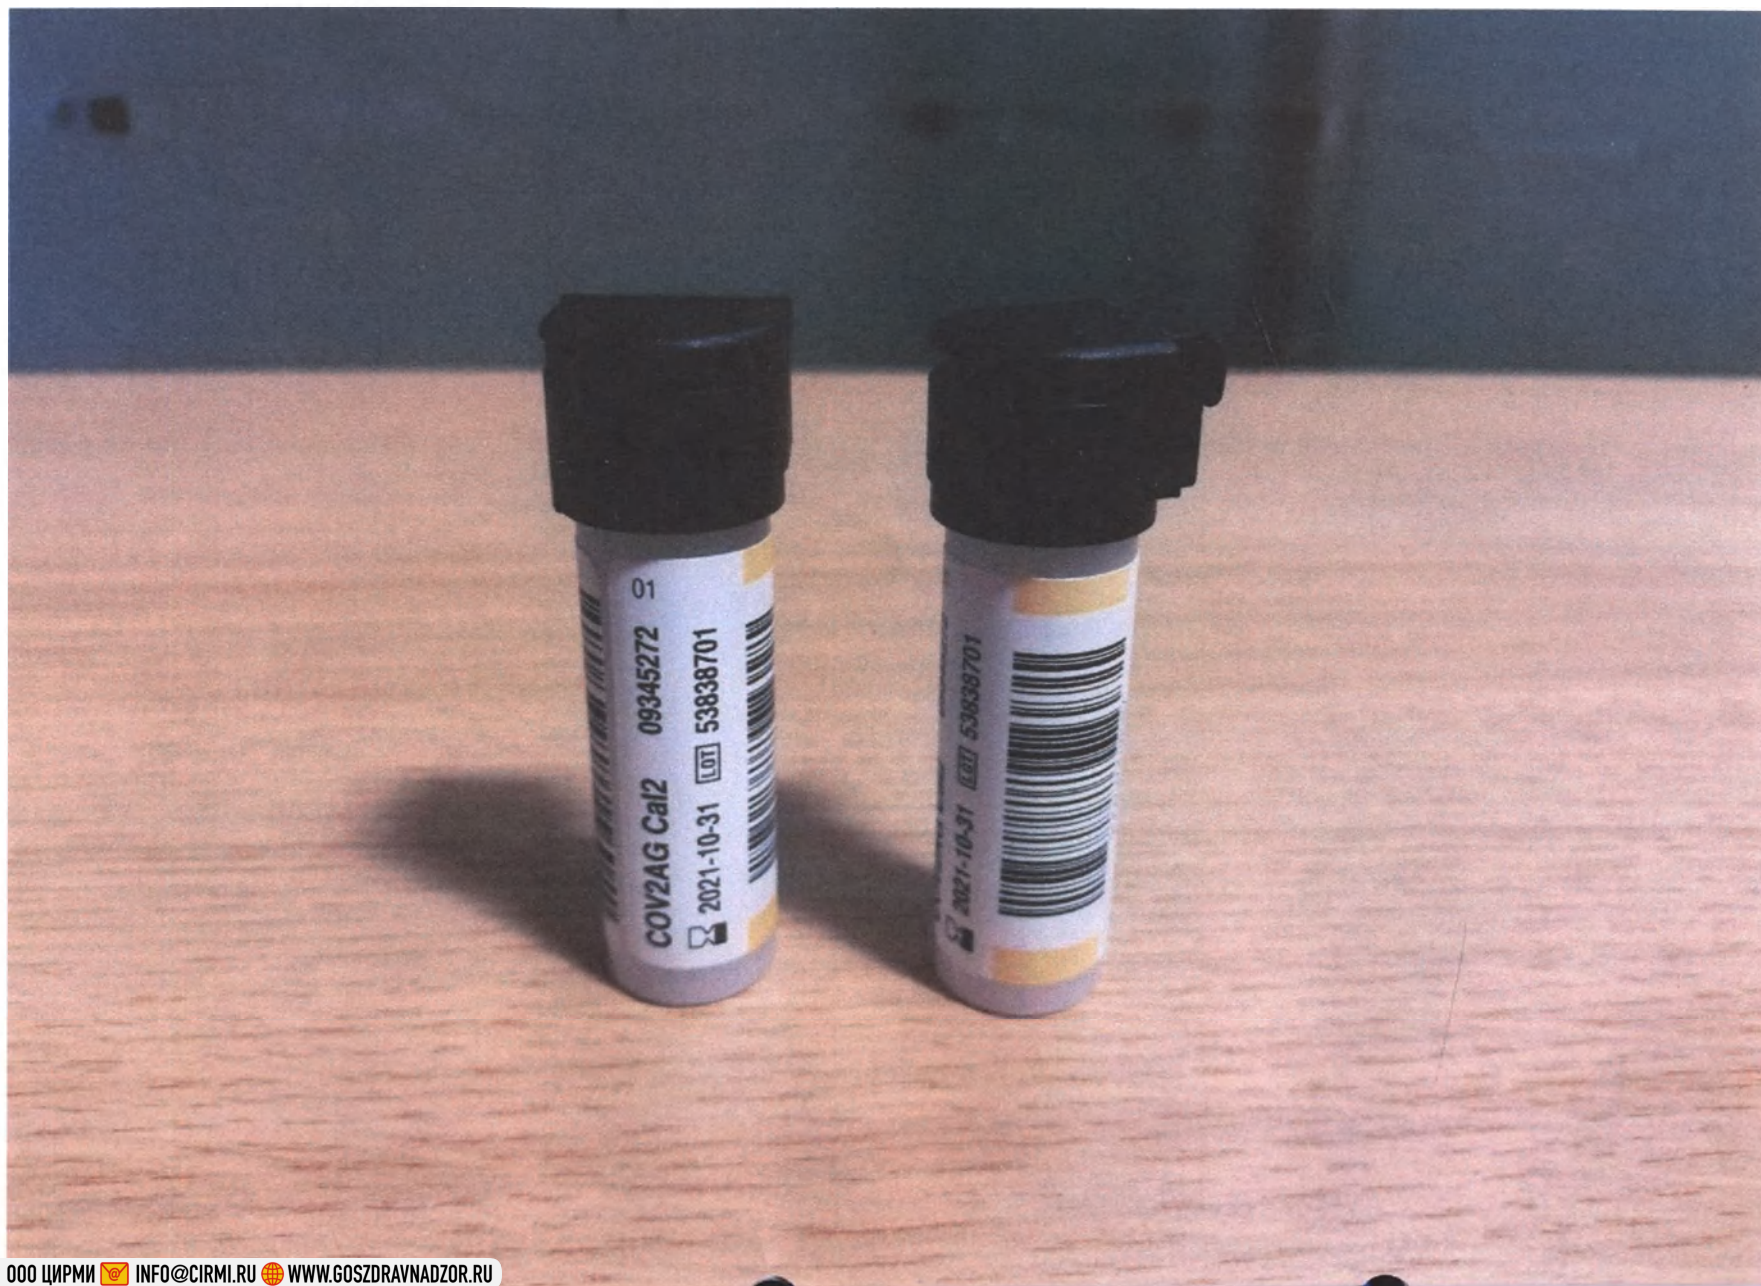

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 200 тестов. Код партии: LOT 53838701

4. Флакон пустой – 4 шт.;



Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 200 тестов. Код партии: LOT 53838701

4. Флакон пустой – 4 шт.;



Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 200 тестов. Код партии: LOT 53838701

5. Этикетка для флакона – 12 шт.;



6. Инструкция по применению.

cobas®

[illegible][illegible][illegible][illegible]

М. Мухоморова, доктор сценаристики (профессионал)
1 группа, 14 лет
Мухоморова, профессионал сценаристики, 0,72 сек.
1 группа, 14 лет
Алексеева, 0,94 сек. (профессионал), 1 группа, 14 лет

[illegible][illegible]

116

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
15 листа (ов)



по доверенности
от 04.02.2021