


Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

**Калибратор для обеспечения правильности одновременного качественного
определения антигена и антител к ВИЧ типа 1 и/или типа 2
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на
иммунохимических анализаторах Alinity i "ВИЧ Аг/Ат Комбо Калибратор (Alinity i
HIV Ag/Ab Combo Calibrator)"**


(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Alinity i HIV Ag/Ab Combo Calibrator



HIV Ag/Ab Cal

CAL 1 1 x 3.0 mL



CONTAINS: AZIDE



www.abbottdiagnostics.com/IFU

REF

08P0701



Exp.

2018-04-19


LOT

78474LI00


R01





G71453R02



(01) 00380740121730 (17) 180419
(10) 78474LI00 (240) 08P0701 (91) HIV Ag/Ab

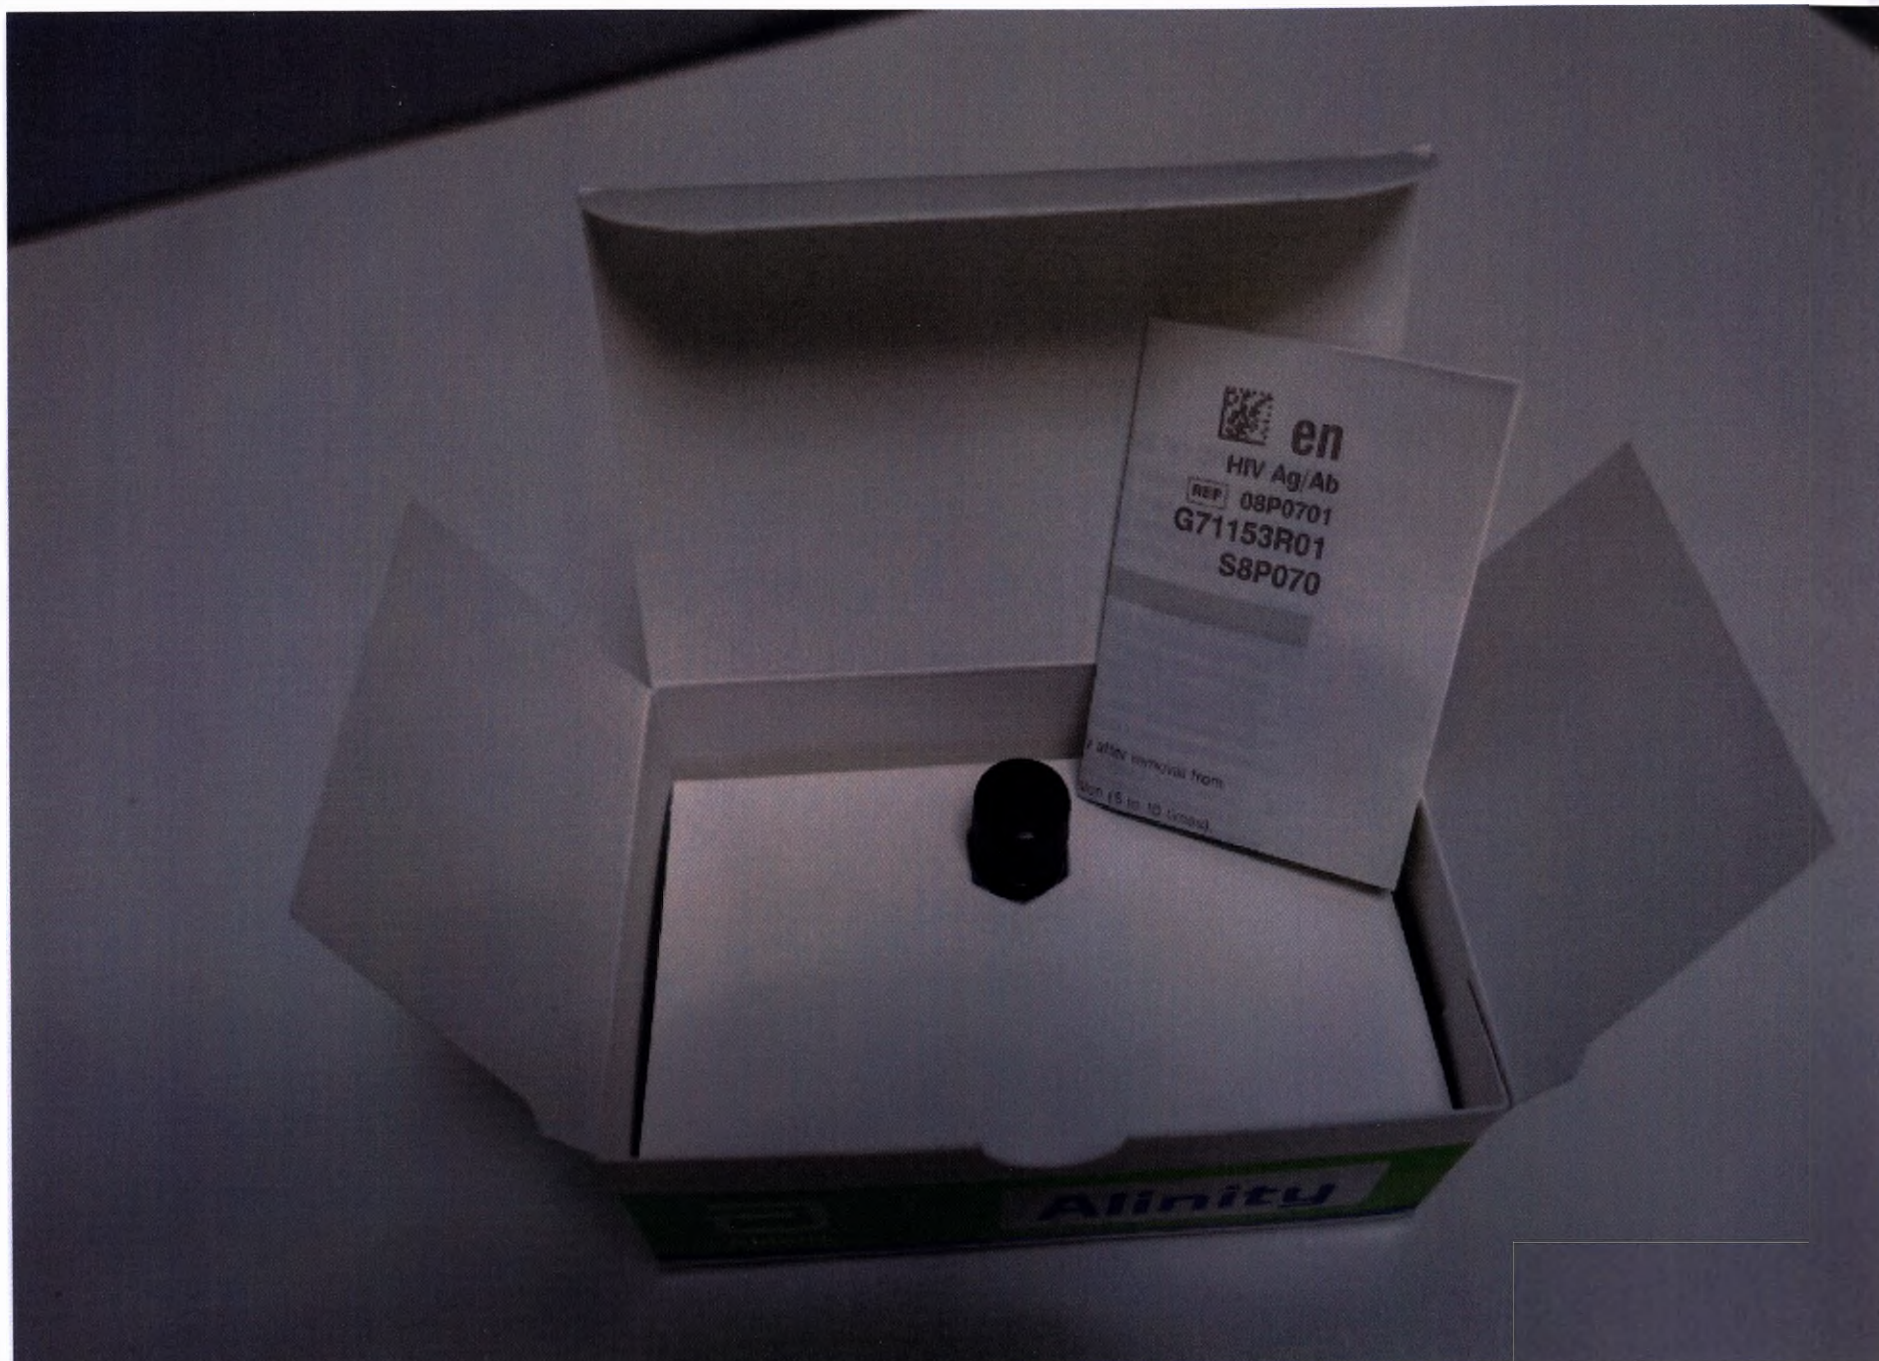

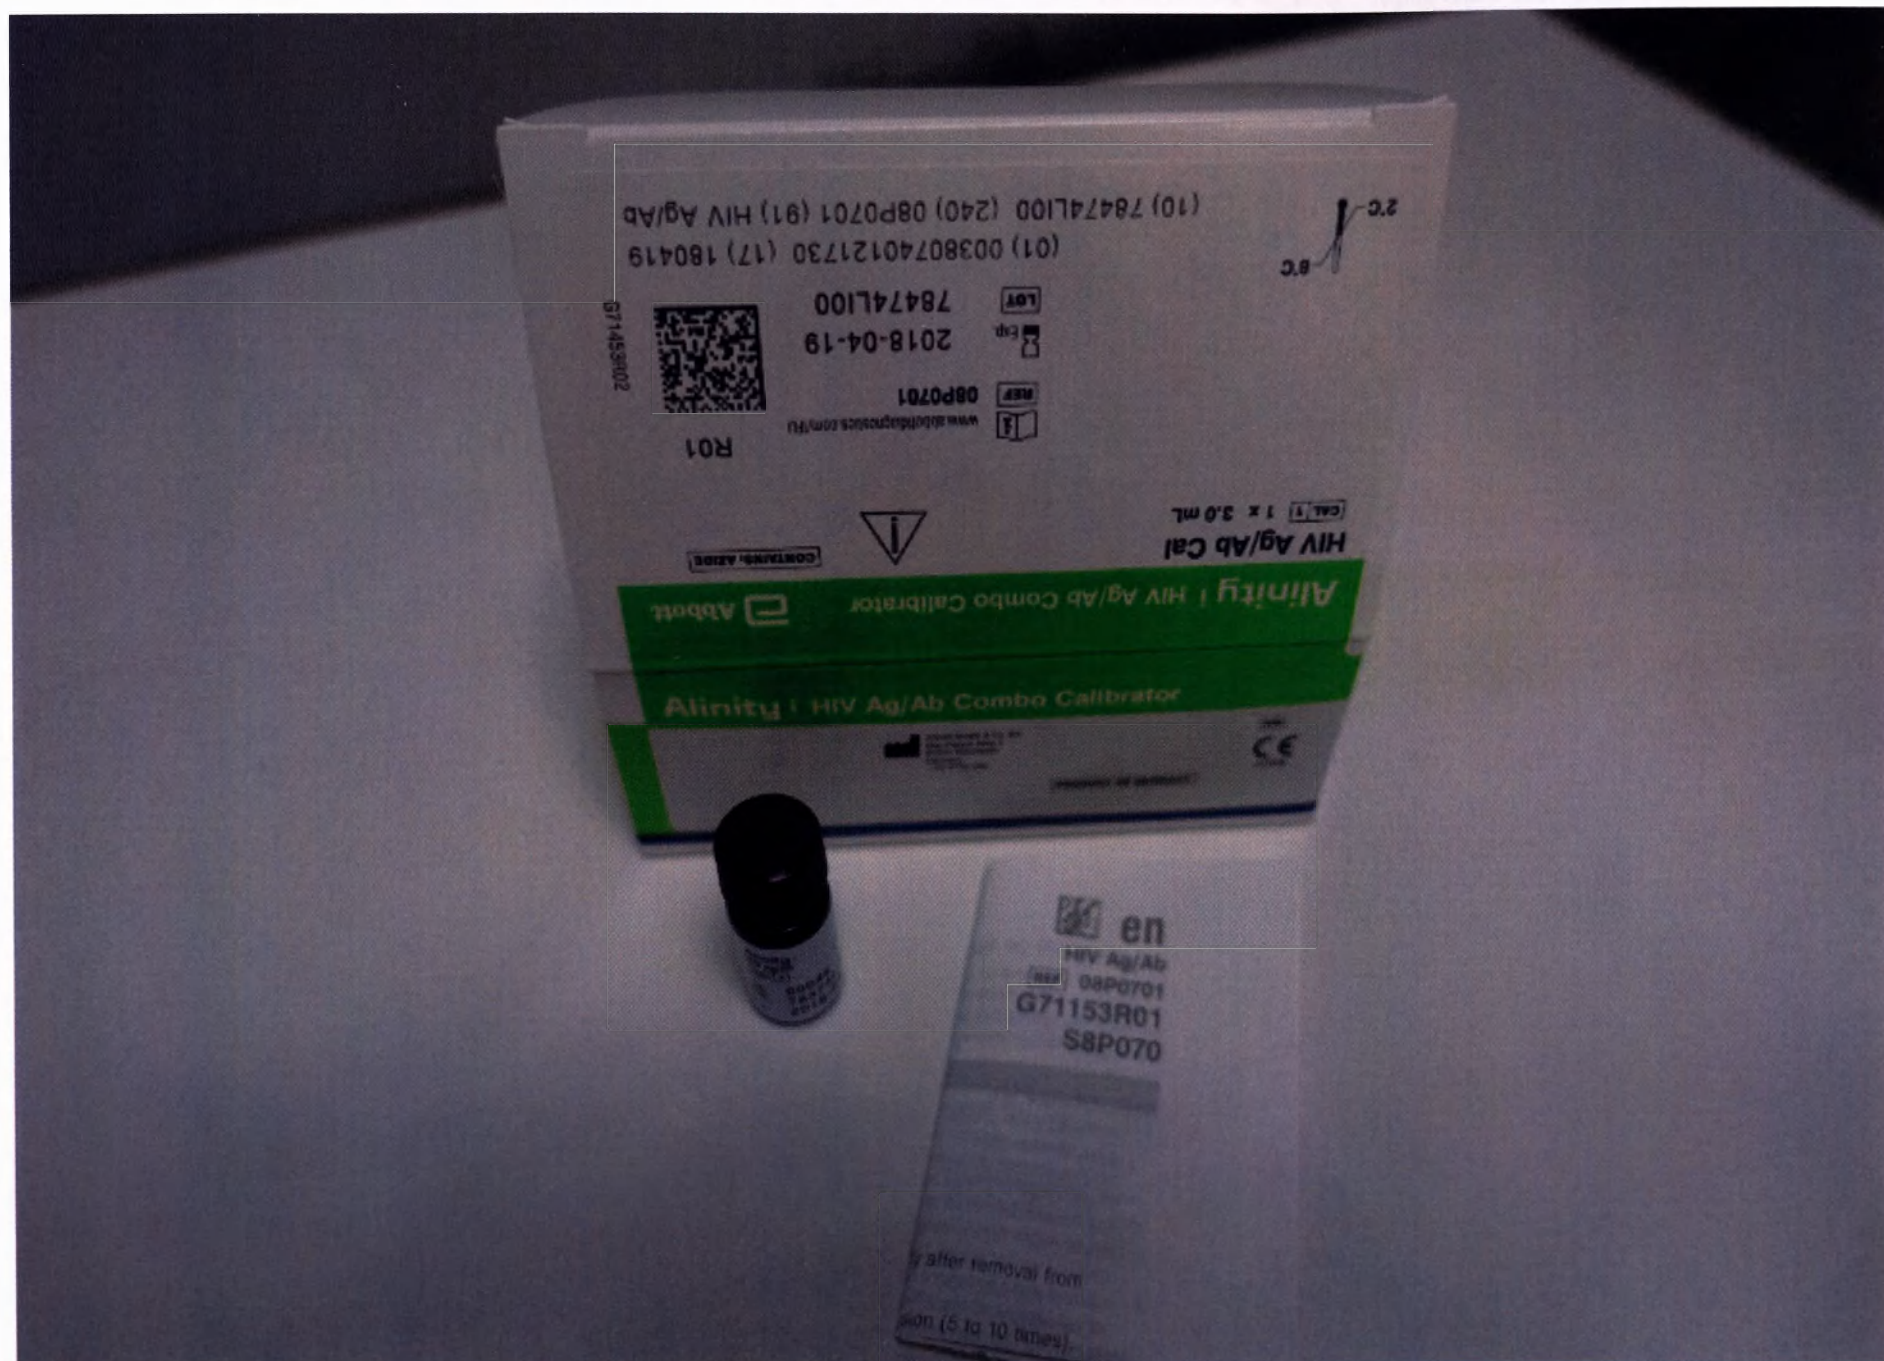

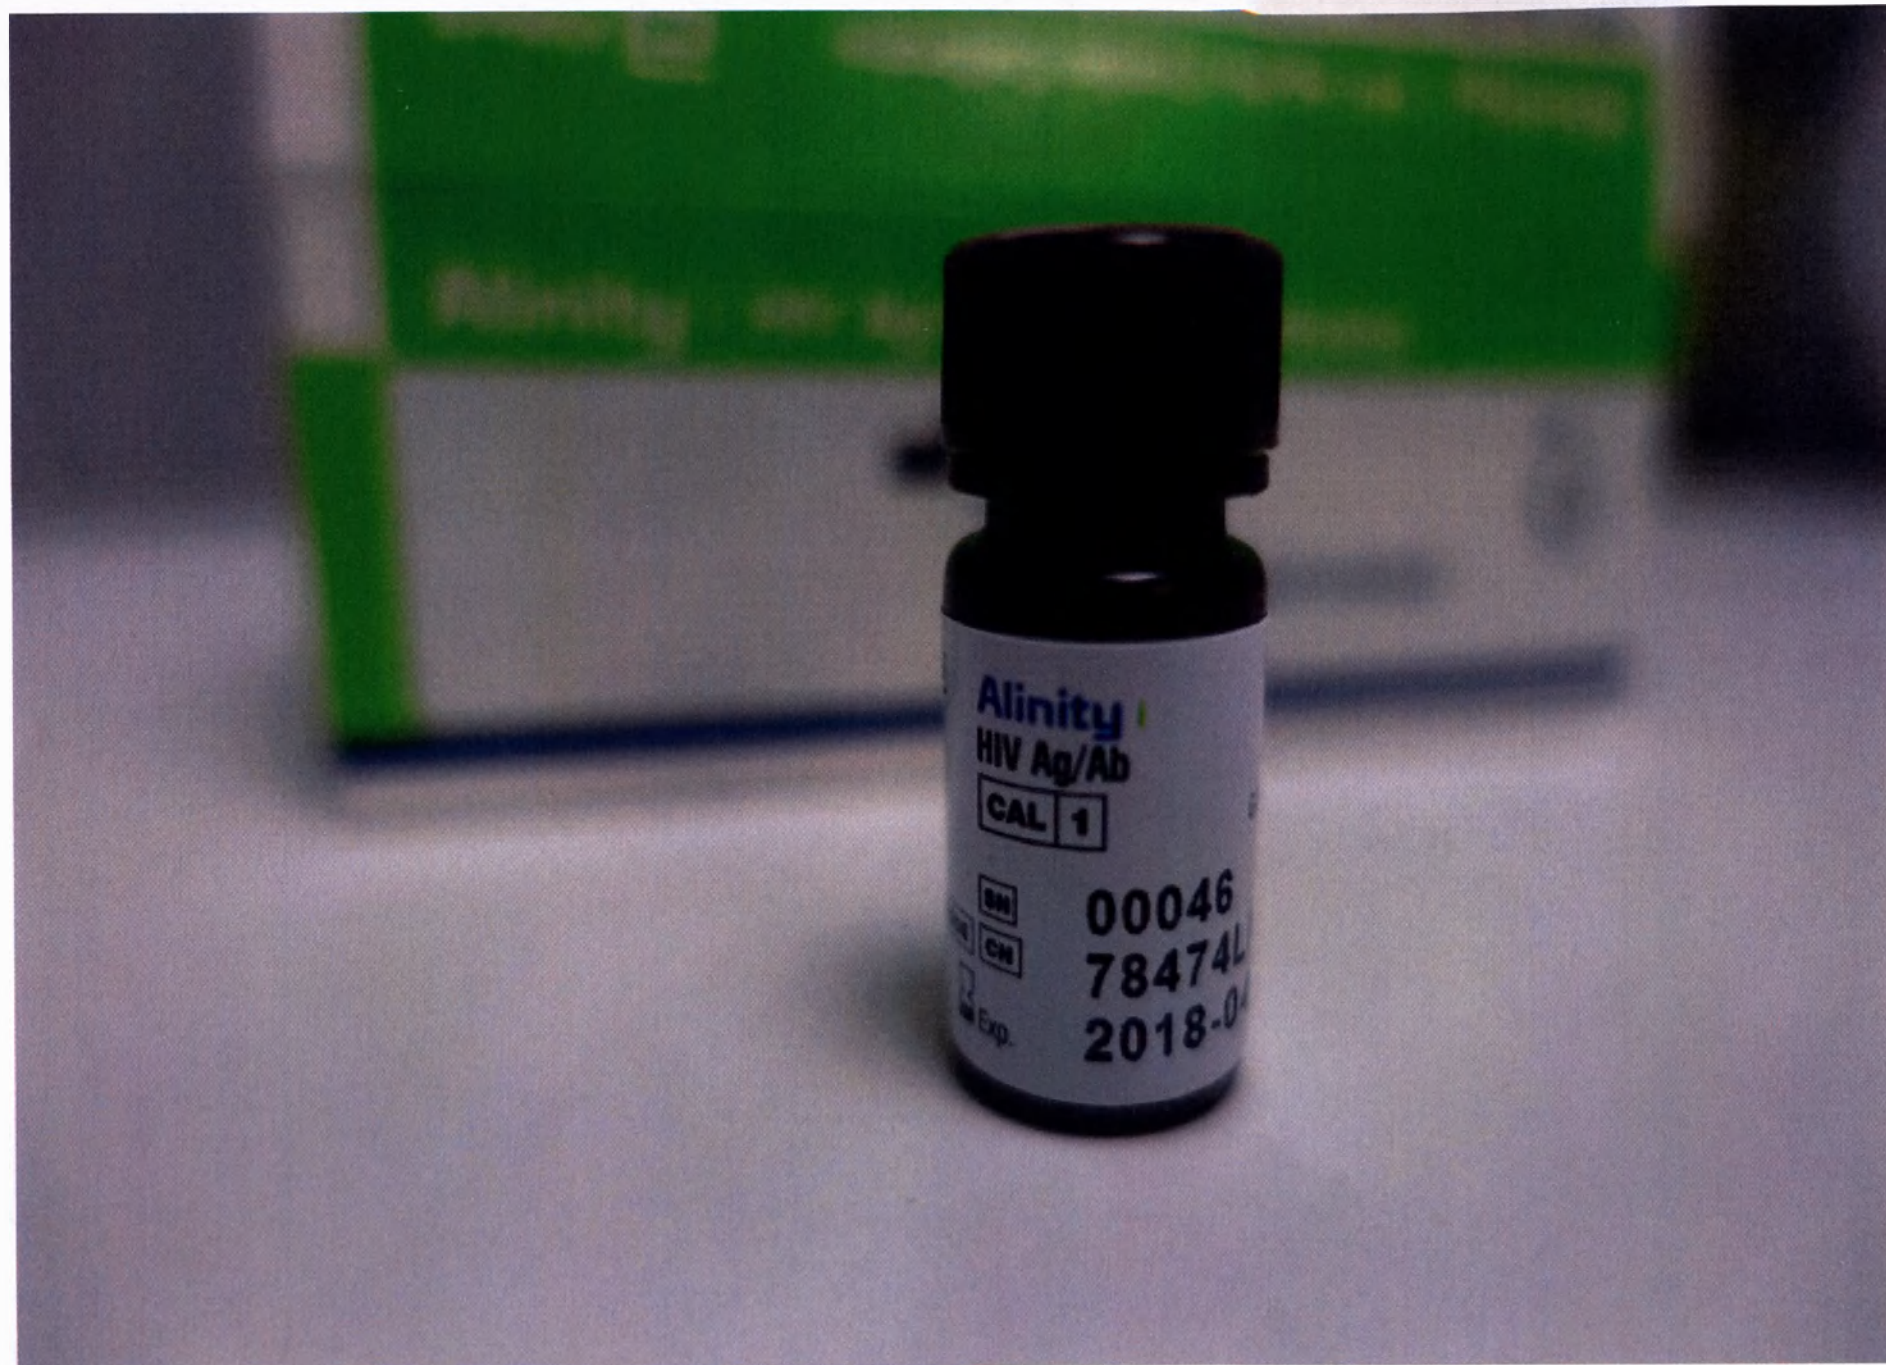

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
37712шт листов

Подпись _____



Макет маркировки на медицинское изделие

Калибратор для обеспечения правильности одновременного качественного определения антигена и антител к ВИЧ типа 1 и/или типа 2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "ВИЧ Аг/Ат Комбо Калибратор (Alinity i HIV Ag/Ab Combo Calibrator)"

После получения регистрационного удостоверения на медицинское изделие маркировка будет введена в обращение и нанесена на медицинское изделие.



REF

08P07-01

IVD



Калибратор для обеспечения правильности одновременного качественного определения антигена и антител к ВИЧ типа 1 и/или типа 2 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке или плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i

"ВИЧ Аг/Ат Комбо Калибратор (Alinity i HIV Ag/Ab Combo Calibrator)"

В составе:

- Калибратор 1 (Alinity i HIV Ag/Ab Combo Calibrator 1) – 1 x 3,0 мл
- Инструкция по применению

Производитель: Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия) / РУ № ____/____ от ____/____/____

Инструкцию по применению на русском языке см: www.abbottdiagnostics.com/IFU

Антитела к вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах.

Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

G71430102


LOT



REF

08P0701

www.abbottdiagnostics.com/IFU



CONTAINS: AZIDE




CAL 1 1 x 3.0 mL
HIV Ag/Ab Cal



Alinity i HIV Ag/Ab Combo Calibrator

Alinity i HIV Ag/Ab Combo Calibrator




Abbott GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580




PRODUCT OF GERMANY

HIV Ag/Ab Cal



Макет маркировки каждого компонента медицинского изделия ВИЧ Аг/Ат Комбо Калибратор (Alinity i HIV Ag/Ab Combo Calibrator):

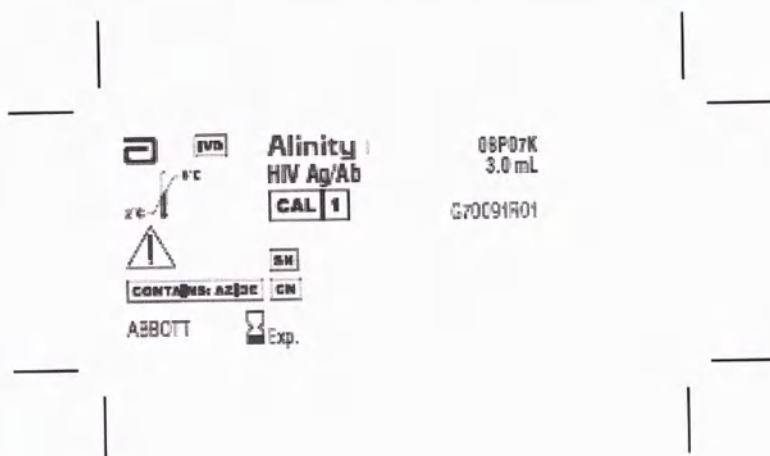

Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:

Стандарт	Наименование стандарта
ГОСТ Р ИСО 18113-1 – 2015	Медицинские изделия для диагностики in vitro. Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования
ГОСТ Р ИСО 18113-2 – 2015	Медицинские изделия для диагностики in vitro. Информация, предоставляемая изготовителем (маркировка). Часть 2. Реагенты для диагностики in vitro для профессионального применения
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования

Всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

31/11/19 листов

Подпись

