


Макет маркировки на медицинское изделие

**Калибратор для обеспечения правильности качественного
определения антител класса IgG к вирусу гепатита А
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «HAV
антитела IgG Калибратор (Alinity i HAVAb IgG Calibrator)»**



REF

08P26-01

IVD



Калибратор для обеспечения правильности качественного определения антител класса IgG к вирусу гепатита А иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «HAV антитела IgG Калибратор (Alinity i HAVAb IgG Calibrator)» в составе:

- Калибратор 1 (Alinity i HAVAb IgG CAL 1) – 1 флакон х 3,0 мл
- Инструкция по применению

Данный продукт содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.

Производитель: Abbott GmbH & Co. KG (Эбботт ГмбХ и Ко. КГ) Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany/ Страна происхождения: Германия /РУ № _____ от ____ /
Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU/
Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах.
Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ: Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

Cal
HAVAb IgG



PRODUCT OF GERMANY

Abbott GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49 6122-580

Abbott

Alinity i HAVAb IgG Calibrator

Alinity i HAVAb IgG Calibrator

Abbott

CAL 1 1 x 3.0 mL



CONTAINS: AZIDE


www.abbottdiagnostics.com/IFU

REF

08P2601

Exp.

LOT



G70932802

Макет маркировки компонента медицинского изделия



Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:

Стандарт	Наименование стандарта
ГОСТ Р ИСО 18113-1-2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования
ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка). Часть 2. Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования

Расшифровка символов представлена в инструкции.

Всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

3 листов

Подпись



Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Калибратор для обеспечения правильности качественного определения антител класса IgG к вирусу гепатита А иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «HAV антитела IgG Калибратор (Alinity i HAVAb IgG Calibrator)»

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Alinity i HAVAb IgG Calibrator

Abbott

CAL 1

1 x 3.0 mL




CONTAINS: AZIDE



www.abbottdiagnostics.com/IFU

REF

08P2601



Exp.

2017-10-11


LOT

71135LI00

R01




G70932R02





(01) 00380740131319 (17) 171011

(10) 71135LI00 (240) 08P2601 (91) HAVAb IgG

Alinity

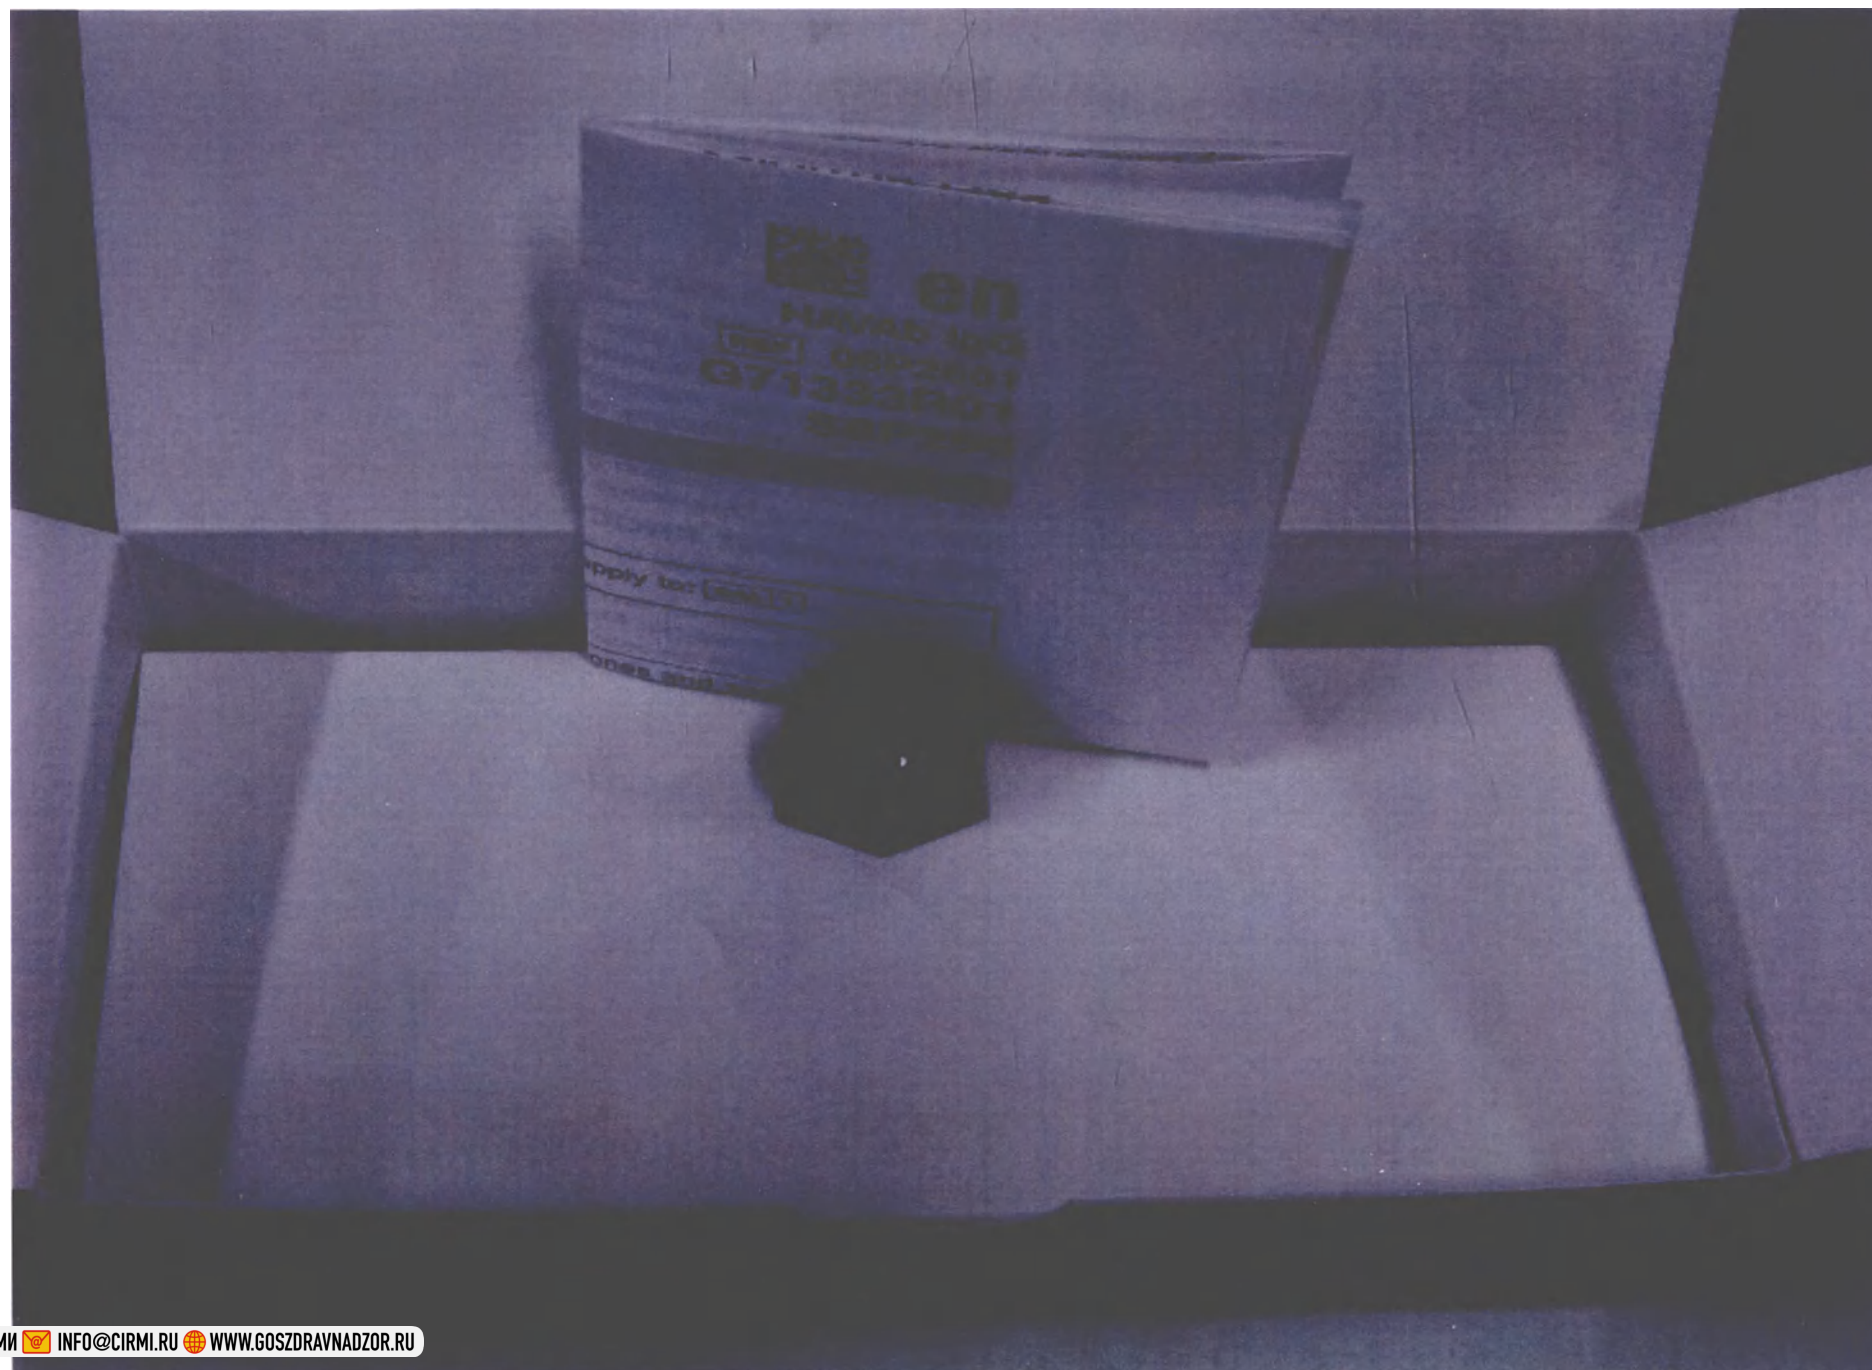

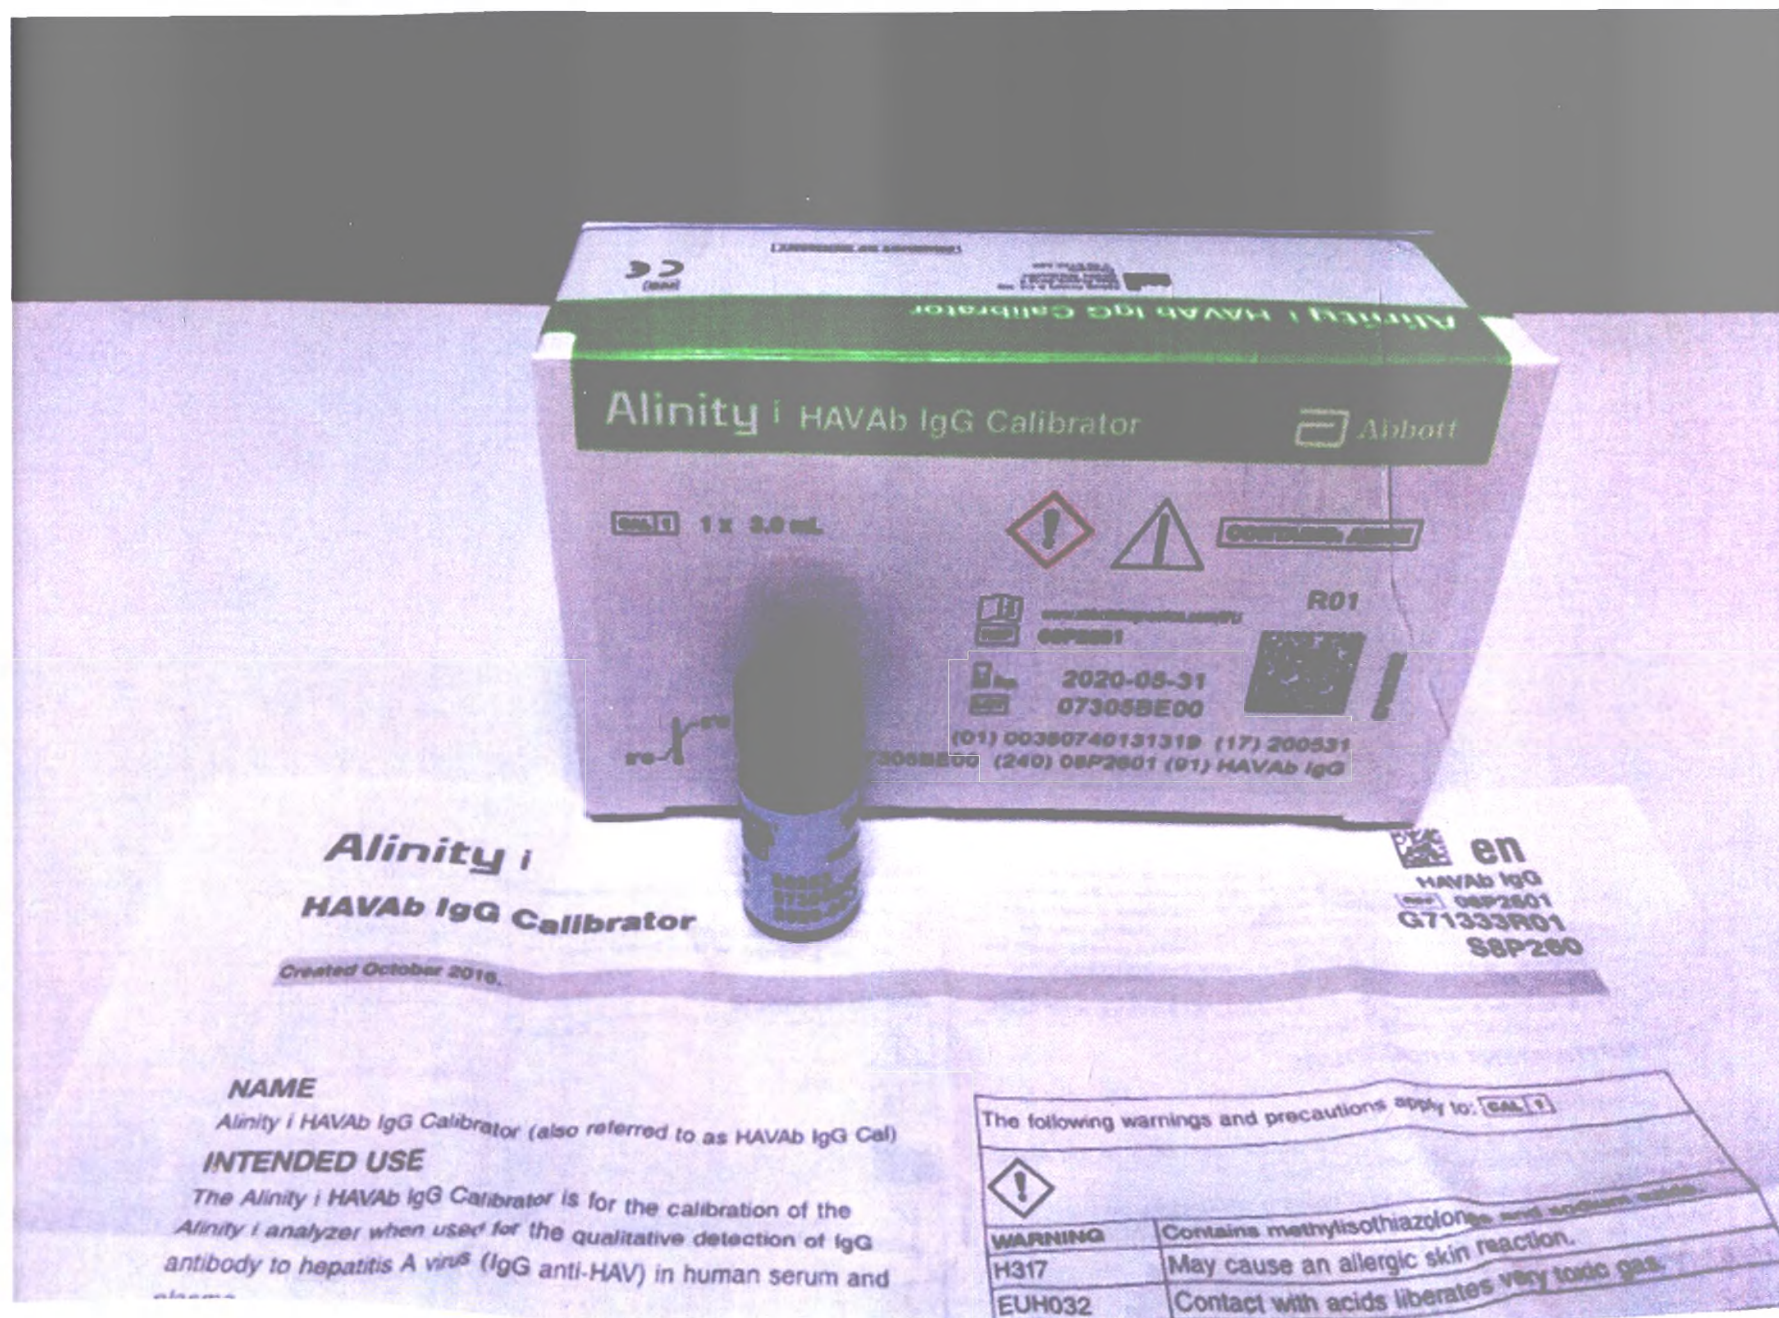

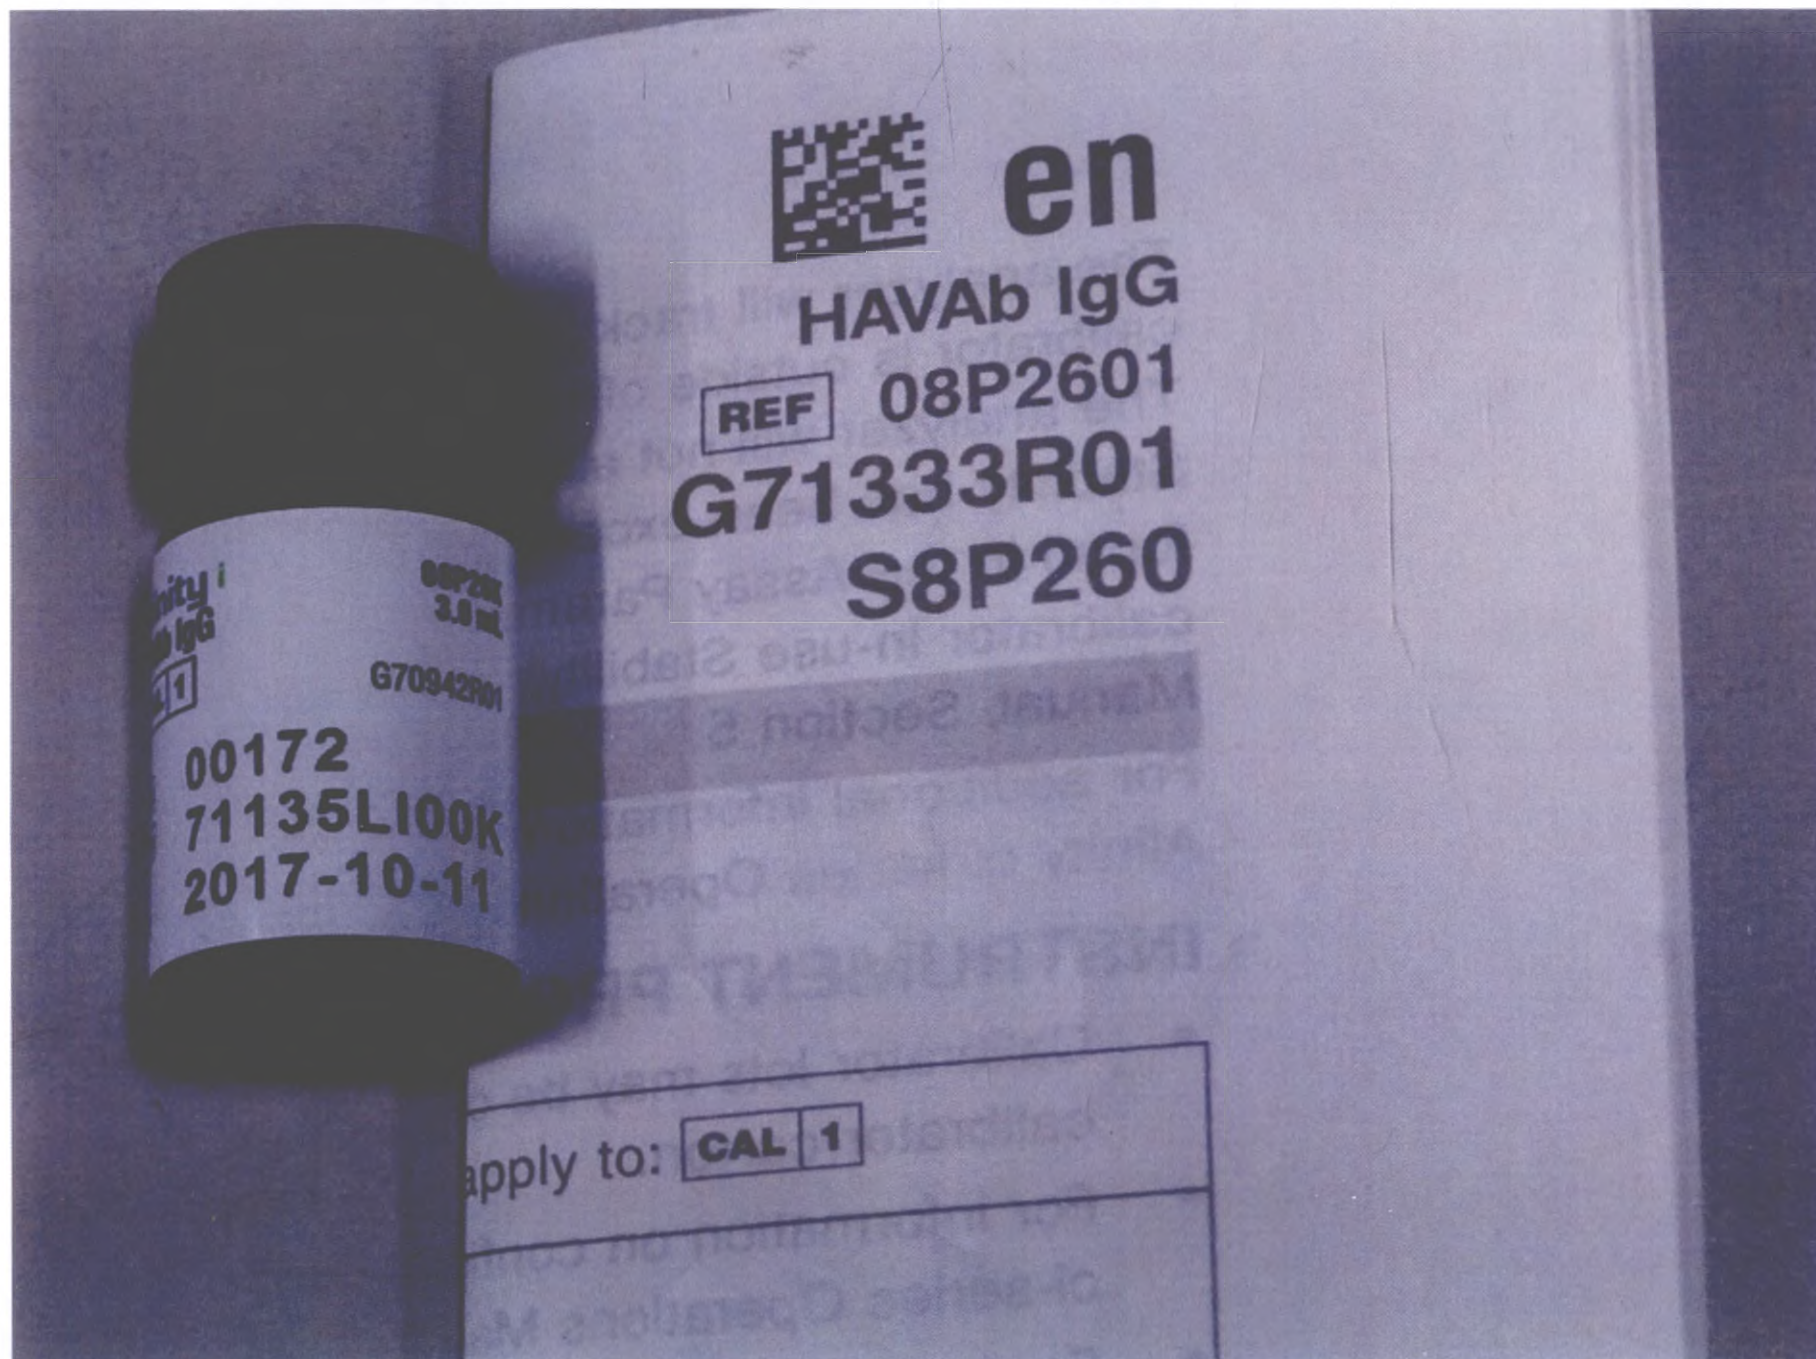

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

3 листов

Подпись



Секретариат
Адрес: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Мухоморова, д. 10
Адрес: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Мухоморова, д. 10