

17, Krylatskaya str., bld. 4, floor 2, premises I,  
room 2 Moscow, 121614  
Tel.: +7 495 139 26 89

121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17, корп. 4,  
эт. 2 пом. I ком 2  
Tel.: +7 495 139 26 89

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор

ООО «ЛайфСкан Раша»

Креанга Е.А.




**Фотографические изображения медицинского изделия**  
**Система контроля уровня глюкозы в крови (глюкометр)**  
**портативная УанТач Верлио Рефлект (OneTouch Verio**  
**Reflect®)**

1. Система контроля уровня глюкозы в крови (глюкометр) портативная УанТач Вериио Рефлект (OneTouch Verio Reflect®)








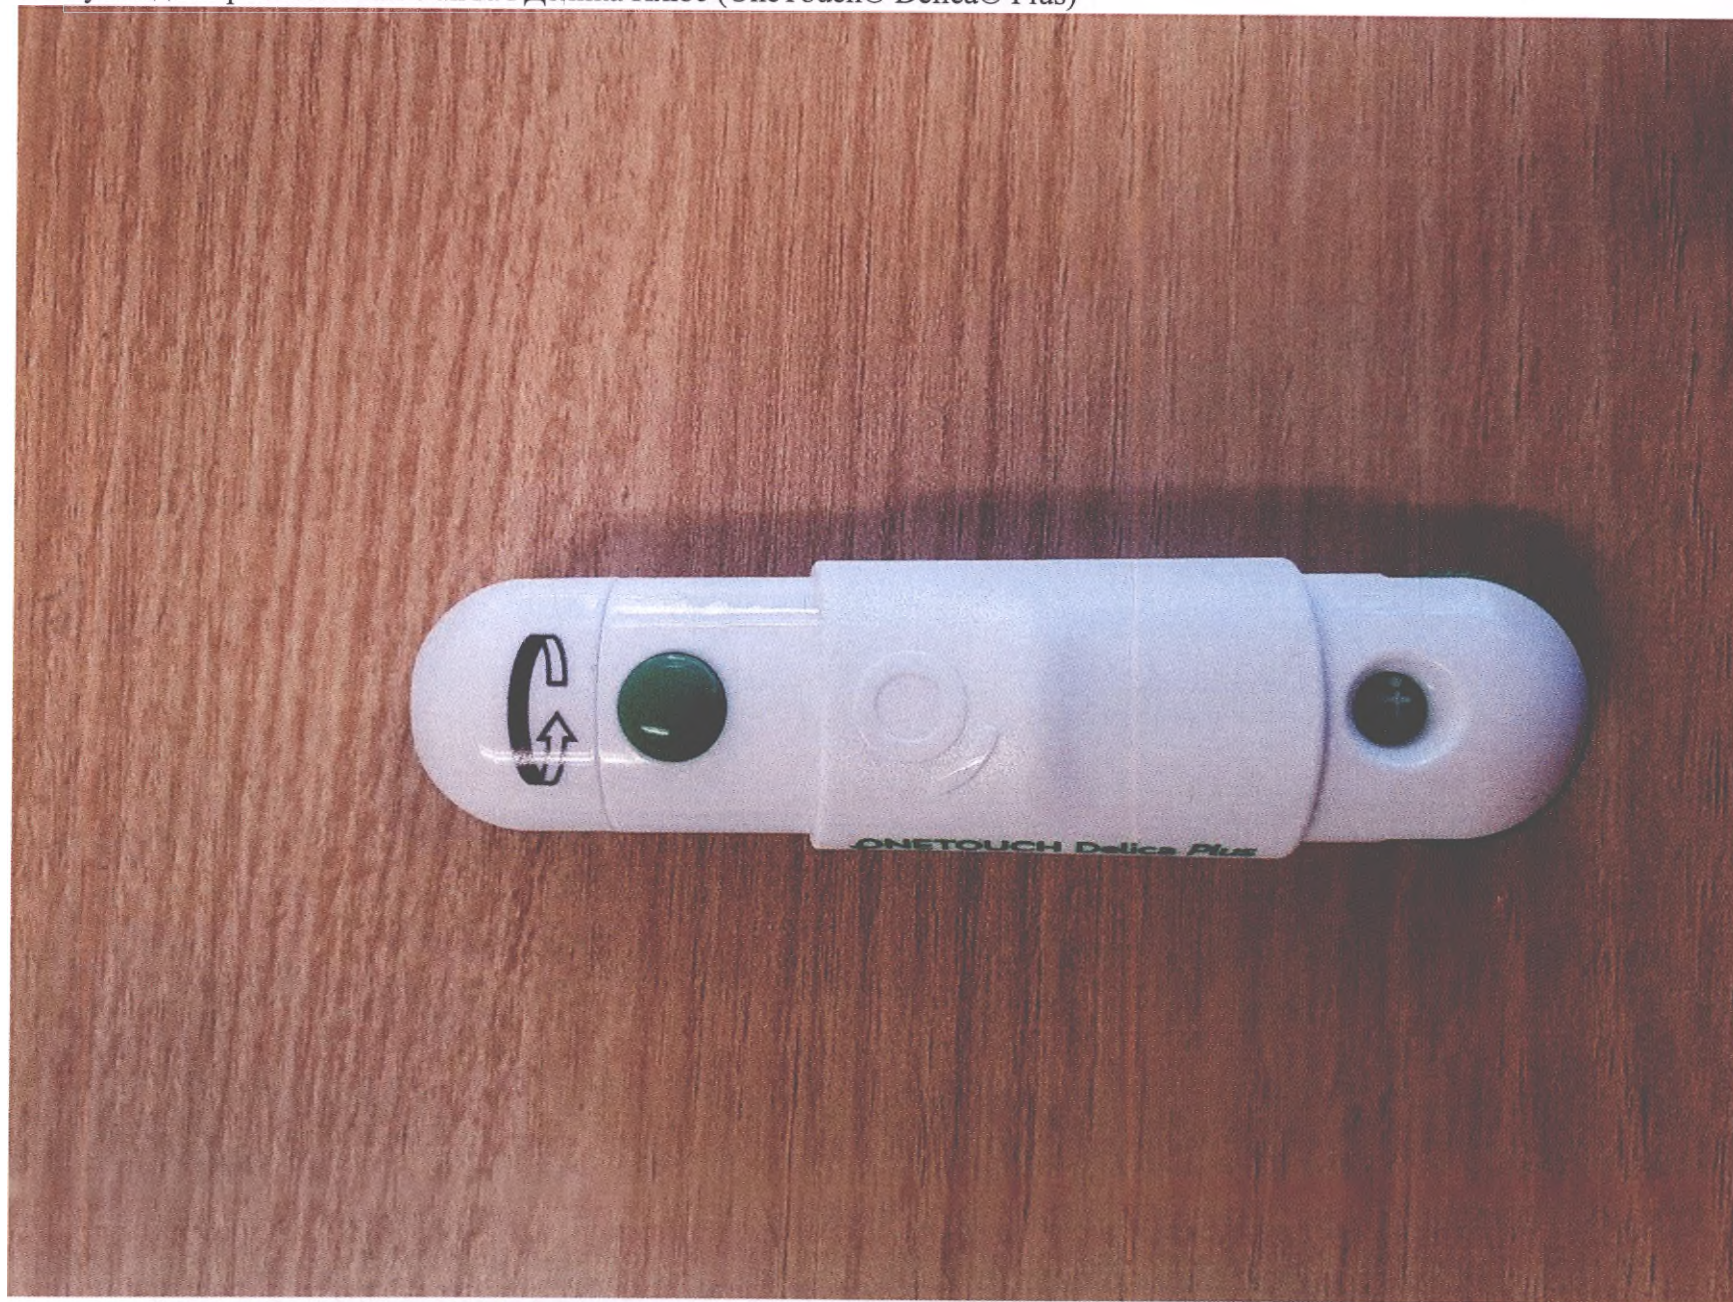



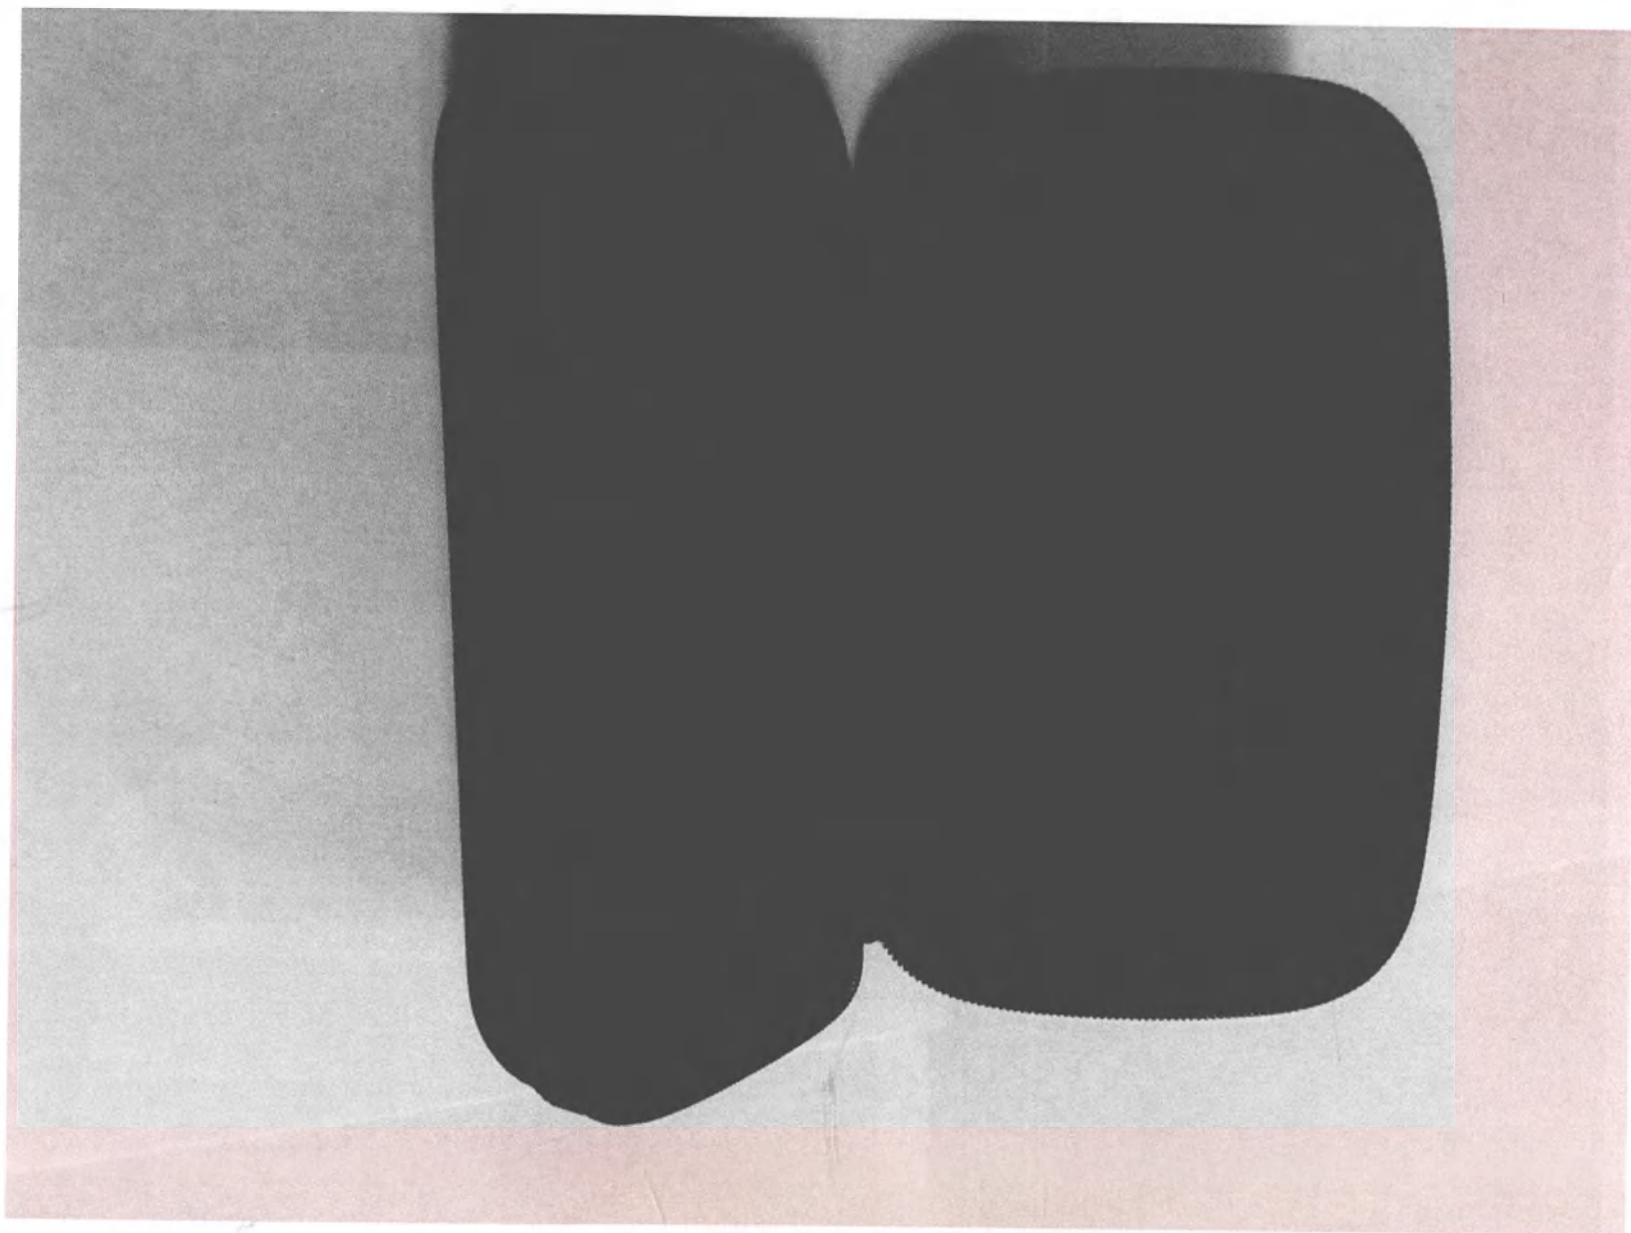













Макет картонной упаковки Системы контроля уровня глюкозы в крови (глюкометр) портативной УанТач Верิโอ Рефлект (OneTouch Verio Reflect®) см. на следующей странице в формате печати А3.

Ниже приведена часть макета маркировки боковой стороны упаковки в увеличенном формате, где будет указан состав комплекта поставки в соответствии с РУ:

# ONETOUCH Verio Reflect®

Система контроля уровня глюкозы в крови  
(глюкометр) портативная УанТач Верิโอ Рефлект  
(OneTouch Verio Reflect®)

**В комплект входят:**

1. Глюкометр УанТач Верิโอ Рефлект (OneTouch Verio Reflect®) - 1 шт.
2. Тест-полоски УанТач Верิโอ (OneTouch Verio®) (10 шт. в уп.).
3. Ручка для прокалывания УанТач Делика Плюс (OneTouch® Delica® Plus)- 1 шт.
4. Ланцеты одноразовые УанТач Делика Плюс (OneTouch® Delica® Plus) (10 шт. в уп.).
5. Футляр - 1шт.
6. Руководство пользователя на Систему контроля уровня глюкозы в крови (глюкометр) портативную УанТач Верิโอ Рефлект (OneTouch Verio Reflect®) - 1 шт.
7. Инструкция по применению на Тест-полоски УанТач Верิโอ (OneTouch Verio®) – 1 шт.




Р ИСО 15197-2015 Тест-системы  
гностики in vitro.  
ания к системам мониторинга  
и в крови для самоконтроля при  
и сахарного диабета



Используется только с тест-  
полосками УанТач Верิโอ  
(OneTouch Verio®)

# ONETOUCH Verio Reflect®

Система контроля уровня глюкозы в крови  
(глюкометр) портативная УанТач Верิโอ Рефлект  
(OneTouch Verio Reflect®)

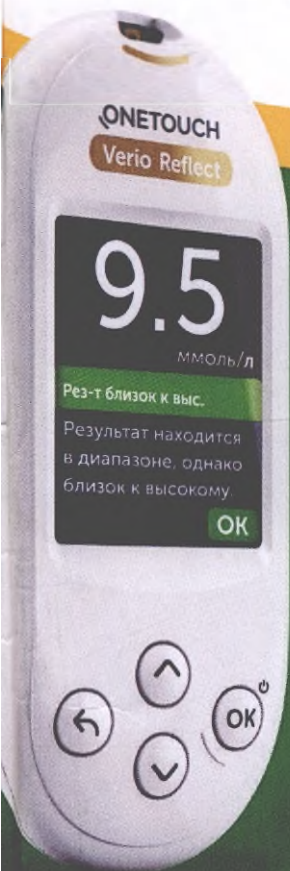

с функцией  
**Помощника  
Blood Sugar  
Mentor**

• **Функция Помощник  
Blood Sugar Mentor  
дает советы, как  
нужно действовать!**

**Bluetooth®**

В комплект входят см. на боковой поверхности.

Официальный представитель  
Официальный импортер  
ПАО «Скан Раша»  
Москва, Федерация, 121614  
ул. Крылатская  
эт. 4, эт. 2, пом. I, ком. 2  
© 2018-2019 LifeScan  
IP Holdings, LLC  
024-055  
Запатентовано




7 613427 003795

# ONETOUCH Verio Reflect®

Система контроля уровня глюкозы в крови  
(глюкометр) портативная УанТач Верิโอ Рефлект  
(OneTouch Verio Reflect®)

В комплект входят:

1. Глюкометр УанТач Верิโอ Рефлект (OneTouch Verio Reflect®) - 1 шт.
2. Тест-полоски УанТач Верิโอ (OneTouch Verio®) (10 шт. в уп.).
3. Ручка для прокалывания УанТач Делика Плюс (OneTouch® Delica® Plus) - 1 шт.
4. Ланцеты одноразовые УанТач Делика Плюс (OneTouch® Delica® Plus) (10 шт. в уп.).
5. Футляр - 1 шт.
6. Руководство пользователя на Систему контроля уровня глюкозы в крови (глюкометр) портативную УанТач Верิโอ Рефлект (OneTouch Verio Reflect®) - 1 шт.
7. Инструкция по применению на Тест-полоски УанТач Верิโอ (OneTouch Verio®) - 1 шт.




не использовать при отсутствии или нарушении целостности пломб.

# ONETOUCH Verio Reflect®

Система контроля уровня глюкозы в крови (глюкометр) портативная УанТач Верлио Рефлект (OneTouch Verio Reflect®)

Персональные советы и мотивирующие сообщения

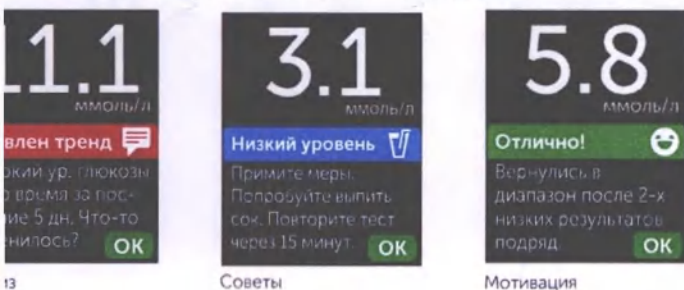

Сообщения функции Помощника Blood Sugar Mentor

**Динамический индикатор диапазона ColourSure®** позволяет мгновенно узнать, находится ли ваш результат в пределах диапазона и насколько он близок к верхней или нижней границе

**Plus - плюс.** Blood Sugar - глюкоза крови, Mentor - помощник.

**ColourSure® PLUS**

## Установите мобильное приложение ONETOUCH Reveal®



Позволяет взглянуть на результаты тестирования по-новому!

- Соединяется с глюкометром OneTouch Verio Reflect® с помощью Bluetooth®
- Собирает и сохраняет результаты автоматически
- Показывает данные в удобном формате
- Помогает принимать решения для управления диабетом

Доступно в магазинах приложений:



Мобильное устройство не входит в комплект.

Используется с тест-полосками OneTouch Verio® и контрольным раствором средней концентрации OneTouch Verio® (продаются отдельно).

Для диагностики *in vitro*. Для самотестирования. Ознакомьтесь с руководством пользователя. Для количественного измерения уровня глюкозы в цельной капиллярной крови. Пределы температуры хранения от 5 °C до 30 °C. Не хранить в холодильнике.

**ВНИМАНИЕ!** Содержит плоские круглые батарейки. Хранить в недоступном для детей месте.

Горячая линия OneTouch®: 8-800-200-83-53 (звонок по России бесплатный).  
Время работы: круглосуточно с 9:00 понедельника до 21:00 пятницы.

Пер. уд. №

ОТВЕТ  
ТРЕБОВА  
ГОСТ Р  
15197-

\*ГОСТ Р И  
для диагн  
Требован  
глюкозы в  
лечения с

(глюк

Состав

Уполномоч  
и Официаль  
в России:  
ООО «Лайф  
Российская  
г. Москва, ул  
д. 17, корп. 4

3 V  15 mA  
Производитель:  
«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»  
Губельштрассе 34  
6300 Цуг, Швейцария  
AW 07218801A



**ONETOUCH**  
Verio Reflect®

Глюкометр

[www.OneTouch.ru](http://www.OneTouch.ru)

**IVD**

Для диагностики *in vitro*.

Для самотестирования.

Ознакомьтесь с руководством  
пользователя



**CE**  
**0344**

Дата редакции макета: 02/2020  
© 2019-20 LifeScan IP Holdings, LLC  
AW 07218701B

**ONETOUCH**  
**Verio®**

### Тест-полоски

Для использования с системами контроля уровня глюкозы в крови (глюкометрами) серии OneTouch Verio® для количественного измерения уровня глюкозы (сахара) в свежих образцах цельной капиллярной крови, взятой из кончика пальца и венозной крови. Для диагностики in vitro. Для самотестирования. Хранить тест-полоски во флаконе. Немедленно закрывать крышку. Не использовать повторно. Пределы температуры хранения от 5 °C до 30 °C. НЕ хранить в холодильнике. Правильно утилизируйте использованные тест-полоски.

**10 тест-полосок**

CE  
0344



LOT



IVD




Производитель:  
«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»  
Губельштрассе 34  
6300 Цуг, Швейцария

Организация-изготовитель:  
«ЛайфСкан Скотланд Лтд.»  
Бичвуд Парк Норт, IV2 3ED Инвернесс  
Шотландия, Великобритания

Дата ред.: 03/2020  
© 2018-2020 LifeScan IP Holdings, LLC

AW 06977403A

После вскрытия флакона срок хранения тест-полосок составляет 6 месяцев (но не позднее окончания срока годности, указанного на упаковке) дата утилизации:

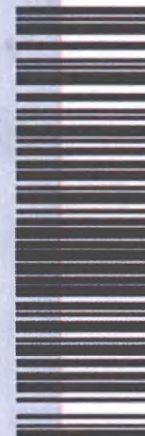

06977403A

perf

SEAL

## ONETOUCH® Delica® Plus

Ланцеты одноразовые УанТач Делика Плюс (OneTouch® Delica® Plus)

10 стерильных ланцетов

Для использования с Ручкой для прокалывания УанТач Делика Плюс (OneTouch® Delica® Plus) и Ручкой для прокалывания ВанТач Делика (OneTouch® Delica®)

Не использовать, если упаковка или защитная крышка отсутствует или повреждена. Только для одноразового использования. Не использовать повторно.

Горячая линия OneTouch®: 8-800-200-83-53  
(звонок по России бесплатный). Круглосуточно  
с 9:00 понедельника до 21:00 пятницы.

Посетите наш сайт [www.onetouch.ru](http://www.onetouch.ru)

Lifescan

0,32 мм

SEAL

perf

SEAL

Ланцеты одноразовые УанТач Делика Плюс (OneTouch® Delica® Plus)



CE  
1639

LOT



STERILE

Уполномоченный  
представитель в России:  
ООО «ЛайфСкан Раша»  
Российская Федерация  
121614, г. Москва  
ул. Крылатская, д. 17  
корп. 4, эт. 2, пом. I, ком. 2

Производитель:  
Asahi Polyslider Co., Ltd.  
860-2 Misaki, Maniwa  
Okayama 719-3226, Japan (Япония)

OneTouch®  
AW 07253701A  
© 2018-2020 LifeScan  
IP Holdings, LLC  
Дата ред.: 01/2020  
013-039

SEAL

Всего пронумеровано,  
прошнуровано и  
скреплено печатью  
18 листа (ов)

