

Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения антител класса IgG к токсоплазме иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "Тохо антитела IgG Калибраторы (Alinity i Toxo IgG Calibrators)"


(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Alinity i Toxo IgG Calibrators

Abbott


CONC
IU/mL

CAL A	1 x 3.0 mL	0.0
CAL B	1 x 3.0 mL	5.0
CAL C	1 x 3.0 mL	25.0
CAL D	1 x 3.0 mL	50.0
CAL E	1 x 3.0 mL	100.0
CAL F	1 x 3.0 mL	200.0



www.abbottdiagnostics.com/IFU

07P4501



2018-06-13




78444LI00

R01



G70650R02



(01) 00380740131234 (17) 180613
(10) 78444LI00 (240) 07P4501 (91) Toxo IgG



Фотографическое изображение упаковки и флаконов Тохо антитела IgG Калибраторы (Alinity i Toxo IgG Calibrators)



Фотографическое изображение флаконов Тохо антитела IgG Калибраторы (Alinity i Toxo IgG Calibrators)





Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

6/14006/ листов

Подпись



Макет маркировки на медицинское изделие

**Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения
антител класса IgG к токсоплазме иммунохемилюминесцентным методом в
сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i
"Тохо антитела IgG Калибраторы (Alinity i Toxo IgG Calibrators)"**



REF 07P45-01

IVD



Калибраторы для обеспечения правильности количественного определения антител класса IgG к токсоплазме иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i "Тохо антитела IgG Калибраторы (Alinity i Toxo IgG Calibrators)"

В составе:

- Калибратор А (Alinity i Toxo IgG Calibrator A) – 1 x 3,0 мл
- Калибратор В (Alinity i Toxo IgG Calibrator B) – 1 x 3,0 мл
- Калибратор С (Alinity i Toxo IgG Calibrator C) – 1 x 3,0 мл
- Калибратор D (Alinity i Toxo IgG Calibrator D) – 1 x 3,0 мл
- Калибратор E (Alinity i Toxo IgG Calibrator E) – 1 x 3,0 мл
- Калибратор F (Alinity i Toxo IgG Calibrator F) – 1 x 3,0 мл
- Инструкция по применению

Производитель: Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 65205, Wiesbaden, Germany (Германия) / РУ № ____/____ от ____/____/____

Инструкцию по применению на русском языке см: www.abbottdiagnostics.com/IFU
Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах.

Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

670650R02

LOT

EXP

REF 07P4501

www.abbottdiagnostics.com/IFU

! !

CONC	IU/mL	CAL
200.0	1 x 3.0 mL	CAL F
100.0	1 x 3.0 mL	CAL E
50.0	1 x 3.0 mL	CAL D
25.0	1 x 3.0 mL	CAL C
5.0	1 x 3.0 mL	CAL B
0.0	1 x 3.0 mL	CAL A

Alinity i Toxo IgG Calibrators

Abbott

Alinity i Toxo IgG Calibrators

Abbott

Abbott GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580

IVD




CE 0088


PRODUCT OF GERMANY

Toxo IgG Cals


2°C - 8°C

Макет маркировки каждого компонента медицинского изделия

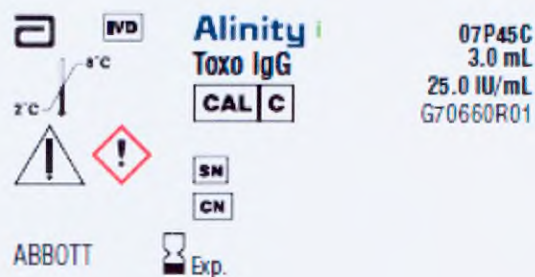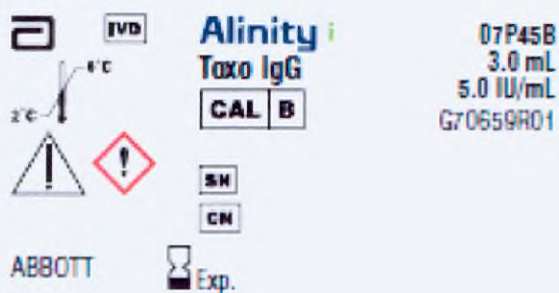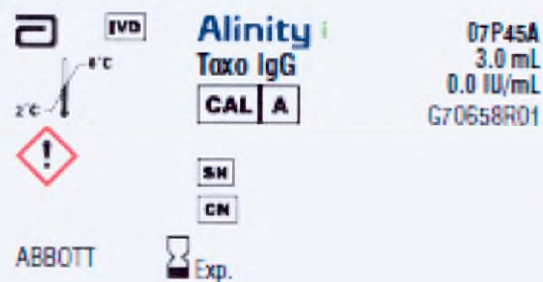


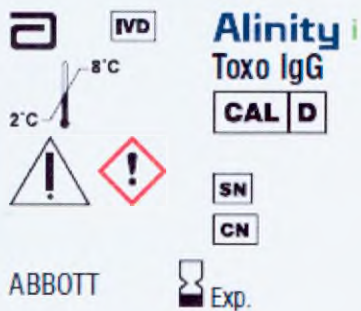

07P45D
3.0 mL
50.0 IU/mL
G70661R01

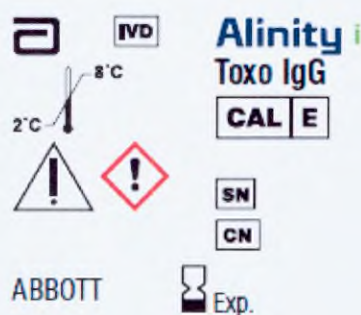

07P45E
3.0 mL
100.0 IU/mL
G70662R01

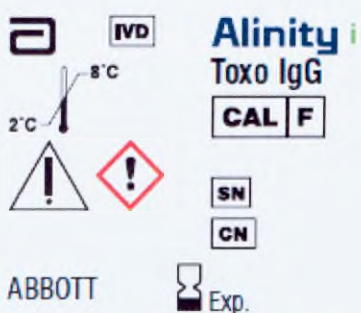

07P45F
3.0 mL
200.0 IU/mL
G70663R01

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 (Четыре) листов

Подпись

