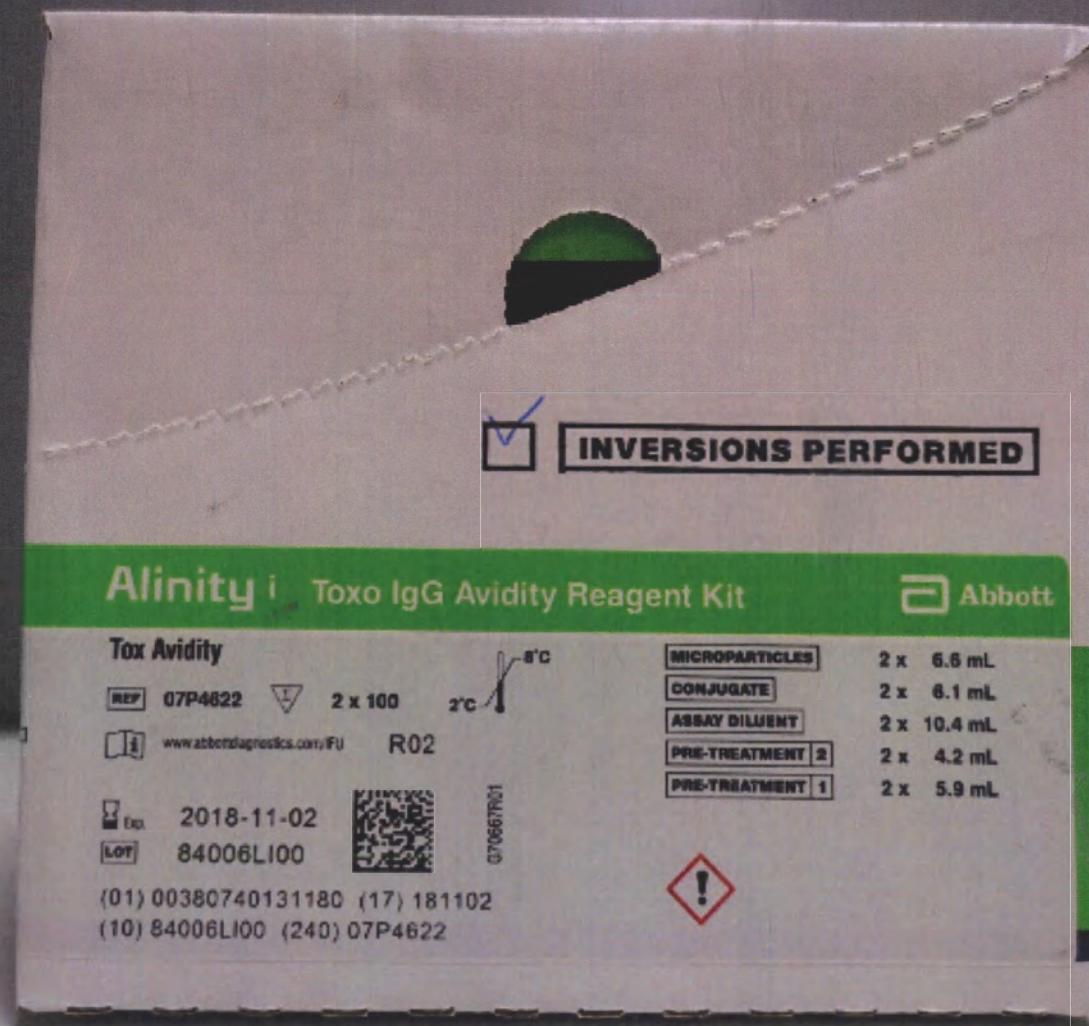


**Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие**

**Набор реагентов для определения авидности антител класса IgG к токсоплазме  
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на  
иммунохимических анализаторах Alinity i "Тохо авидность антител IgG Реагенты  
(Alinity i Toxo IgG Avidity Reagent Kit)"**

**(размером не менее 18 x 24 сантиметра)**









4.2 mL

**PRE-TREATMENT 2**

G70673R01

2°C 8°C

ABBOTT  
55255 Wiesbaden, Germany

**Alinity i**

G70674R01

00017

**Tox Avidity** <sup>2/2</sup>

Toto IgG Avidity

**PRE-TREATMENT 1** <sup>07P46</sup>  
<sup>IVD</sup>

5.9 mL

G70672R01

Exp. 2018-11-02  
LOT 84006L100

**Abbott**

всего прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью

6/Шесть листов

Подпись \_\_\_\_\_



## **Макет маркировки на медицинское изделие**

**Набор реагентов для определения авидности антител класса IgG к токсоплазме  
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на  
иммунохимических анализаторах Alinity i "Toxo Авидность антител IgG Реагенты  
(Alinity i Toxo IgG Avidity Reagent Kit)"**

**REF****07P46-22****IVD**

Набор реагентов для определения avidности антител класса IgG к токсоплазме иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i

**"Тохо avidность антител IgG Реагенты (Alinity i Toxo IgG Avidity Reagent Kit)"**

**2 набора картриджей по 100 тестов в составе:**

- Микрочастицы (Alinity i Toxo IgG Avidity Microparticles) – 2 x 6,6 мл
- Конъюгат (Alinity i Toxo IgG Avidity Conjugate) – 2 x 6,1 мл
- Дилуент теста (Alinity i Toxo IgG Avidity Assay Diluent) – 2 x 10,4 мл
- Реагент предварительной обработки 1 (Alinity i Toxo IgG Avidity Pre-Treatment 1) – 2 x 5,9 мл
- Реагент предварительной обработки 2 (Alinity i Toxo IgG Avidity Pre-Treatment 2) – 2 x 4,2 мл
- Инструкция по применению

**Производитель:** Abbott GmbH & Co. KG, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия) / РУ № \_\_\_\_ / \_\_\_\_ от \_\_\_\_.

Инструкцию по применению на русском языке: [www.abbottdiagnostics.com/IFU](http://www.abbottdiagnostics.com/IFU)


Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах.

Расшифровку графических символов см. в инструкции.

**Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:**

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

**Tox Avidity****Alinity i Toxo IgG Avidity Reagent Kit**

Abbott GmbH & Co. KG  
Max-Planck-Ring 2  
65205 Wiesbaden  
Germany  
+49 5122-580

**Tox Avidity****REF 07P4622****2 x 100** [www.abbottdiagnostics.com/IFU](http://www.abbottdiagnostics.com/IFU)


CF706627R01

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| MICROPARTICLES  | 2 x 6.6 mL  |
| CONJUGATE       | 2 x 6.1 mL  |
| ASSAY DILUENT   | 2 x 10.4 mL |
| PRE-TREATMENT 2 | 2 x 4.2 mL  |
| PRE-TREATMENT 1 | 2 x 5.9 mL  |



PRODUCT OF GERMANY

Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>MICROPARTICLES</b></p> <p>6.6 mL</p>  <p>G70669R01</p>  <p>ABBOTT<br/>65205 Wiesbaden, Germany</p> |  <p><b>CONJUGATE</b></p> <p>6.1 mL</p> <p>G70670R01</p> <p>SN</p> | <p><b>Tox Avidity</b> <sup>1/2</sup></p> <hr/> <p>Toxo IgG Avidity</p> <p><b>ASSAY DILUENT</b> <span style="float: right;">07P46<br/>IVD</span></p> <p>10.4 mL</p>  <p>G70671R01</p> <p>Exp.<br/>LOT</p> <p><b>Abbott</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>PRE-TREATMENT 2</b></p> <p>4.2 mL</p>  <p>G70673R01</p>  <p>ABBOTT<br/>65205 Wiesbaden, Germany</p> |  <p>G70674R01</p> <p>SN</p> | <p><b>Tox Avidity</b> <sup>2/2</sup></p> <hr/> <p>Toxo IgG Avidity</p> <p><b>PRE-TREATMENT 1</b> <span style="float: right;">07P46<br/>IVD</span></p> <p>5.9 mL</p>  <p>G70672R01</p> <p>Exp.<br/>LOT</p> <p><b>Abbott</b></p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

3 (три) листов

Подпись \_\_\_\_\_

*sa*  
*Иль*