

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»


М.Д. Хусаинов
« 05 » 08 2020 г.



Образцы маркировки на Набор реагентов для иммунохемилюминесцентного определения концентрации опухолевого маркера СА-125 в сыворотке крови для автоматического ИХЛА-анализатора «Люминит» (Luminite) «СА-125-Люминит»

1. Образцы этикеток на компоненты набора «СА-125-Люминит»

Наименование компонента	Этикетка
Штатив с двухмерным штрих-кодом с реагентами	
Магнитные микрочастицы с иммобилизованными моноклональными антителами к СА-125	
Калибровочный образец (КО)	
Раствор для разведения сывороток (PPC)	
Конъюгат	

Наименование компонента	Этикетка
Раствор для разведения сывороток (PPC)	
Контрольный образец 1 (K1)	
Контрольный образец 2 (K2)	

2. Образцы этикеток на коробке набора «СА-125-Люминит»

2.1. Верхняя этикетка.

REF X-XXXX набор реагентов для иммунохемилюминесцентного определения концентрации опухолевого маркера СА-125 в сыворотке крови для автоматического ИХЛА-анализатора "Люминит" (Luminite)																									
СА-125-Люминит																									
LOT XXXX	Состав: <table border="0"> <tr> <td>1. Штатив с двухмерным штрих-кодом с реагентами:</td> <td>2 шт.</td> <td> LOT XXXX</td> </tr> <tr> <td>Магнитные микрочастицы с иммобилизованными моноклональными антителами к СА-125</td> <td>1 фл. 3,7 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>Калибровочный образец</td> <td>2 фл. по 2,5 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>Раствор для разведения сывороток</td> <td>1 фл. 13,0 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>Конъюгат</td> <td>1 фл. 6,0 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>2. Раствор для разведения сывороток</td> <td>2 фл. по 12,0 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>3. Контрольный образец 1</td> <td>2 проб. по 2,5 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>4. Контрольный образец 2</td> <td>2 проб. по 2,5 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> </table>	1. Штатив с двухмерным штрих-кодом с реагентами:	2 шт.	LOT XXXX	Магнитные микрочастицы с иммобилизованными моноклональными антителами к СА-125	1 фл. 3,7 мл	XXXX	Калибровочный образец	2 фл. по 2,5 мл	XXXX	Раствор для разведения сывороток	1 фл. 13,0 мл	XXXX	Конъюгат	1 фл. 6,0 мл	XXXX	2. Раствор для разведения сывороток	2 фл. по 12,0 мл	XXXX	3. Контрольный образец 1	2 проб. по 2,5 мл	XXXX	4. Контрольный образец 2	2 проб. по 2,5 мл	XXXX
1. Штатив с двухмерным штрих-кодом с реагентами:	2 шт.	LOT XXXX																							
Магнитные микрочастицы с иммобилизованными моноклональными антителами к СА-125	1 фл. 3,7 мл	XXXX																							
Калибровочный образец	2 фл. по 2,5 мл	XXXX																							
Раствор для разведения сывороток	1 фл. 13,0 мл	XXXX																							
Конъюгат	1 фл. 6,0 мл	XXXX																							
2. Раствор для разведения сывороток	2 фл. по 12,0 мл	XXXX																							
3. Контрольный образец 1	2 проб. по 2,5 мл	XXXX																							
4. Контрольный образец 2	2 проб. по 2,5 мл	XXXX																							

2.2. Боковая этикетка № 1.


REF	X-XXXX	Σ 108	LOT	XXXX
ТУ 21.20.23-105-23548172-2020 ПУ №			XXXX-XX-XX XXXX-XX-XX	
СА-125-Люминит				
IVD				
			 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
<i>Антитела к ВИЧ-1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют</i>				

2.3. Боковая этикетка № 2.

АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211
тел/факс: (383) 332-67-49, 332-67-52
E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Примечание. Текст боковой этикетки № 2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом.

«СОГЛАСОВАНО»
Директор НИИСД
АО «Вектор-Бест»



М.Ю. Рукавишников
«05» 08 2020 г.

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 3 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"




А.В. Масяго

2020 г.


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 "СА-125-Люминит"
 серия 1

Генеральный директор
 АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
 "18" 08/ 2020 г.

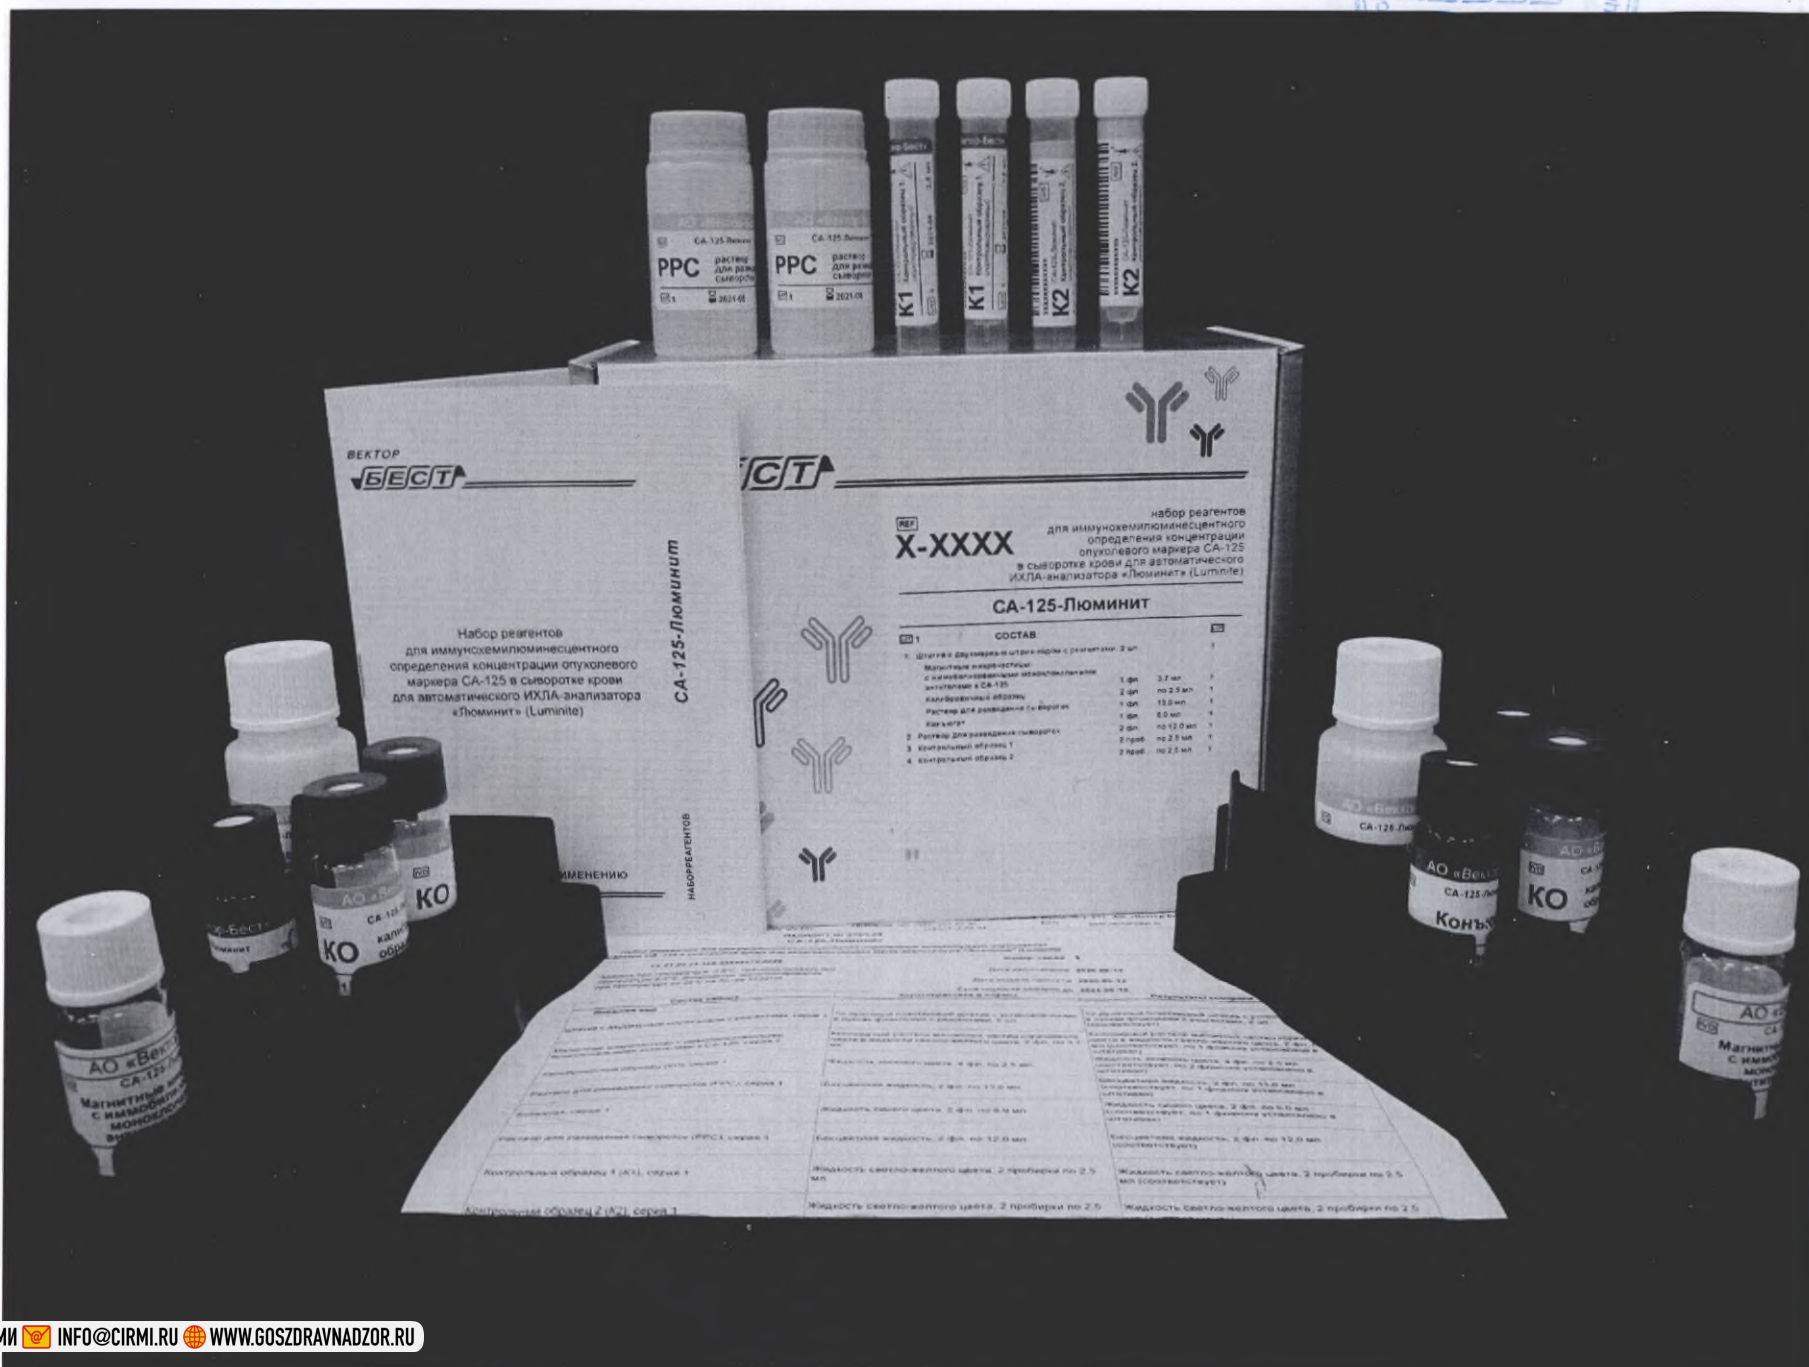


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"СА-125-Люминит" № 1
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"15" 08/2020 г.

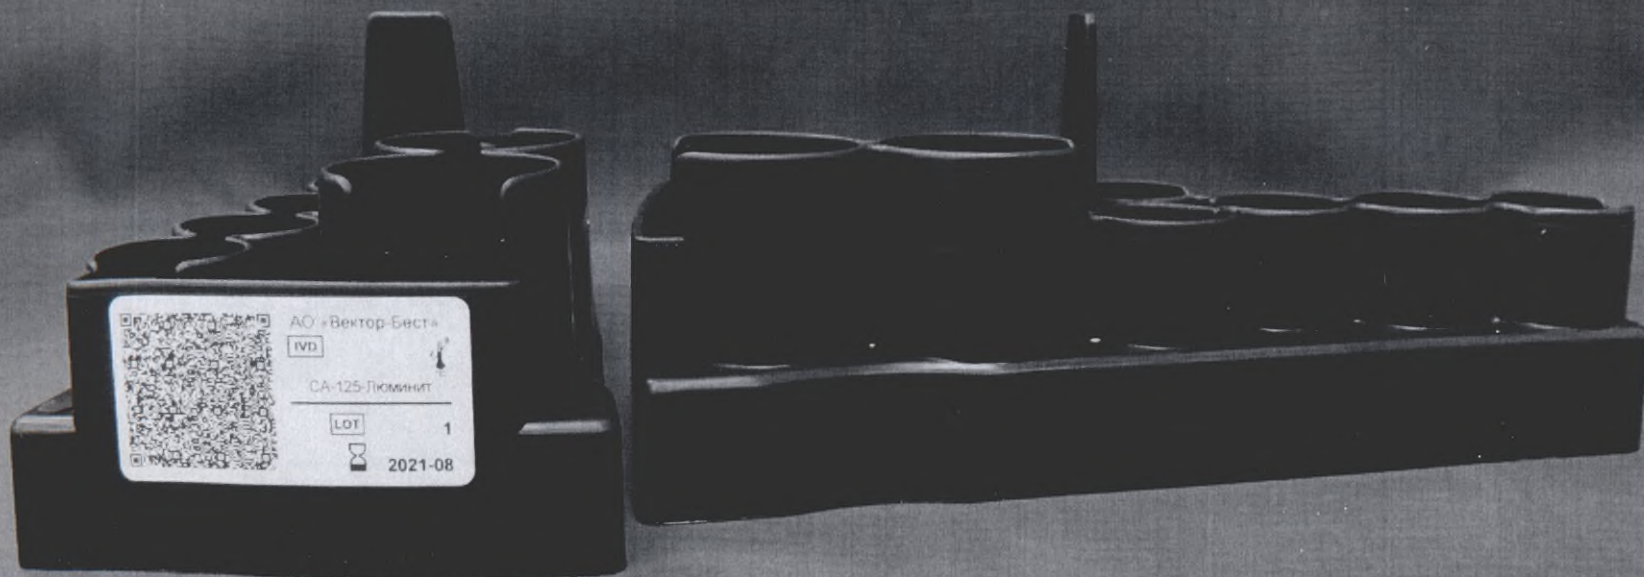

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"СА-125-Люминит" № 2
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"12" 08 2020 г.

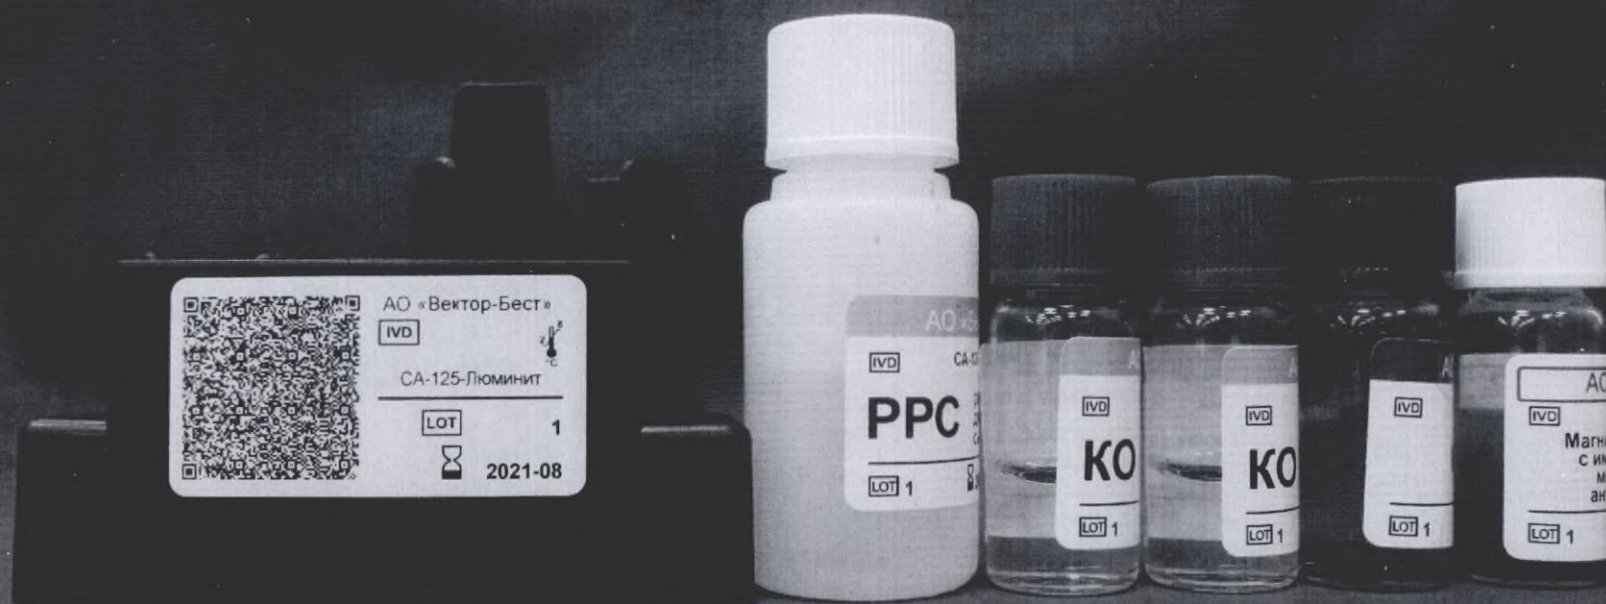

фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"СА-125-Люминит" № 3
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов




12.08.2020 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"СА-125-Люминит" № 4
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"12.08" 2020 г.

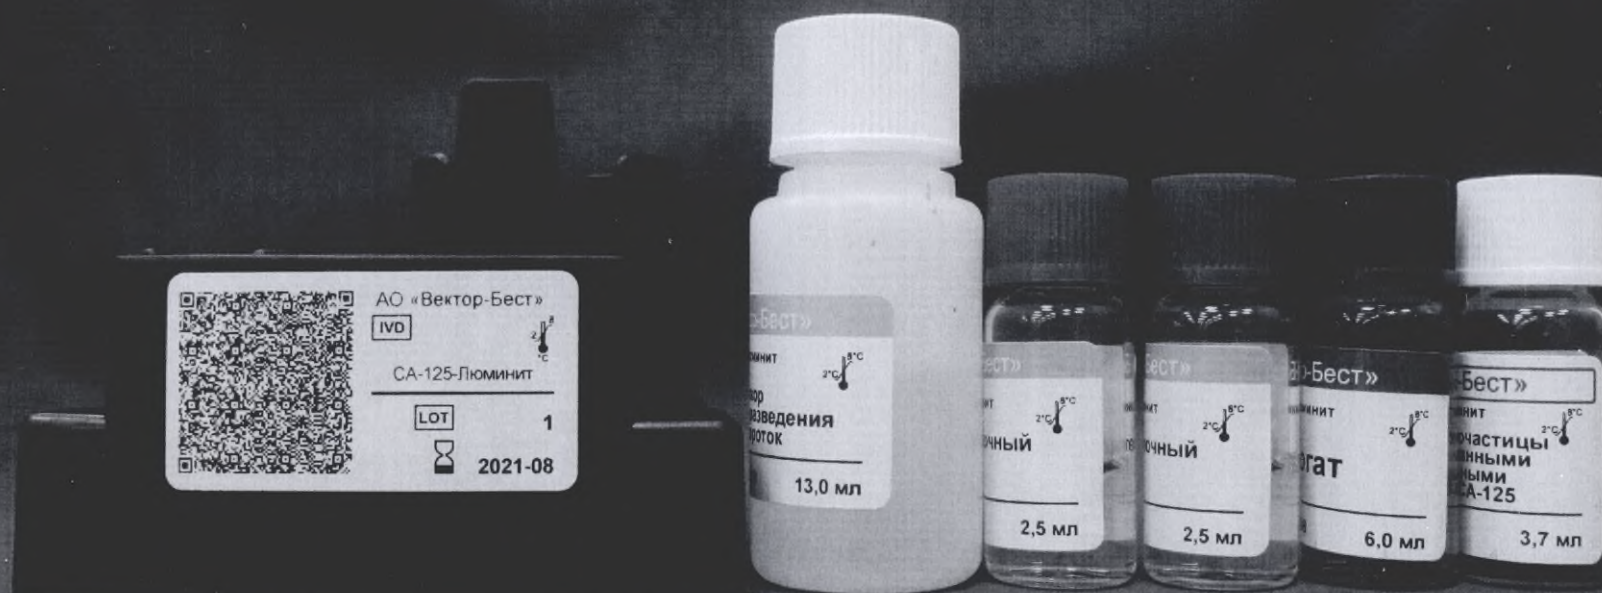

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"СА-125-Люминит" № 5
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
08/ 2020 г.





2020 г.




фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"СА-125-Люминит" № 7
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"



М.Д. Хусаинов
"12" 08/ 2020 г.

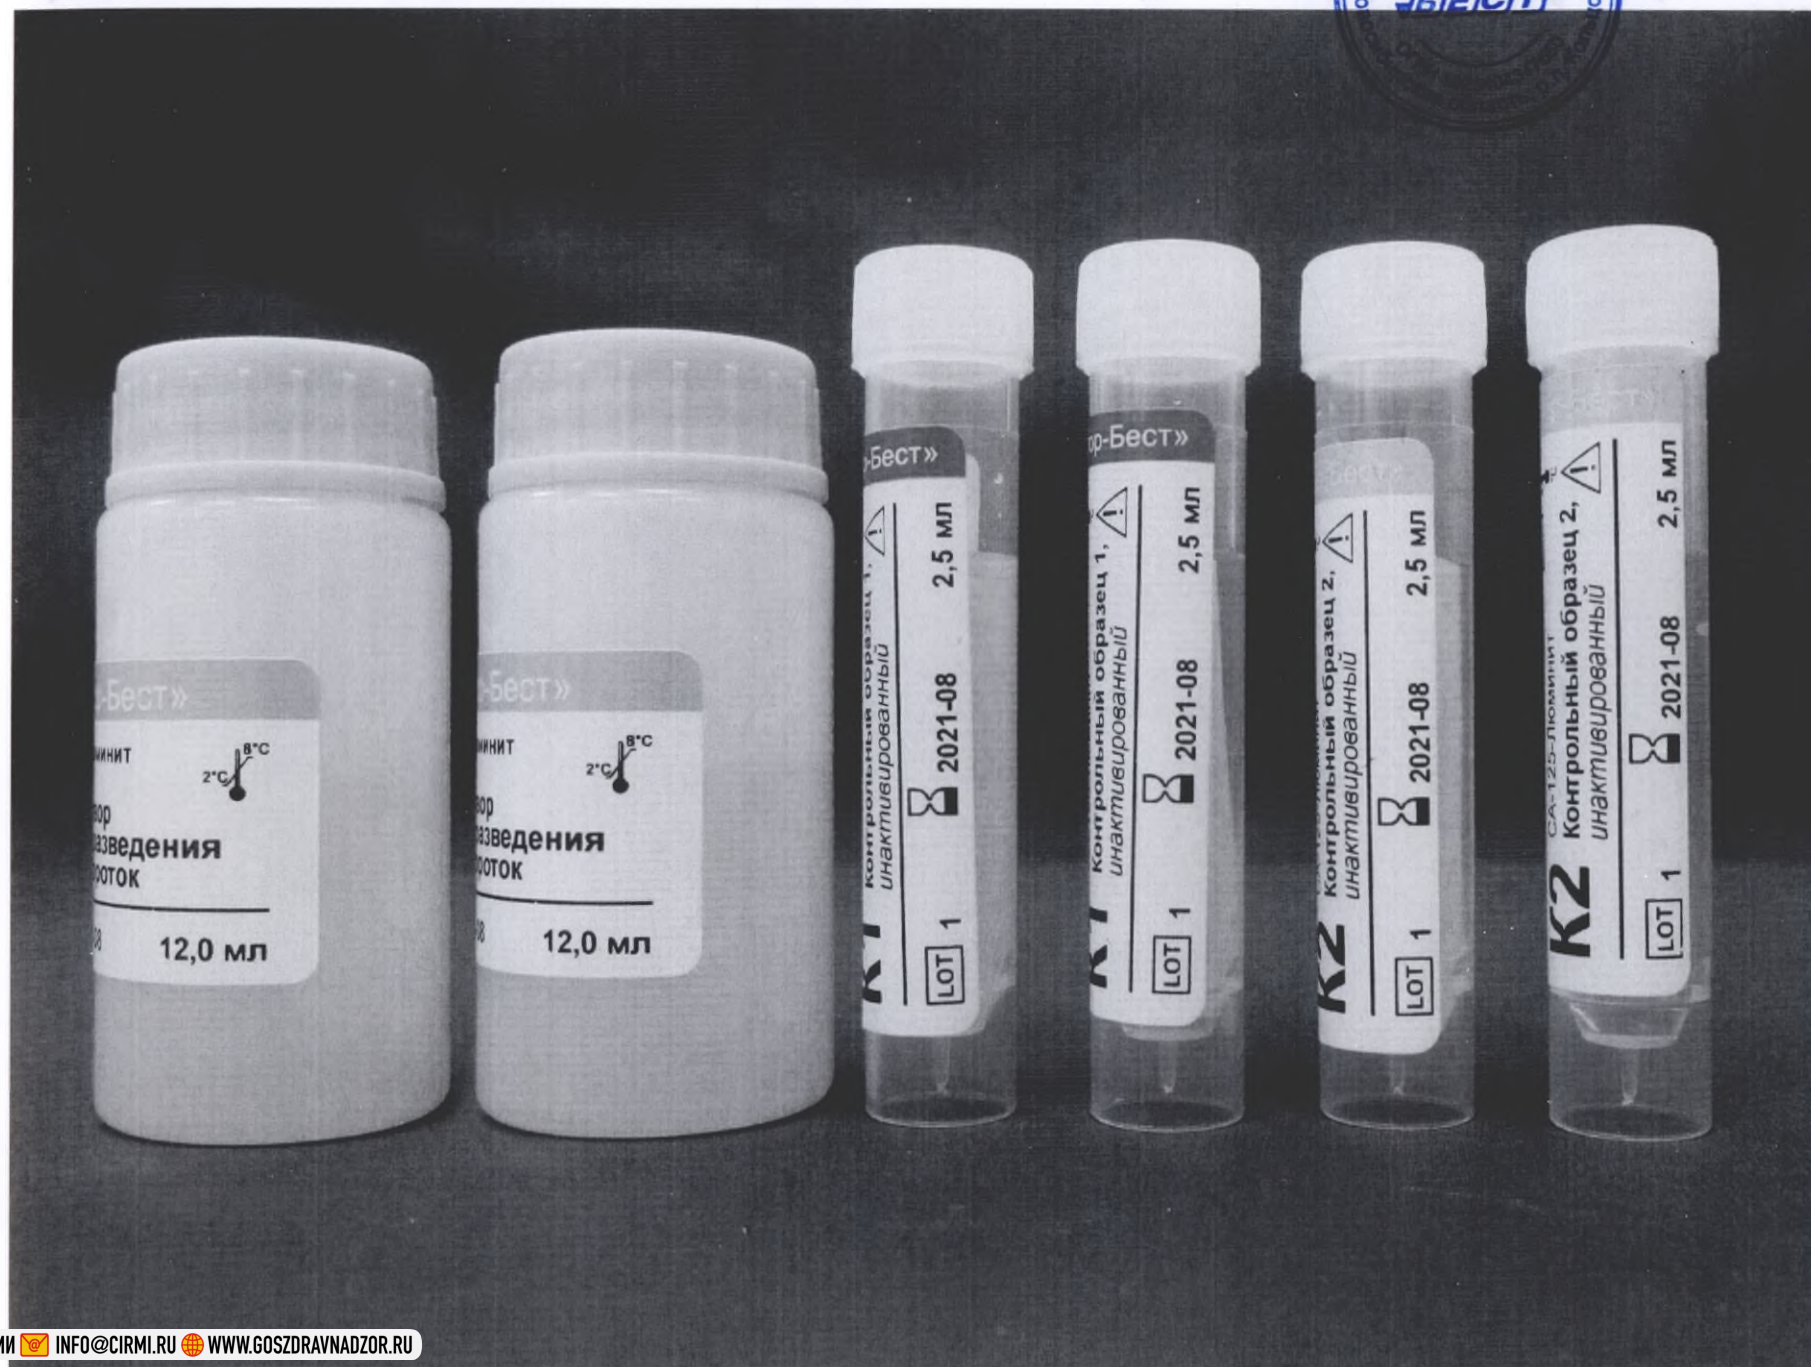

ВЕКТОР
БЕСТ

REF

X-XXXX

набор реагентов
для иммунохемилюминесцентного
определения концентрации
опухолевого маркера СА-125
в сыворотке крови для автоматического
ИХЛА-анализатора «Люминит» (Luminite)

СА-125-Люминит

LOT 1

СОСТАВ:

LOT

1. Штатив с двумерным штрих-кодом с реагентами: 2 шт.			1
Магнитные микрочастицы с иммобилизованными моноклональными антителами к СА-125	1 фл.	3,7 мл	1
Калибровочный образец	2 фл.	по 2,5 мл	1
Раствор для разведения сывороток	1 фл.	13,0 мл	1
Конъюгат	1 фл.	6,0 мл	1
2. Раствор для разведения сывороток	2 фл.	по 12,0 мл	1
3. Контрольный образец 1	2 проб.	по 2,5 мл	1
4. Контрольный образец 2	2 проб.	по 2,5 мл	1

фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"СА-125-Люминит" № 2
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
12.08.2020 г.

ВЕКТОР

БЕСТ

REF X-XXXX

Σ 108

LOT

1

ТУ 21.20.23-105-23548172-2020

РУ №

2020-08-12

2021-08-12

СА-125-Люминит

IVD




XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов
2020 г.



Графическое изображение упаковки медицинского изделия
«СА-125-Люминит» № 3
серия 1




АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52


E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 "СА-125-Люминит"
 серия 2

Генеральный директор
 АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
 "12" 08 2020 г.

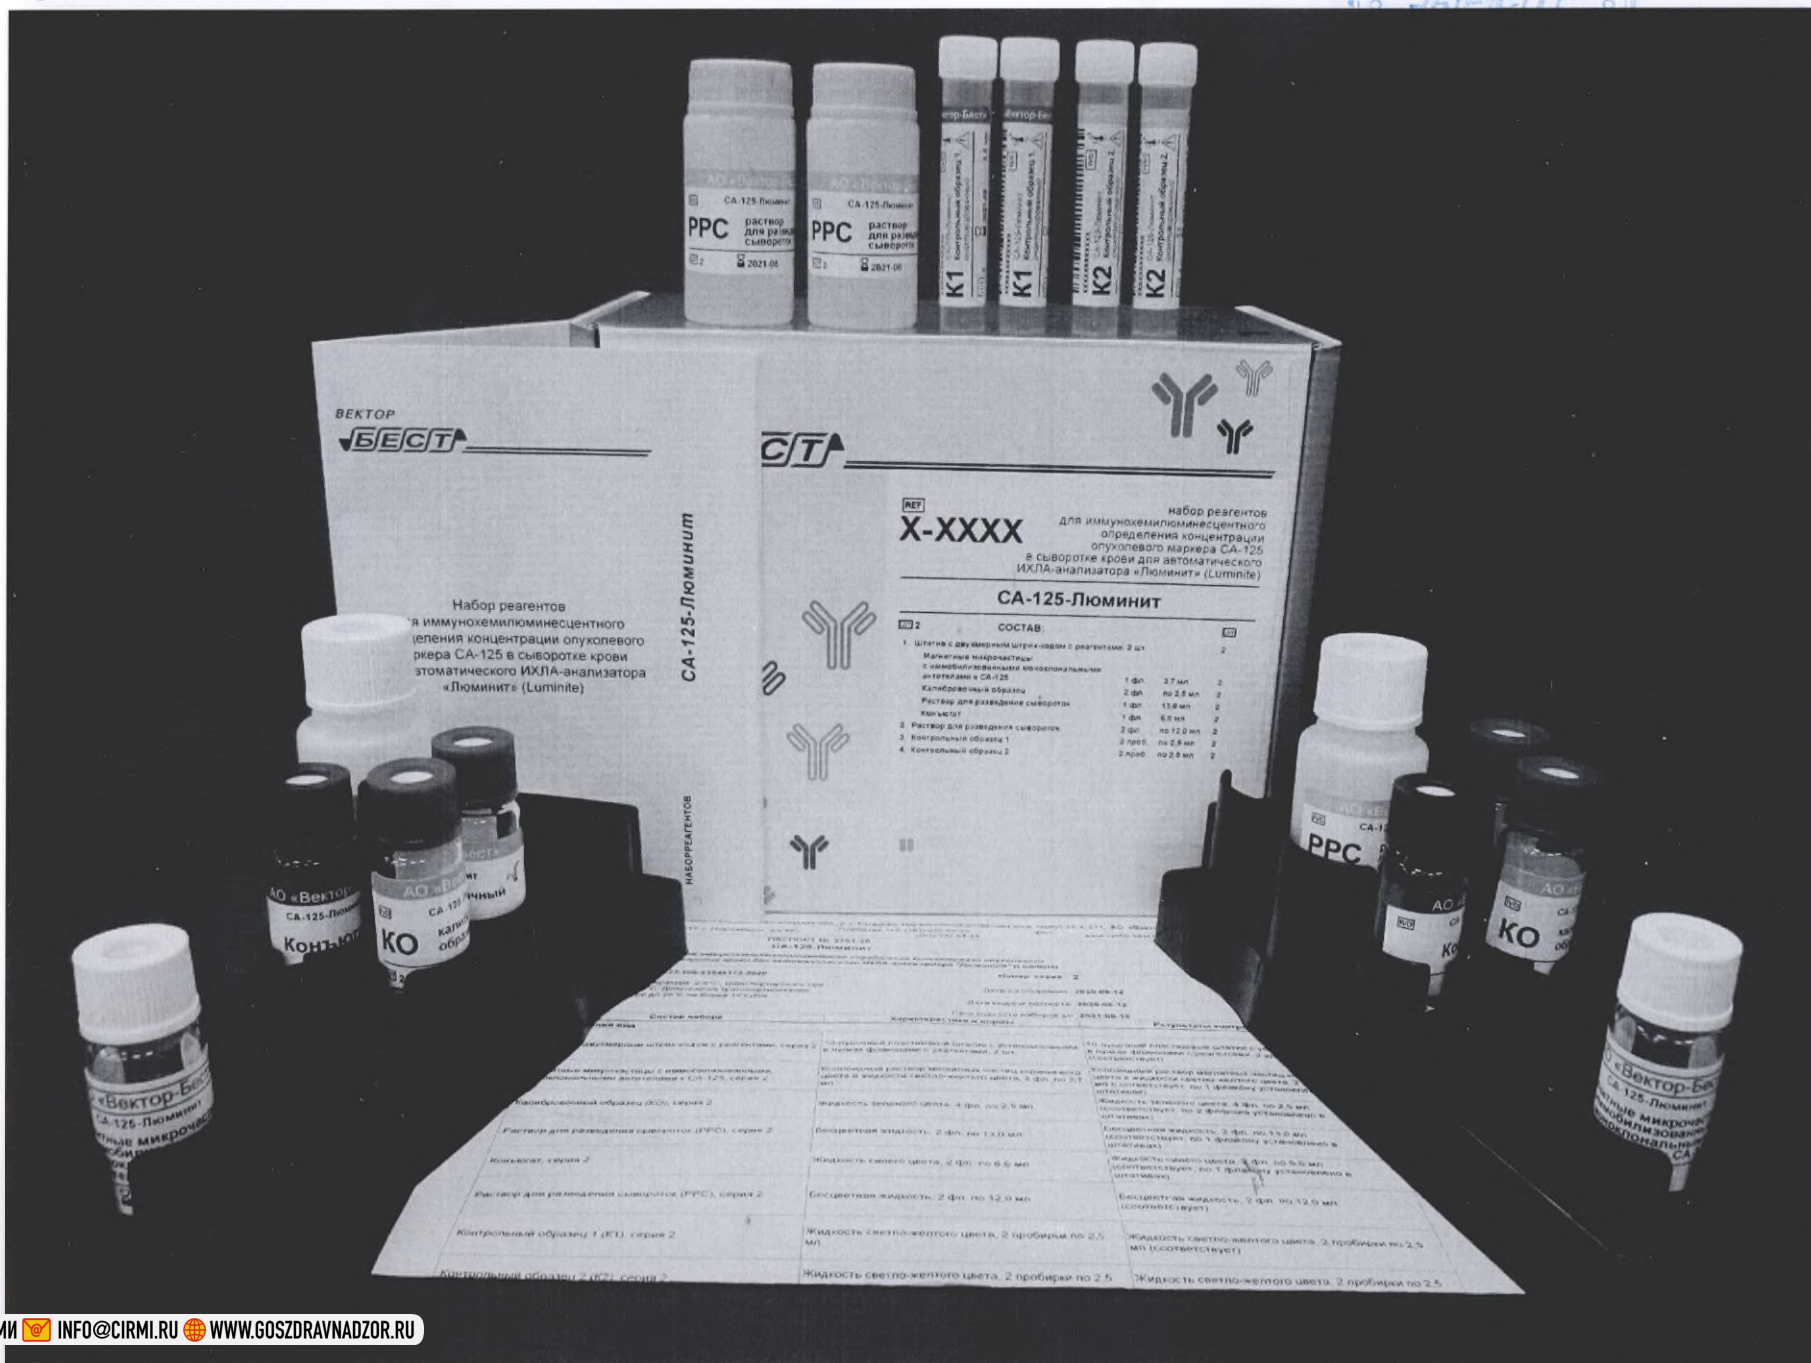


фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"СА-125-Люминит" № 1
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"  М.Д. Хусаинов
"12" 08 2020 г.

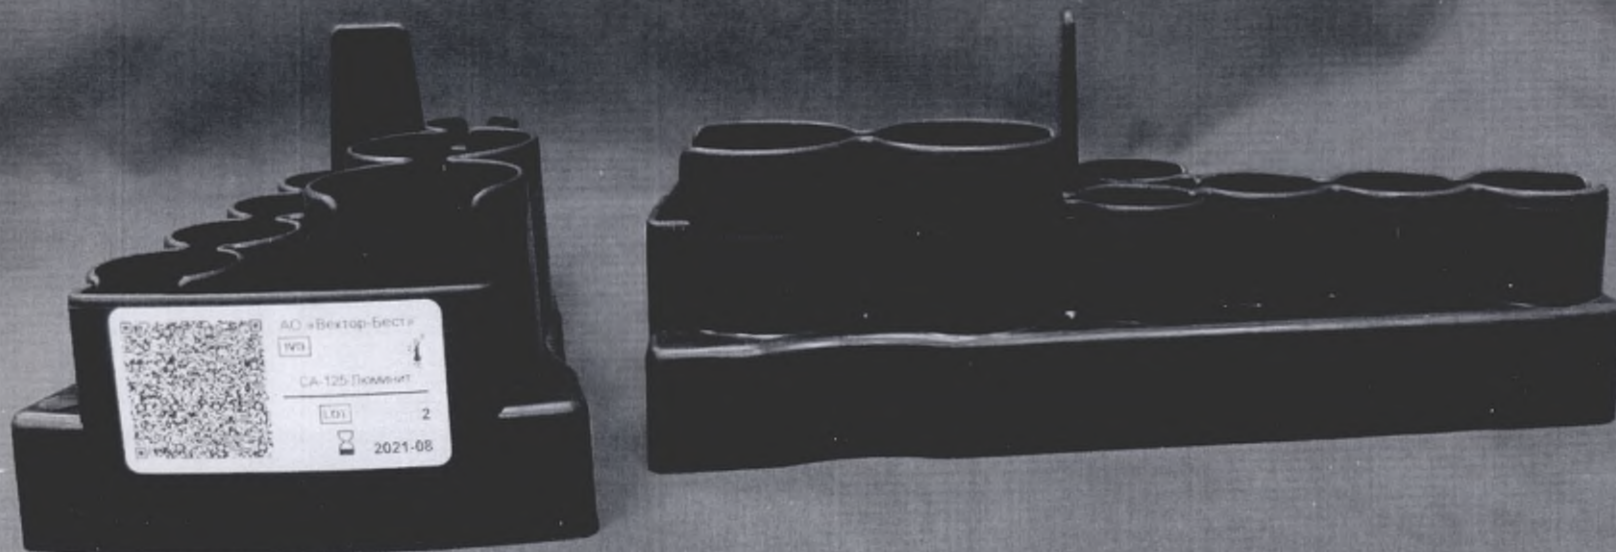



фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"СА-125-Люминит" № 2
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"12" 08 2020 г.

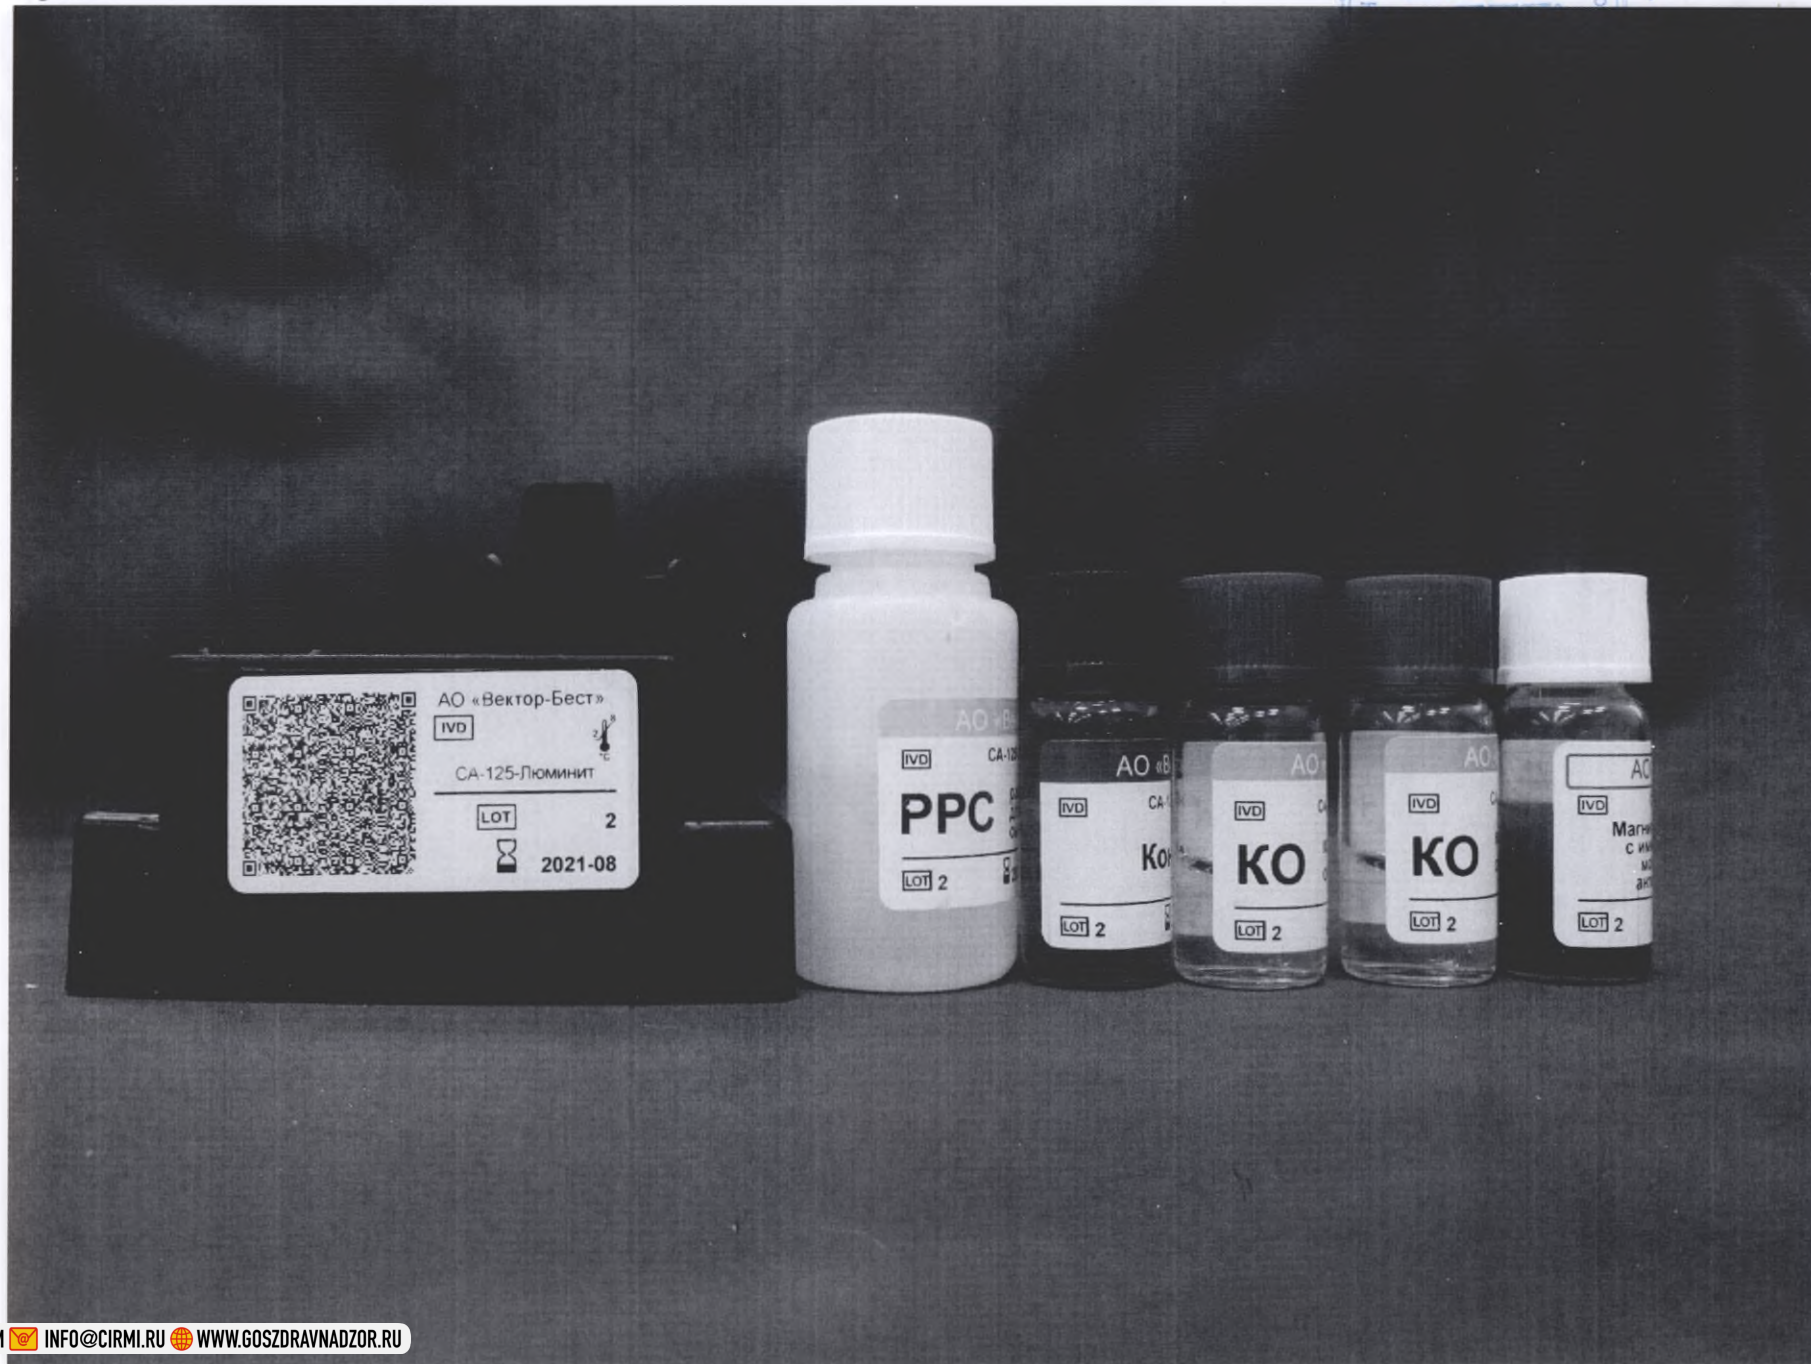


Графическое изображение компонентов медицинского изделия
"СА-125-Люминит" № 3
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"  М.Д. Хусаинов
"18" 08 2020 г.

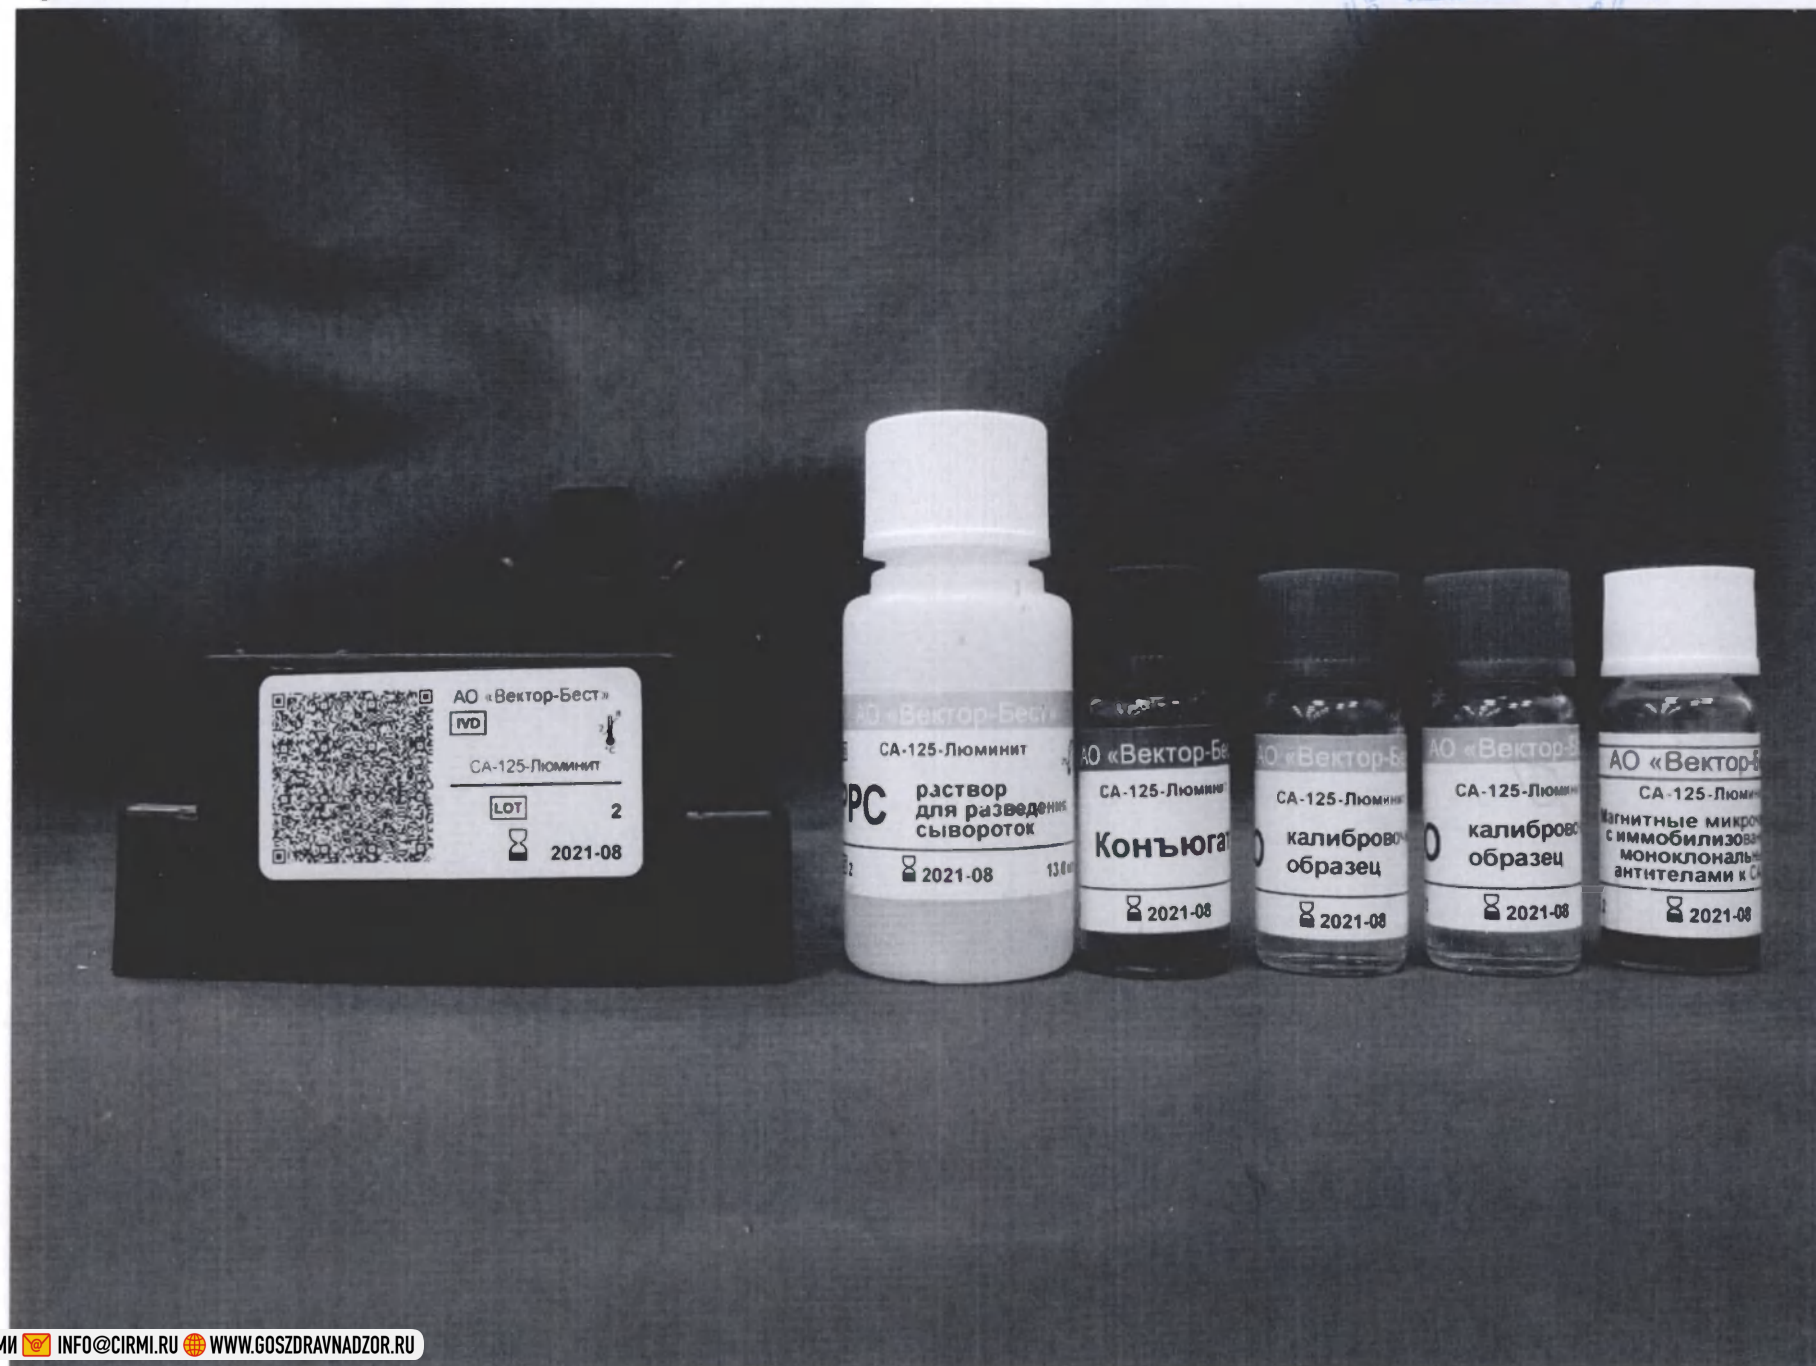


фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«СА-125-Люминит» № 4
серия 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
«12» 08 2020 г.

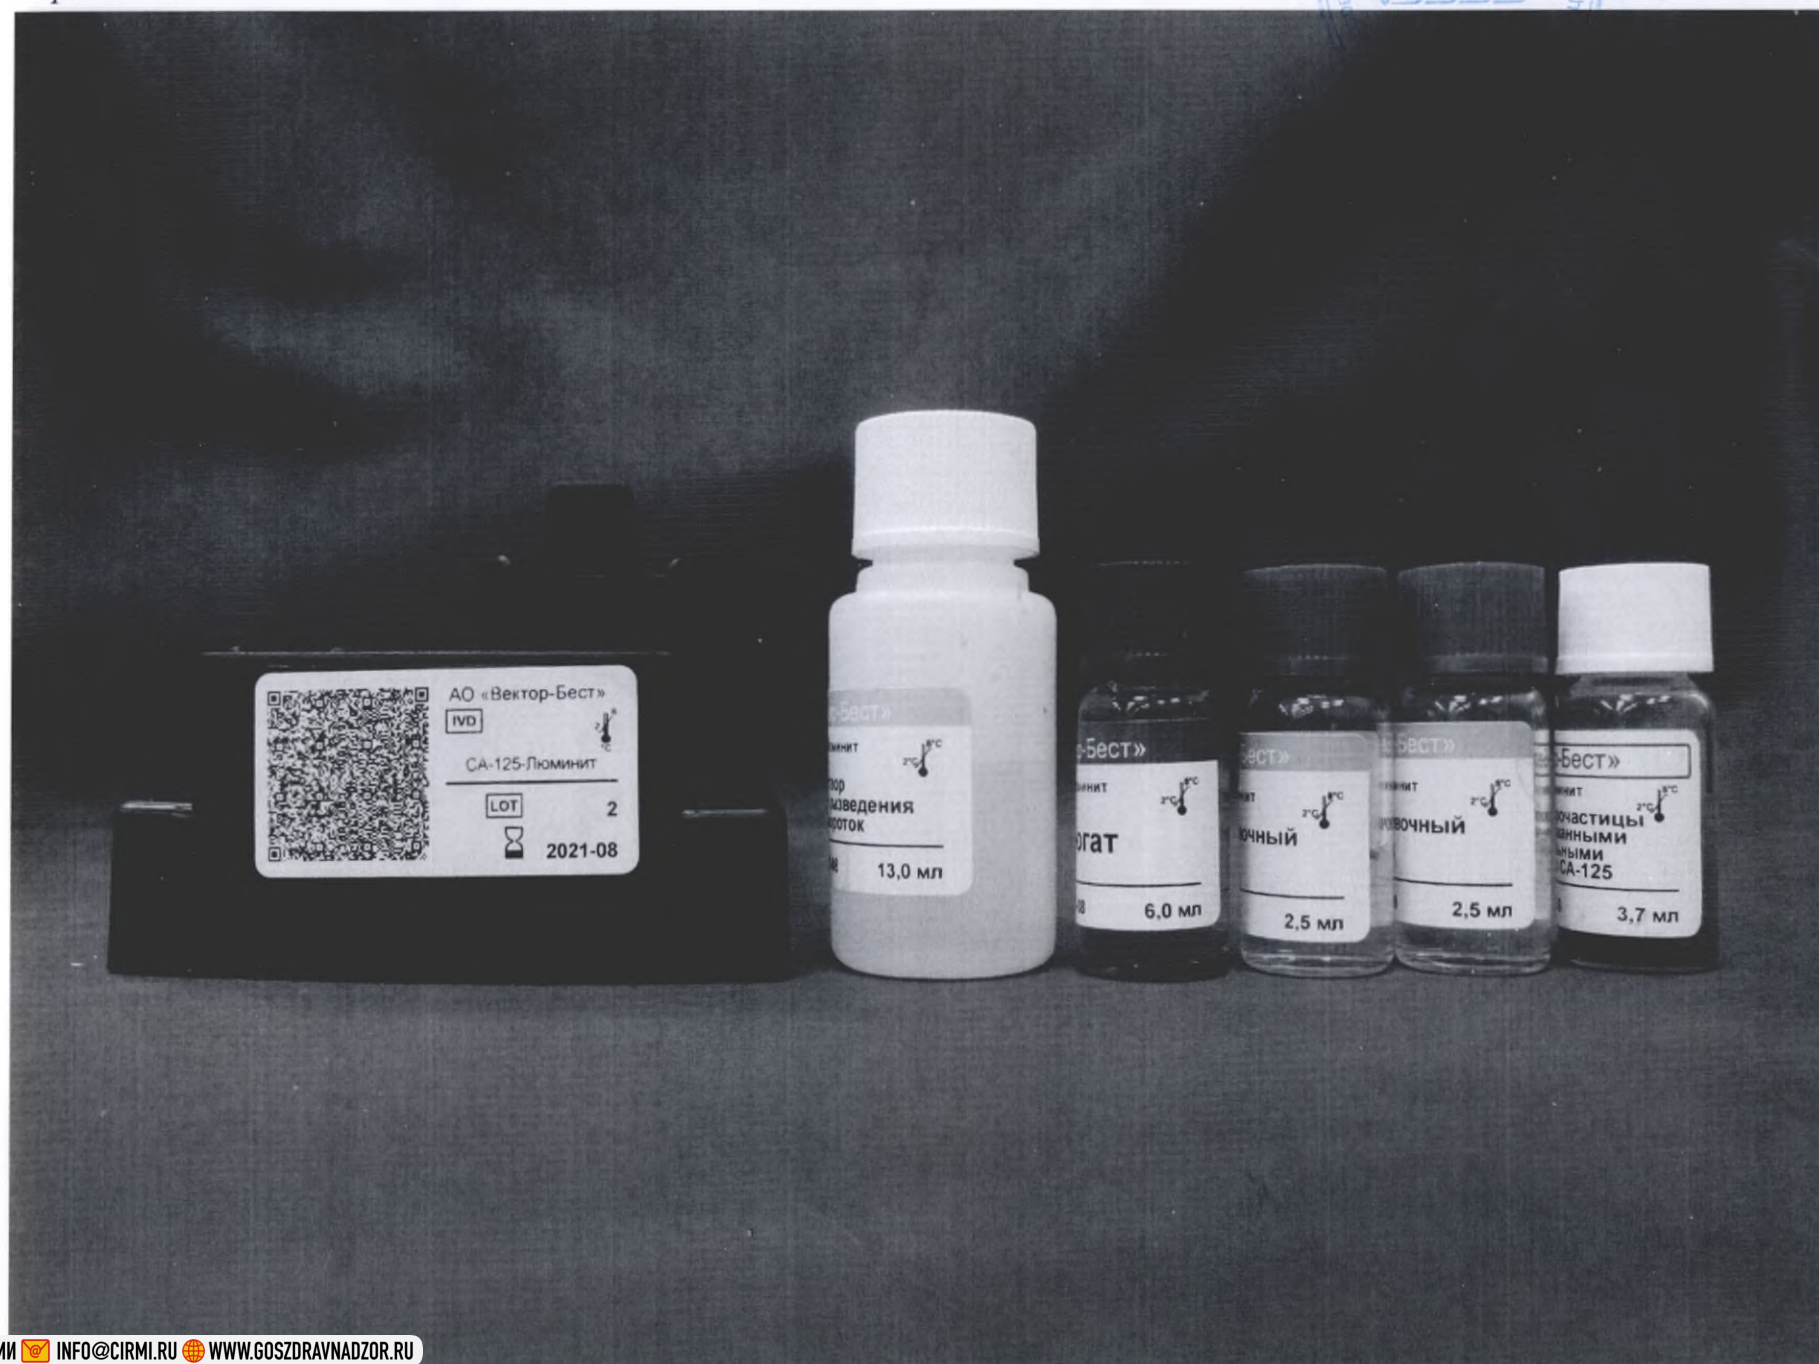

Графическое изображение компонентов медицинского изделия
"СА-125-Люминит" № 5
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"12" 08/2020 г.

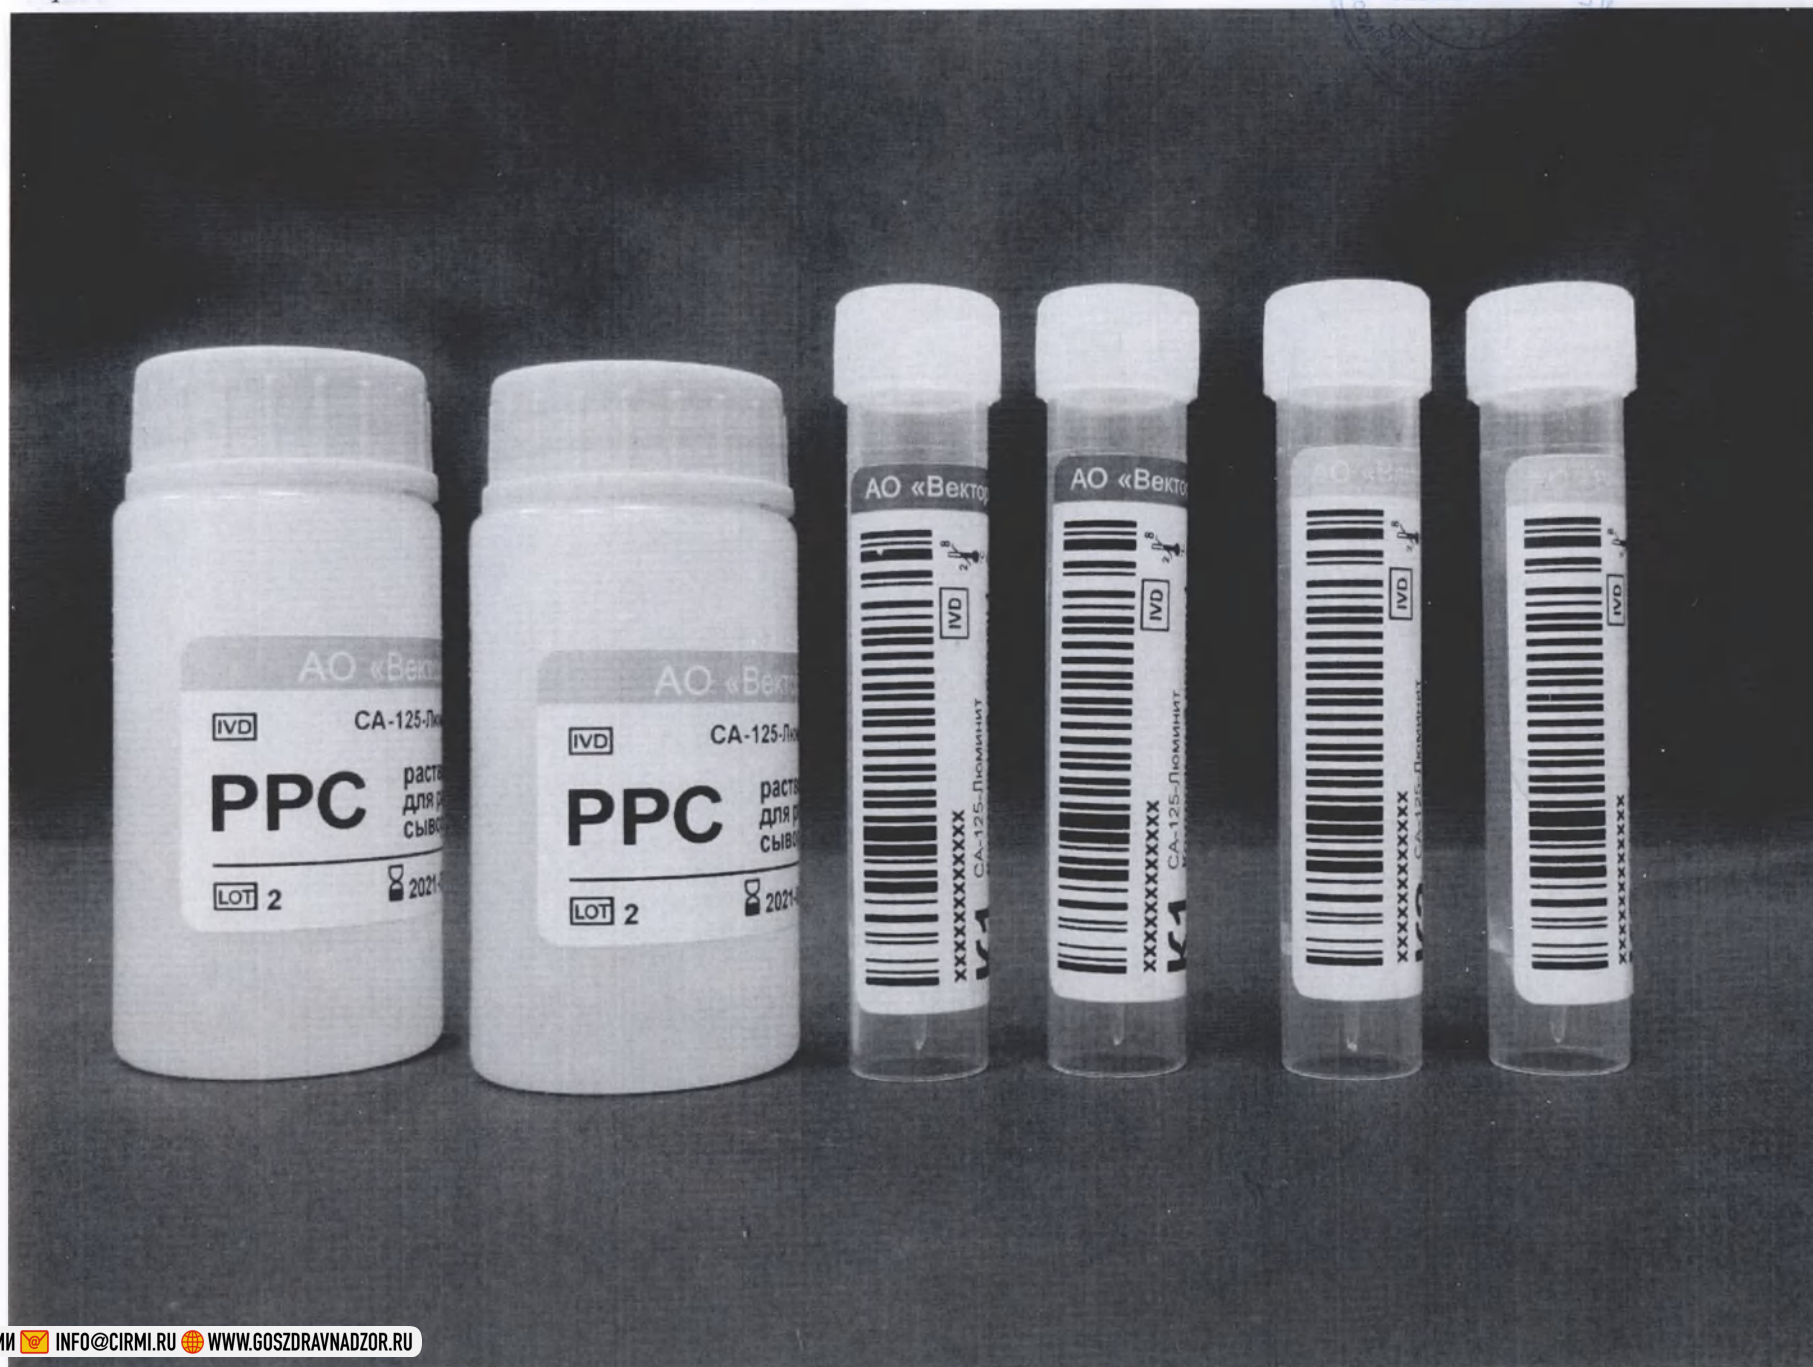


Графическое изображение компонентов медицинского изделия
"СА-125-Люминит" № 6
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"12" 08 2020 г.



фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"СА-125-Люминит" № 7
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор" М.Д. Хусаинов
2020 г.

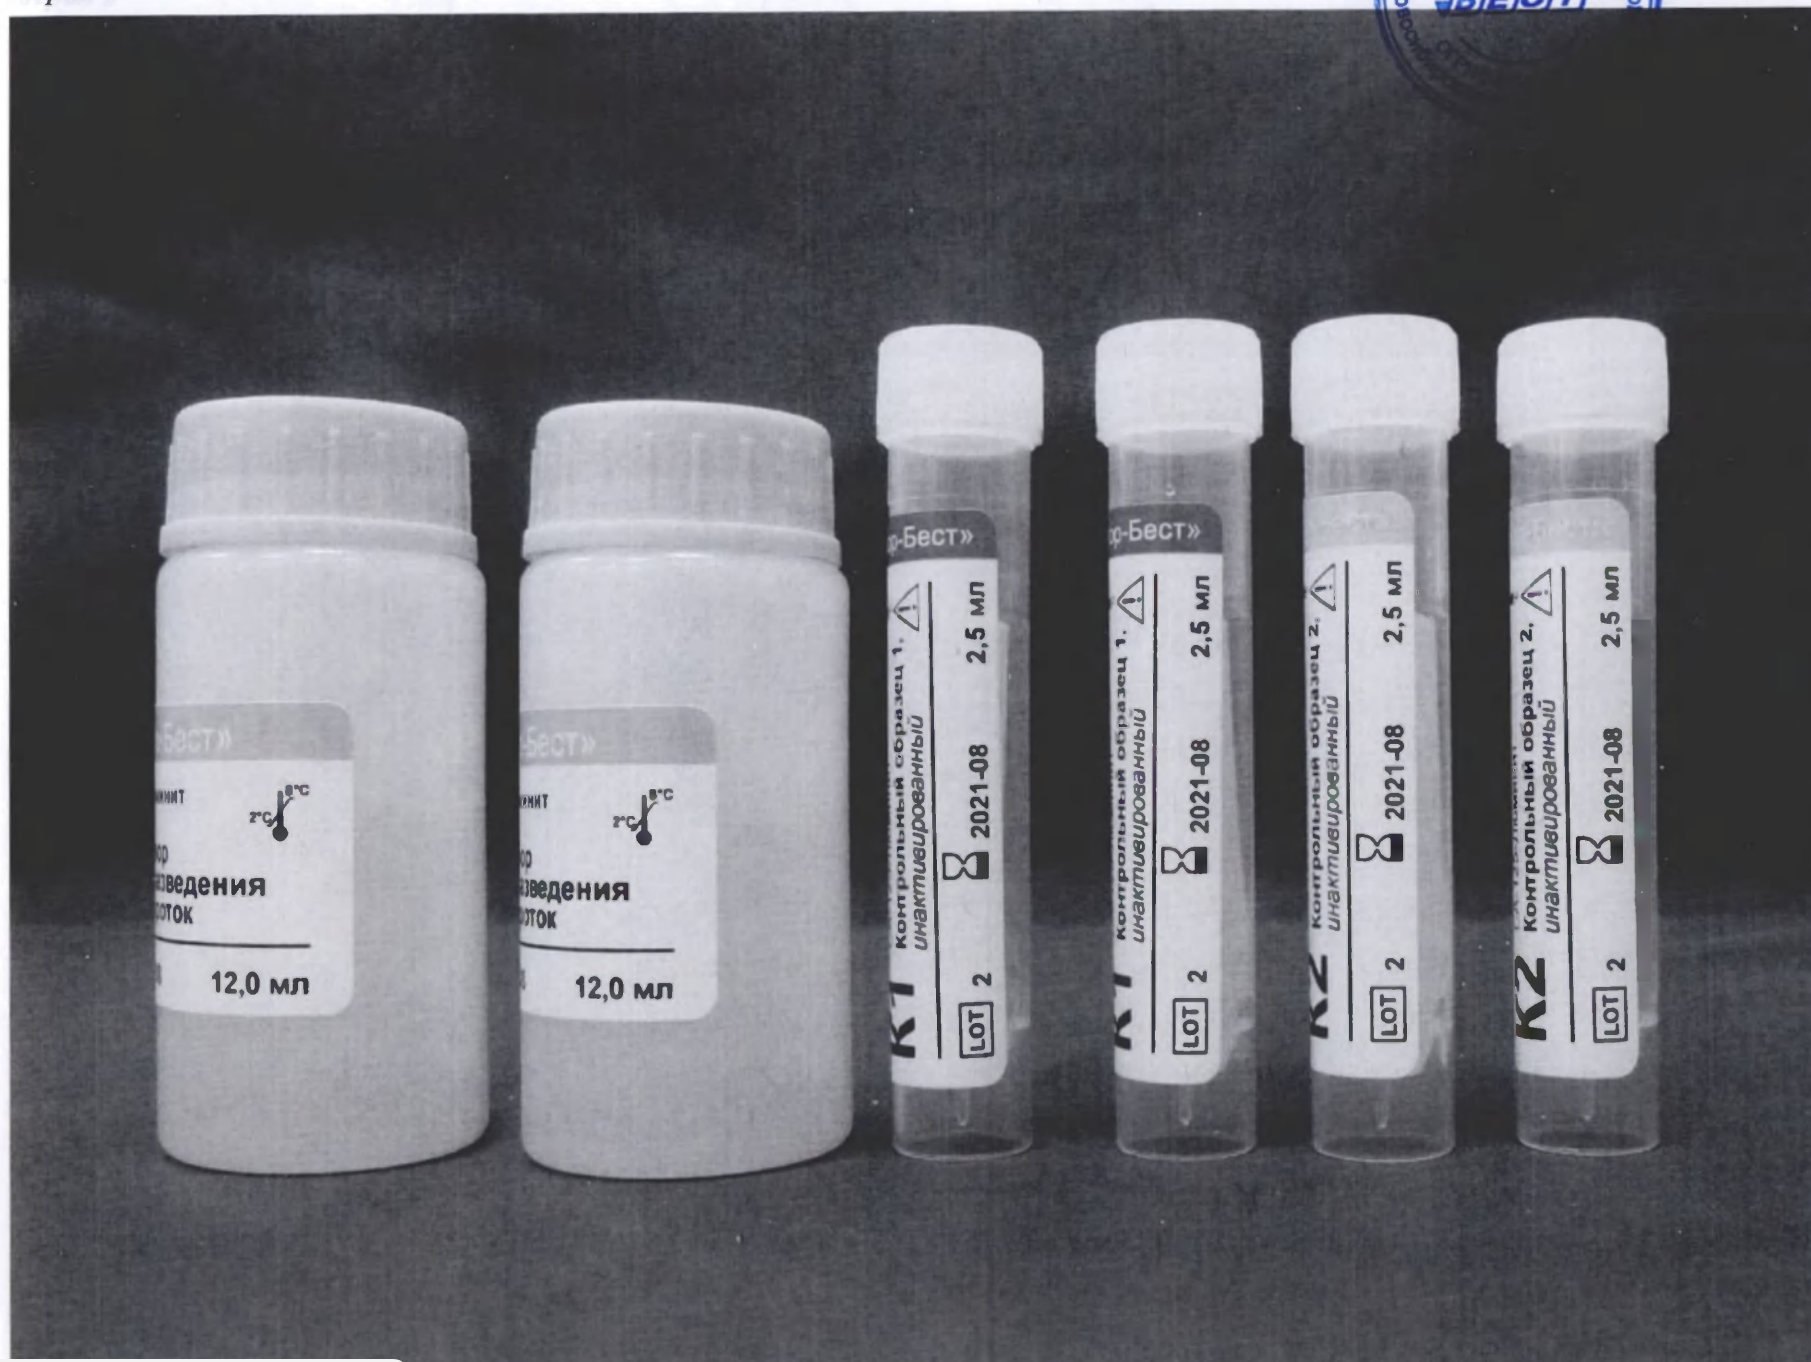

графическое изображение упаковки медицинского изделия
"СА-125-Люминит" № 1
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"12" 08 2020 г.

ВЕКТОР
БЕСТ

REF

X-XXXX

набор реагентов
для иммунохемилюминесцентного
определения концентрации
опухолевого маркера СА-125
в сыворотке крови для автоматического
ИХЛА-анализатора «Люминит» (Luminite)

СА-125-Люминит


LOT 2

СОСТАВ:

LOT

1. Штатив с двумерным штрих-кодом с реагентами: 2 шт.			2
Магнитные микрочастицы с иммобилизованными моноклональными антителами к СА-125	1 фл.	3,7 мл	2
Калибровочный образец	2 фл.	по 2,5 мл	2
Раствор для разведения сывороток	1 фл.	13,0 мл	2
Конъюгат	1 фл.	6,0 мл	2
2. Раствор для разведения сывороток	2 фл.	по 12,0 мл	2
3. Контрольный образец 1	2 проб.	по 2,5 мл	2
4. Контрольный образец 2	2 проб.	по 2,5 мл	2

Графическое изображение упаковки медицинского изделия
"СА-125-Люминит" № 2
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"  М.Д. Хусаинов
"12" 08 2020 г.

ВЕКТОР

БЕСТ

REF **X-XXXX**

Σ 108

LOT

2

ТУ 21.20.23-105-23548172-2020

РУ №



2020-08-12



2021-08-12

СА-125-Люминит


IVD



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"СА-125-Люминит" № 3
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"  М.Д. Хусаинов
"12" 08 2020 г.



АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru