


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 "ПСА общий-Люминит"
 серия 1

Генеральный директор
 АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
 08.08.2020 г.

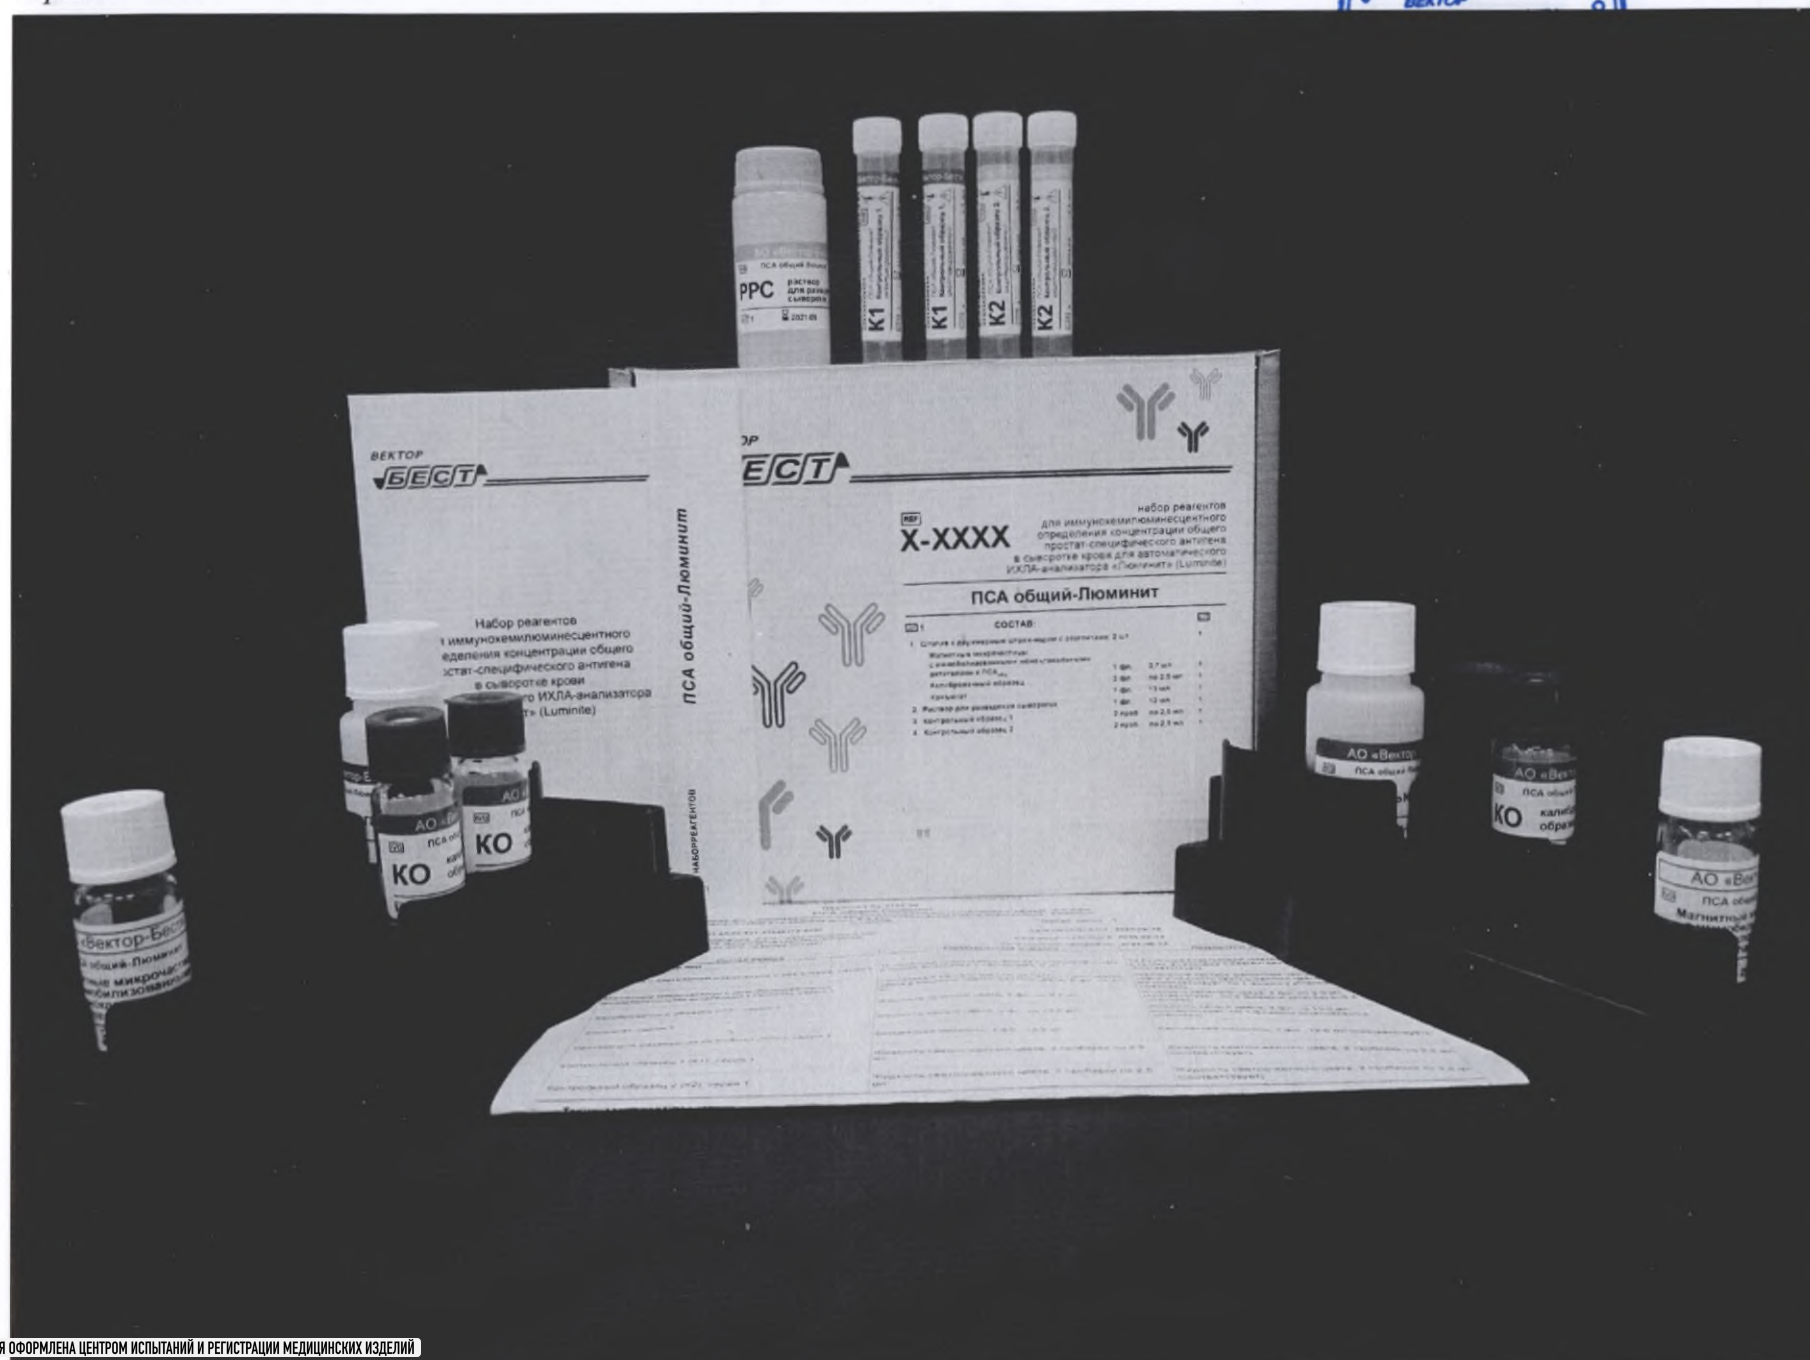

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"ПСА общий-Люминит" № 1
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"18" 08 2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"ПСА общий-Люминит" № 2
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"19" 2020 г.



AO «Вектор-Бест»
IVD
ПСА общий-Люминит
LOT 1
2021-08

AO «Вектор-Бест»
IVD
ПСА общий-Люминит
Конъюгат
LOT 1





AO «Вектор-Бест»
IVD
ПСА
КО
LOT 1

AO «Вектор-Бест»
IVD
ПСА
КО
LOT 1

AO «Вектор-Бест»
IVD
ПСА
Магнитный
с иммобилизованным
антигеном
LOT 1


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"ПСА общий-Люминит" № 3
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2020 г.

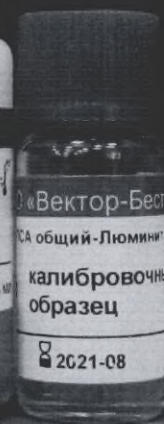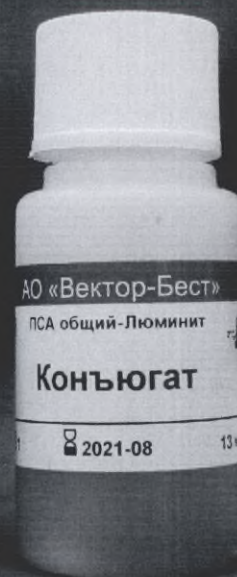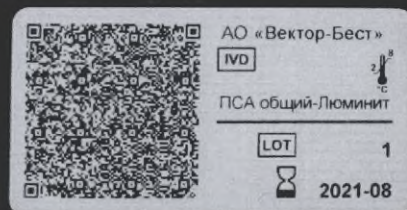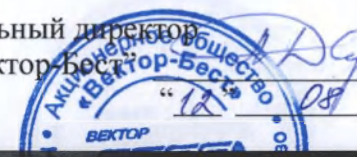

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"ПСА общий-Люминит" № 4
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"12" 08 2020 г.

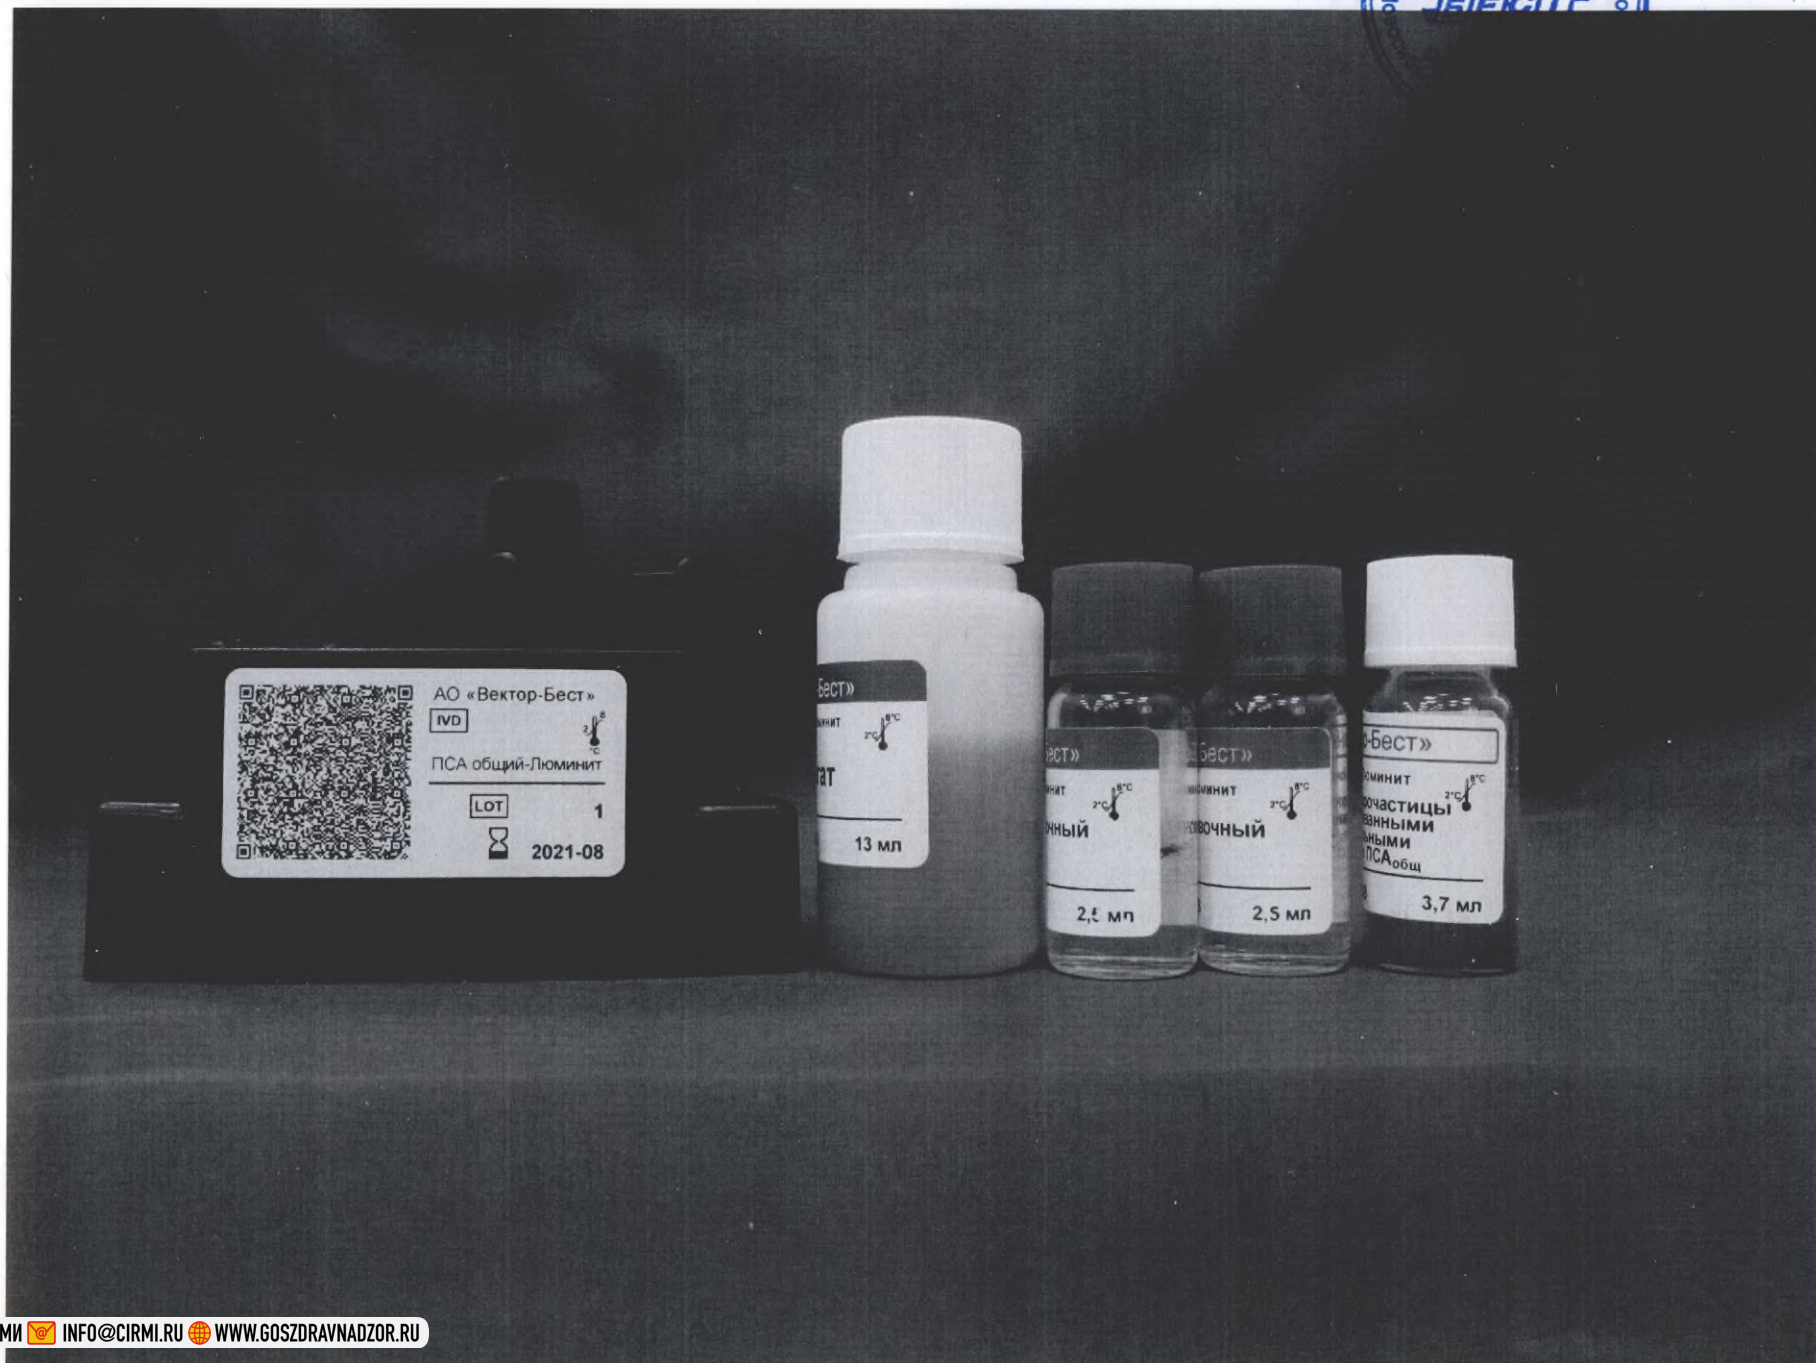

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ПСА общий-Люминит” № 5
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”




М.Д. Хусаинов

2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ПСА общий-Люминит” № 6
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“12” 08 2020 г.

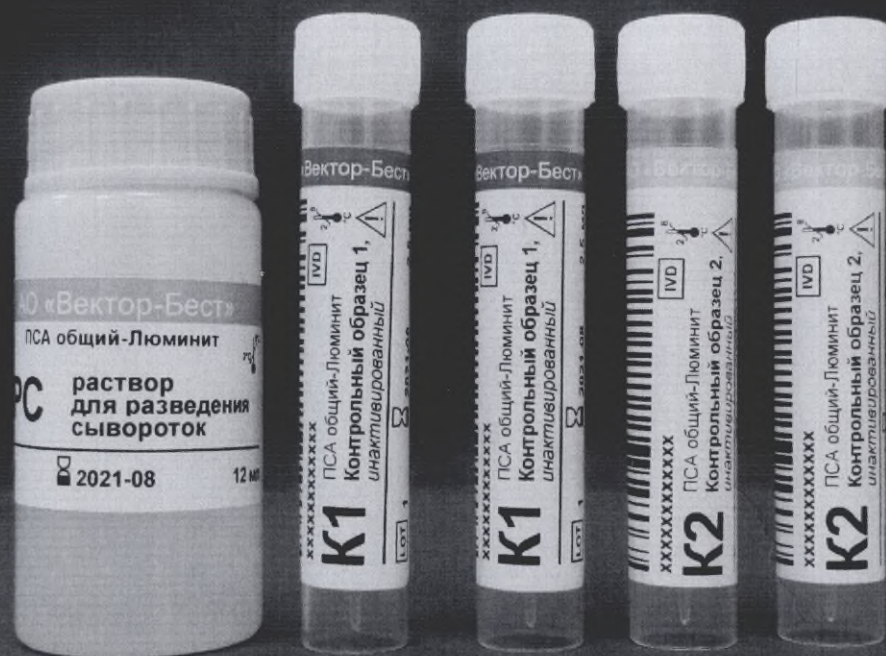

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ПСА общий-Люминит” № 7
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“12” 08 2020 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"ПСА общий-Люминит" № 1
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"12" 08/ 2020 г.

ВЕКТОР
БЕСТ

REF

X-XXXX

набор реагентов
для иммунохемилюминесцентного
определения концентрации общего
простат-специфического антигена
в сыворотке крови для автоматического
ИХЛА-анализатора «Люминит» (Luminite)

ПСА общий-Люминит

LOT 1

СОСТАВ:

LOT

1. Штатив с двухмерным штрих-кодом с реагентами: 2 шт.

1

Магнитные микрочастицы
с иммобилизованными моноклональными
антителами к ПСА_{св}

1 фл. 3,7 мл 1

Калибровочный образец

2 фл. по 2,5 мл 1

Конъюгат

1 фл. 13 мл 1

2. Раствор для разведения сывороток

1 фл. 12 мл 1

3. Контрольный образец 1

2 проб. по 2,5 мл 1

4. Контрольный образец 2

2 проб. по 2,5 мл 1

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ПСА общий-Люминит” № 2
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“18” 08/ 2020 г.



BEKTOP
ВЕСТ

REF **X-XXXX**


Σ
108

LOT

1

ТУ 21 20 23-121-23548172-2020

РУ №



2020-08-12

2021-08-12

ПСА общий-Люминит

IVD



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"ПСА общий-Люминит" № 3
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2020 г.



АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

М.Д. Хусаинов
2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"ПСА общий-Люминит" № 1
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"

М.Д. Хусаинов
2020 г.



фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"ПСА общий-Люминит" № 2
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2020 г.





фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"ПСА общий-Люминит" № 3
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"12" 08 2020 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"ПСА общий-Люминит" № 4
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2020 г.

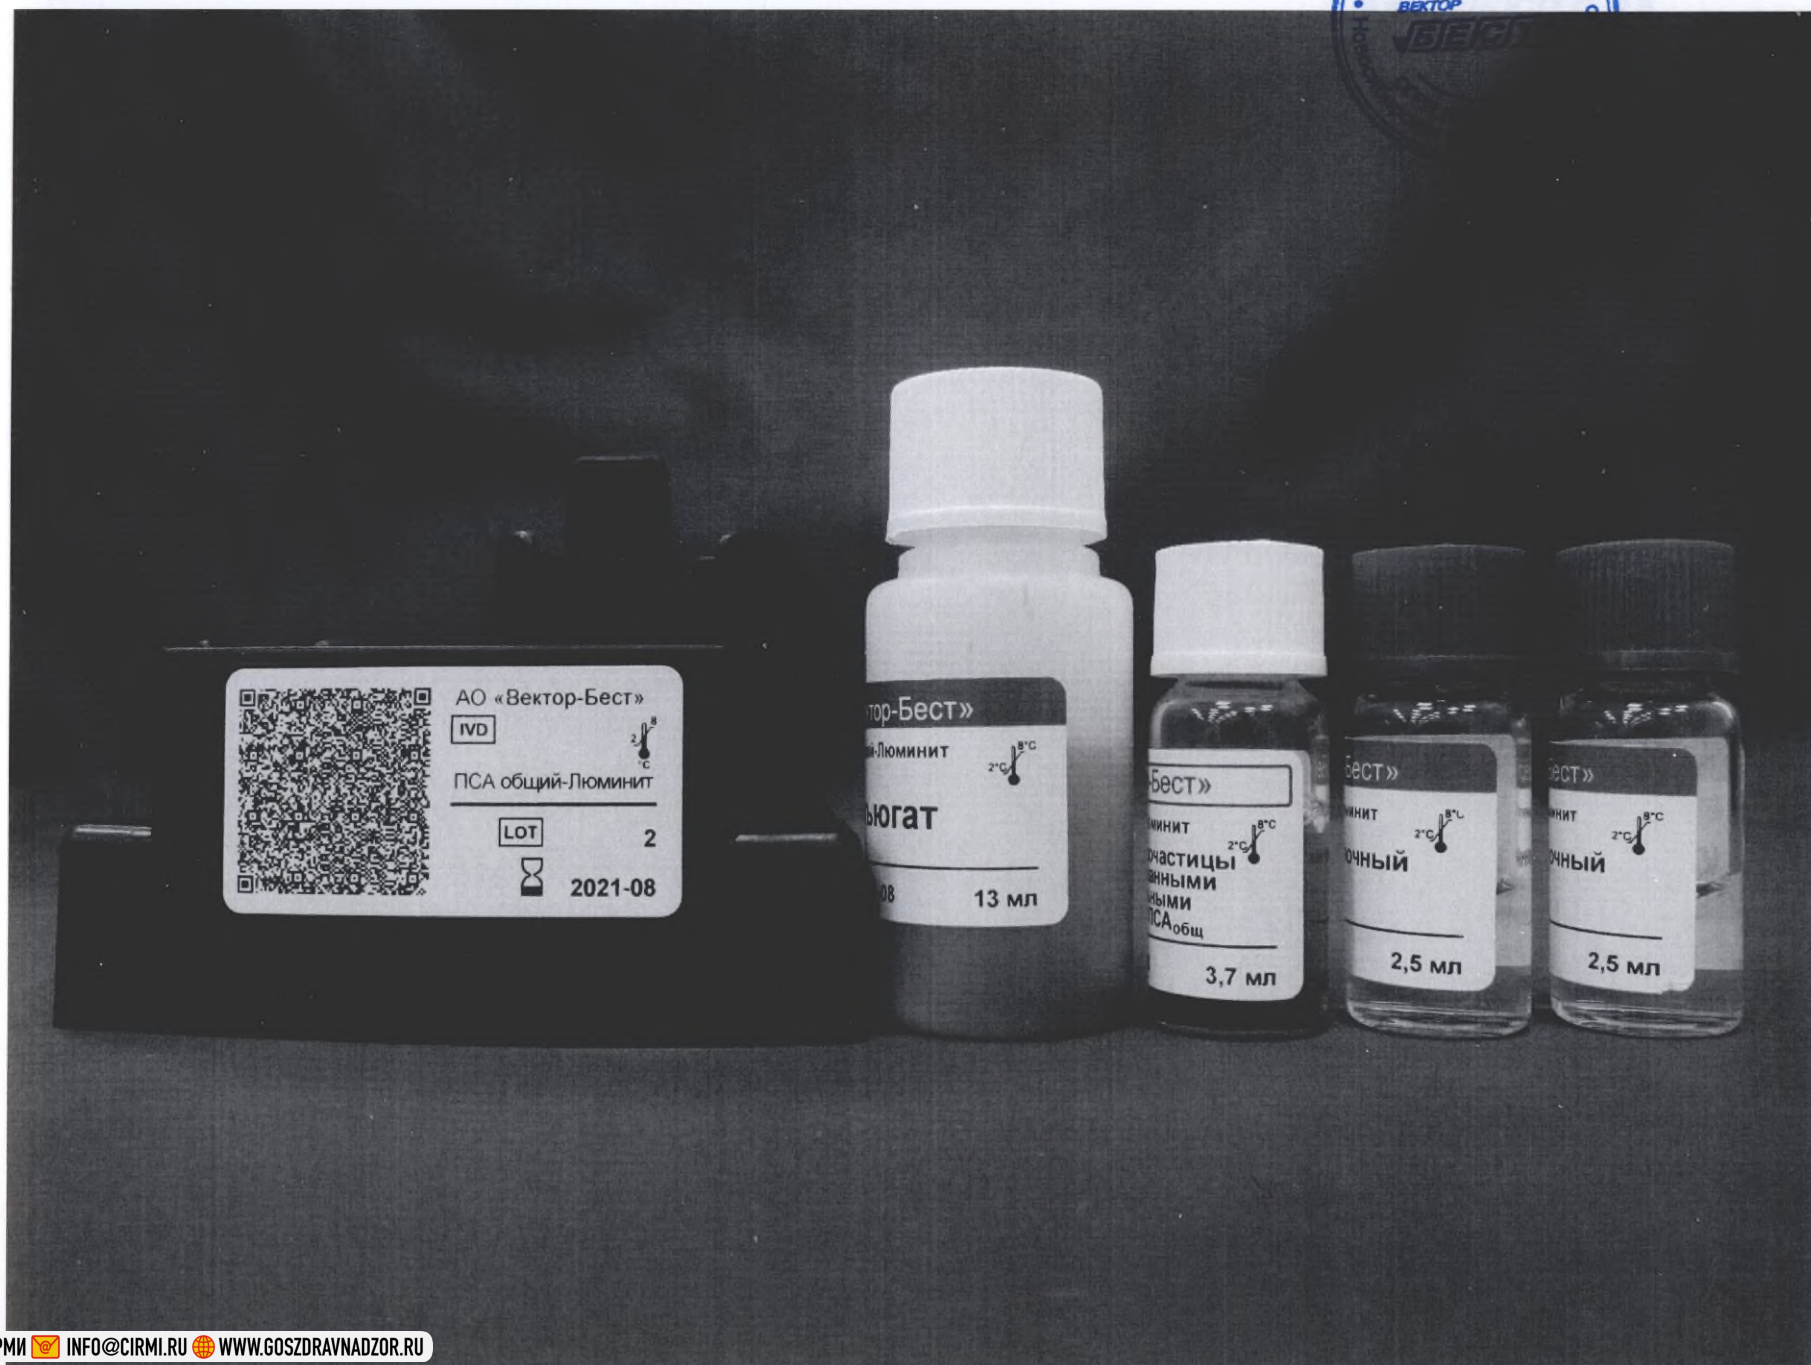

фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"ПСА общий-Люминит" № 5
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"



М.Д. Хусаинов
2020 г.




фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"ПСА общий-Люминит" № 6
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2020 г.



фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"ПСА общий-Люминит" № 7
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2020 г.

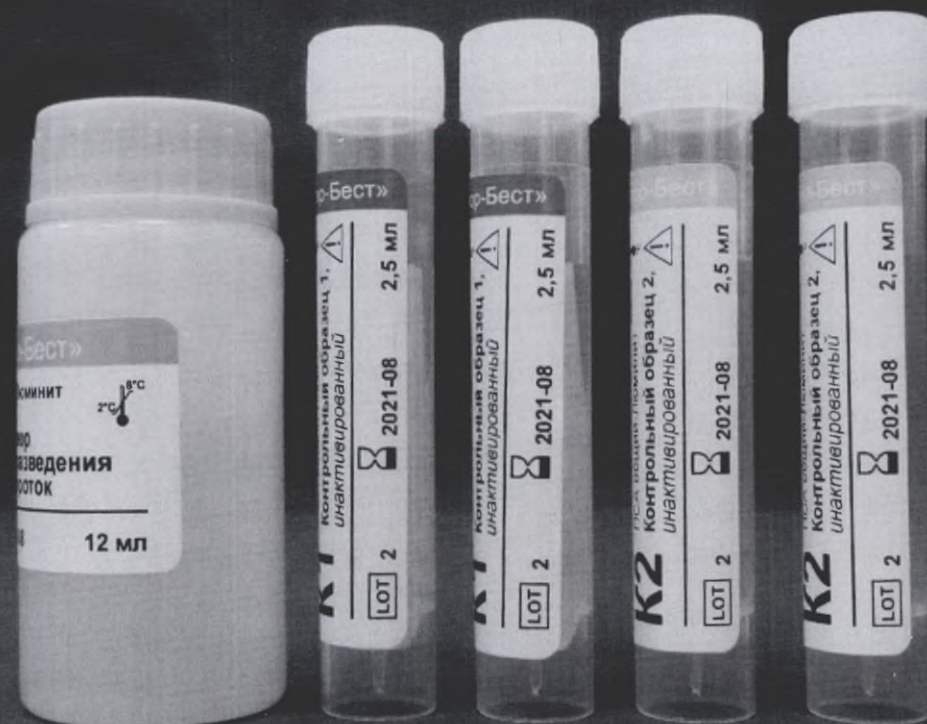

фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"ПСА общий-Люминит" № 1
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"



М.Д. Хусаинов
2020 г.

ВЕКТОР
БЕСТ

REF

X-XXXX

набор реагентов
для иммунохемилюминесцентного
определения концентрации общего
простат-специфического антигена
в сыворотке крови для автоматического
ИХЛА-анализатора «Люминит» (Luminite)

ПСА общий-Люминит

2

СОСТАВ:


2

1. Штатив с двумерным штрих-кодом с реагентами: 2 шт.			2
Магнитные микрочастицы с иммобилизованными моноклональными антителами к ПСА _{общ}	1 фл.	3,7 мл	2
Калибровочный образец	2 фл.	по 2,5 мл	2
Конъюгат	1 фл.	13 мл	2
2. Раствор для разведения сывороток	1 фл.	12 мл	2
3. Контрольный образец 1	2 проб.	по 2,5 мл	2
4. Контрольный образец 2	2 проб.	по 2,5 мл	2

фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"ПСА общий-Люминит" № 2
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"

М.Д. Хусаинов
2020 г.

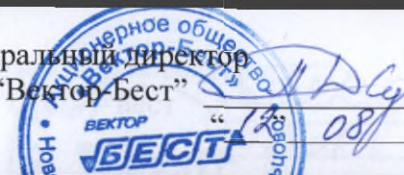

ВЕКТОР

БЕСТ

REF **X-XXXX**

Σ 108

LOT

2

ТУ 21.20.23-121-23548172-2020

РУ №

2020-08-12

2021-08-12

ПСА общий-Люминит

IVD



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"ПСА общий-Люминит" № 3
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"



М.Д. Хусаинов
2020 г.



АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов
2020 г.



Образцы маркировки на Набор реагентов для иммунохемилюминесцентного определения концентрации общего простат-специфического антигена в сыворотке крови для автоматического ИХЛА-анализатора «Люминит» (Luminite) «ПСА общий-Люминит»

1. Образцы этикеток на компоненты набора «ПСА общий-Люминит»

Наименование компонента	Этикетка
Штатив с двухмерным штрих-кодом с реагентами	
Магнитные микрочастицы с иммобилизованными моноклональными антителами к ПСАобщ	
Калибровочный образец (КО)	
Конъюгат	

Наименование компонента	Этикетка
Раствор для разведения сывороток (PPC)	
Контрольный образец 1 (K1)	
Контрольный образец 2 (K2)	

2. Образцы этикеток на коробке набора «ПСА общий-Люминит»

2.1. Верхняя этикетка.

REF X-XXXX	набор реагентов для иммунохемилюминесцентного определения концентрации общего простат-специфического антигена в сыворотке крови для автоматического ИХЛА-анализатора "Люминит" (Luminite)	
ПСА общий-Люминит		
LOT XXXX	Состав:	LOT
1. Штатив с двухмерным штрих-кодом с реагентами:	2 шт.	XXXX
Магнитные микрочастицы с иммобилизованными моноклональными антителами к ПСА _{общ}		
	1 фл. 3,7 мл	XXXX
Калибровочный образец	2 фл. по 2,5 мл	XXXX
Конъюгат	1 фл. 13,0 мл	XXXX
2. Раствор для разведения сывороток	1 фл. 12,0 мл	XXXX
3. Контрольный образец 1	2 проб. по 2,5 мл	XXXX
4. Контрольный образец 2	2 проб. по 2,5 мл	XXXX

2.2. Боковая этикетка № 1.


REF	X-XXXX	Σ 108	LOT	XXXX
ТУ 21.20.23-121-23548172-2020 РУ №			XXXX-XX-XX	XXXX-XX-XX
ПСА общий-Люминит				
IVD	  	 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Антитела к ВИЧ-1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют				

2.3. Боковая этикетка № 2.

АО "Вектор-Бест"
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211
тел/факс: (383) 332-67-49, 332-67-52
E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Примечание. Текст боковой этикетки № 2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом.

«СОГЛАСОВАНО»
Директор НИИСД
АО «Вектор-Бест»



М.Ю. Рукавишников
« 05 » 08 2020 г.

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 03 листов.

Директор по технологии и качеству
АО «Вектор-Бест»



А.В. Масыго А.В. Масыго

08 2020 г.