



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

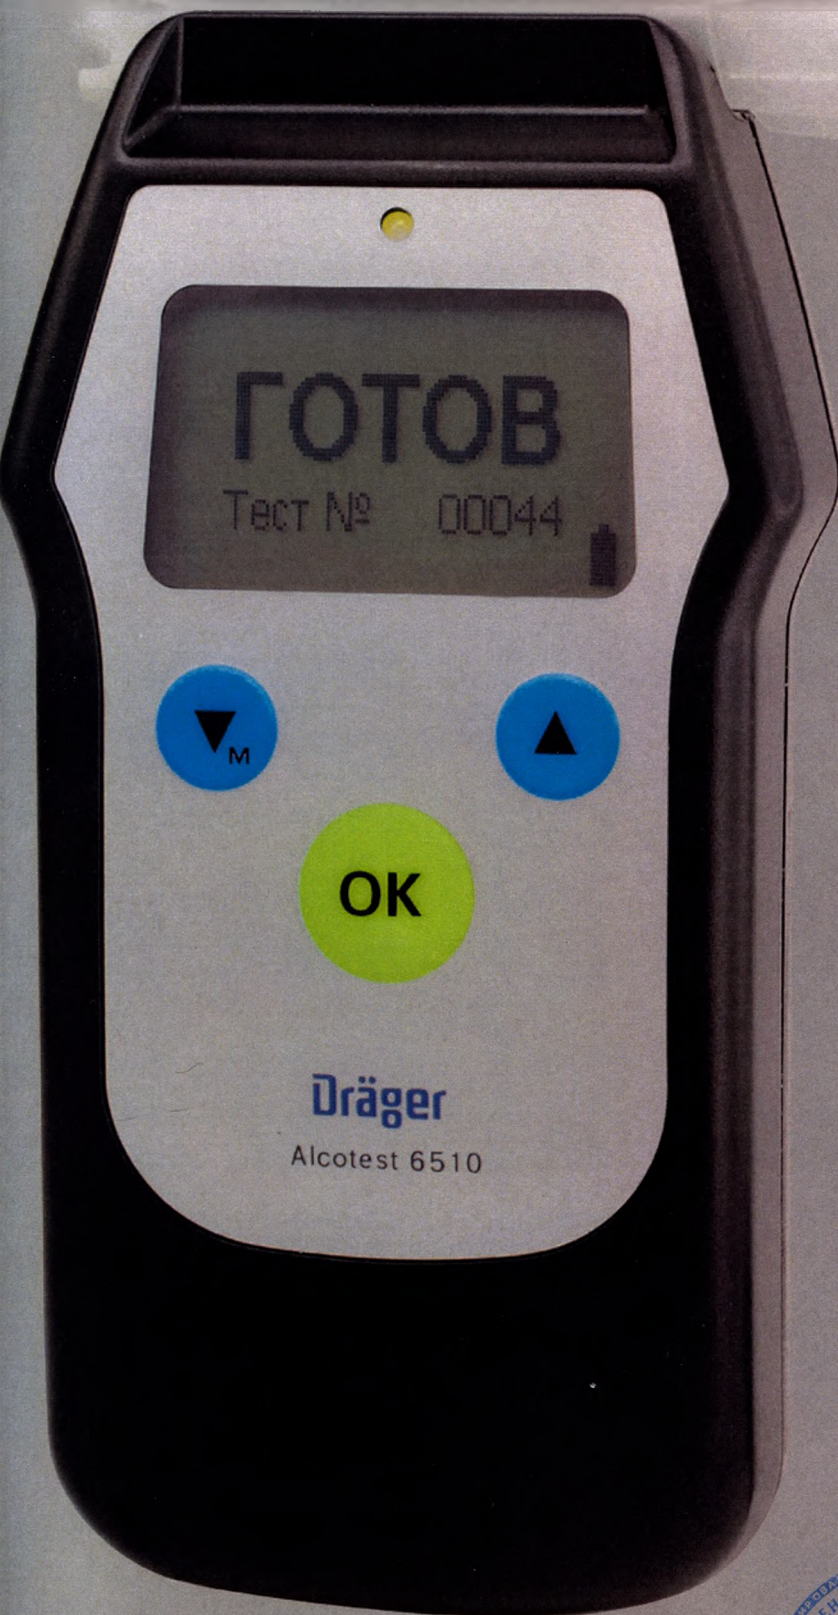

Генеральный директор ООО «СИМС-2»


Бадалян С.П.

Бадальян С.П.




Генеральный директор ООО «СИМС-2»





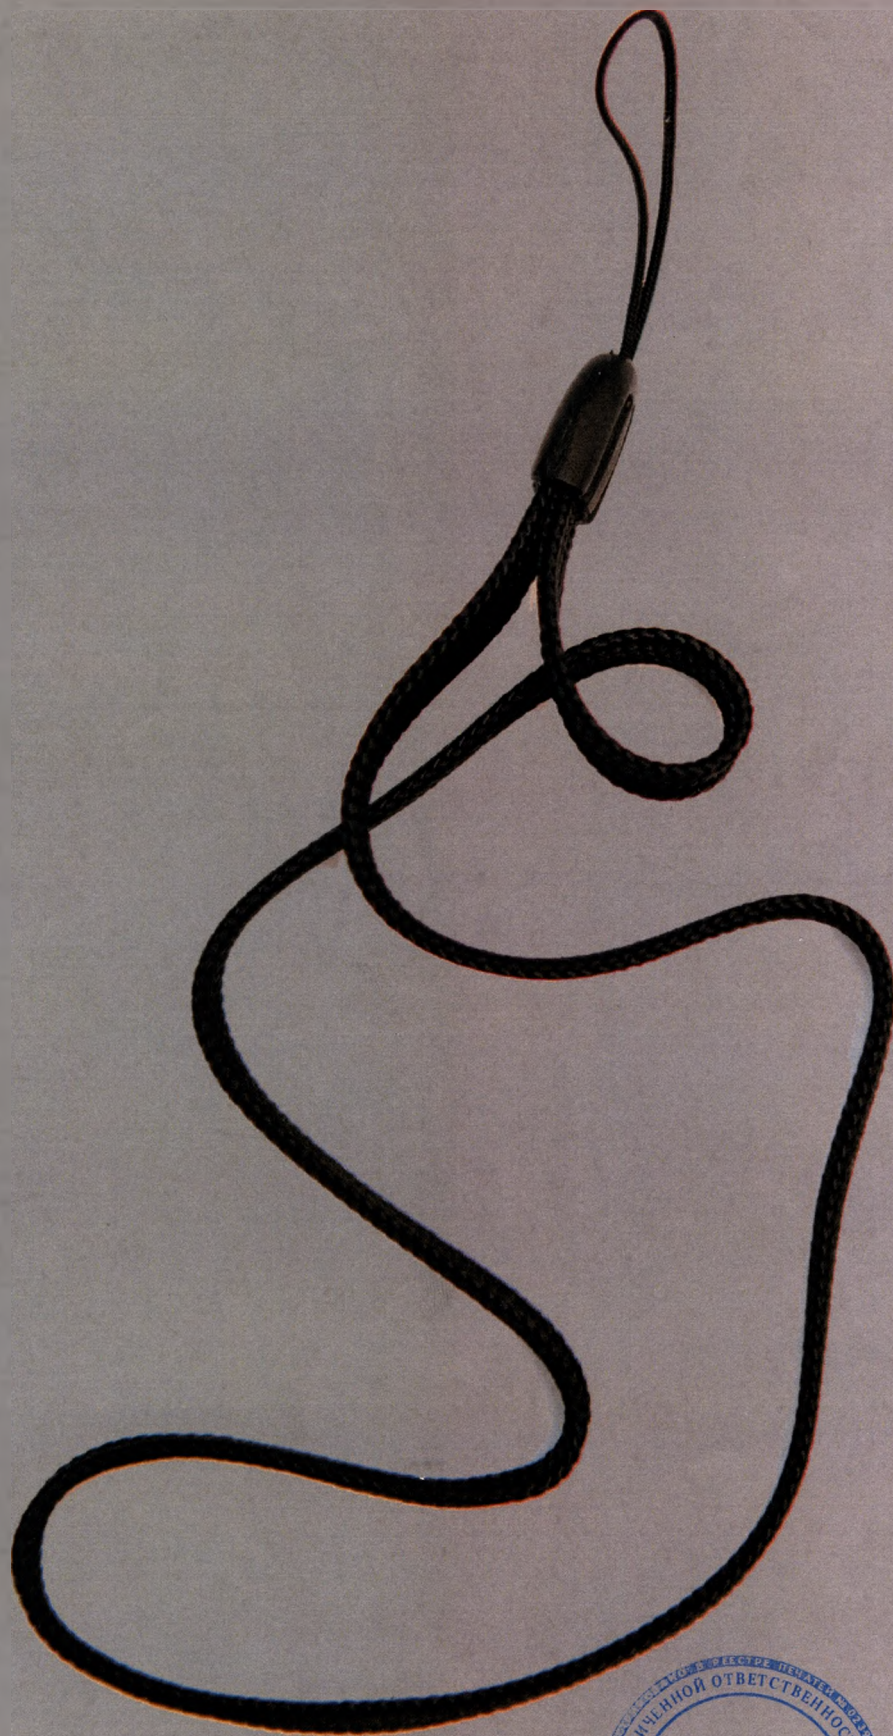

Генеральный директор ООО «СИМС-2»




Бадалян С.П.

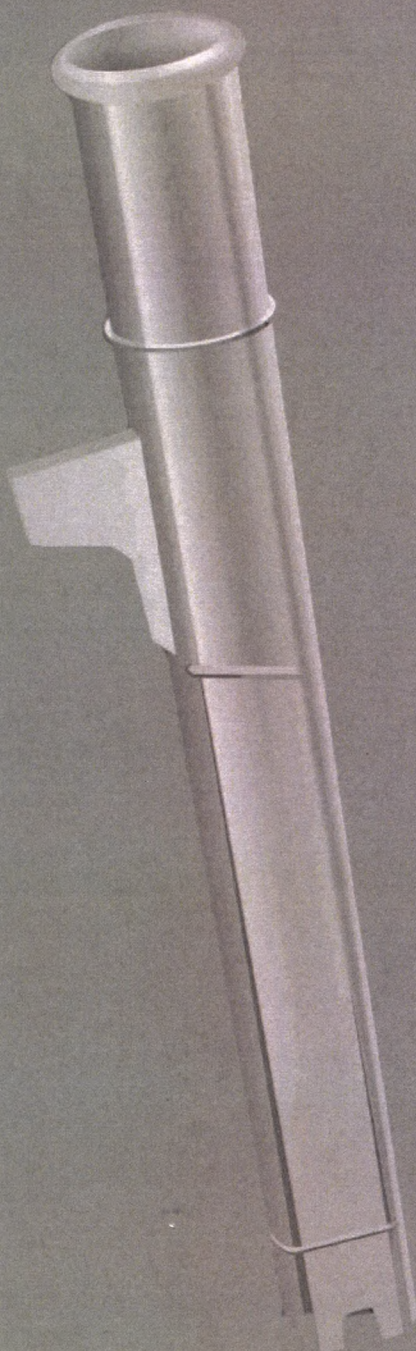

Генеральный директор ООО «СИМС-2»

Бадалян С.П.

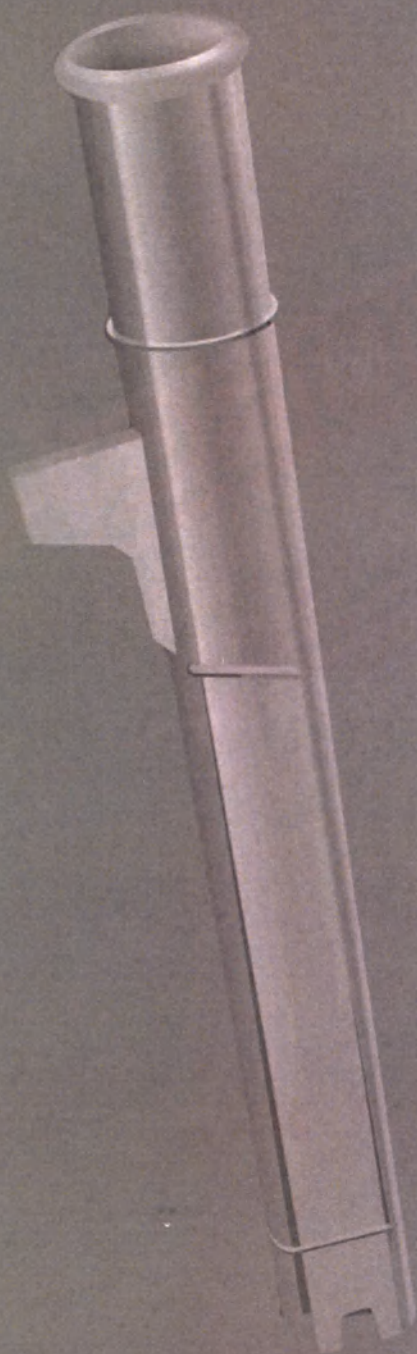

Генеральный директор ООО «СИМС-2»

Бадалян С.П.



Генеральный директор ООО «СИМС-2»



Бадалян С.П.



генеральный директор ООО «СИМС-2»



Бадалян С.П.


1. Einschalten: OK-Taste kurz drücken bis Gerät eingeschaltet ist.
2. Test-
vorbereitung: Neues Mundstück einsetzen.
Warten bis "BEREIT" angezeigt wird.
3. Test: Tief Atem holen und gleichmäßig in das Mundstück blasen, bis der Hupston verstummt. Das Testergebnis wird nach der Analyse angezeigt.
4. Testende: Mundstück entfernen. Für Folgetest OK-Taste einmal drücken. Zum Ausschalten OK-Taste drücken bis das Gerät abeschaltet.

1. Power ON: Press OK-button until device switches on.
2. Test
Preparation: Insert a new mouthpiece.
Wait until "READY" is displayed.
3. Test: Take a deep breath and blow evenly into the mouthpiece until the audible signal stops. The test result is displayed after analyzing.
4. End of test: Remove mouthpiece. For another test, press OK-button. To power OFF, press OK-button until device switches off.

1. Encendido: Presione OK hasta que el analizador se enciende.
2. Preparación
del muestreo: Inserta una boquilla nueva.
Espere hasta leer "LISTO".
3. Muestreo: Tome aire profundamente y sople uniformemente a través de la boquilla hasta que el sonido pare. El resultado del muestreo aparece indicado.
4. Fin de
muestreo: Quite la boquilla. Para un nuevo muestreo presione OK. Para apagar, presione OK hasta que el analizador se apague.

1. Mettre en marche: Pour allumer l'appareil, appuyer sur le bouton OK jusqu'à ce que l'appareil s'allume.
2. Préparation de la
mesure: Insérer un nouvel embout buccal.
Attendre que "Prêt" soit affiché.
3. Mesure: Inspirer profondément et souffler régulièrement dans l'embout buccal jusqu'à l'arrêt du signal sonore. Le résultat de la mesure est affiché.
4. Fin du test: Retirer l'embout buccal. Pour une nouvelle mesure, appuyer sur le bouton OK. Pour arrêter l'appareil, appuyer sur le bouton OK jusqu'à l'arrêt de l'appareil.



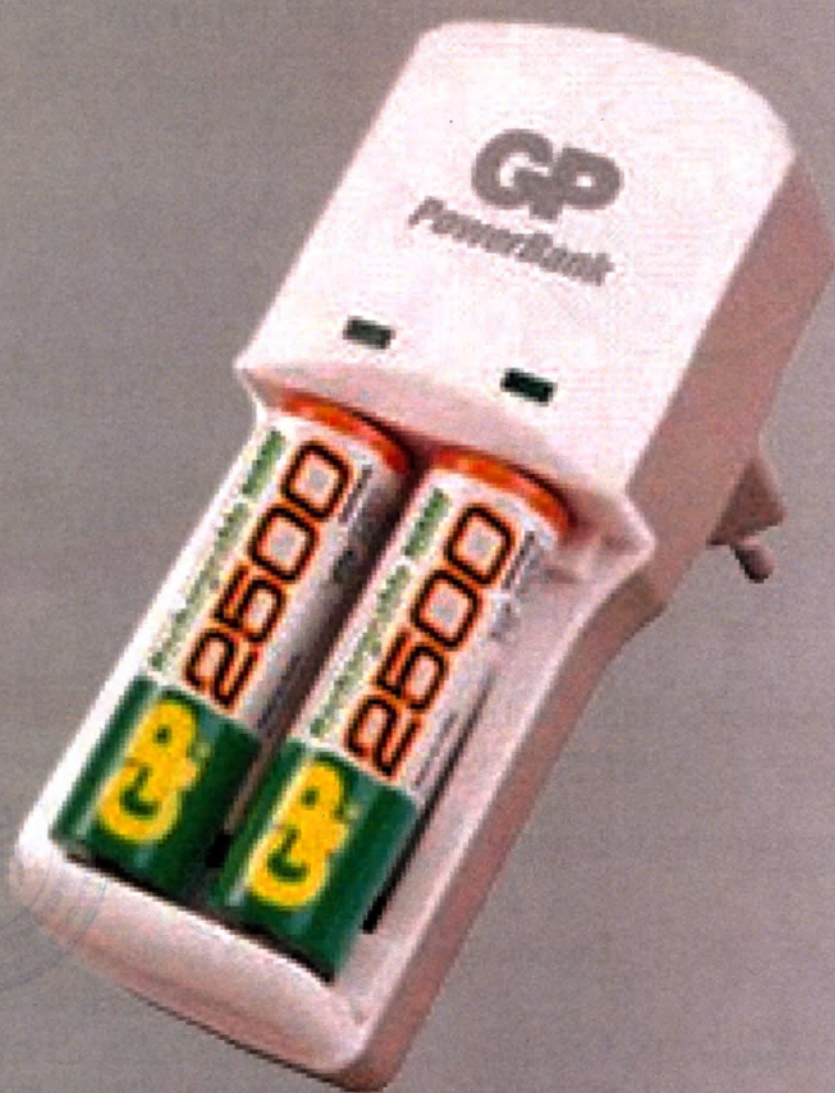

Генеральный директор ООО «СИМС-2»

Бадалян С.П.



Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
лист

