



Фотографические изображения

Набор реагентов для количественного определения тиреоглобулина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Tg II), в вариантах исполнения 100, 300 тестов

Набор реагентов для количественного определения тиреоглобулина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови человека для
анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Tg II Elecsys and cobas e
analyzers), вариант исполнения 100 тестов

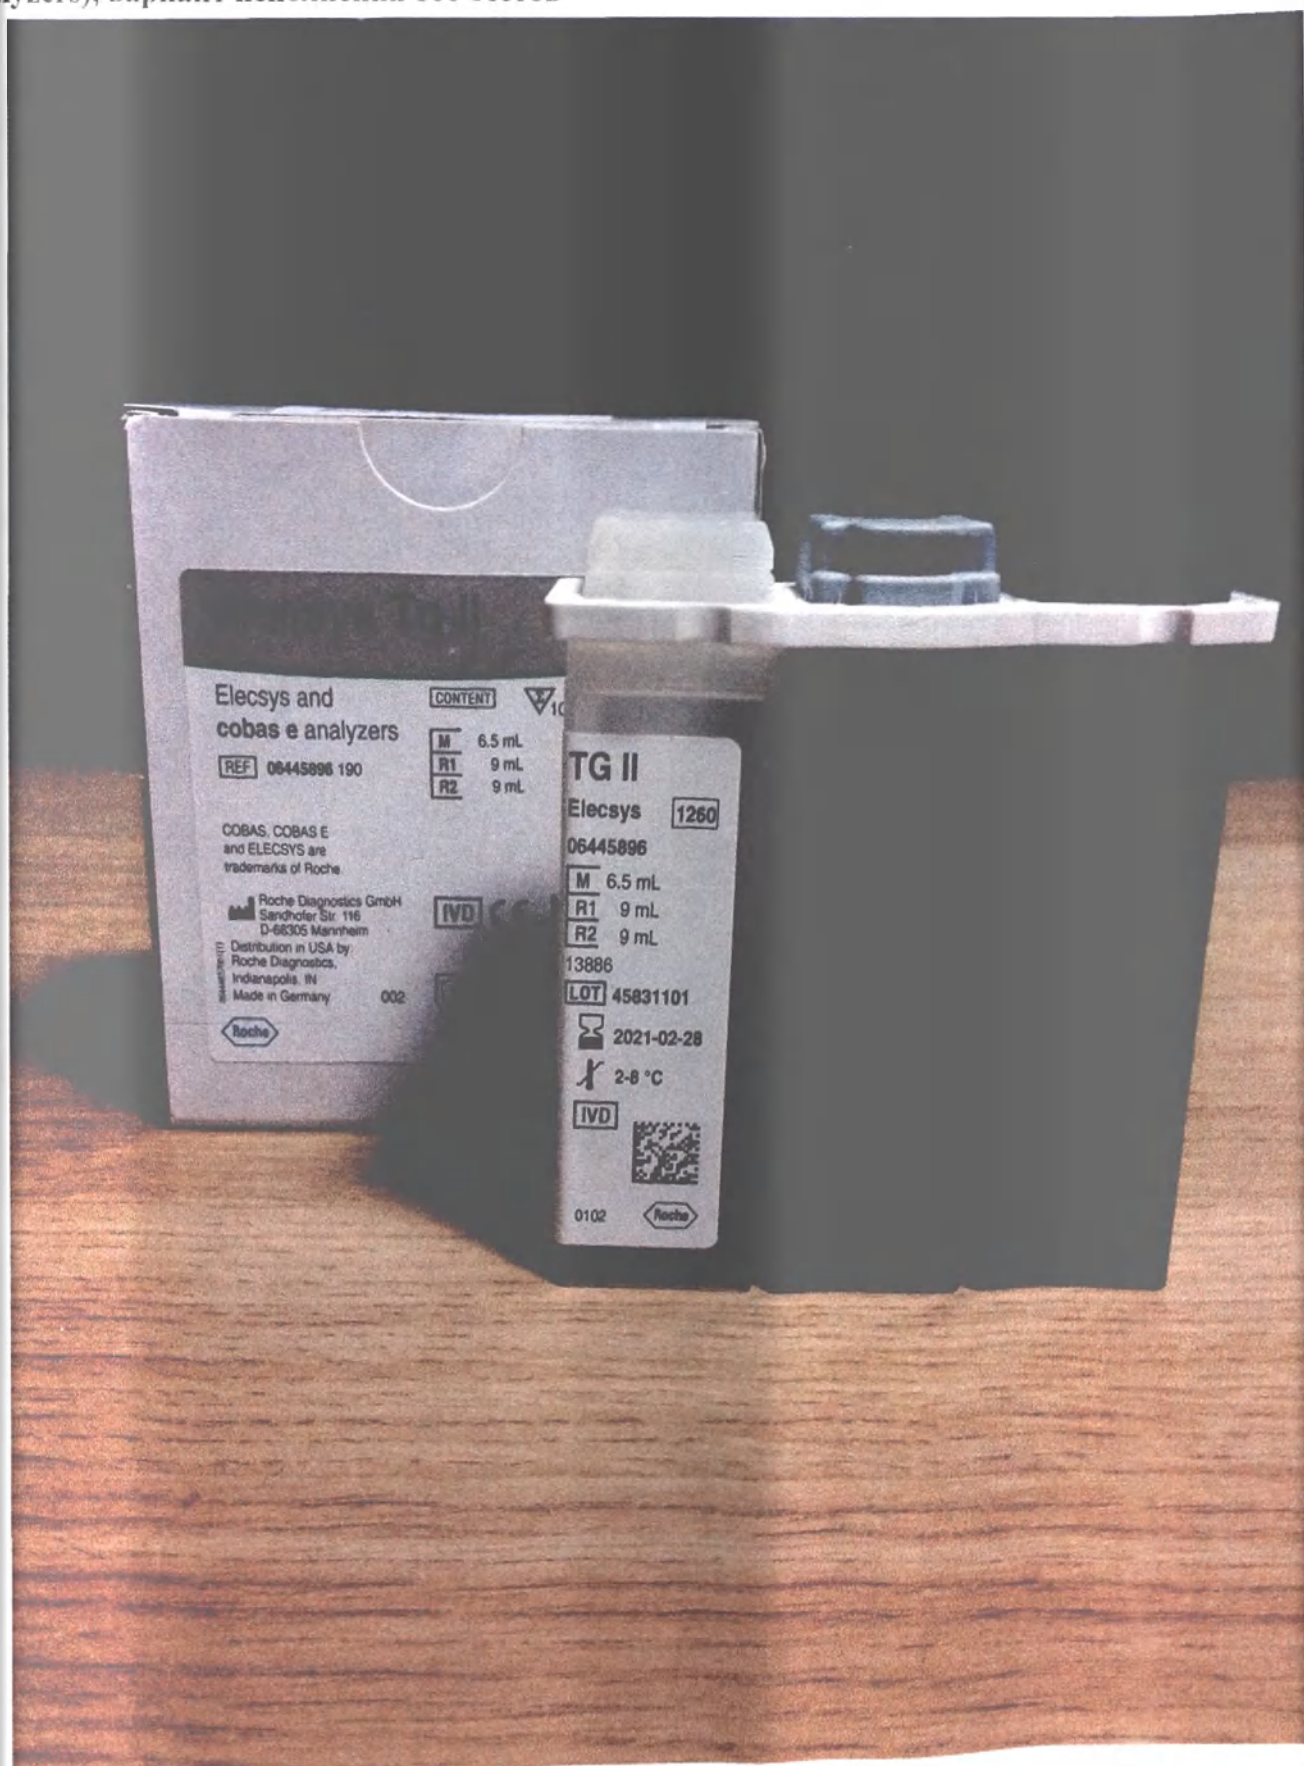

Набор реагентов для количественного определения тиреоглобулина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови человека для
анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Tg II Elecsys and cobas e
analyzers), вариант исполнения 100 тестов

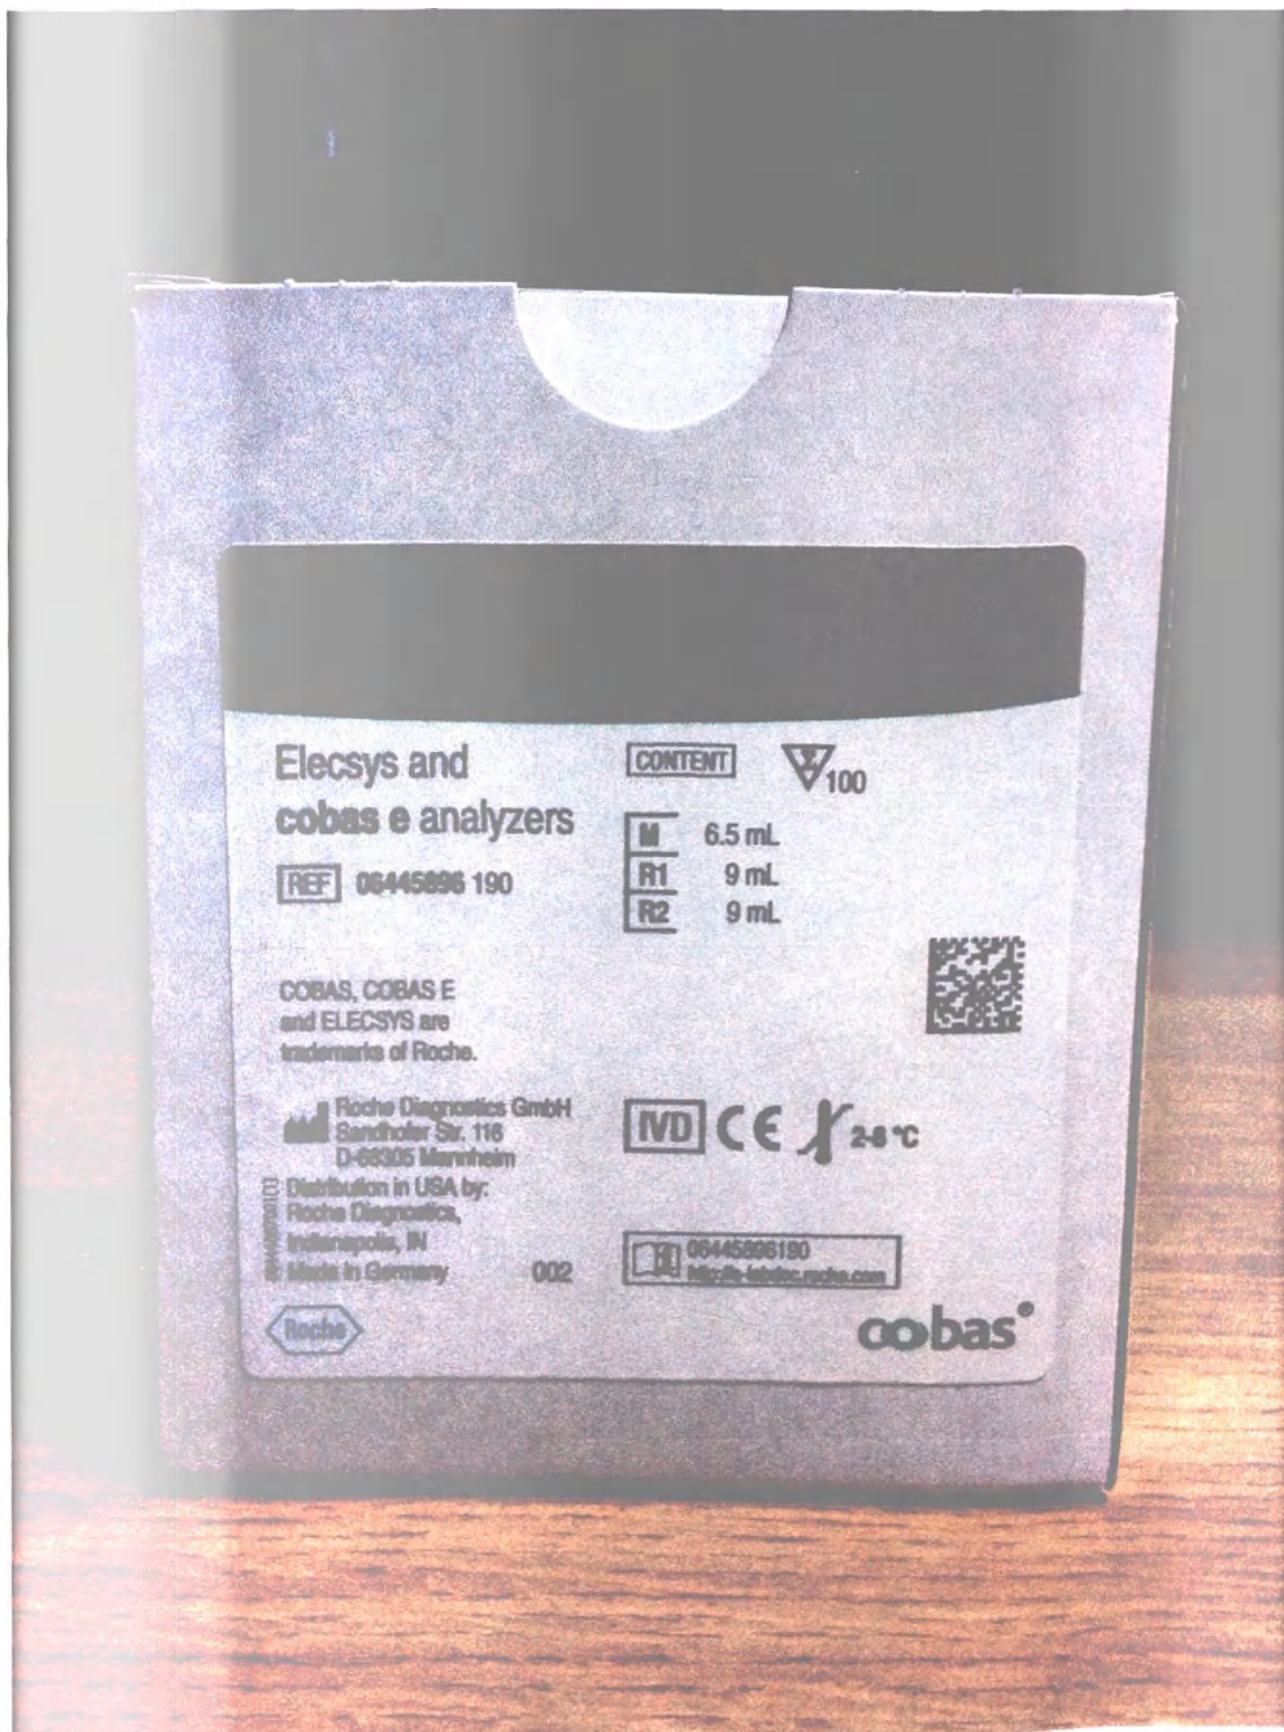

Набор реагентов для количественного определения тиреоглобулина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови человека для
анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Tg II Elecsys and cobas e
analyzers), вариант исполнения 100 тестов



Набор реагентов для количественного определения тиреоглобулина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови человека для анализаторов
и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Tg II Elecsys and cobas e analyzers), вариант
исполнения 100 тестов

Elecsys Tg II

REF 06445896 190

For USA: **CONTENT**

- M Streptavidin-coated microparticles 0.72 mg/mL
- R1 Biotinylated monoclonal anti-Tg antibody
(mouse) 1 mg/L
- R2 Monoclonal anti-Tg antibodies (mouse) labeled with
ruthenium complex 3.1 mg/L



Rx only

002




Набор реагентов для количественного определения тиреоглобулина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови человека для анализаторов
и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Tg II Elecsys and cobas e analyzers), вариант
исполнения 100 тестов

Набор реагентов для количественного определения тиреоглобулина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови
человека для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e
(Elecsys Tg II Elecsys and cobas e analyzers), вариант исполнения 100 тестов
Регистрационное удостоверение № _____ от _____
Срок годности см. на упаковке.
Температура хранения см. на упаковке
Номер лота см. на упаковке
Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют
Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"),
Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия
Изделие предназначено только для диагностики in vitro
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус»
(ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2
Тел: +7 495 229-69-69, факс: +7 495 229-62-64, E-mail: moscow.reception_dis@roche.com
Кат. номер 86446896190

Набор реагентов для количественного определения тиреоглобулина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови человека для
анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Tg II Elecsys and cobas e
analyzers), вариант исполнения 100 тестов



Набор реагентов для количественного определения тиреоглобулина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови человека для
анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Tg II cobas e analyzers), вариант
исполнения 300 тестов

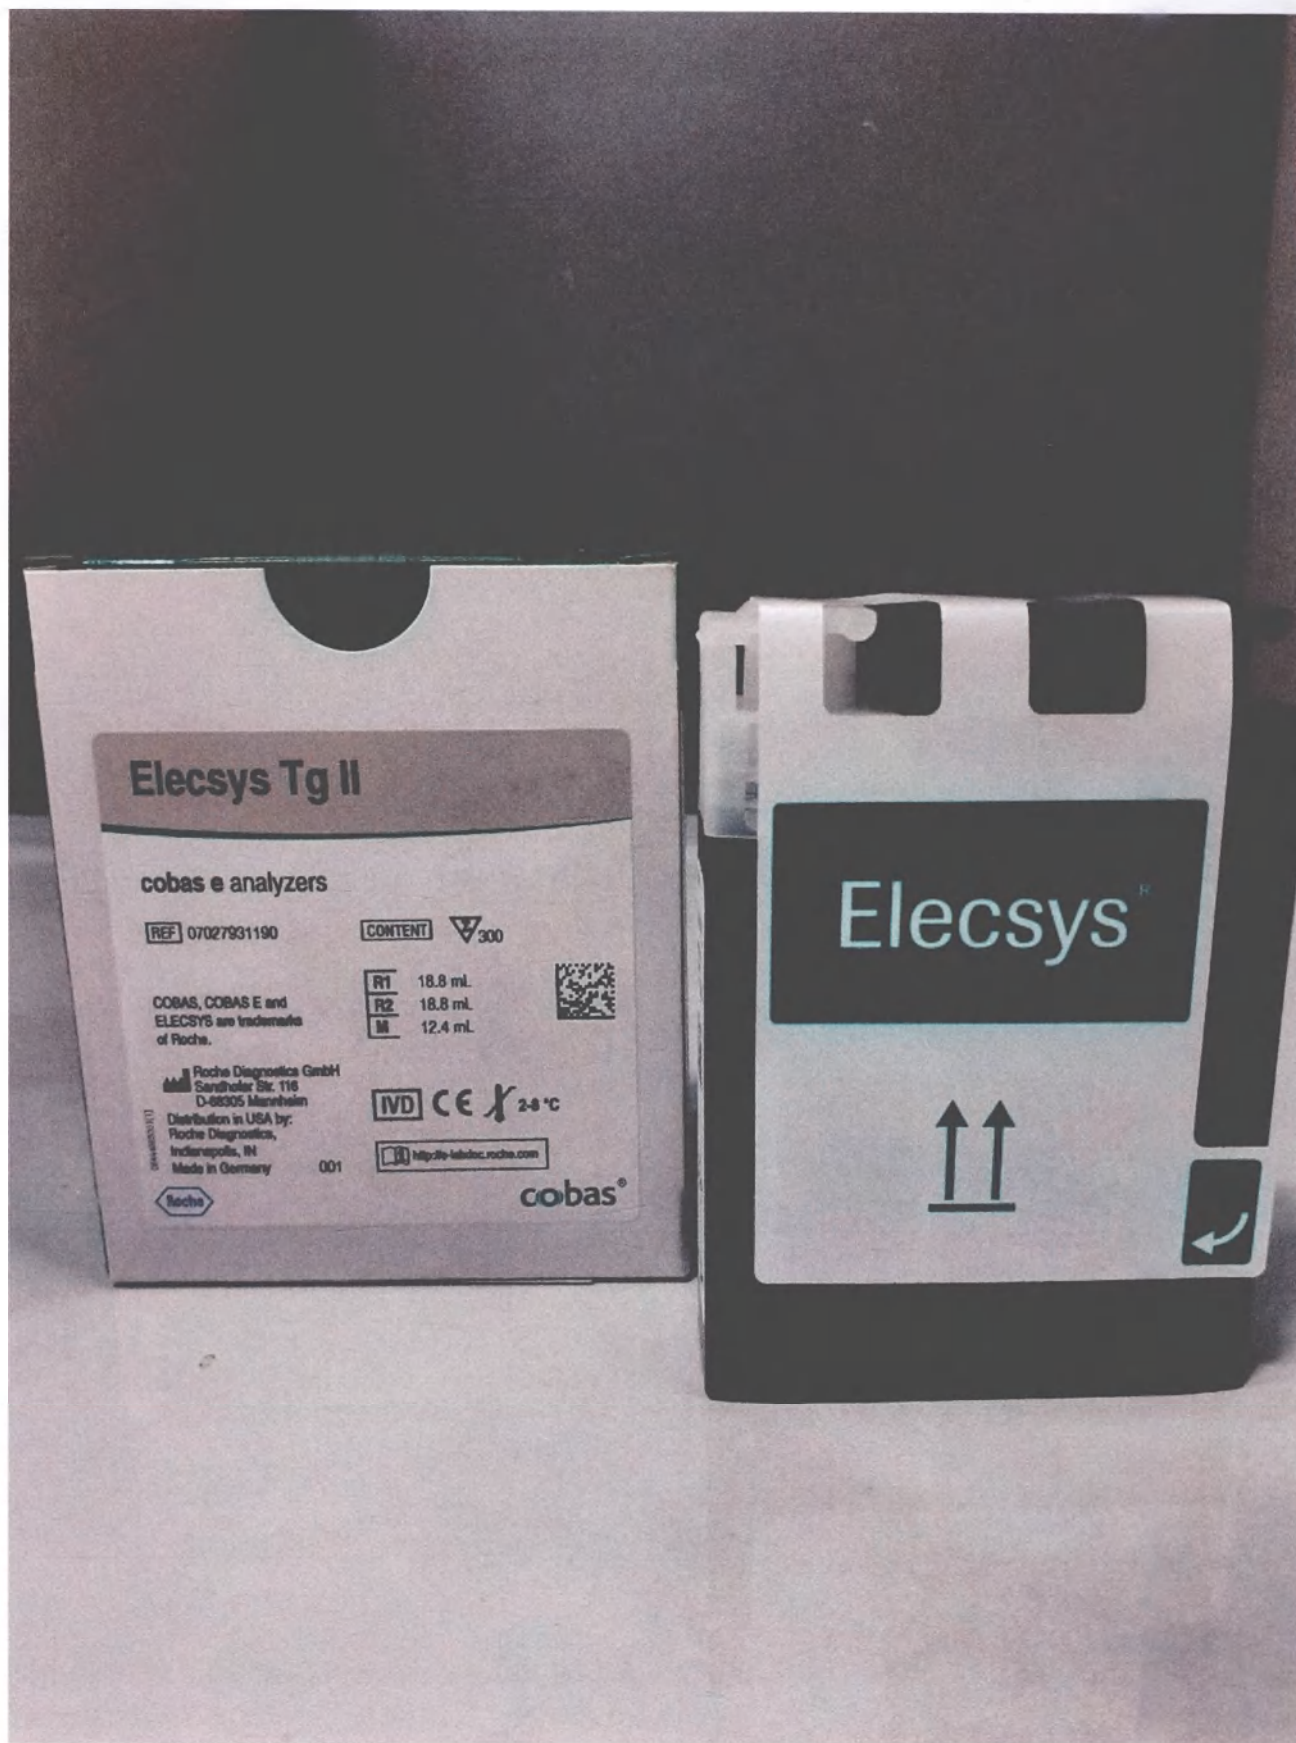

**Набор реагентов для количественного определения тиреоглобулина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови человека для
анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Tg II cobas e analyzers),
вариант исполнения 300 тестов**



Набор реагентов для количественного определения тиреоглобулина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Tg II cobas e analyzers), вариант исполнения 300 тестов

Набор реагентов для количественного определения тиреоглобулина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови человека для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Tg II cobas e analyzers), вариант исполнения 300 тестов

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке.

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рох Дианостикс ГмбХ"),

Sandhofer Strasse 118, 68306 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:


Общество с ограниченной ответственностью «Рох Дианостика Рус»

(ООО «Рох Дианостика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2

Тел: +7 495 229-60-00, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Кат. номер 67627931190

**Набор реагентов для количественного определения тиреоглобулина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови человека для анализаторов и
модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Tg II cobas e analyzers), вариант исполнения 300
тестов**

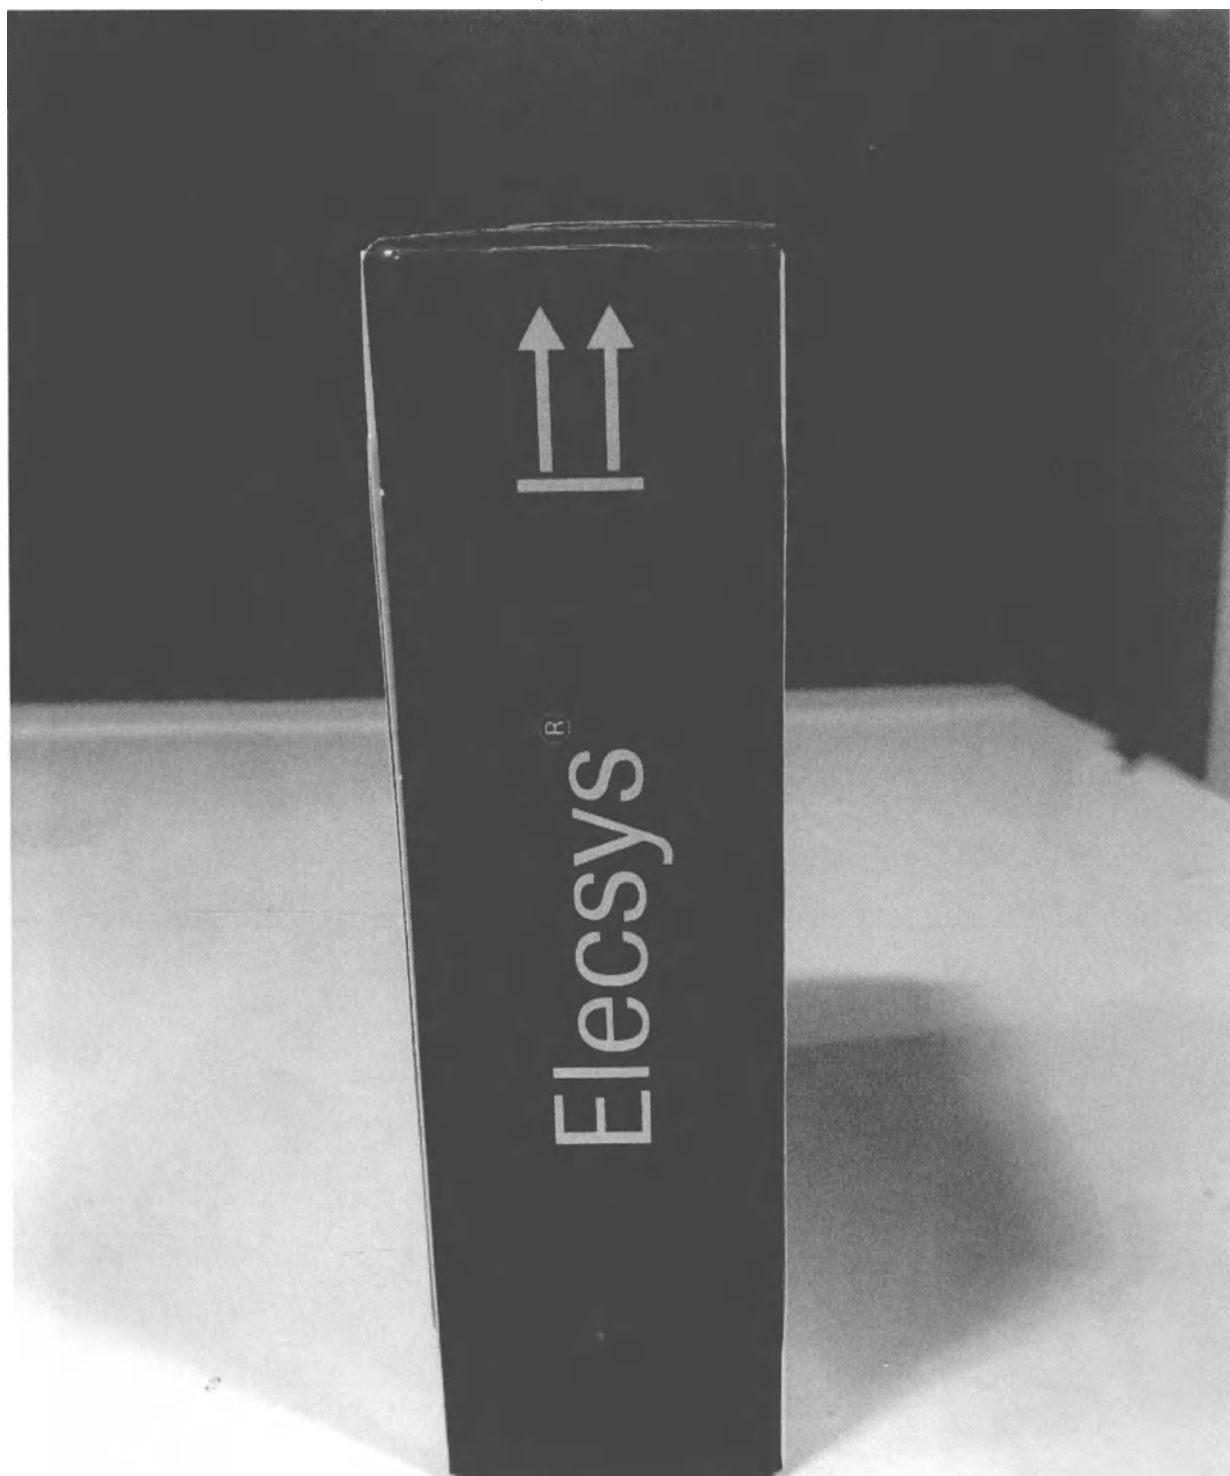

Набор реагентов для количественного определения тиреоглобулина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови человека для анализаторов
модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Tg II cobas e analyzers), вариант исполнения 300
тестов

Elecsys Tg II

REF 07027931190

For USA: CONTENT

- R1 Biotinylated monoclonal anti-Tg antibody
(mouse) 1 mg/L
- R2 Monoclonal anti-Tg antibodies (mouse) labeled
with ruthenium complex 3.1 mg/L
- M Streptavidin-coated microparticles 0.72 mg/mL



Rx only

001



Набор реагентов для количественного определения тиреоглобулина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови человека для
анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Tg II cobas e analyzers),
вариант исполнения 300 тестов



Набор реагентов для количественного определения тиреоглобулина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови человека для
анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Tg II cobas e analyzers),
вариант исполнения 300 тестов



**Набор реагентов для количественного определения тиреоглобулина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови человека для
анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Tg II cobas e analyzers),
вариант исполнения 300 тестов**



**Набор реагентов для количественного определения тиреоглобулина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови человека для
анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Tg II cobas e analyzers),
вариант исполнения 300 тестов**



Набор реагентов для количественного определения тиреоглобулина
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови человека для
анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Tg II cobas e analyzers),
вариант исполнения 300 тестов

