



Генеральный директор
ООО «ТМС»

(подпись и печать заявителя) Р.В. Серегин
(И.О. Фамилия)


Фотографические изображение МИ:

Стол офтальмологический электрический «АТЕ»


Производитель:
“АНТОНИ КАРЛЕС, С.А.”
(ANTONI CARLES, S.A.)

2020 г.


Офтальмологический электрический АТЕ-300 в составе:

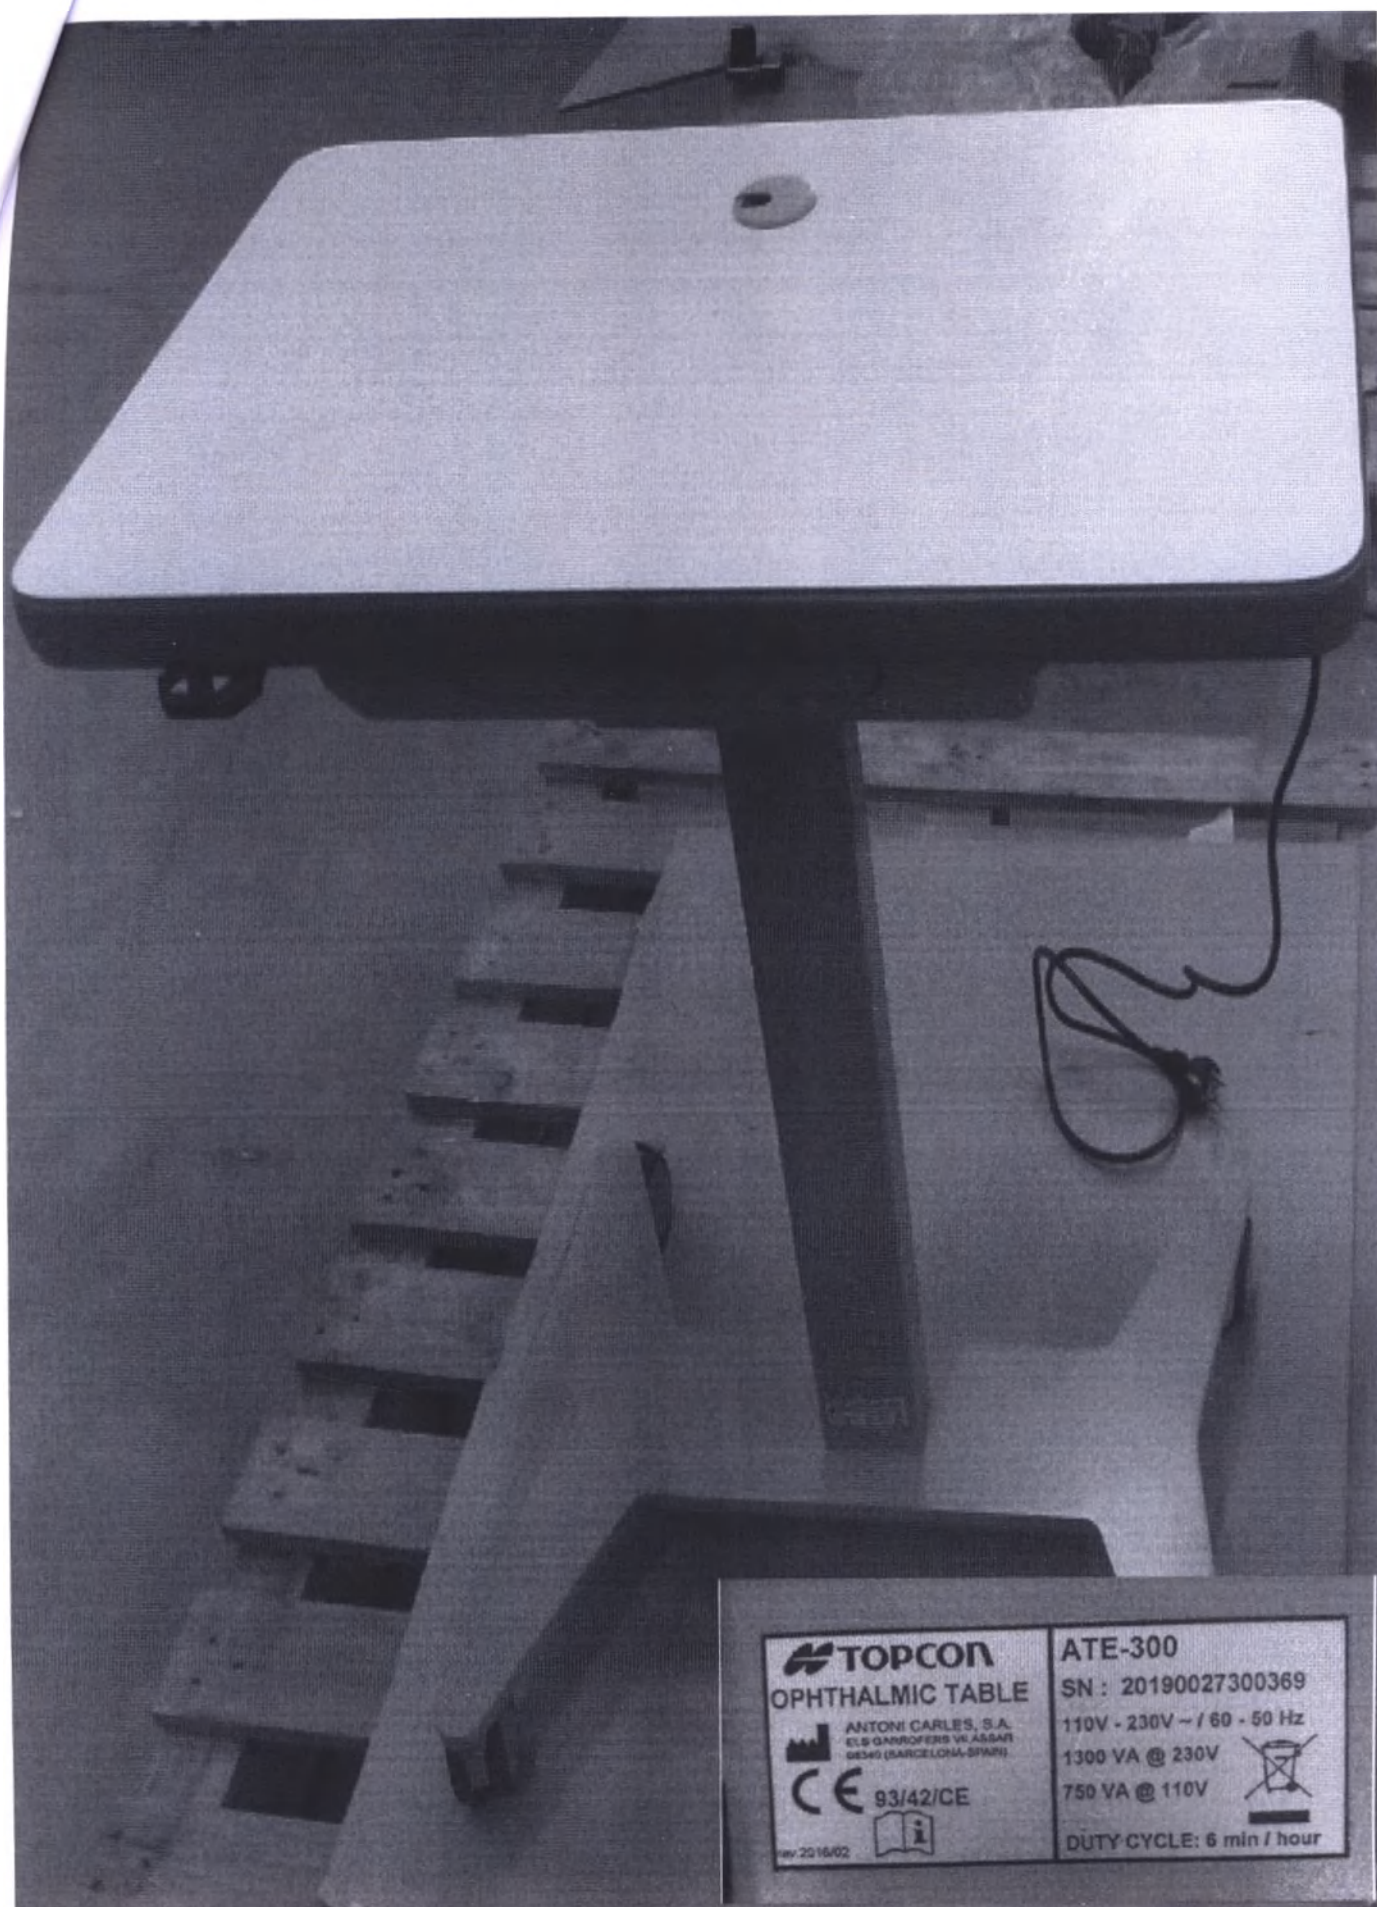

Столешница прямоугольная с блоком питания - 1 шт.

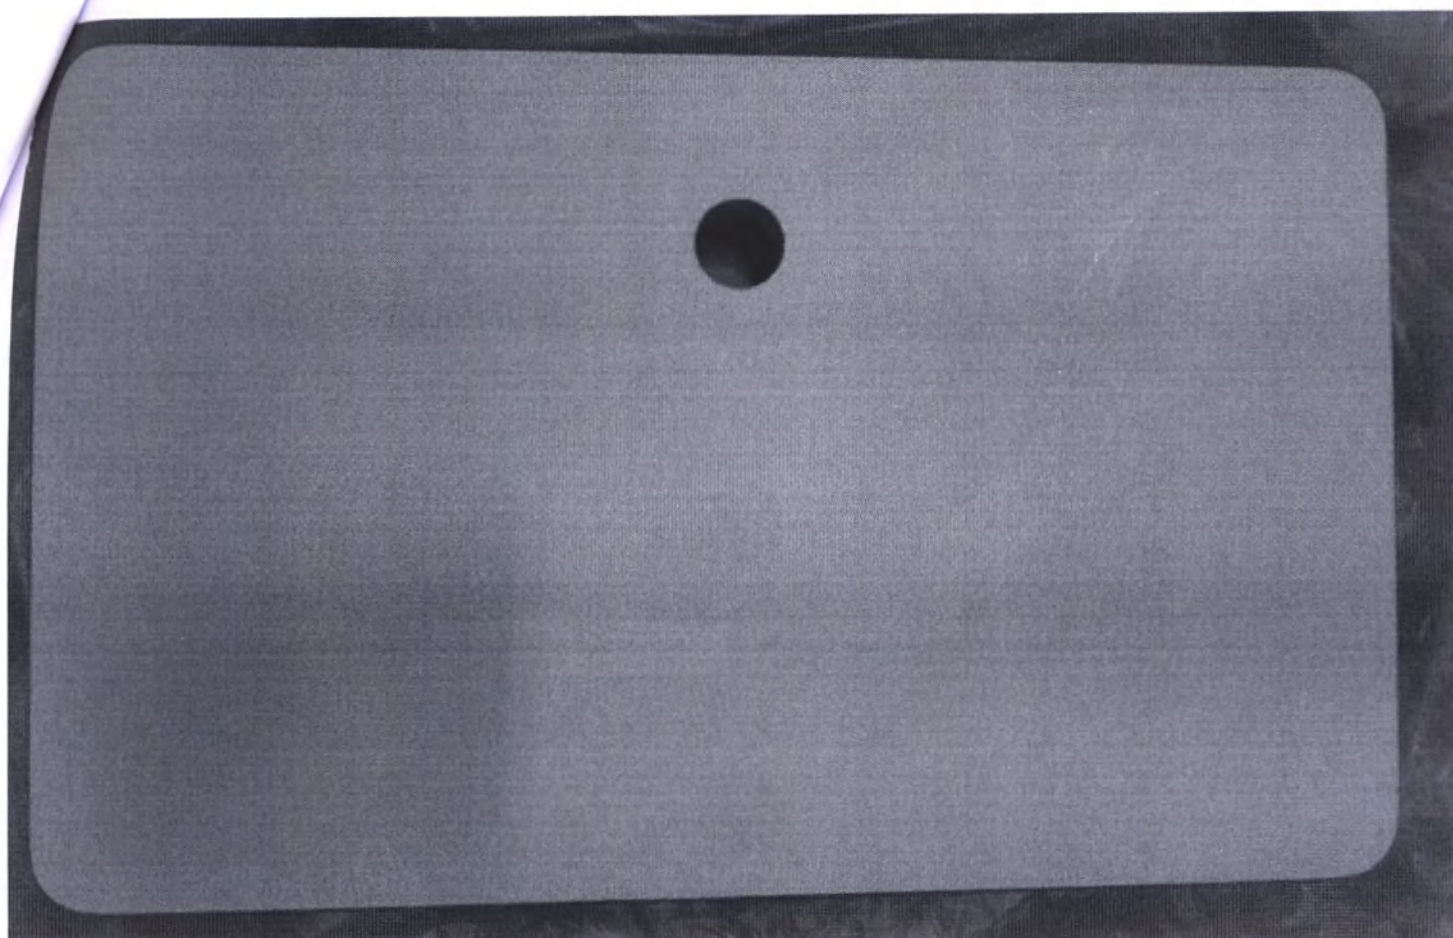


Вид сверху

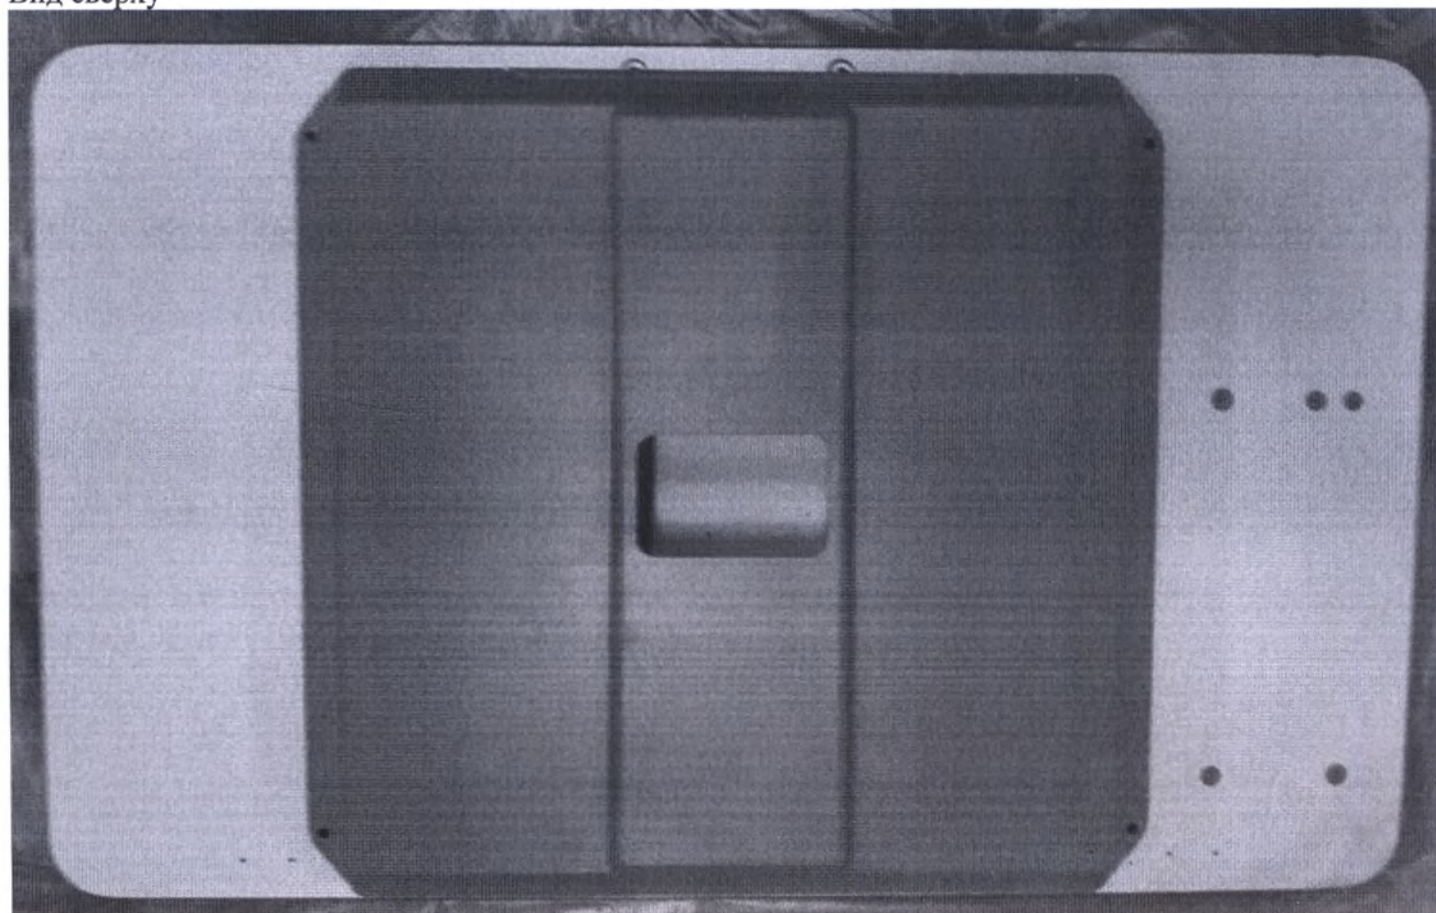


Вид снизу


Колонна электромеханическая телескопическая - 1 шт.

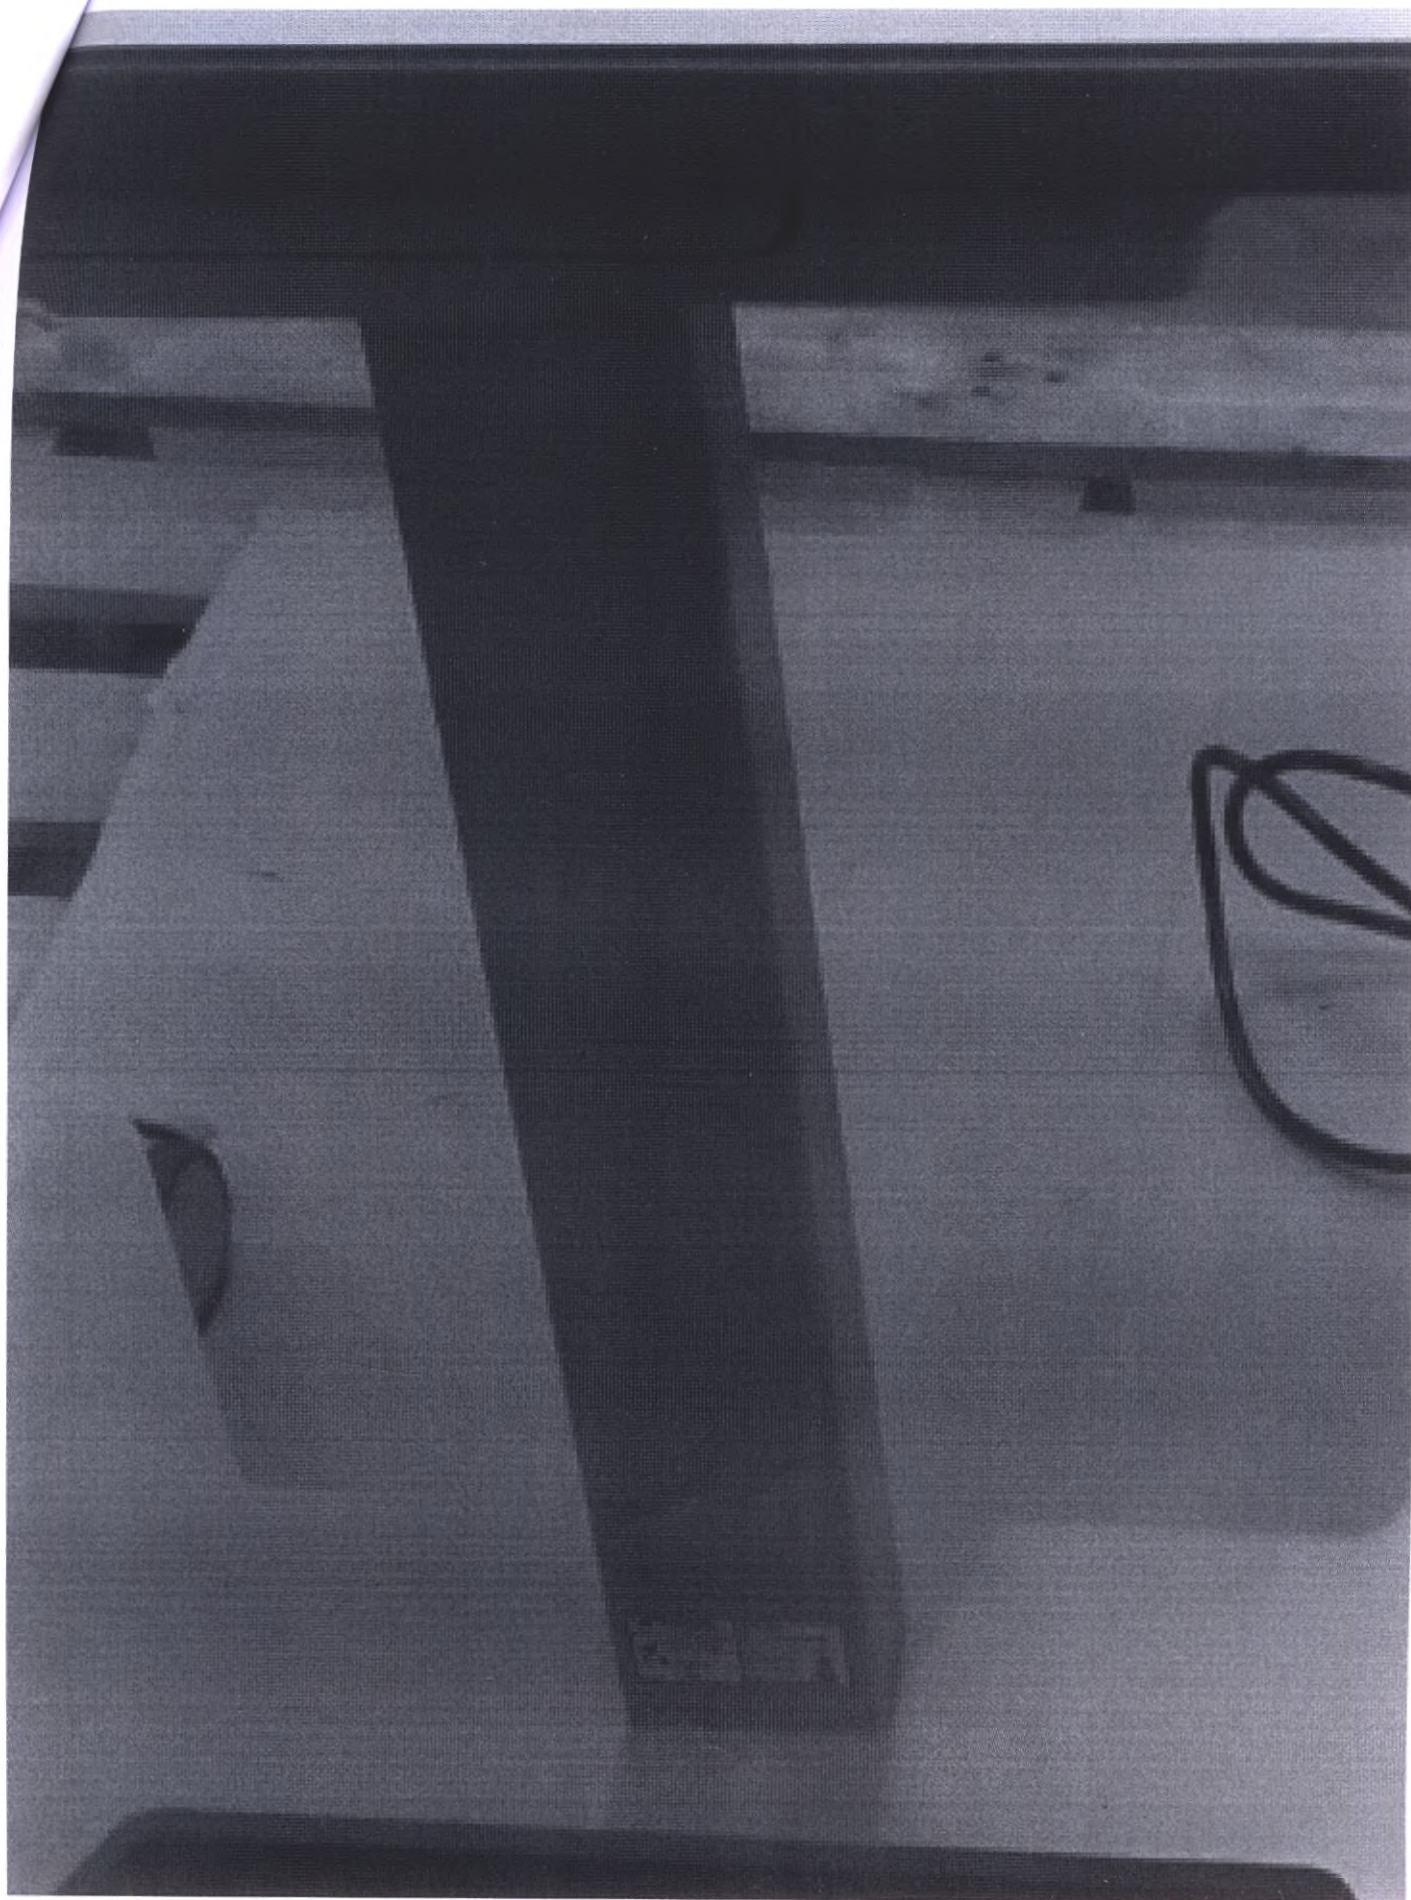


Основание Н-образное - 1 шт.

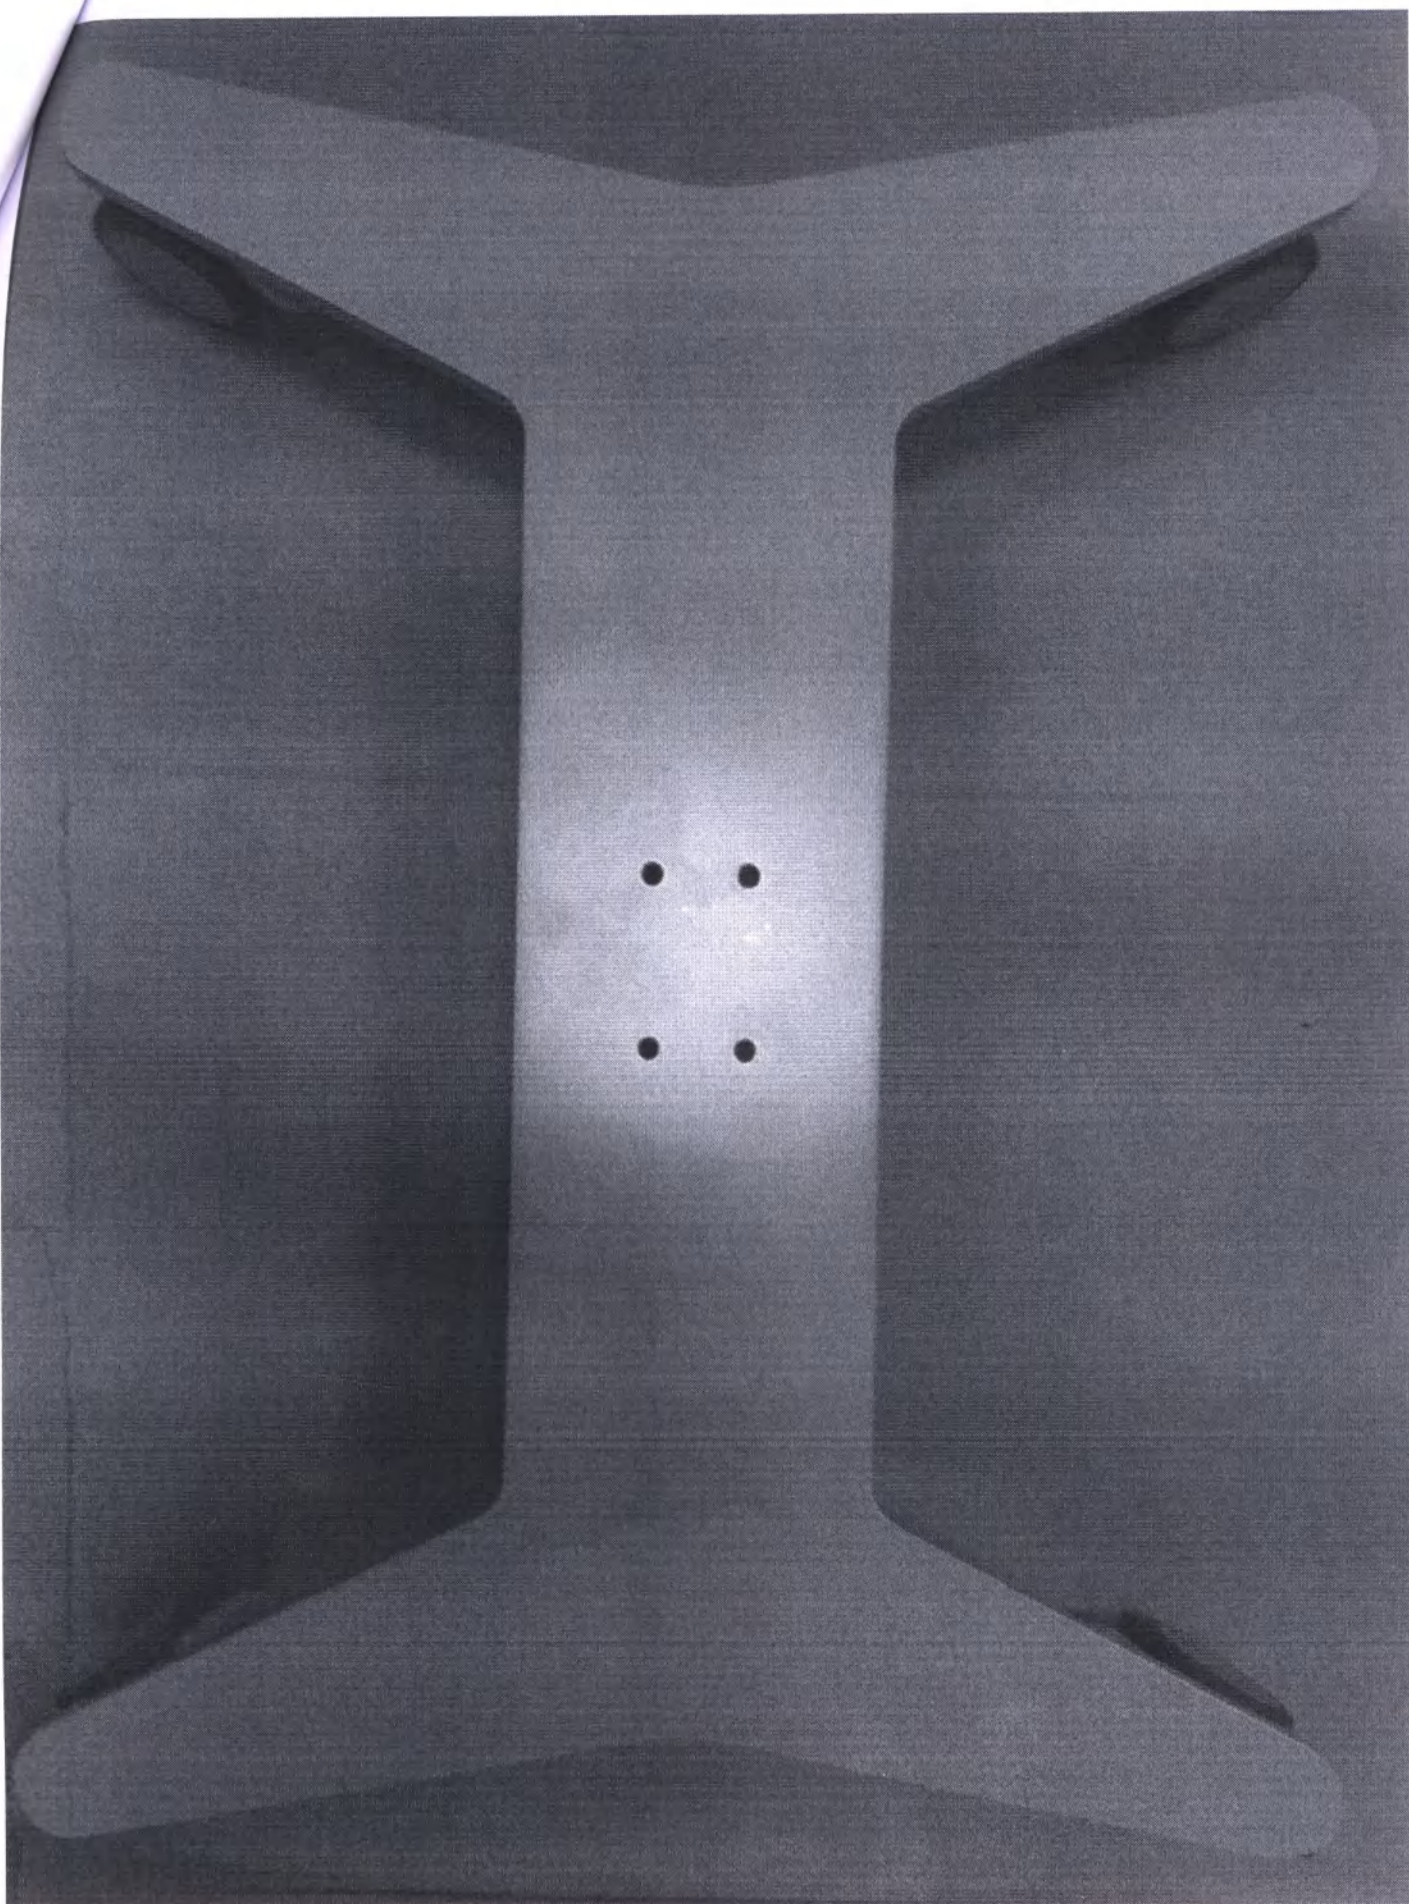


Колеса под основание - 4 шт.

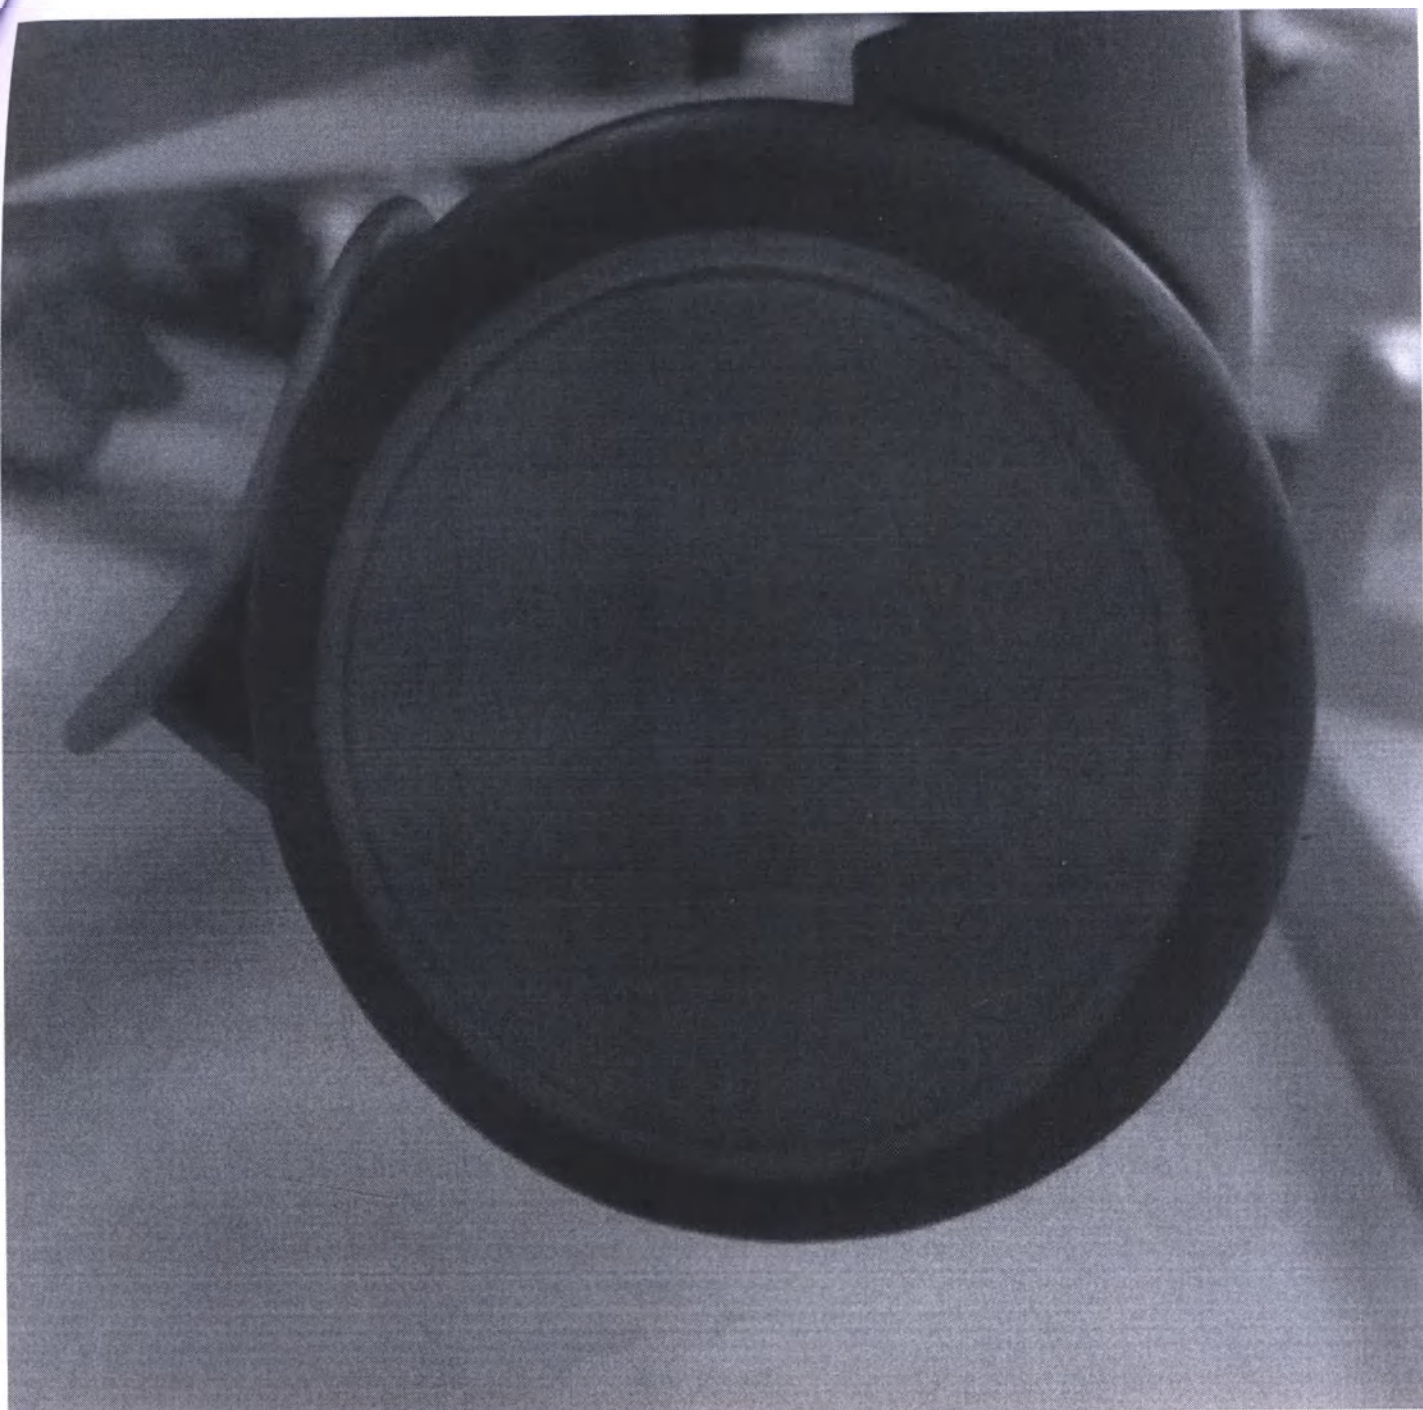


Кабель сетевой - 1 шт.

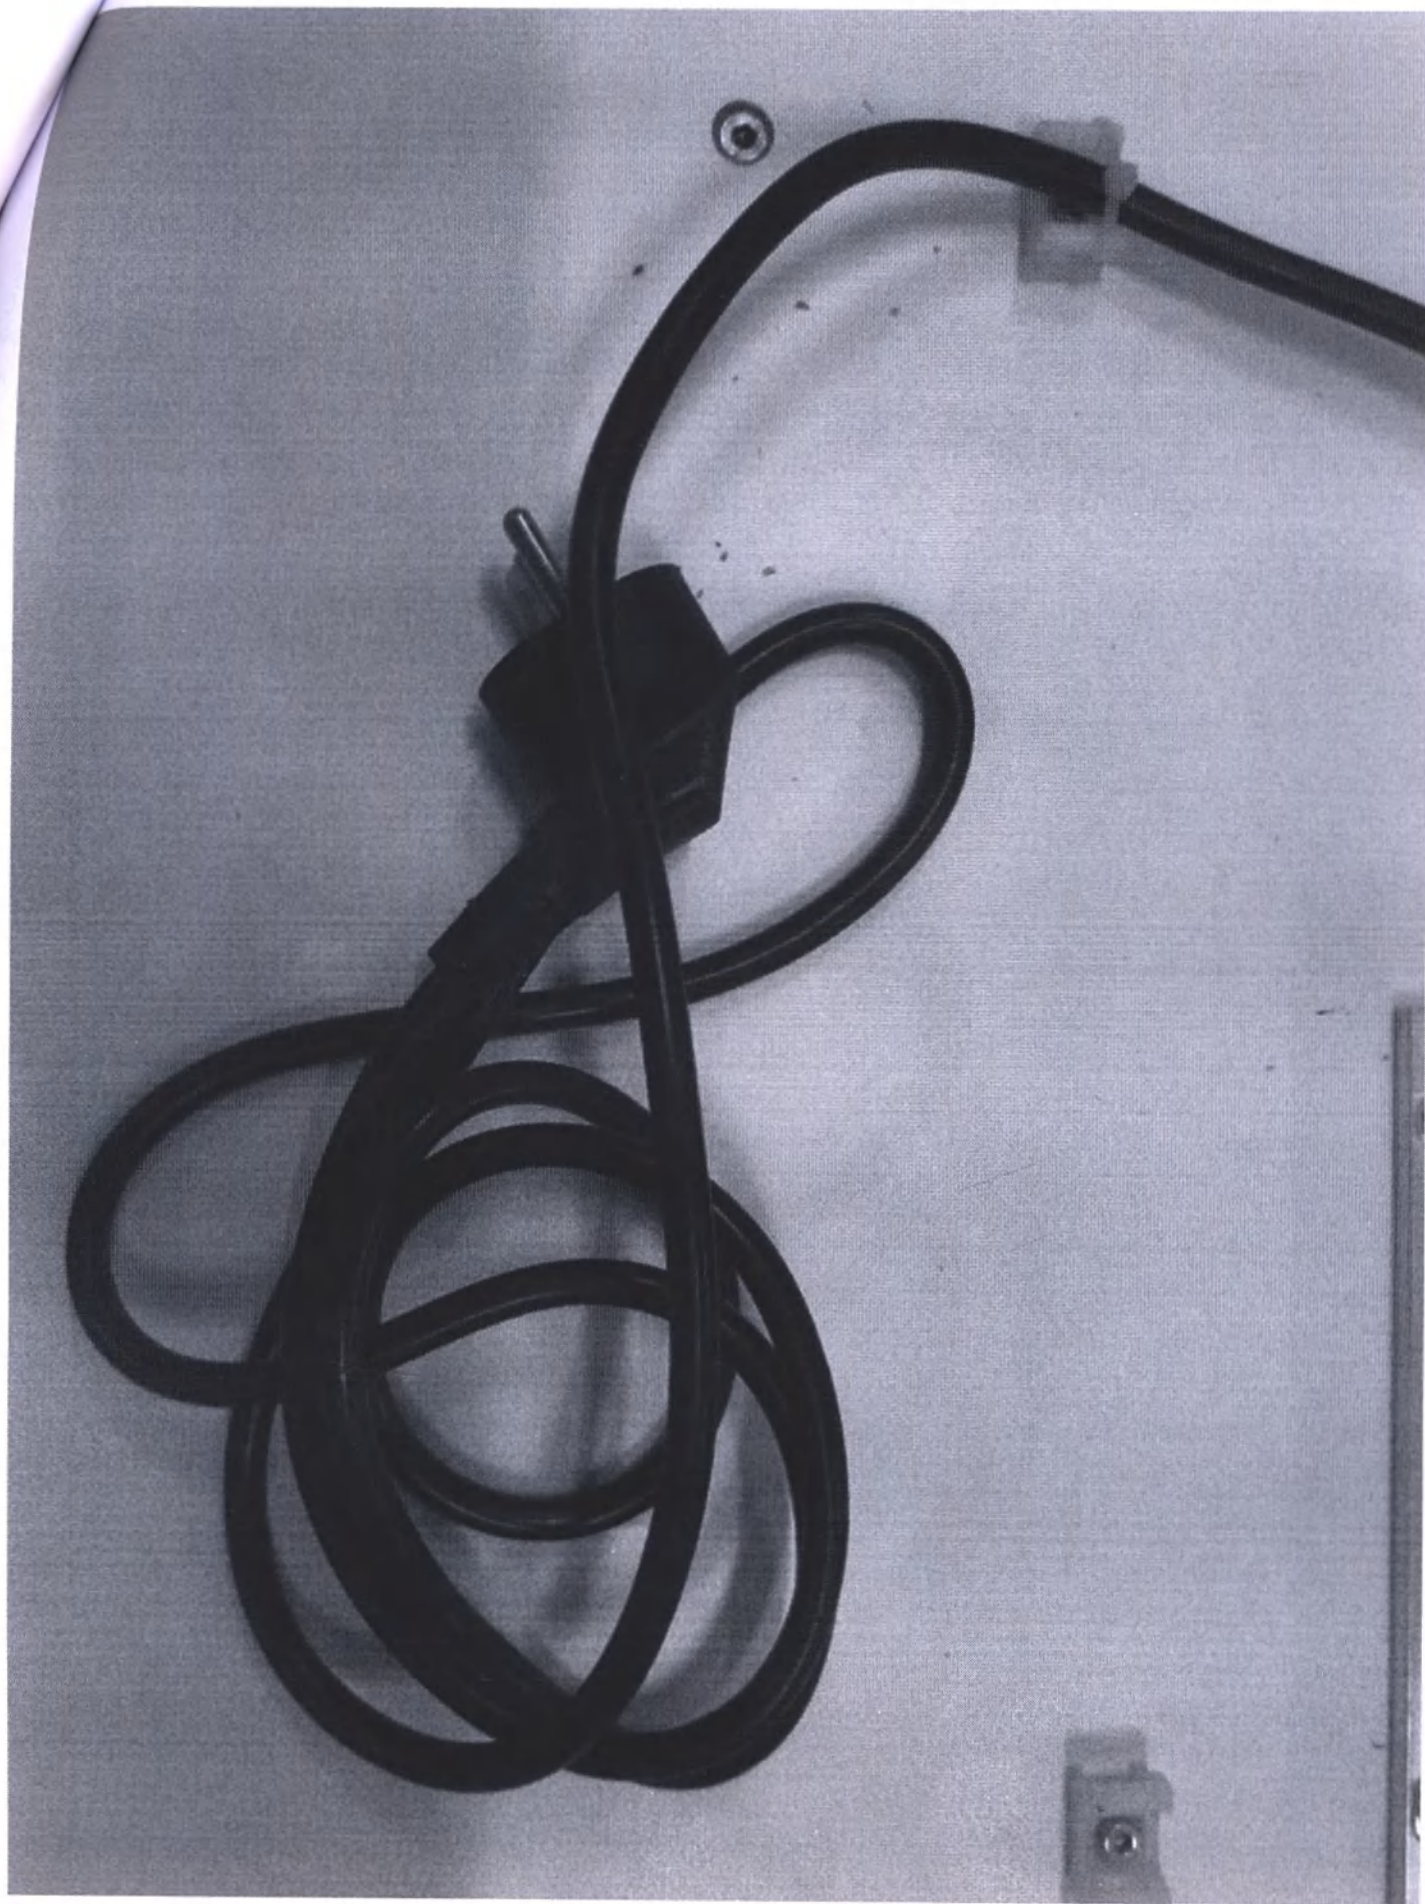

Пульт управления - 1 шт.

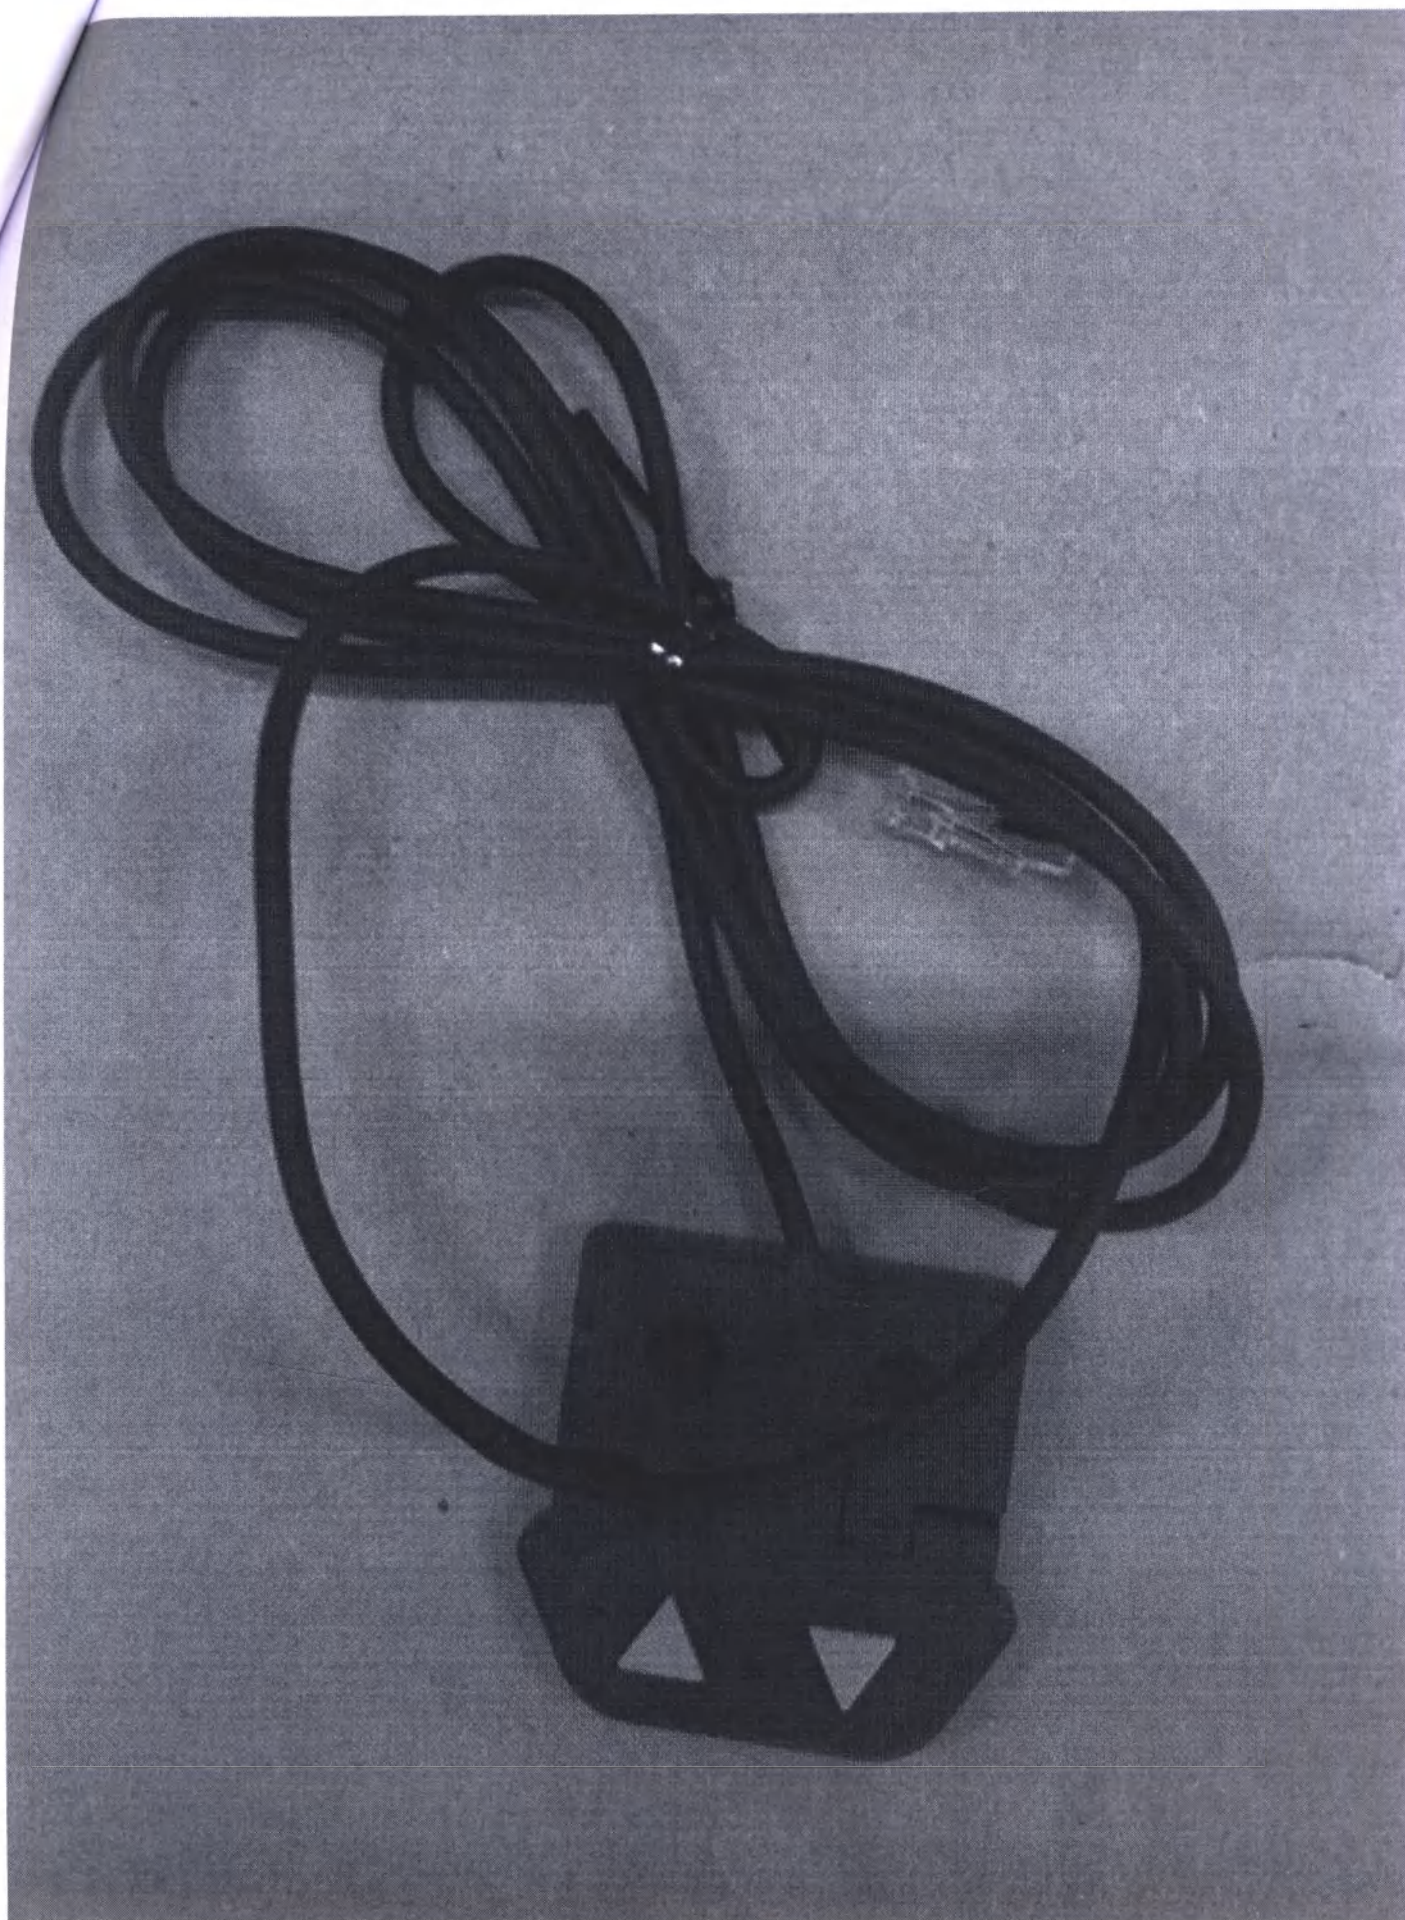

Заглушка пластиковая - 1 шт.

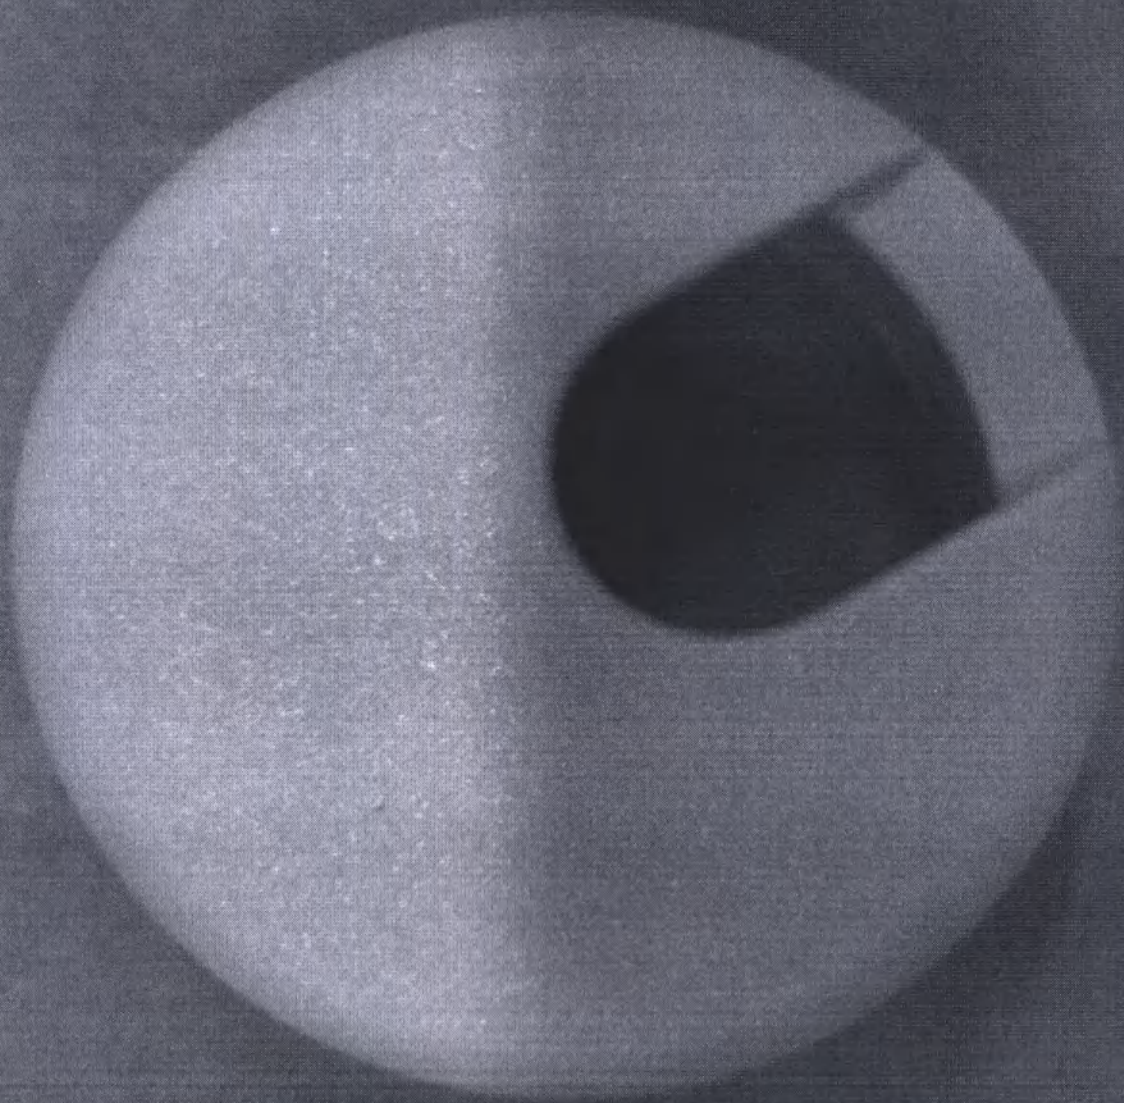

 Стол офтальмологический электрический «АТЕ»	Руководство по эксплуатации на МИ	Номер документа: RU-2020/08/TOPCON/ATE	
		Версия: 1	Страница: 1 из 49
Производитель: "АНТОНИ КАРЛЕС, С.А." (ANTONI CARLES, S.A.)	Уполномоченный представитель в РФ: Общество с ограниченной ответственностью "Тринити Медикал Системс"		Дата выпуска: 2020-08-02

Руководство по эксплуатации

Стол офтальмологический электрический «АТЕ»

Варианты исполнения:

Стол офтальмологический электрический АТЕ-300 в составе
Стол офтальмологический электрический АТЕ-600 в составе
Стол офтальмологический электрический АТЕ-700 в составе
Стол офтальмологический электрический АТЕ-700РС BOX в составе
Стол офтальмологический электрический АТЕ-800 в составе

(Настоящее руководство подготовлено для предоставления сведений в целях регистрации медицинского изделия на территории Российской Федерации. Сведения представлены в объеме, требуемом в соответствии с Правилами регистрации медицинских изделий (постановление Правительства РФ от 27.12.2012 №1416)


Производитель:
"АНТОНИ КАРЛЕС, С.А."
(ANTONI CARLES, S.A.)

2020


офтальмологический электрический АТЕ-600 в составе:
Столешница прямоугольная (44х61см) - 1 шт.




2.2. Столешница прямоугольная (57,5x91см) - 1 шт. (при необходимости).

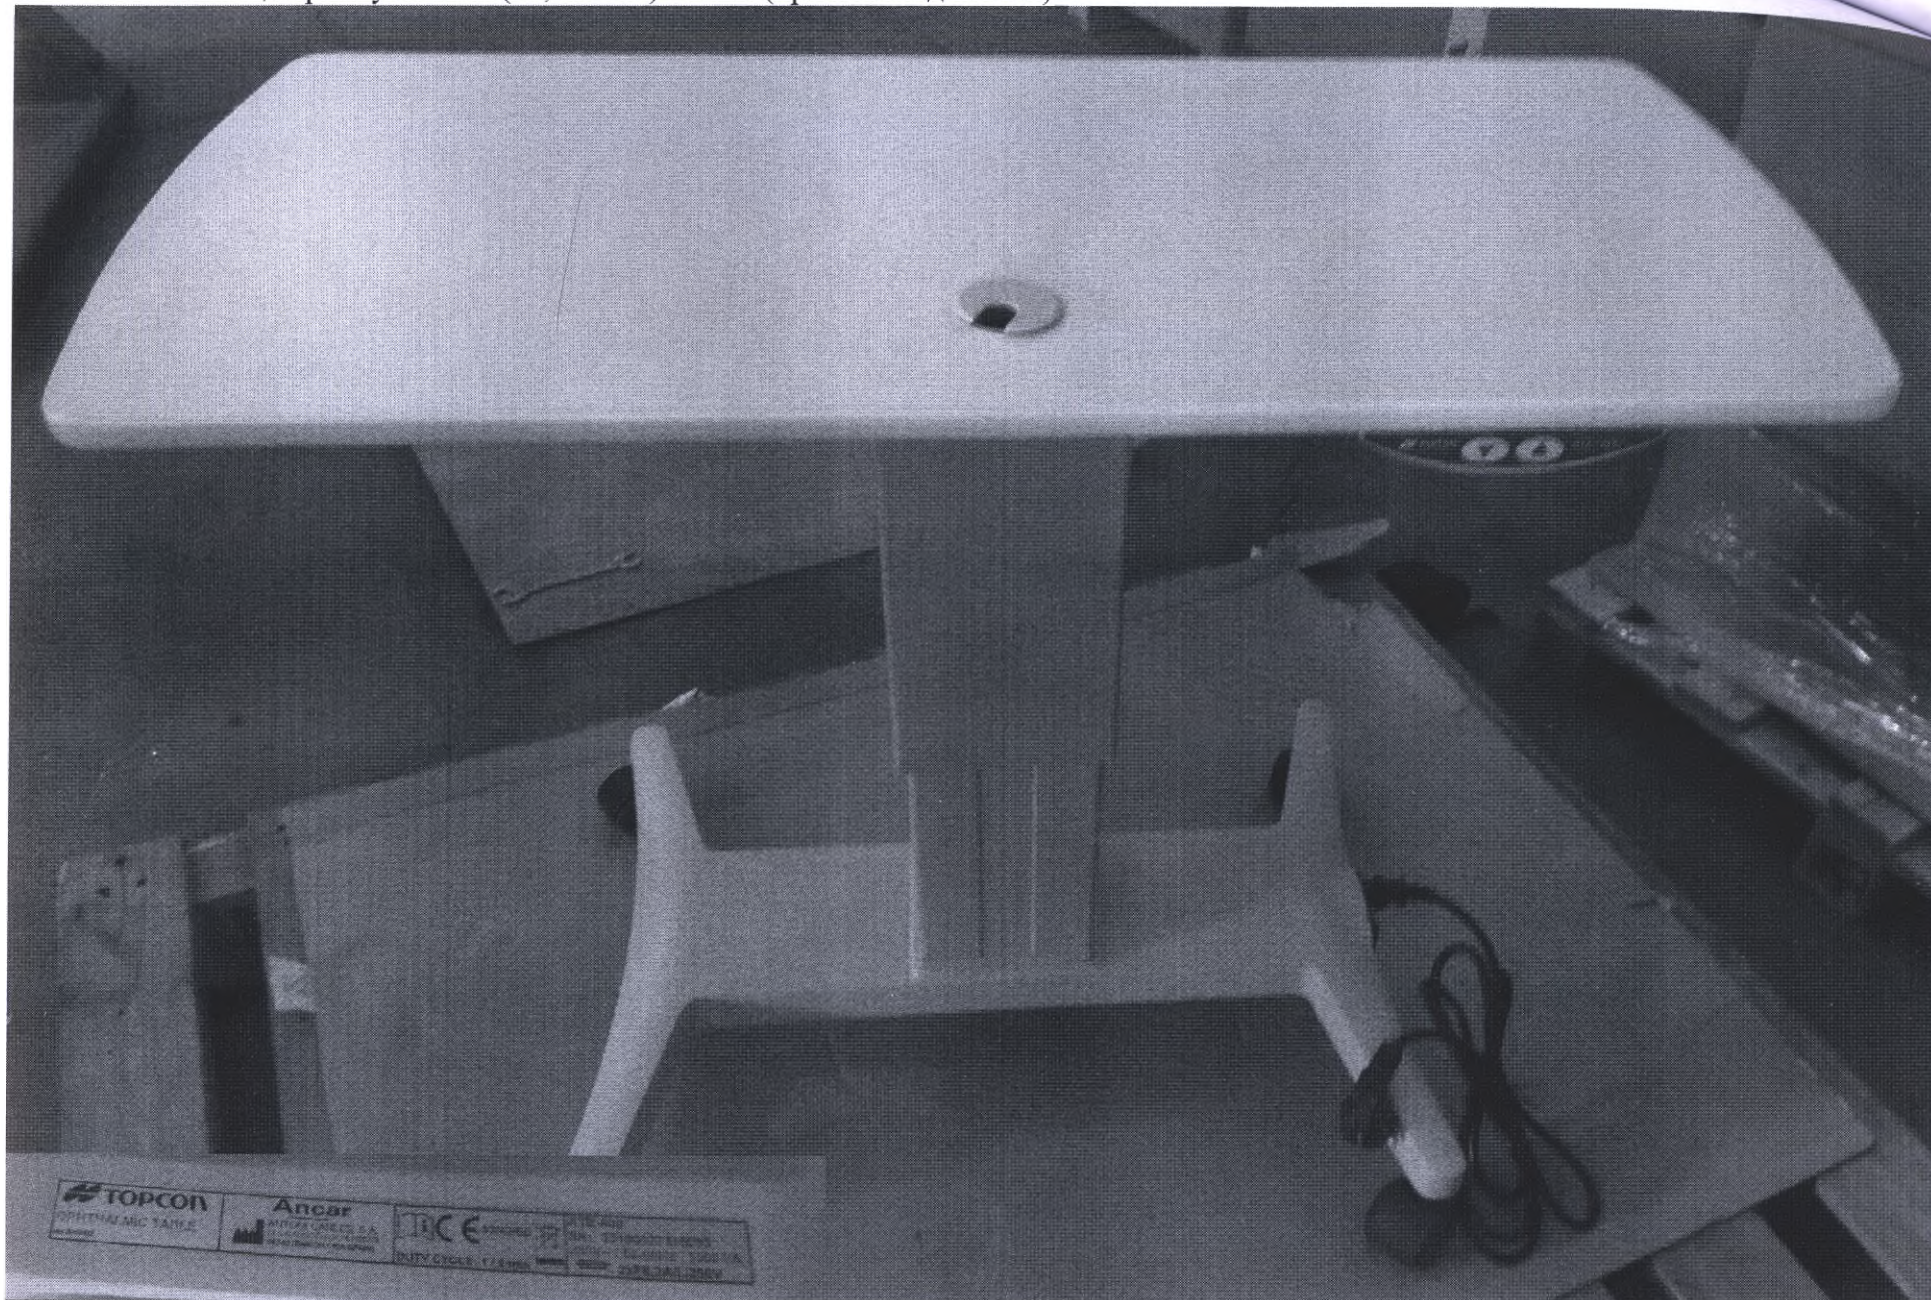


2.3. Столешница V-образная - 1 шт. (при необходимости).

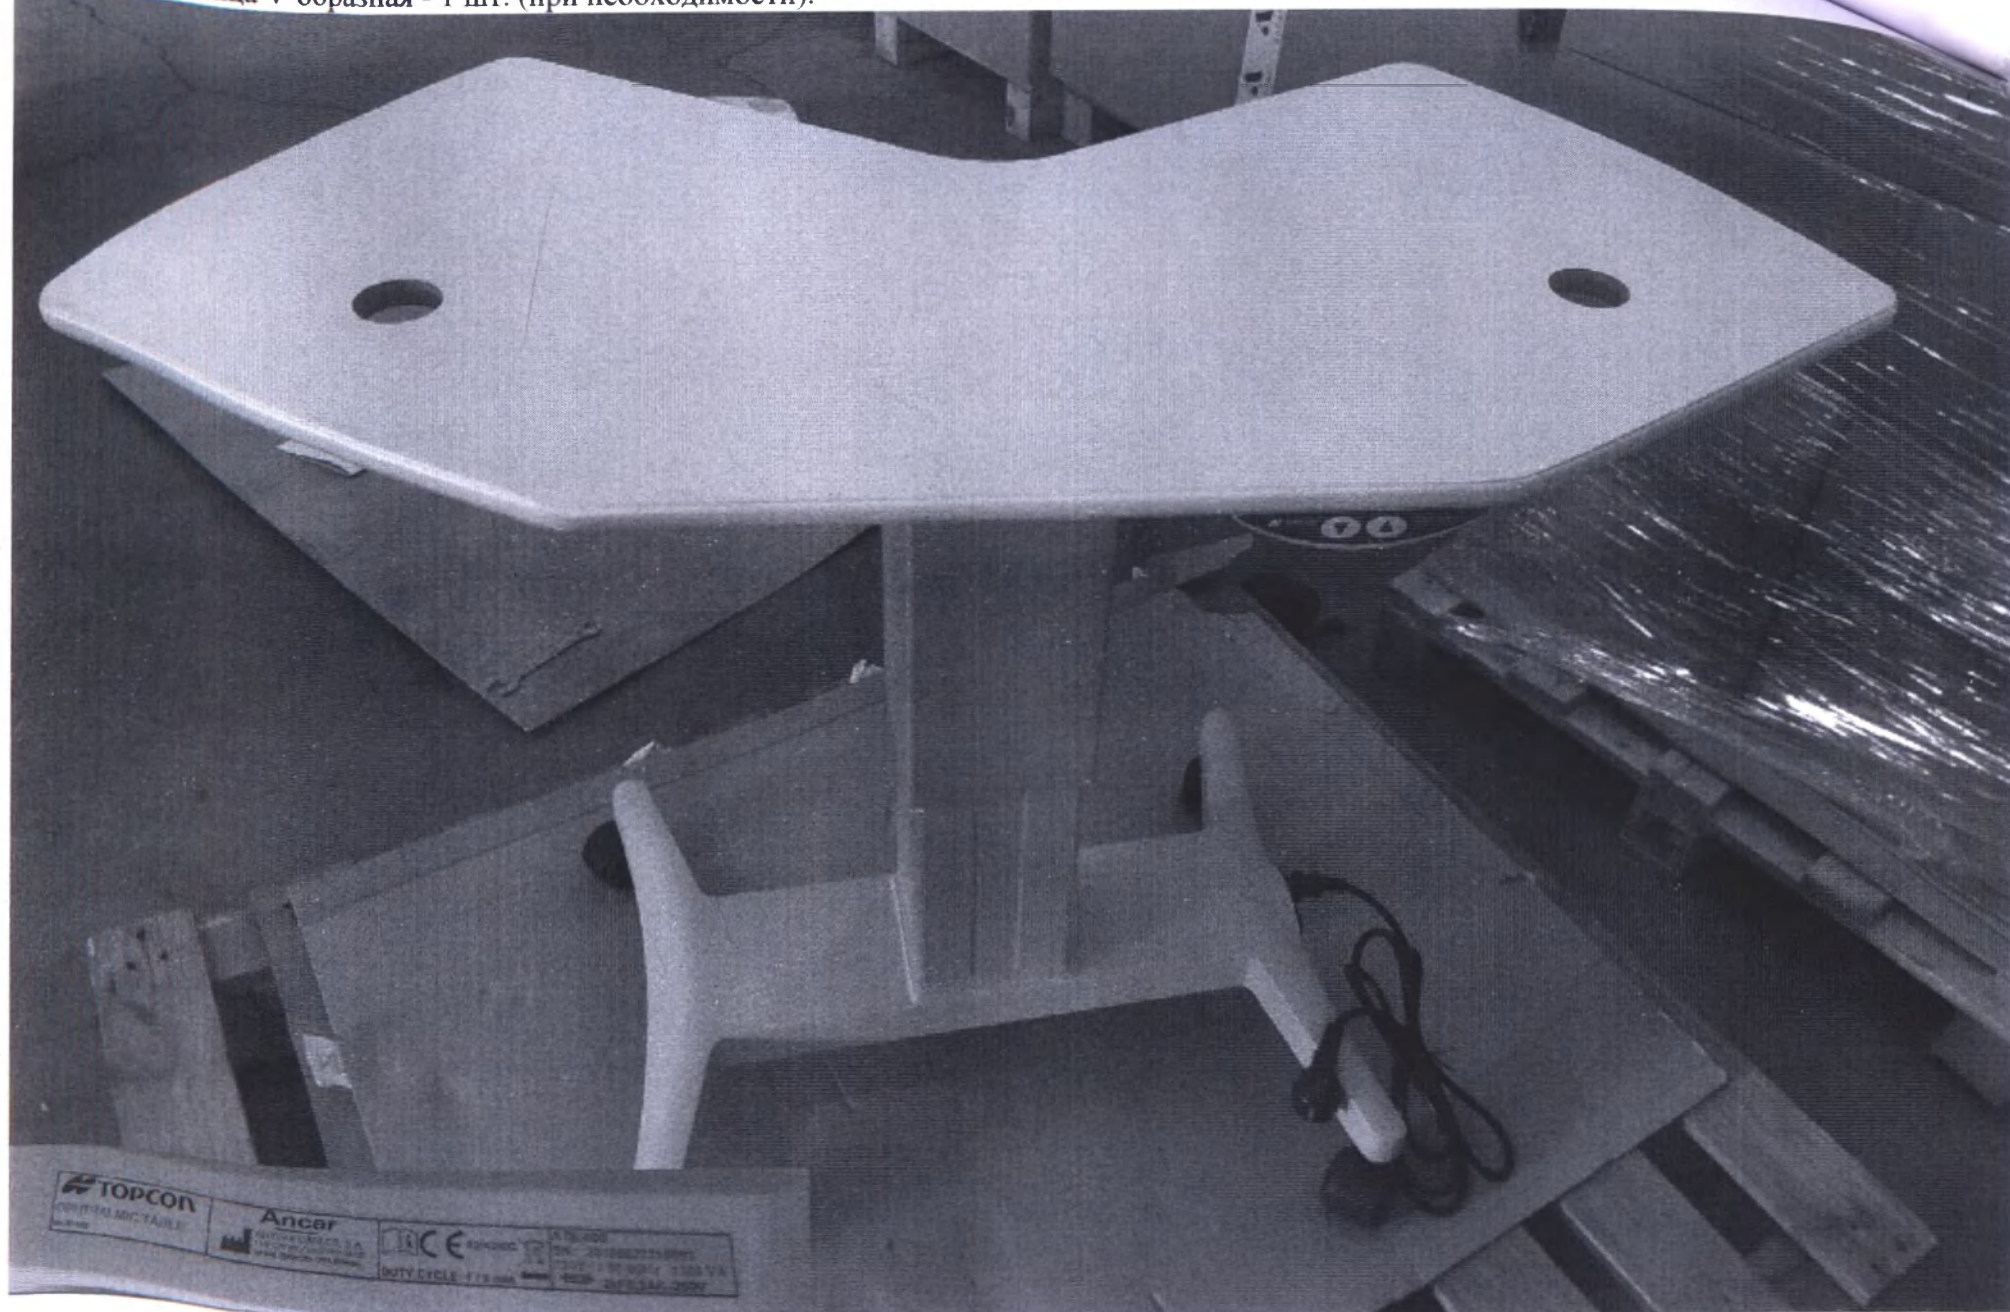


2.4. Колонна электромеханическая телескопическая - 1 шт.

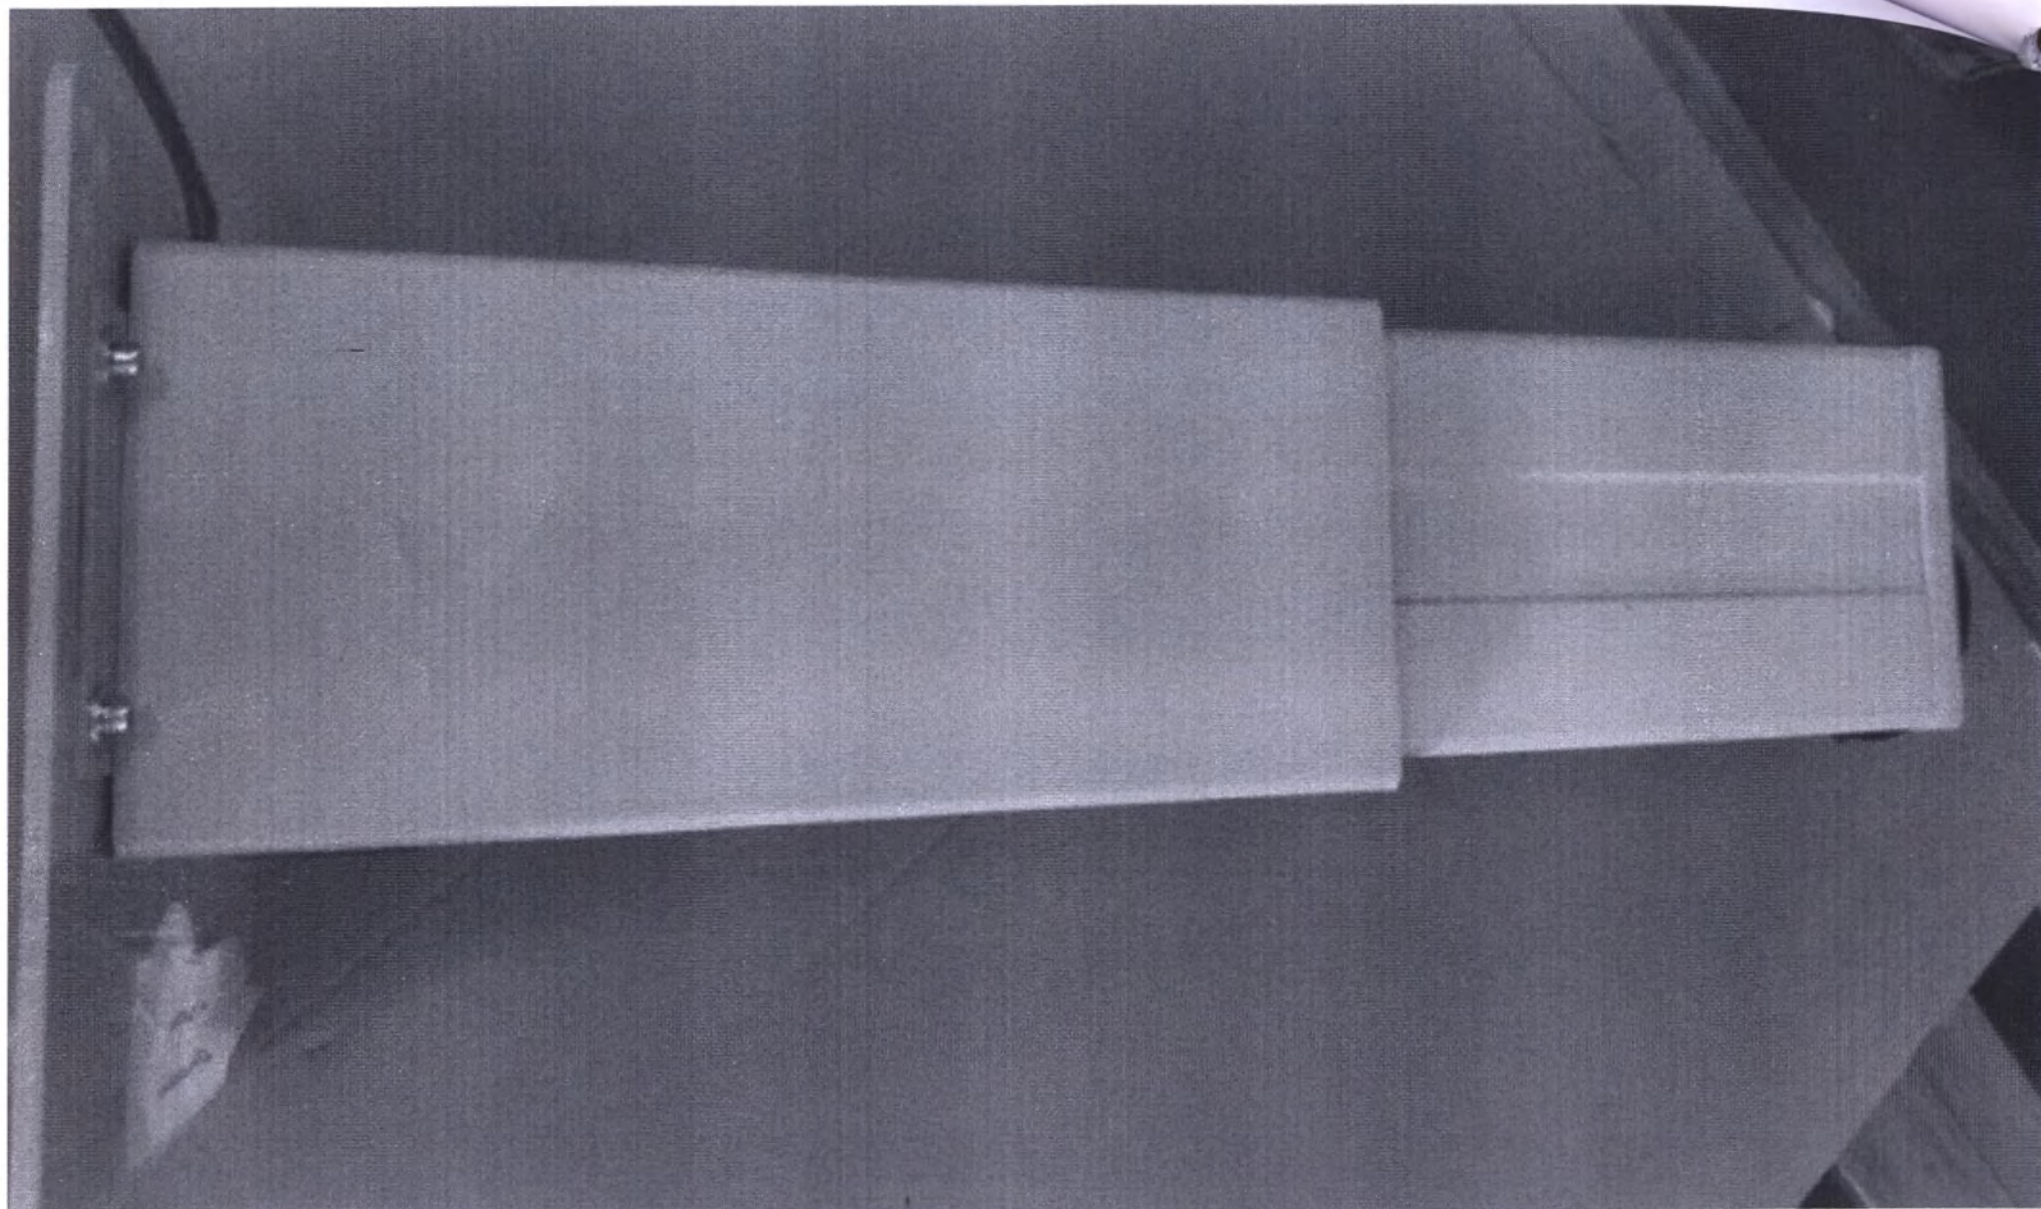


2.5. Основание Н-образное - 1 шт.

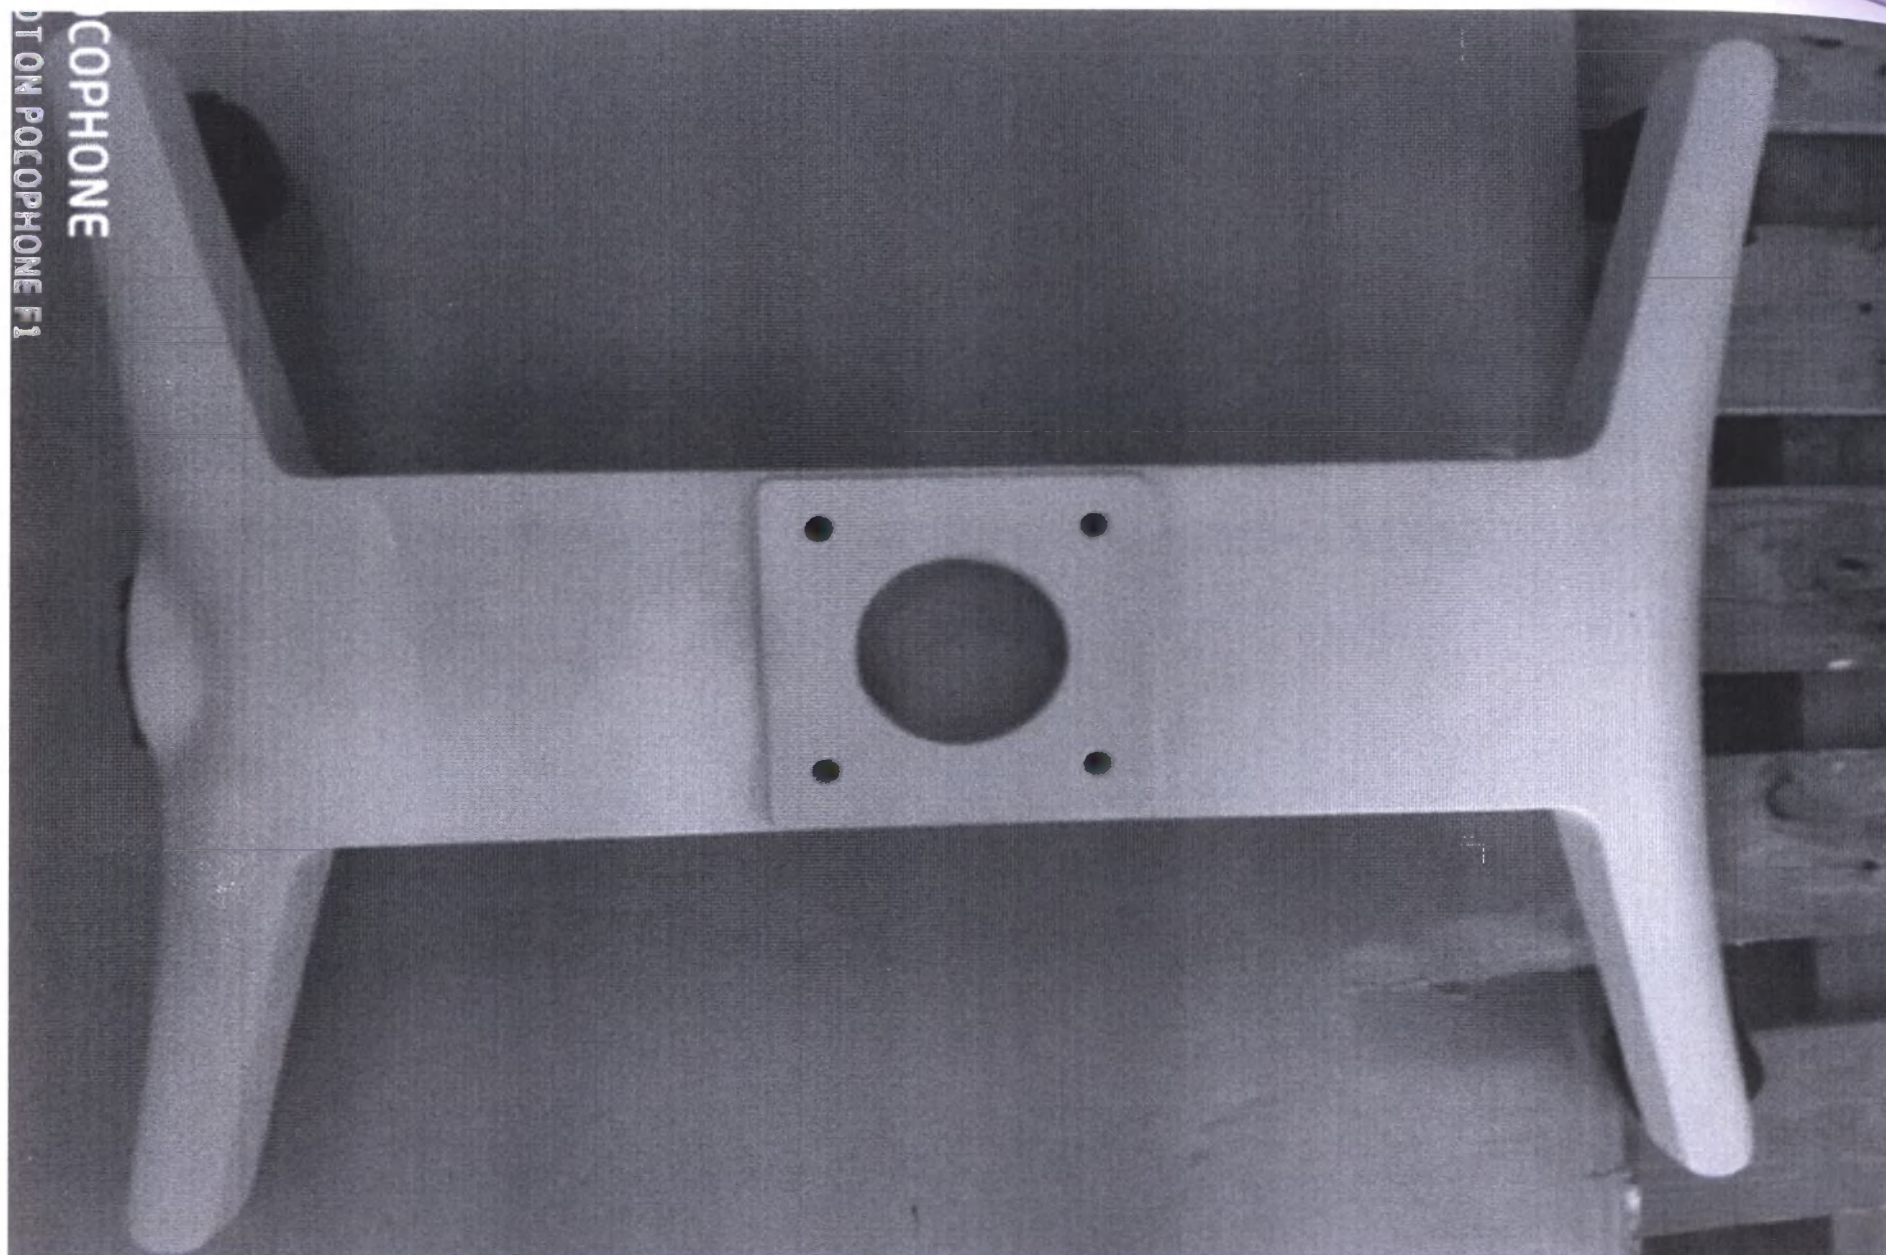


2.6. Колеса под основание - 4 шт.

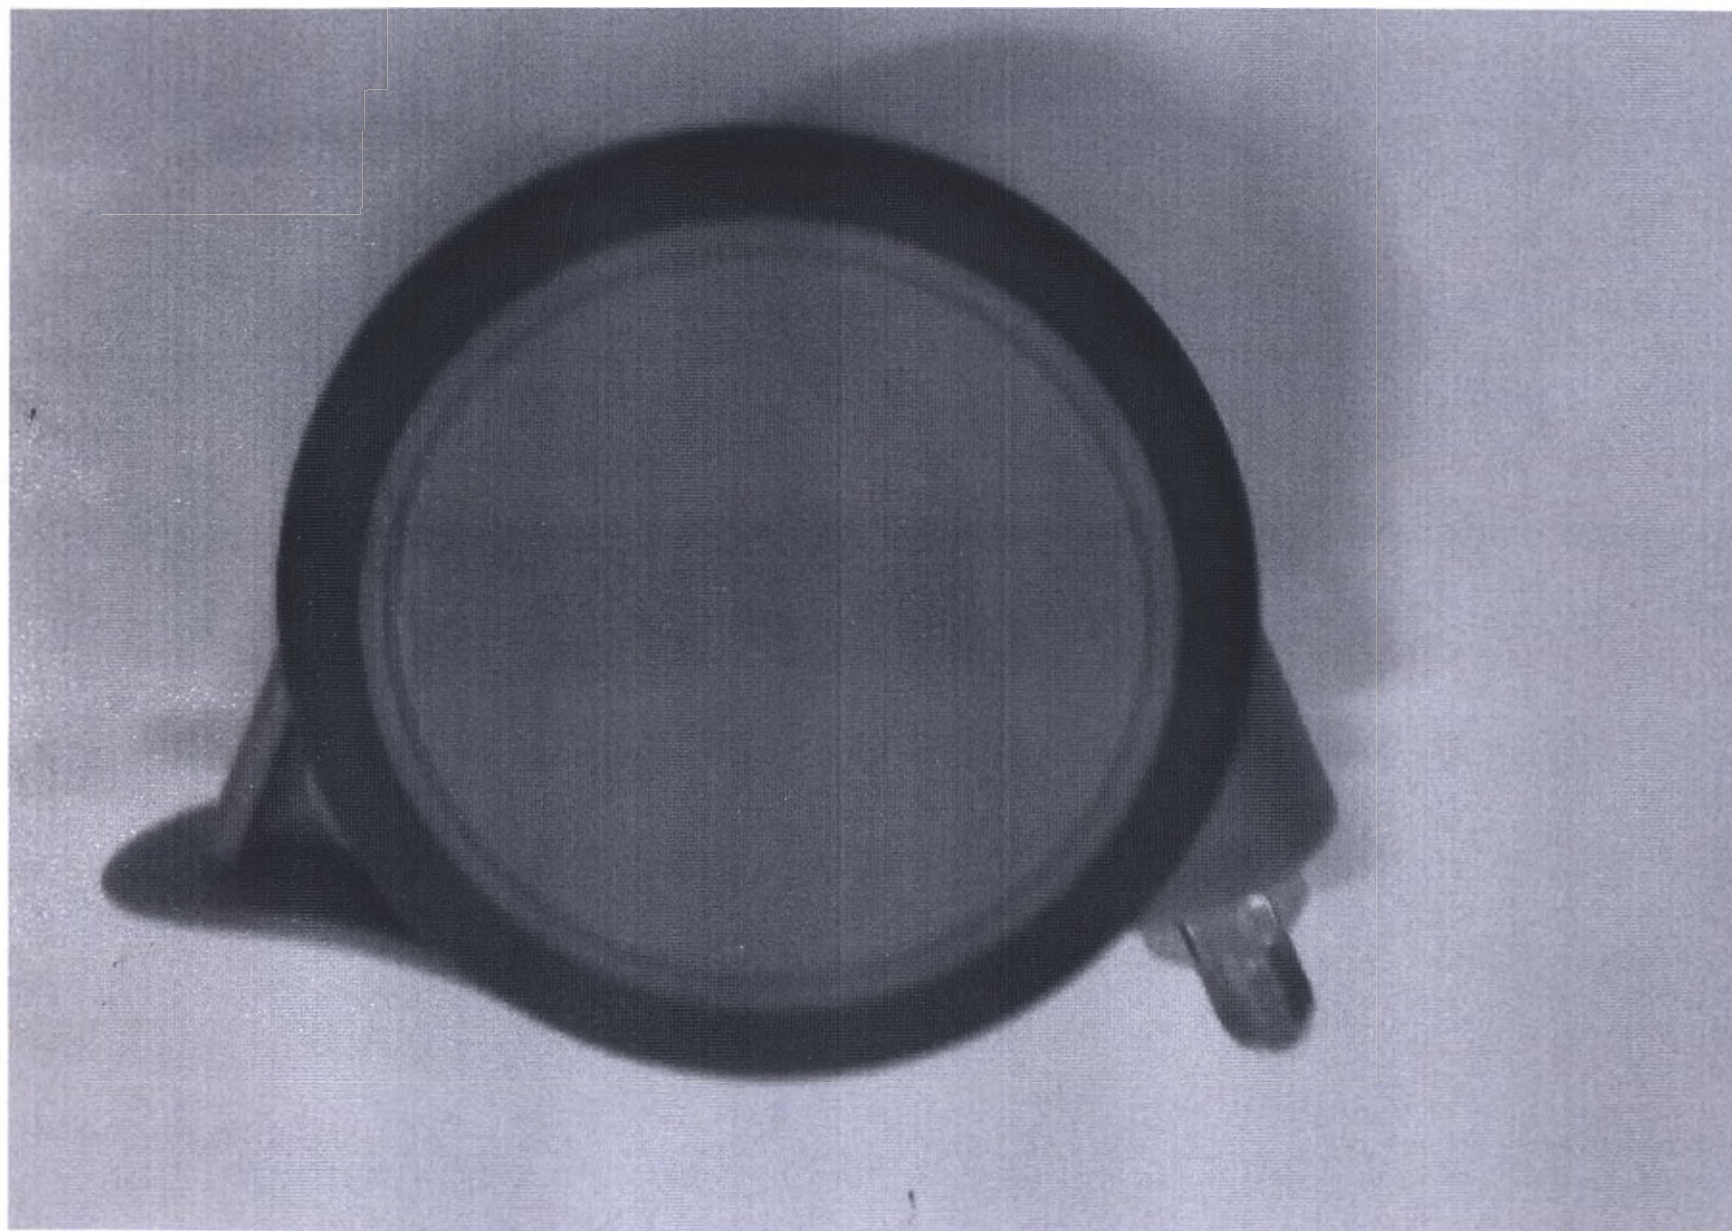

2.7. Кабель сетевой - 1 шт.

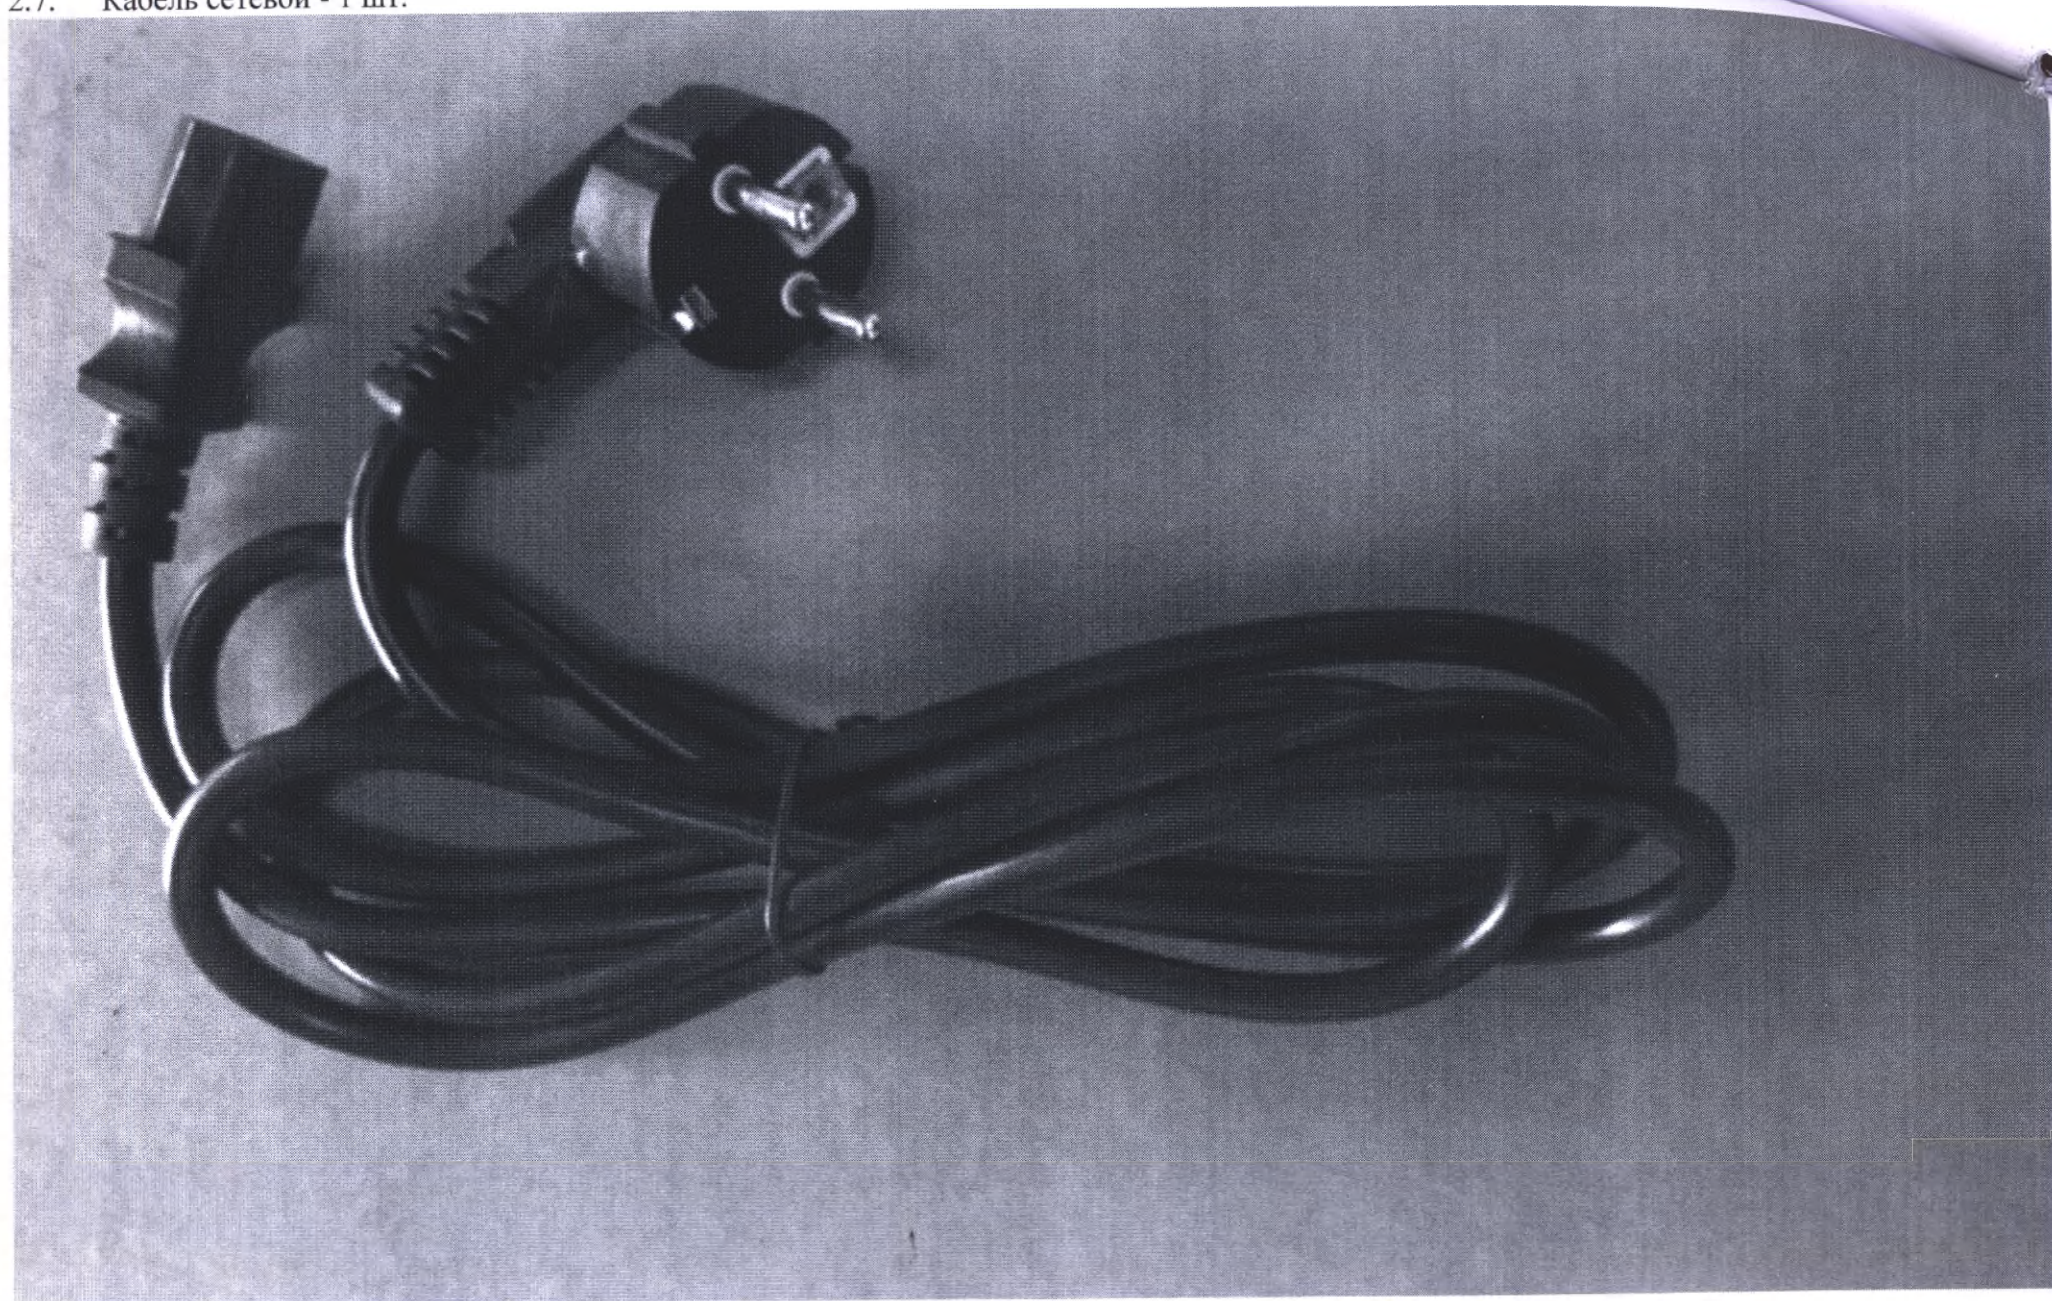

2.8. Пульт управления - 1 шт.

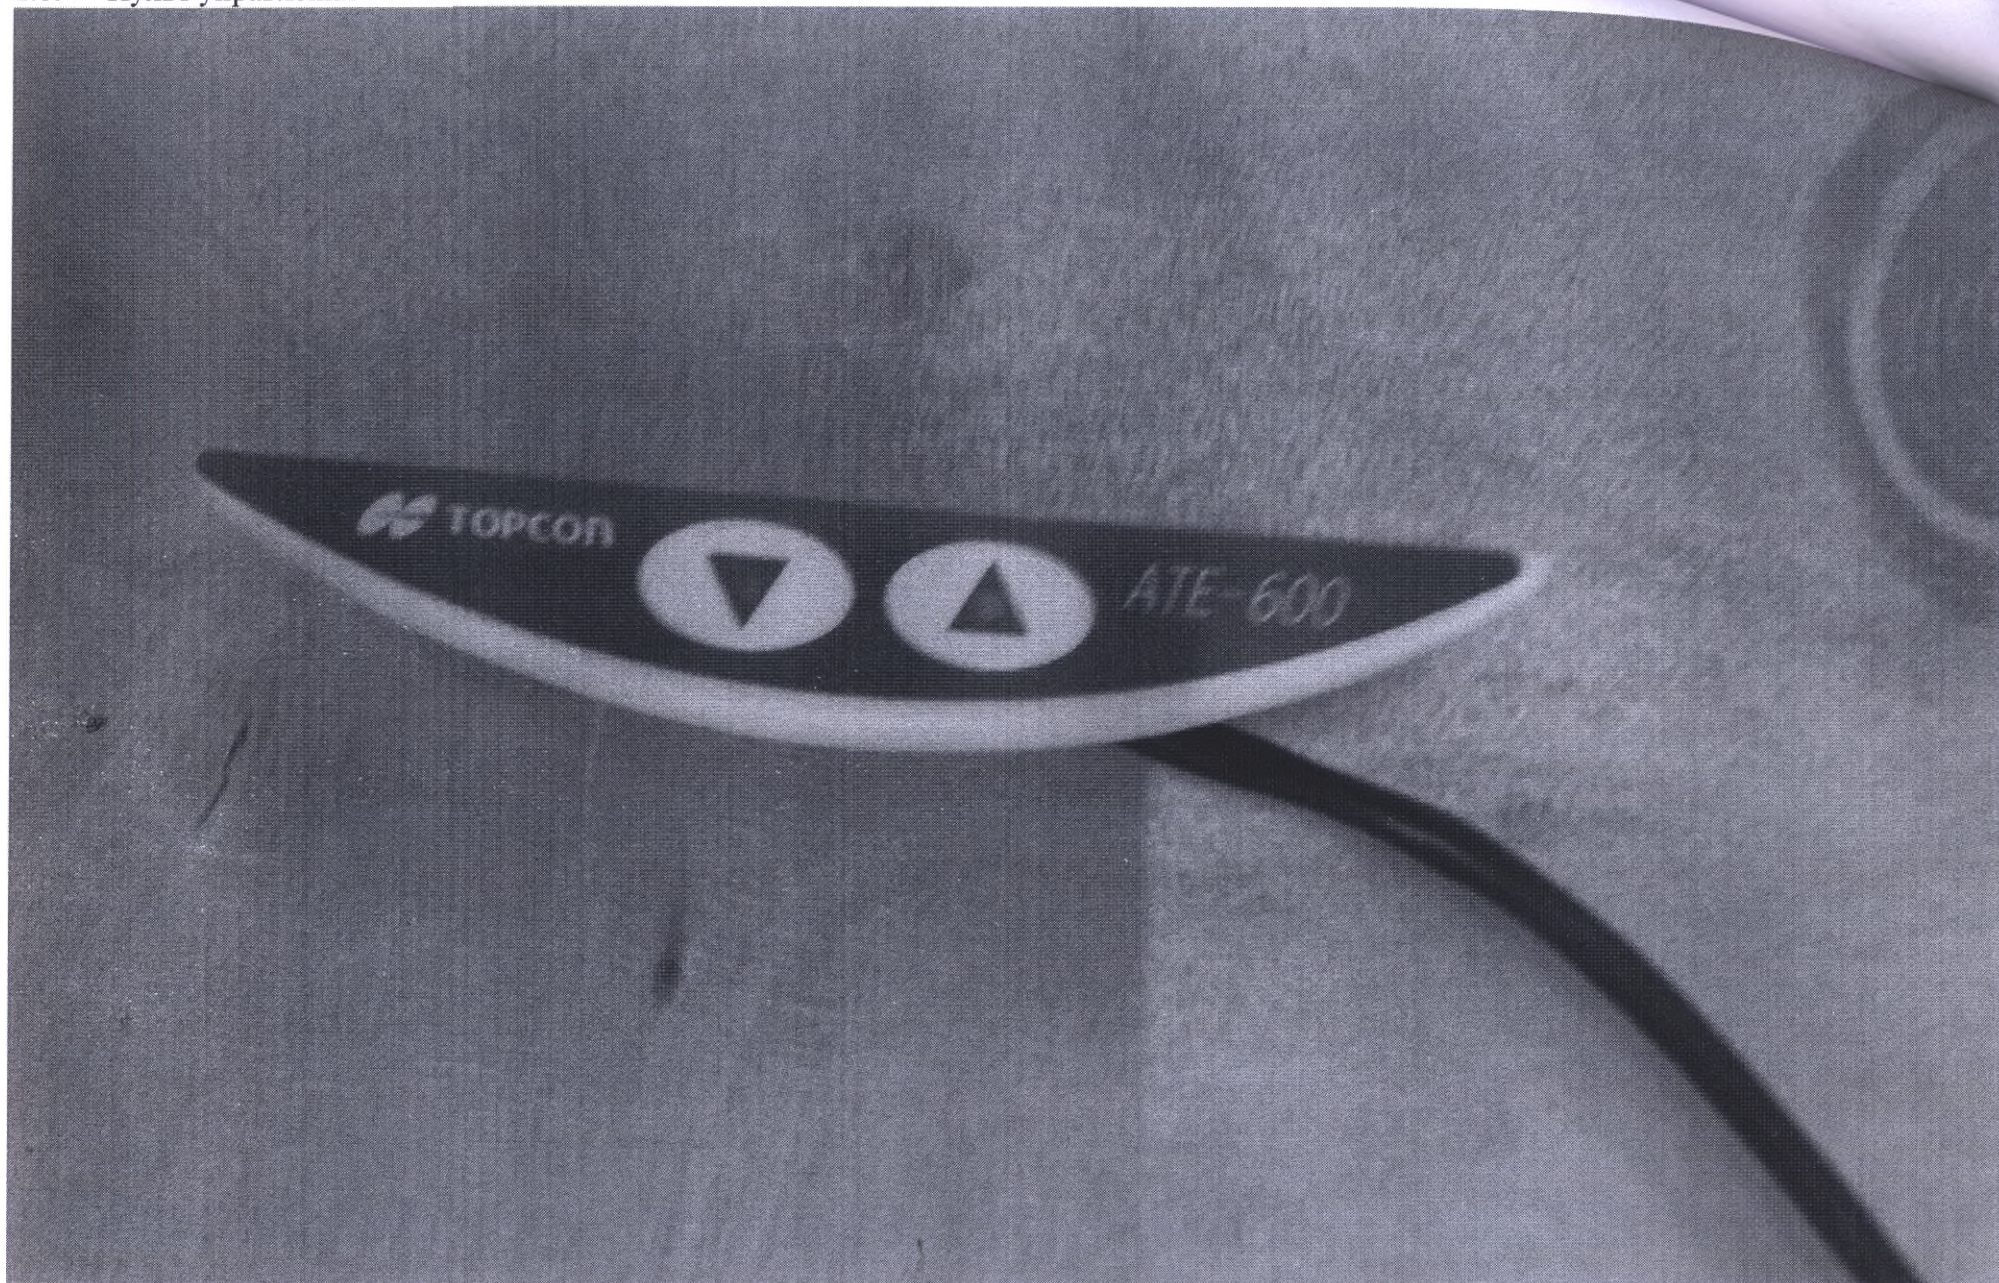

 Стол офтальмологический электрический «АТЕ»	Руководство по эксплуатации на МИ	Номер документа: RU-2020/08/TOPCON/ATE	
		Версия: 1	Страница: 1 из 49
Производитель: "АНТОНИ КАРЛЕС, С.А." (ANTONI CARLES, S.A.)	Уполномоченный представитель в РФ: Общество с ограниченной ответственностью "Тринити Медикал Системс"		Дата выпуска: 2020-08-02

Руководство по эксплуатации

Стол офтальмологический электрический «АТЕ» Варианты исполнения:

Стол офтальмологический электрический АТЕ-300 в составе
Стол офтальмологический электрический АТЕ-600 в составе
Стол офтальмологический электрический АТЕ-700 в составе
Стол офтальмологический электрический АТЕ-700РС BOX в составе
Стол офтальмологический электрический АТЕ-800 в составе


(Настоящее руководство подготовлено для предоставления сведений в целях регистрации медицинского изделия на территории Российской Федерации. Сведения представлены в объеме, требуемом в соответствии с Правилами регистрации медицинских изделий (постановление Правительства РФ от 27.12.2012 №1416)

Производитель:
"АНТОНИ КАРЛЕС, С.А."
(ANTONI CARLES, S.A.)


2020

3. Стол офтальмологический электрический АТЕ-700 в составе:


3.1. Столешница прямоугольная с блоком питания - 1 шт.

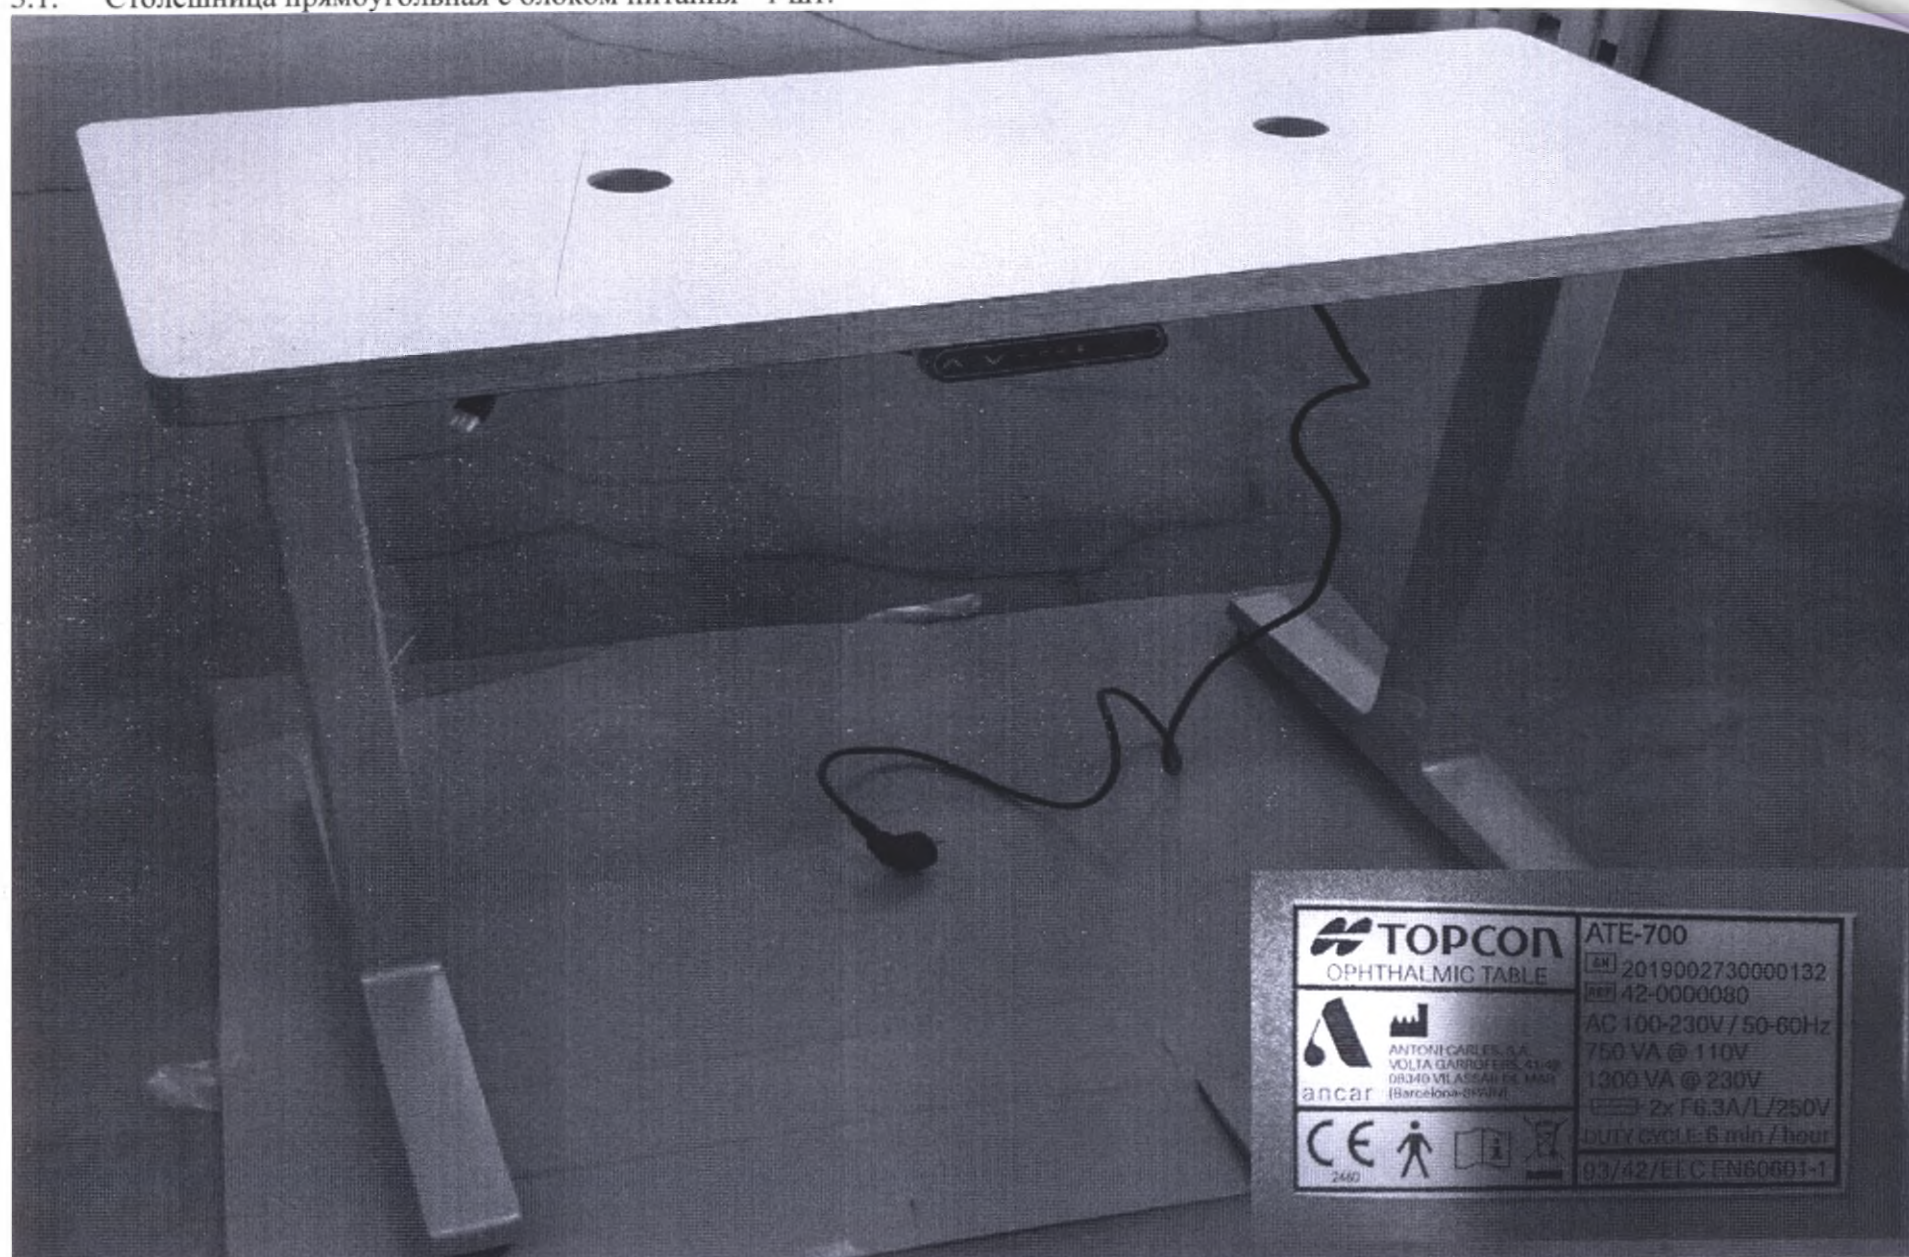


3.2. Колонна электромеханическая телескопическая с основанием - 2 шт.

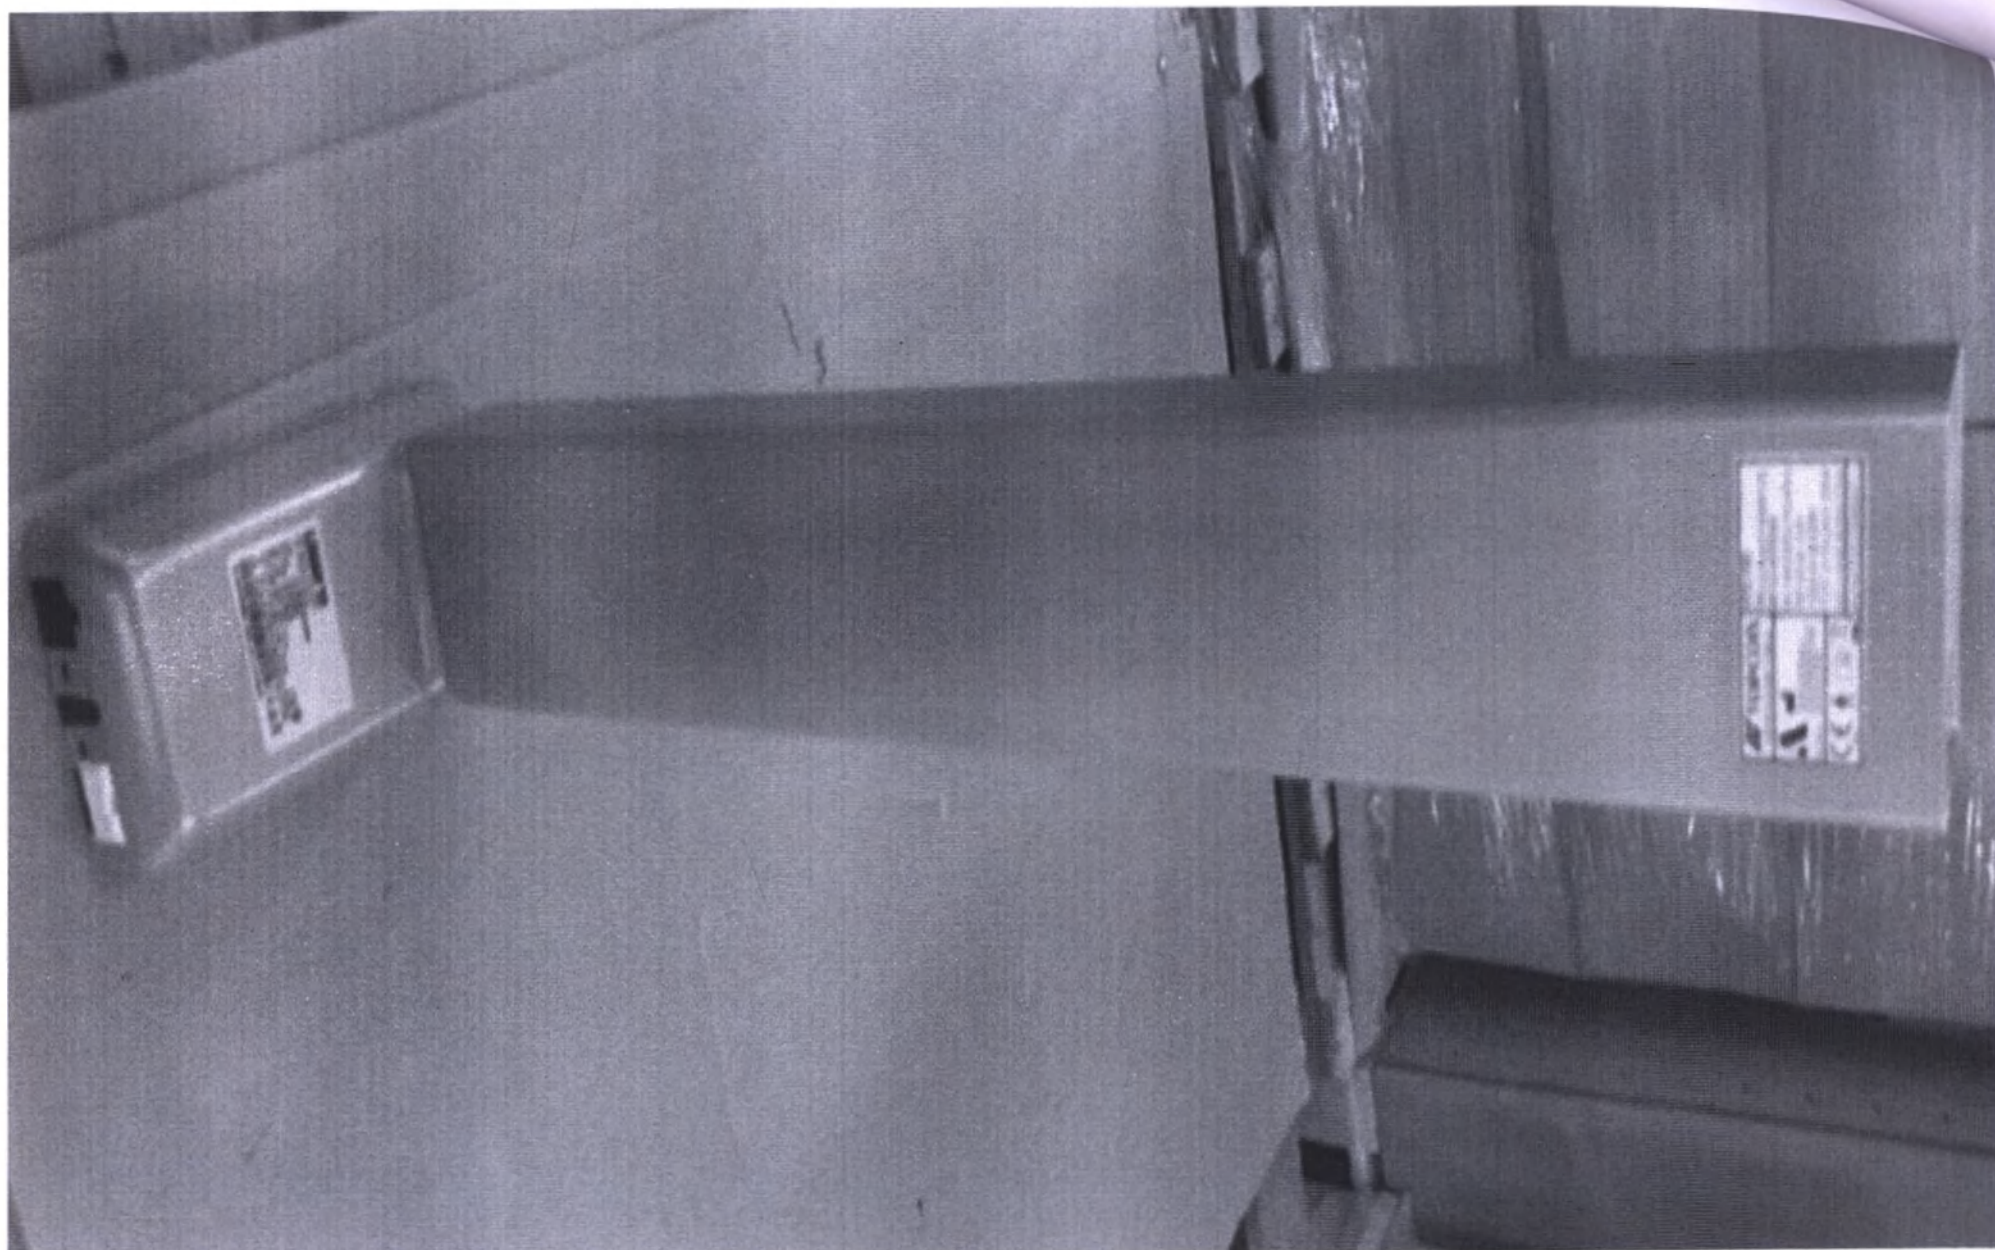


3.3. Ножки под основание - 4 шт.

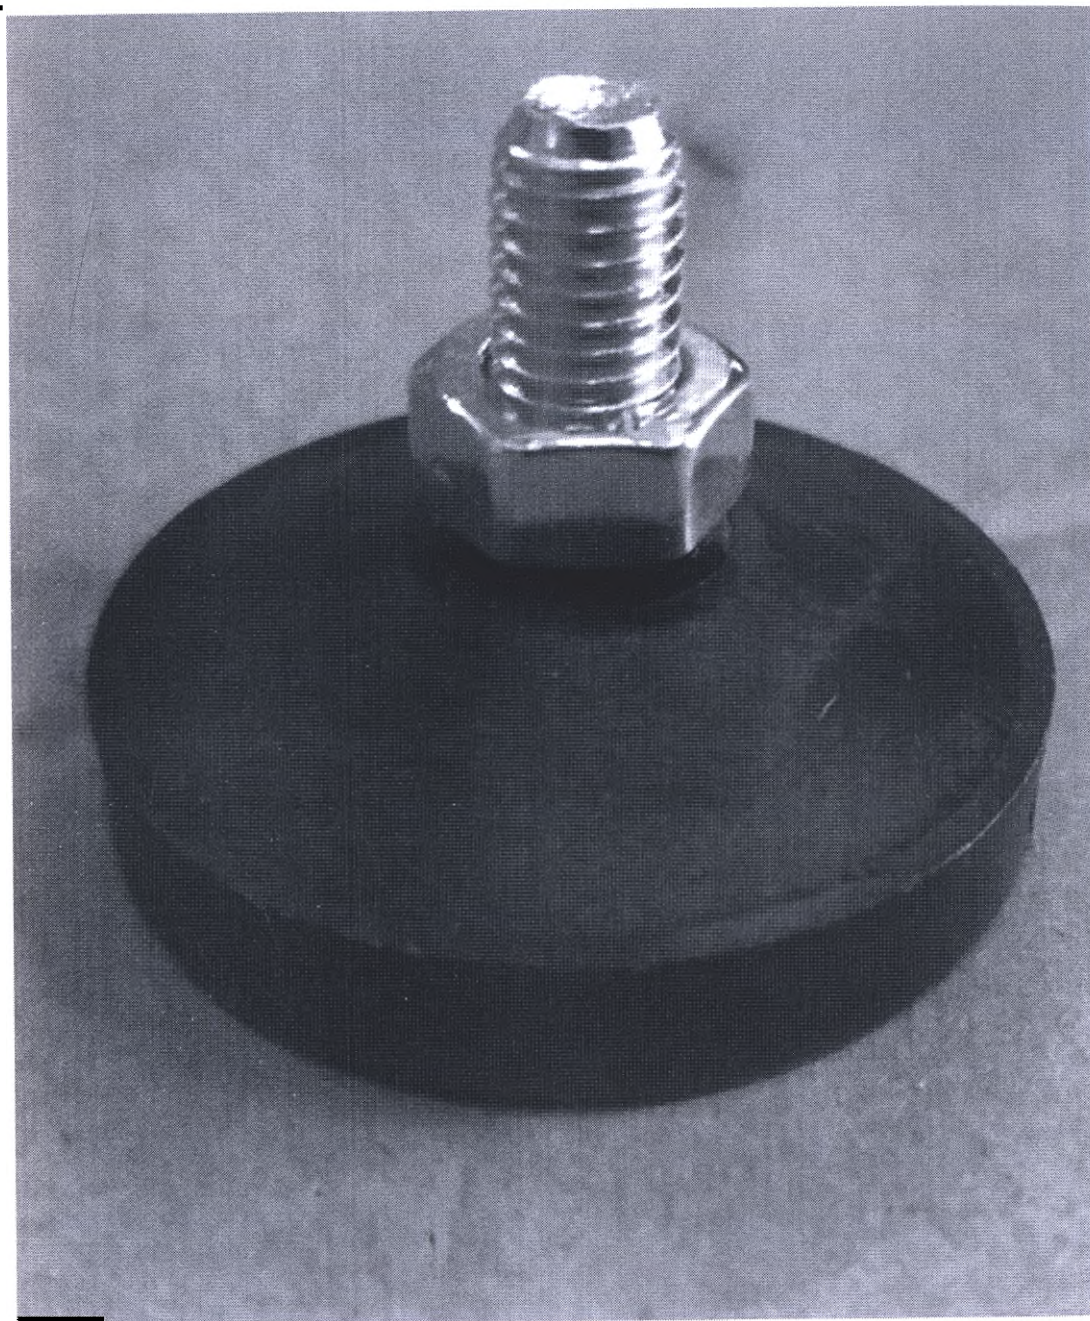


3.4. Колеса под основание - 4 шт. (при необходимости).

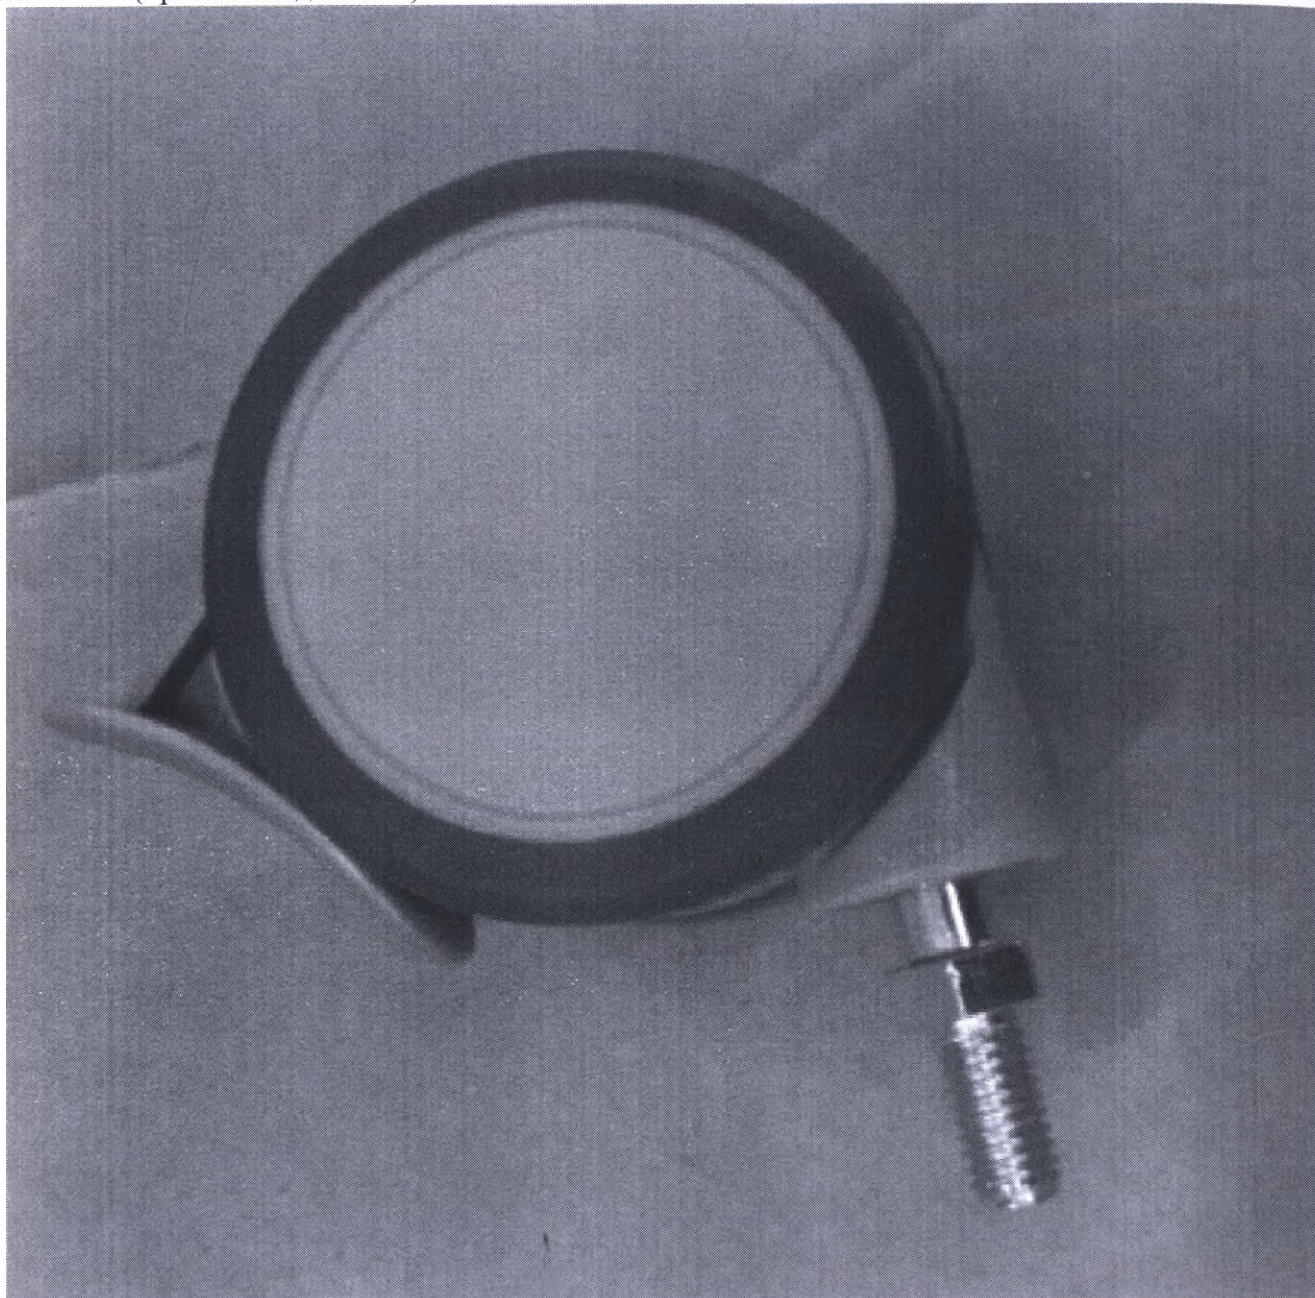


3.5. Кабель сетевой - 1 шт.

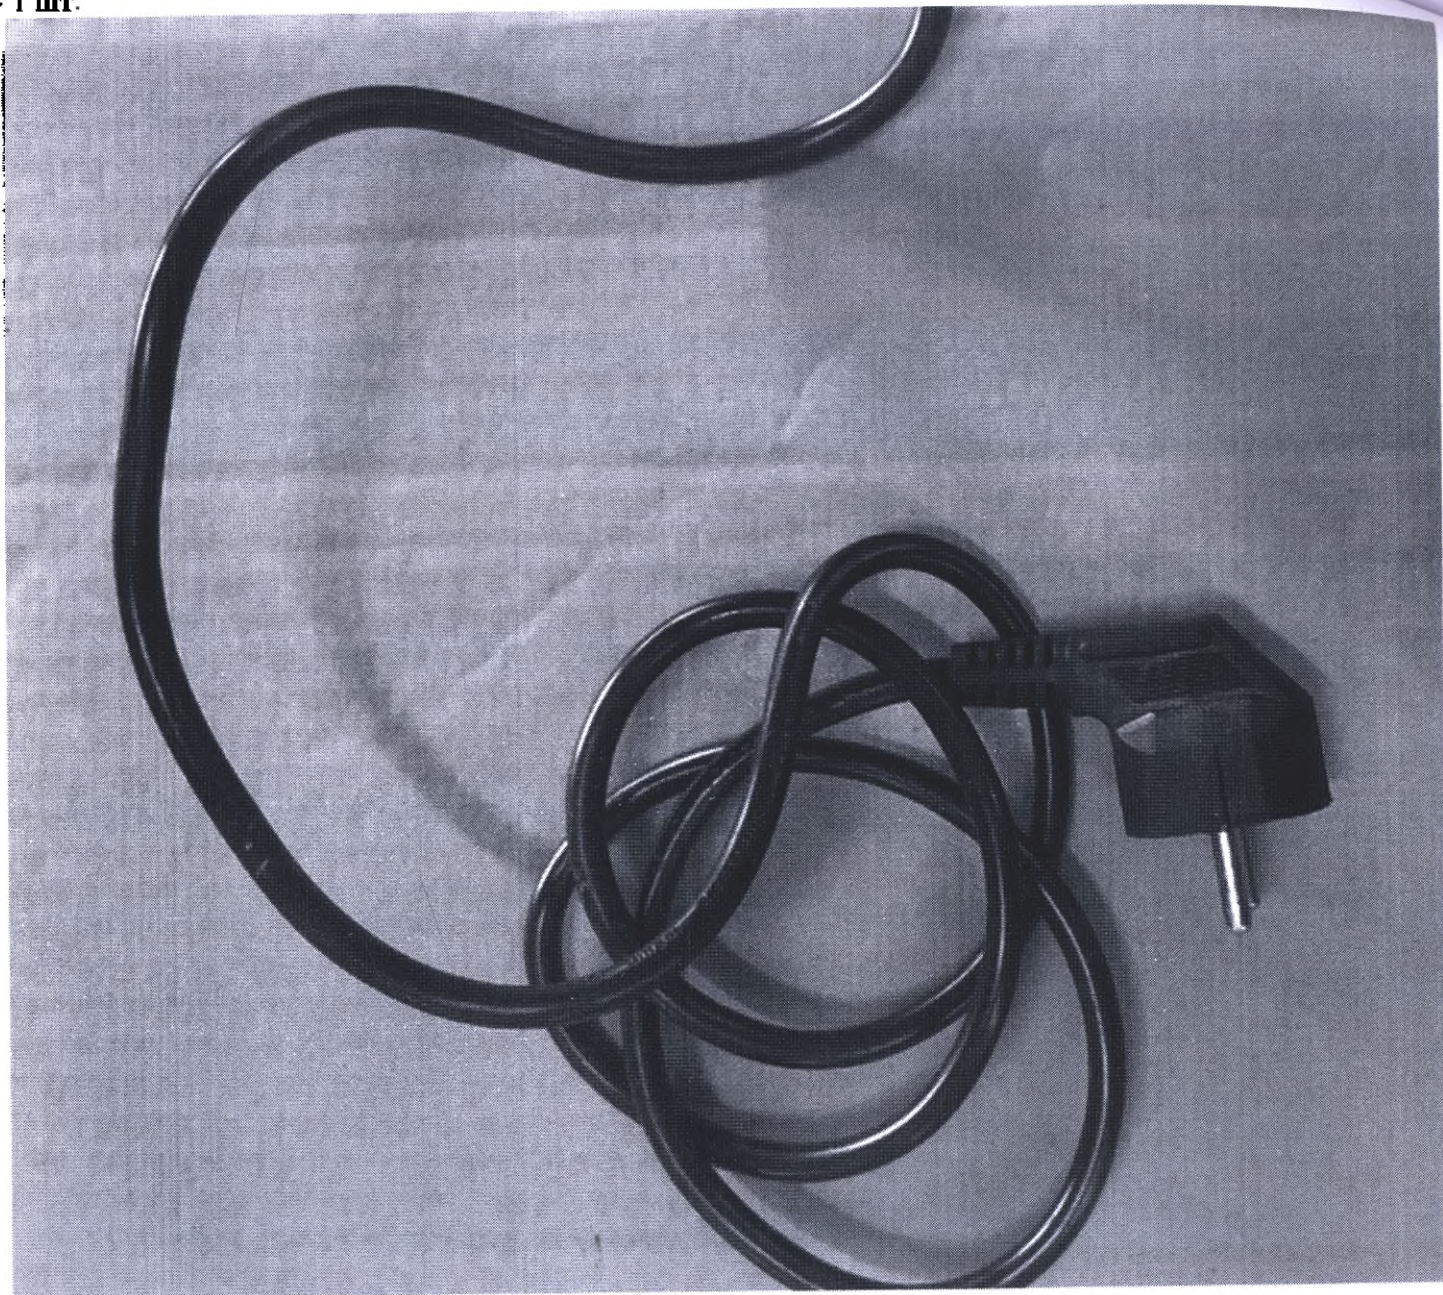

3.6. Пульт управления - 1 шт.

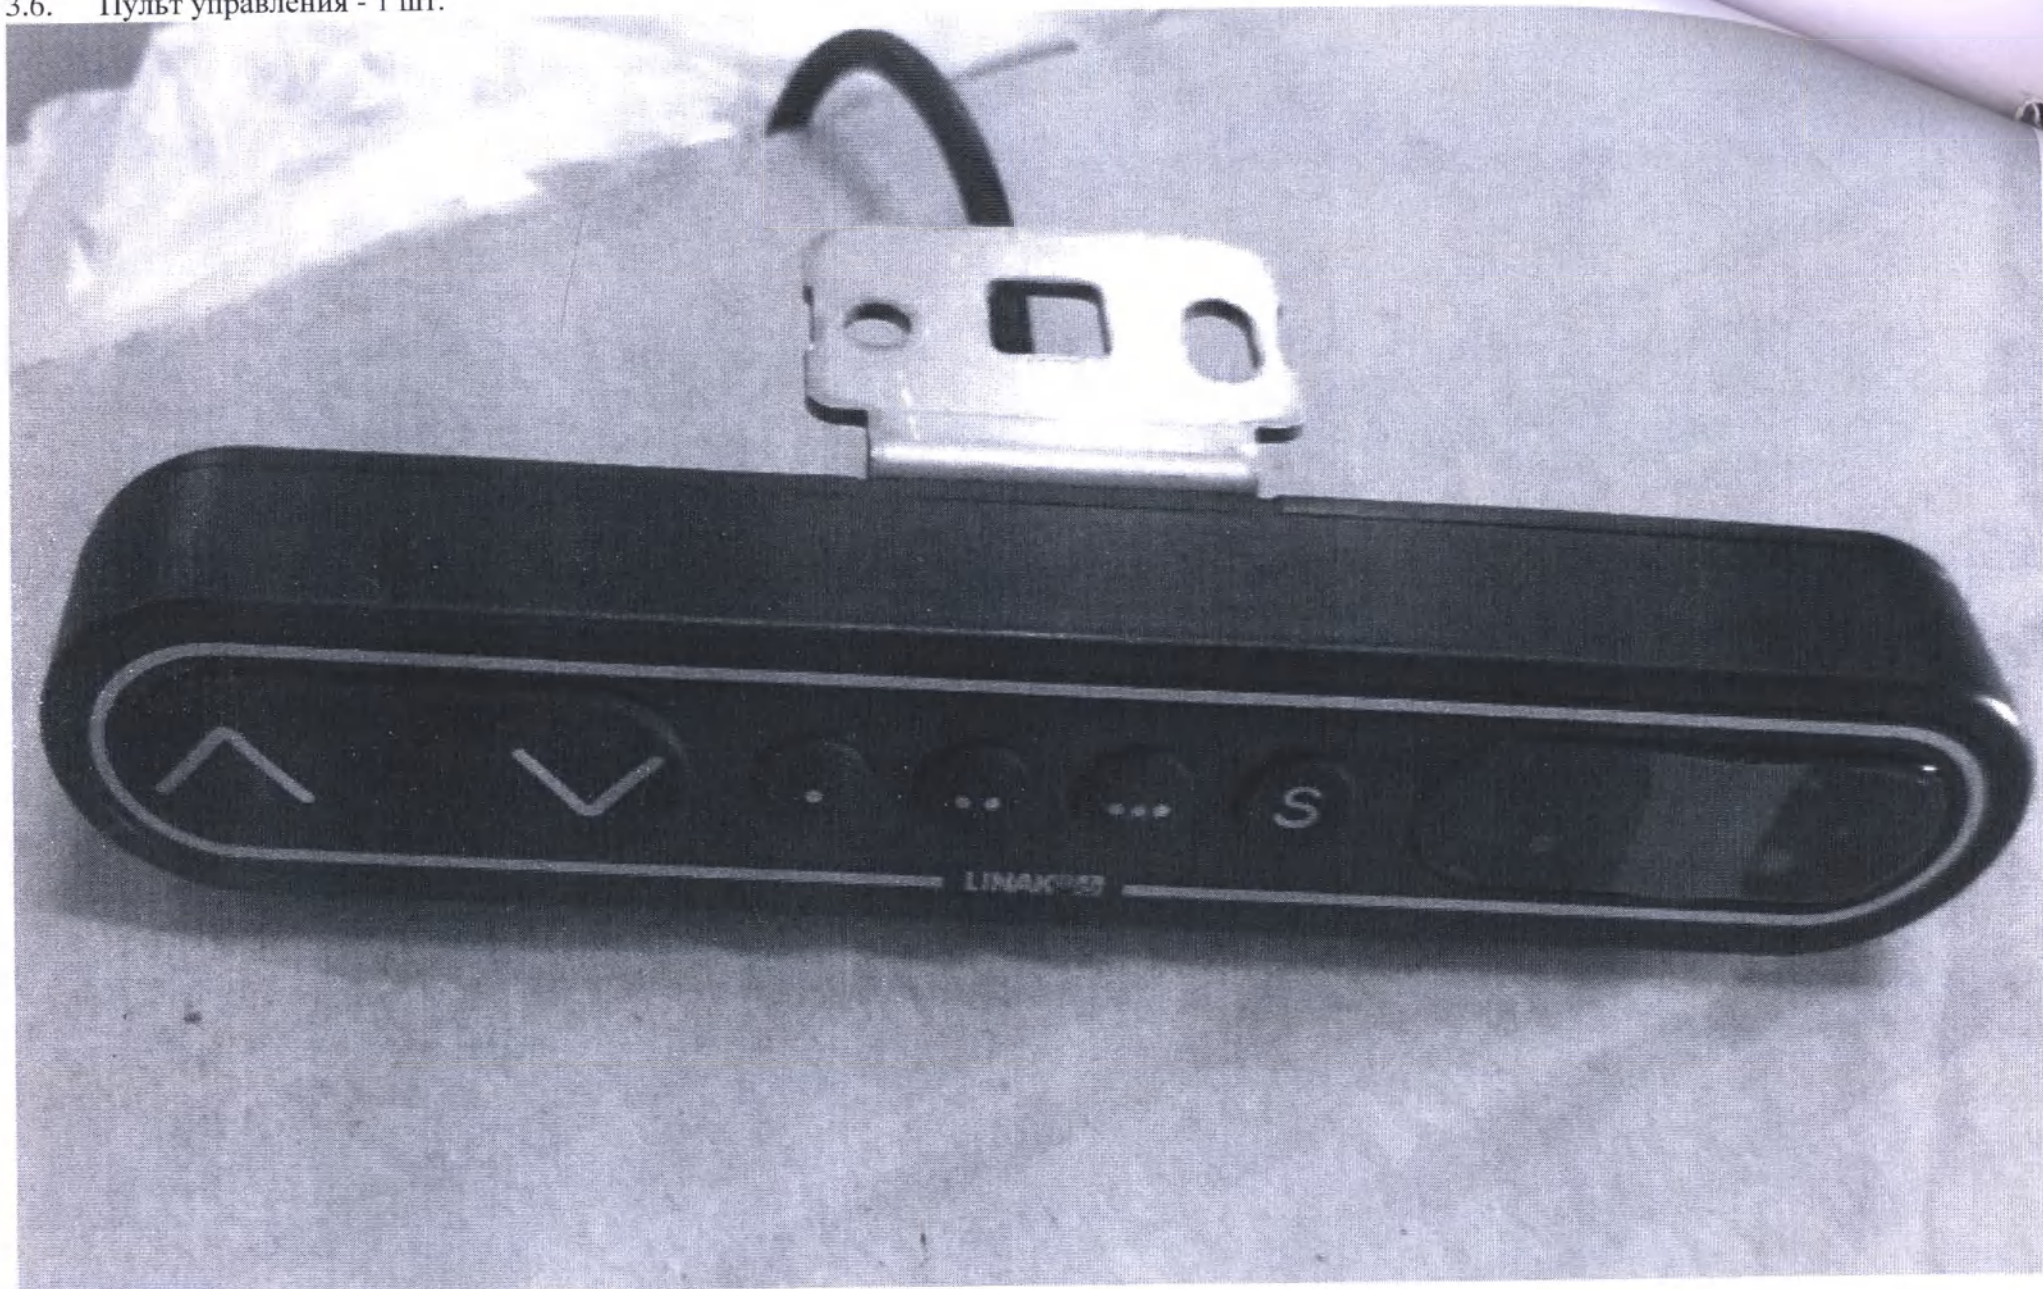

3.7. Заглушка пластиковая - 2 шт.

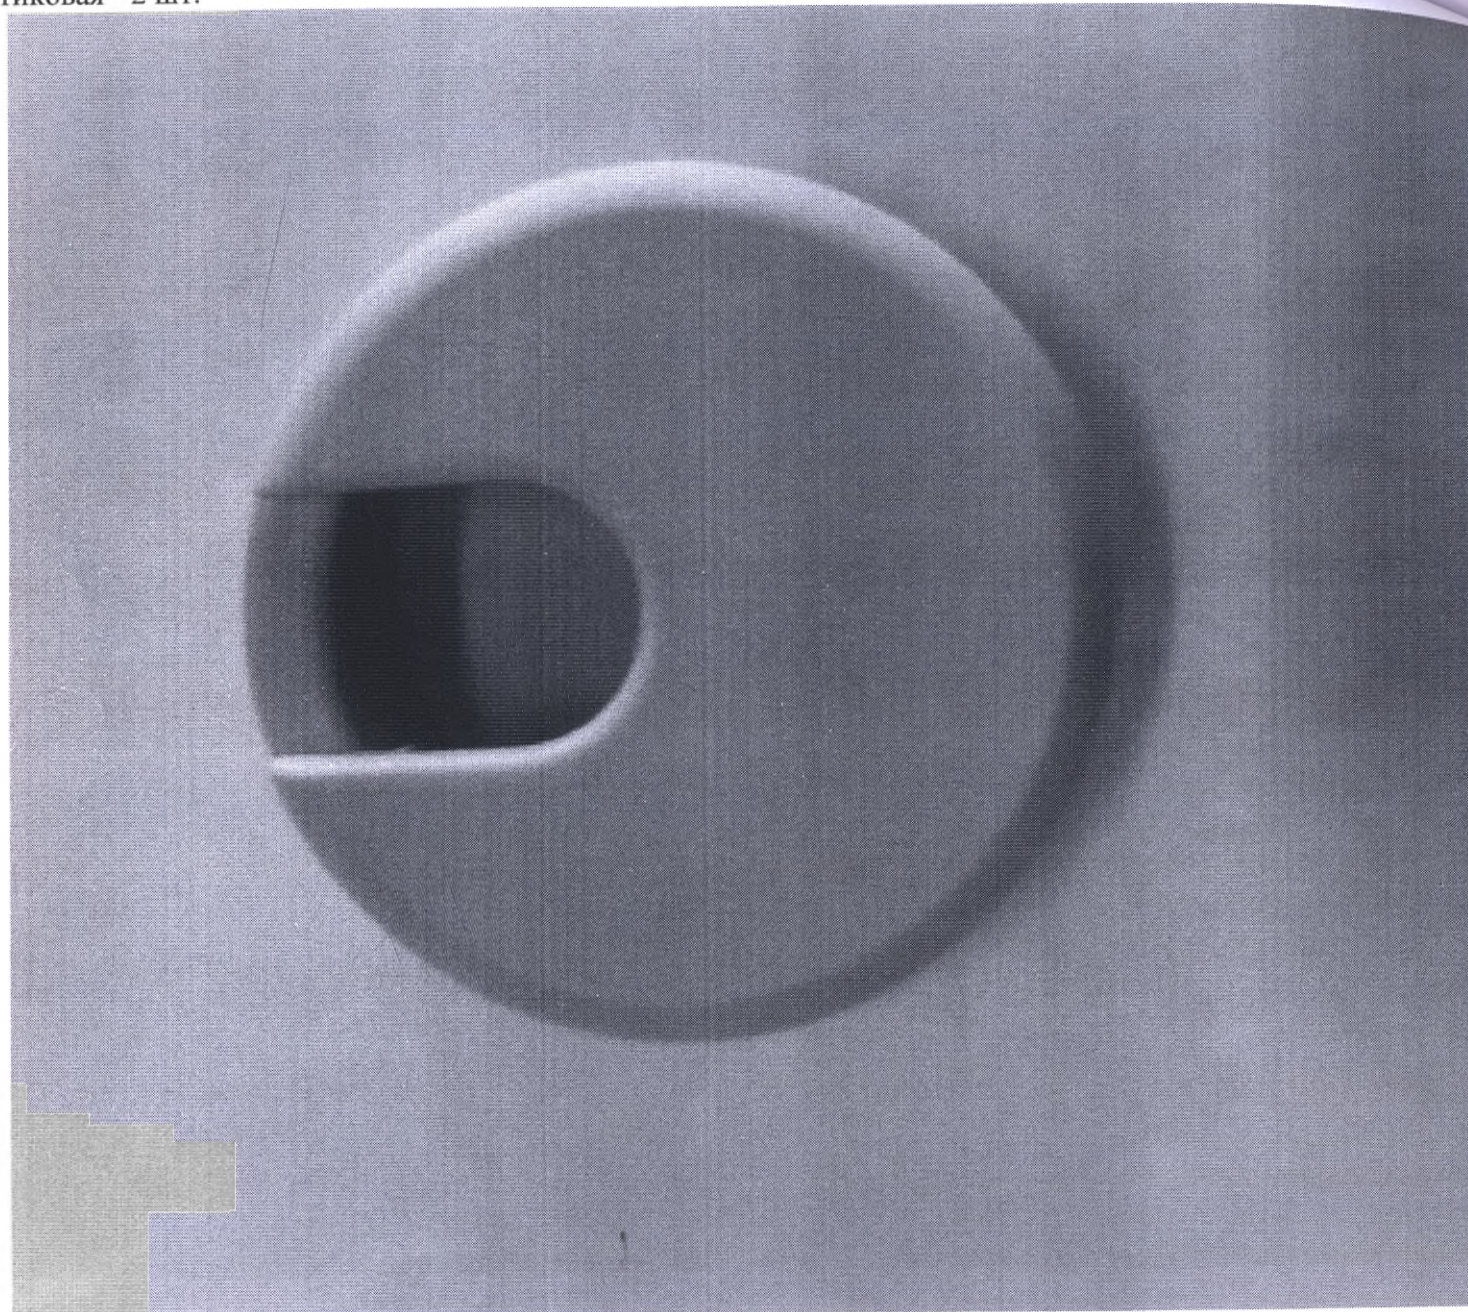

	Руководство по эксплуатации на МИ	Номер документа: RU-2020/08/TOPCON/ATE	
		Версия: 1	Страница: 1 из 49
Производитель: "АНТОНИ КАРЛЕС, С.А." (ANTONI CARLES, S.A.)	Уполномоченный представитель в РФ: Общество с ограниченной ответственностью "Тринити Медикал Системс"	Дата выпуска: 2020-08-02	

Руководство по эксплуатации

Стол офтальмологический электрический «АТЕ»

Варианты исполнения:

Стол офтальмологический электрический АТЕ-300 в составе
Стол офтальмологический электрический АТЕ-600 в составе
Стол офтальмологический электрический АТЕ-700 в составе
Стол офтальмологический электрический АТЕ-700PC BOX в составе
Стол офтальмологический электрический АТЕ-800 в составе


(Настоящее руководство подготовлено для предоставления сведений в целях регистрации медицинского изделия на территории Российской Федерации. Сведения представлены в объеме, требуемом в соответствии с Правилами регистрации медицинских изделий (постановление Правительства РФ от 27.12.2012 №1416)

Производитель:
"АНТОНИ КАРЛЕС, С.А."
(ANTONI CARLES, S.A.)


2020

4. Стол офтальмологический электрический АТЕ-700РС BOX в составе:


4.1. Столешница Т-образная с блоком питания - 1 шт.

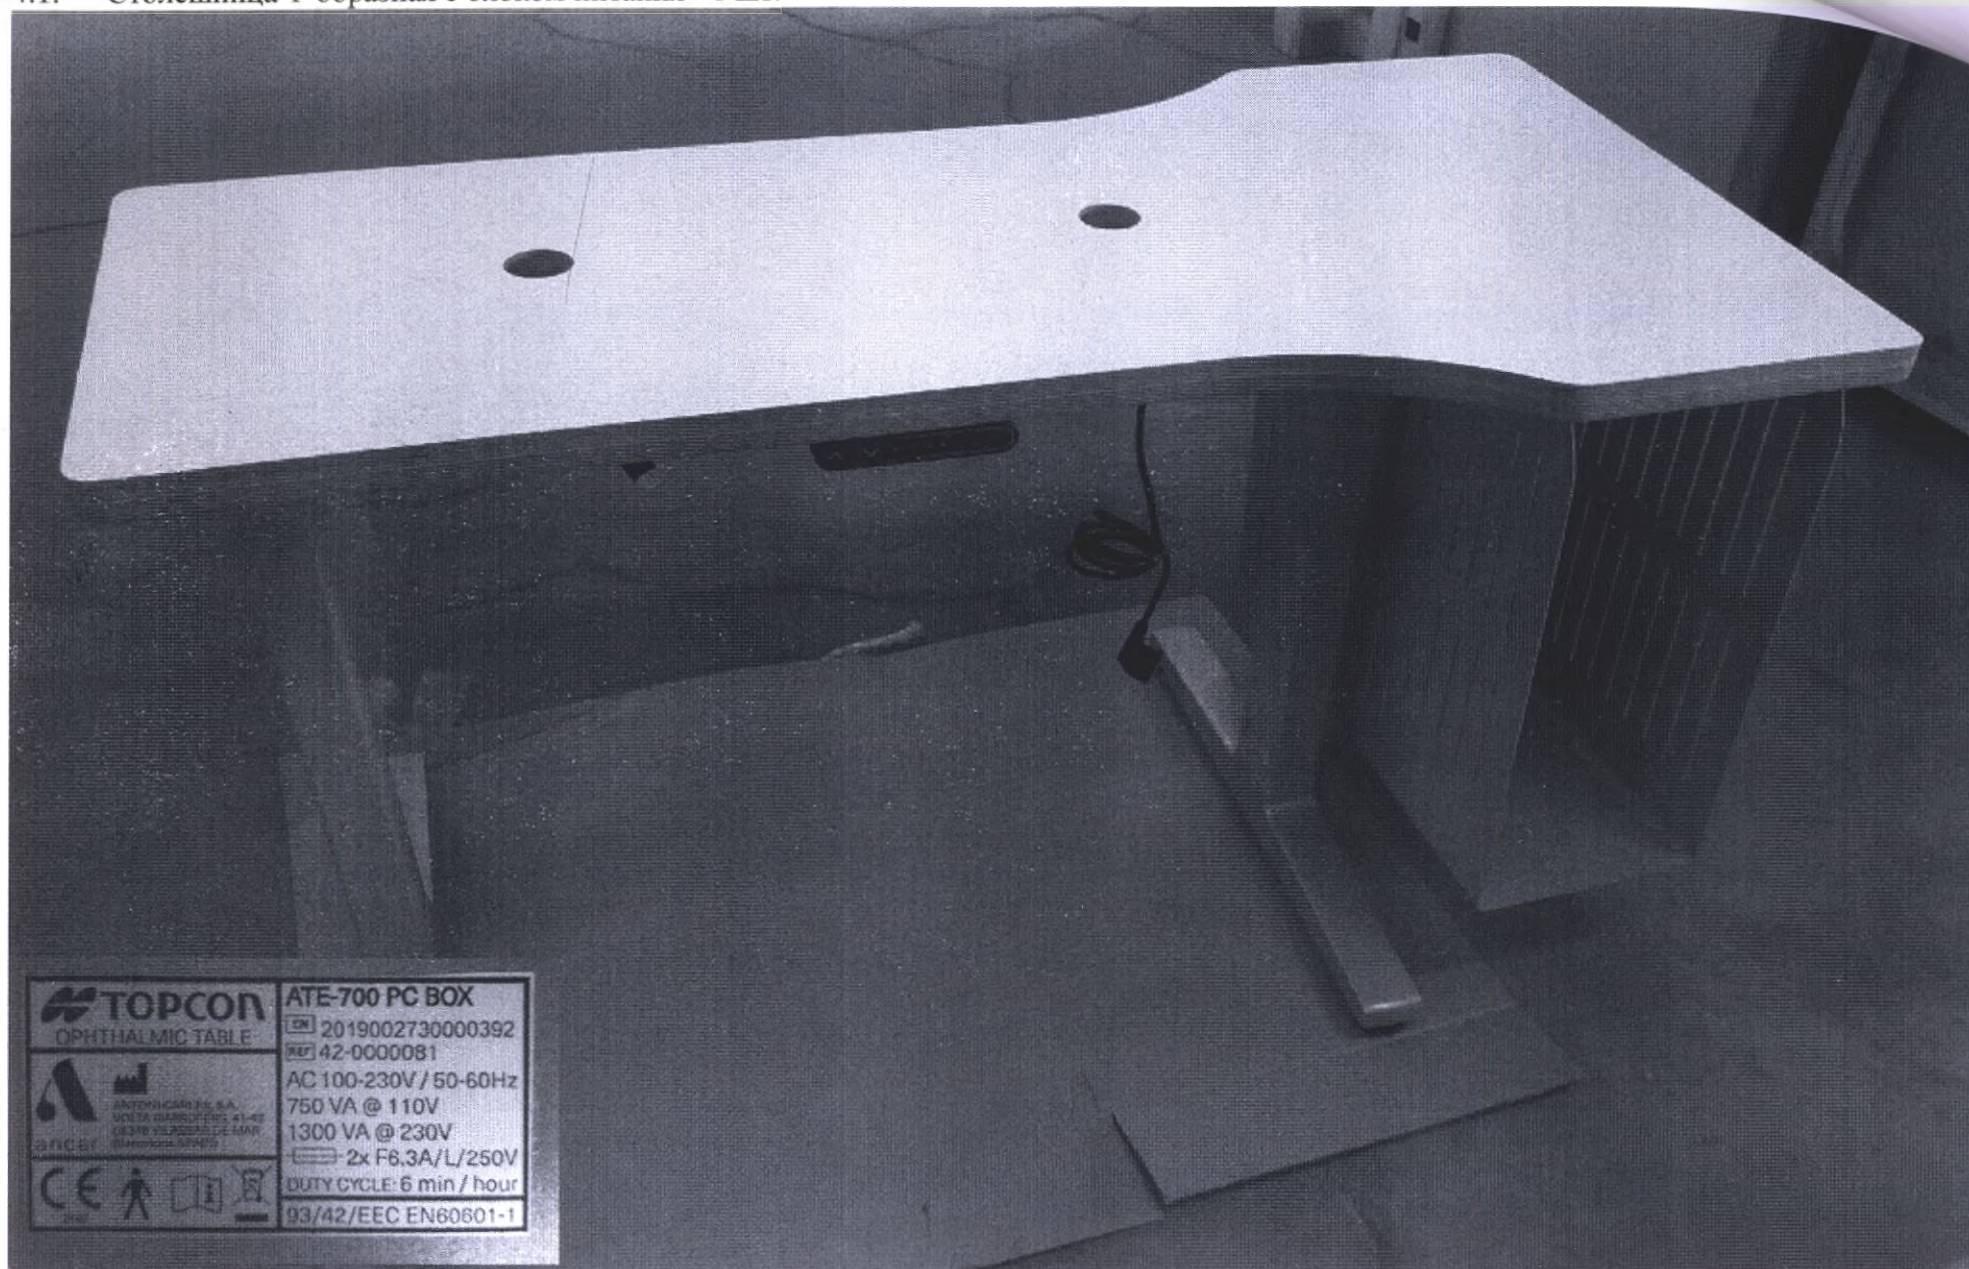


4.2. Колонна электромеханическая телескопическая с основанием - 2 шт.

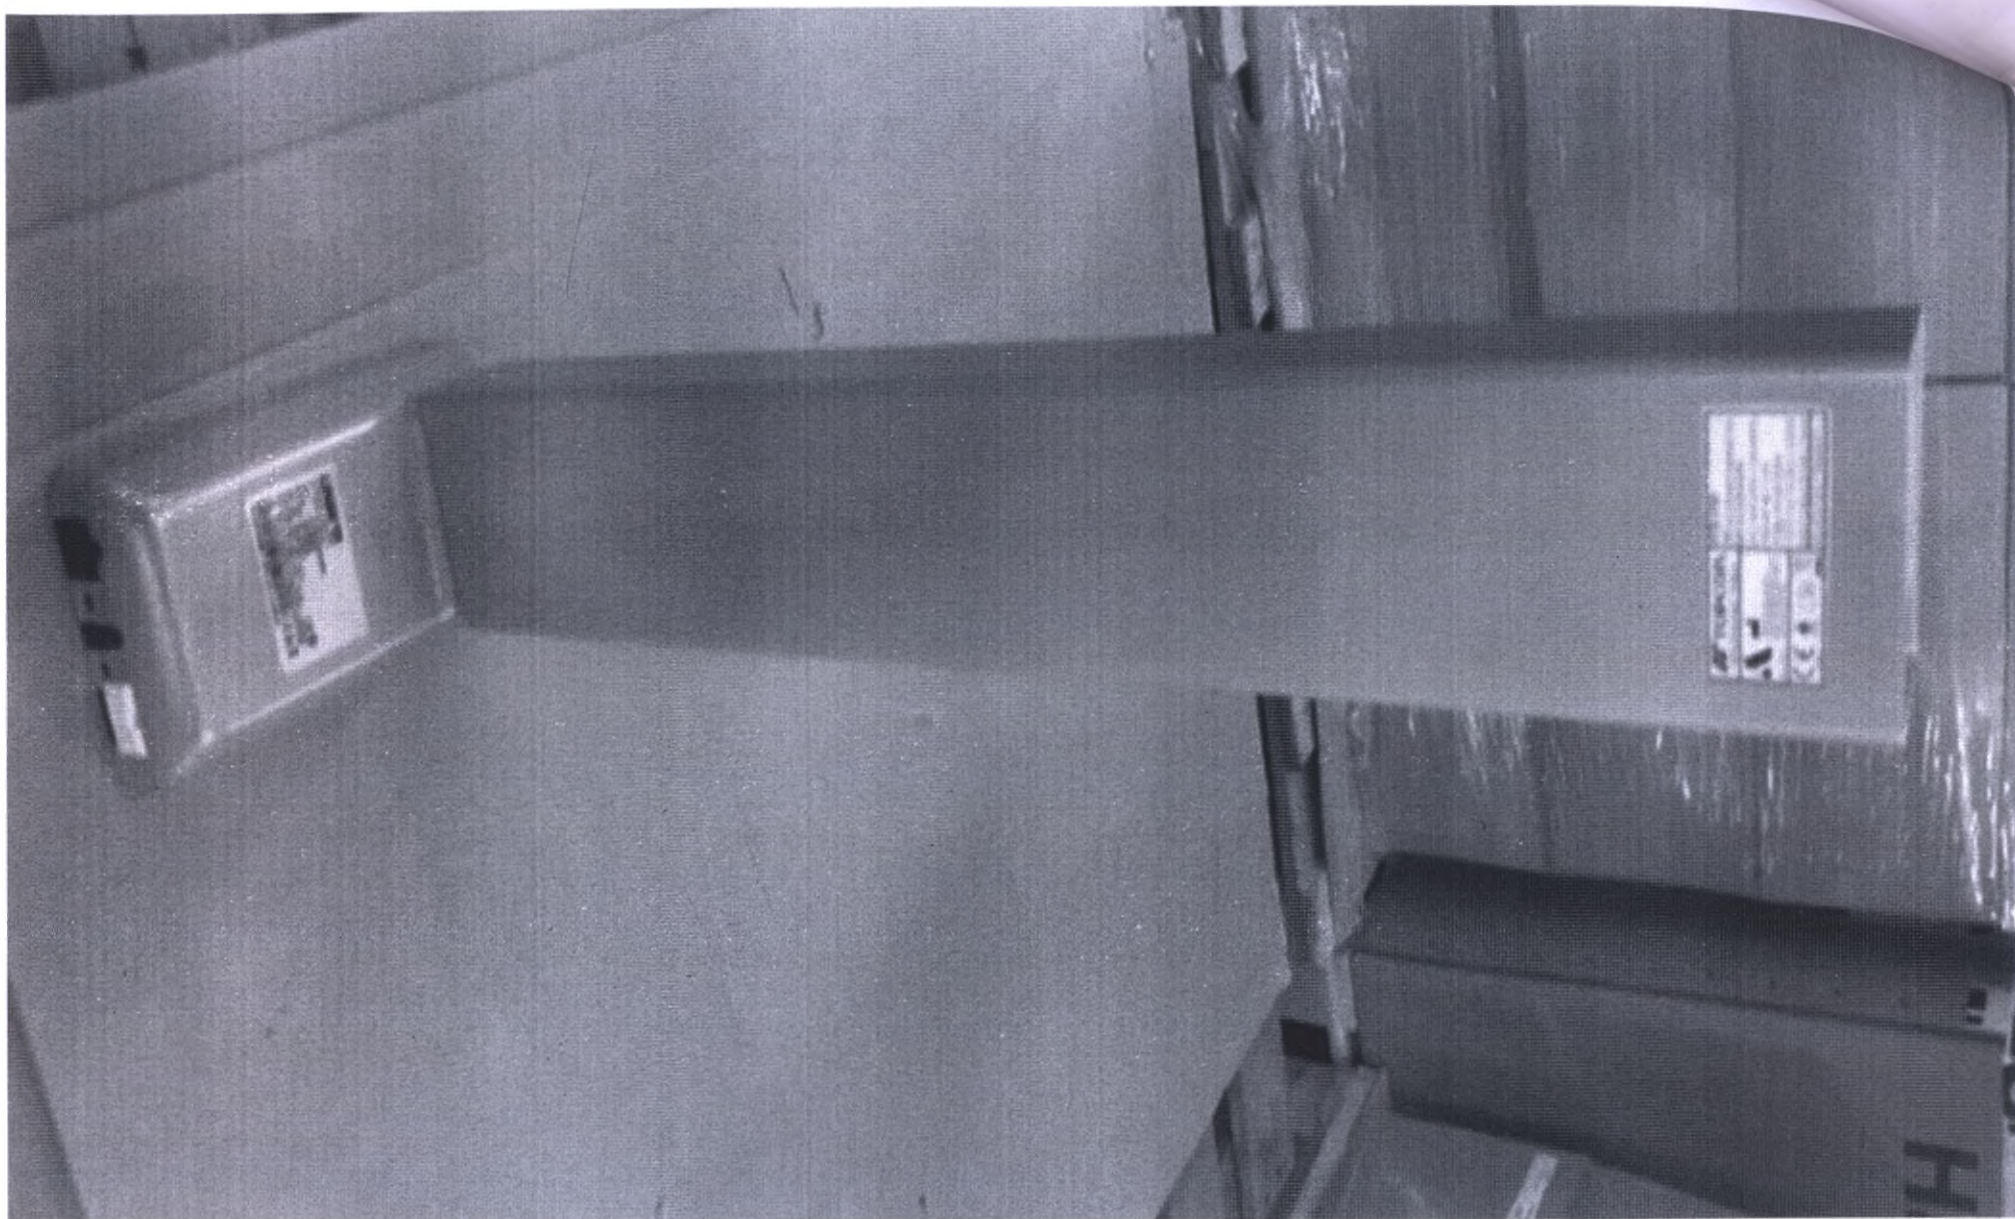


4.3. Ножки под основание - 4 шт.

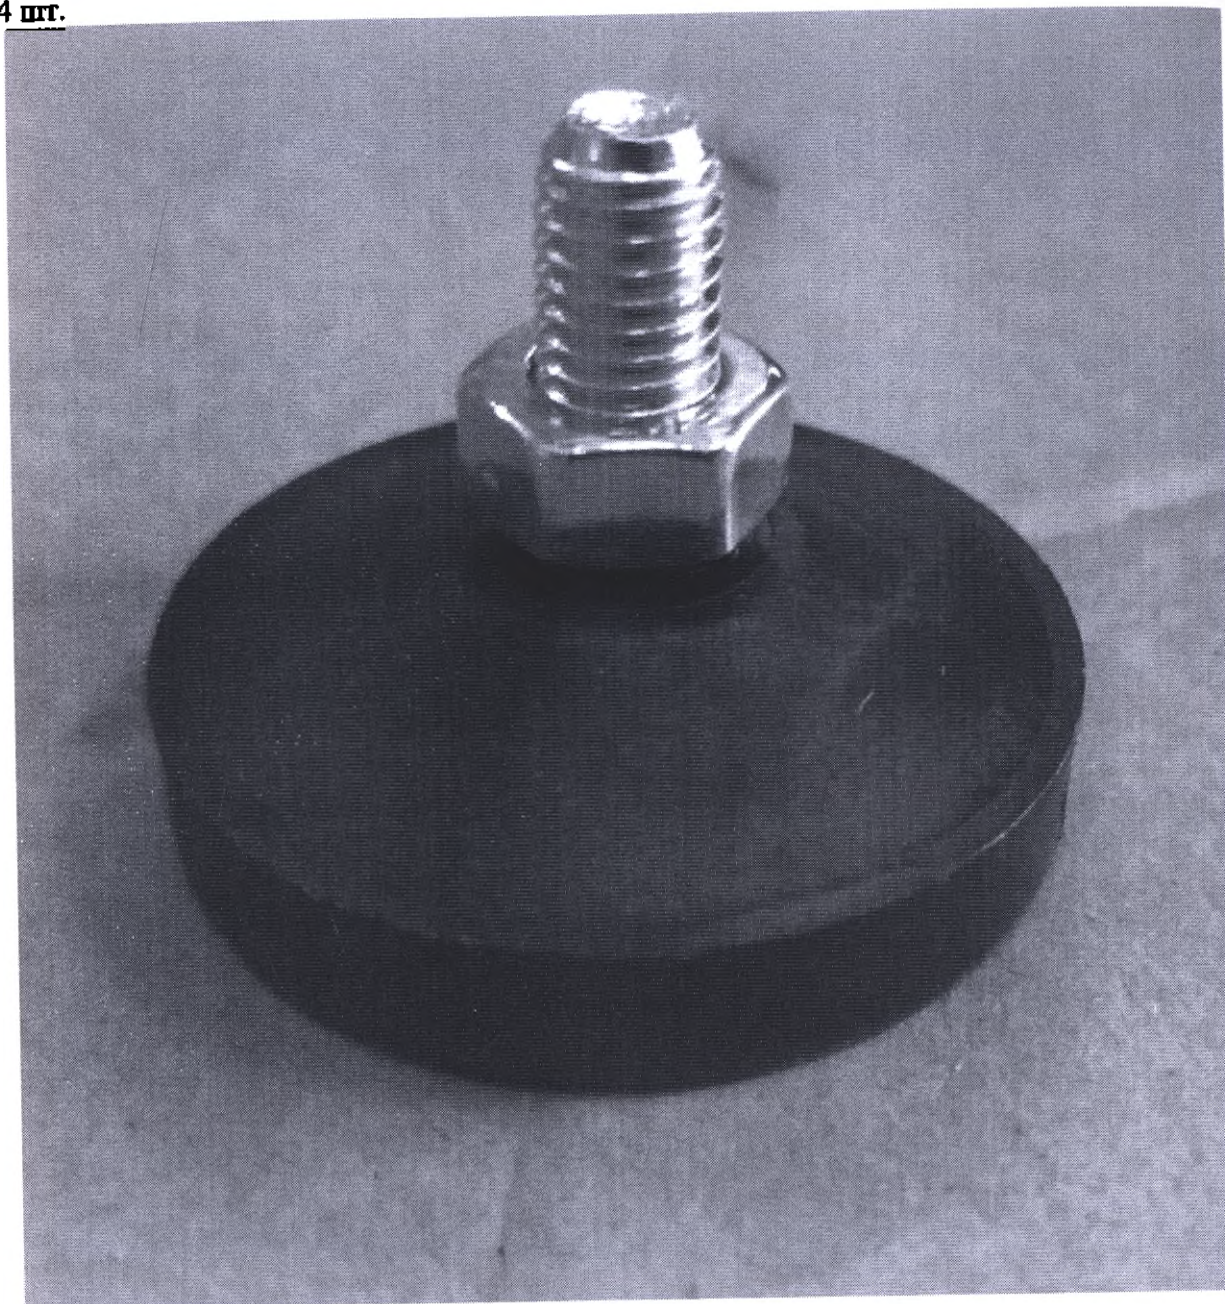


4.4. Колеса под основание - 4 шт.

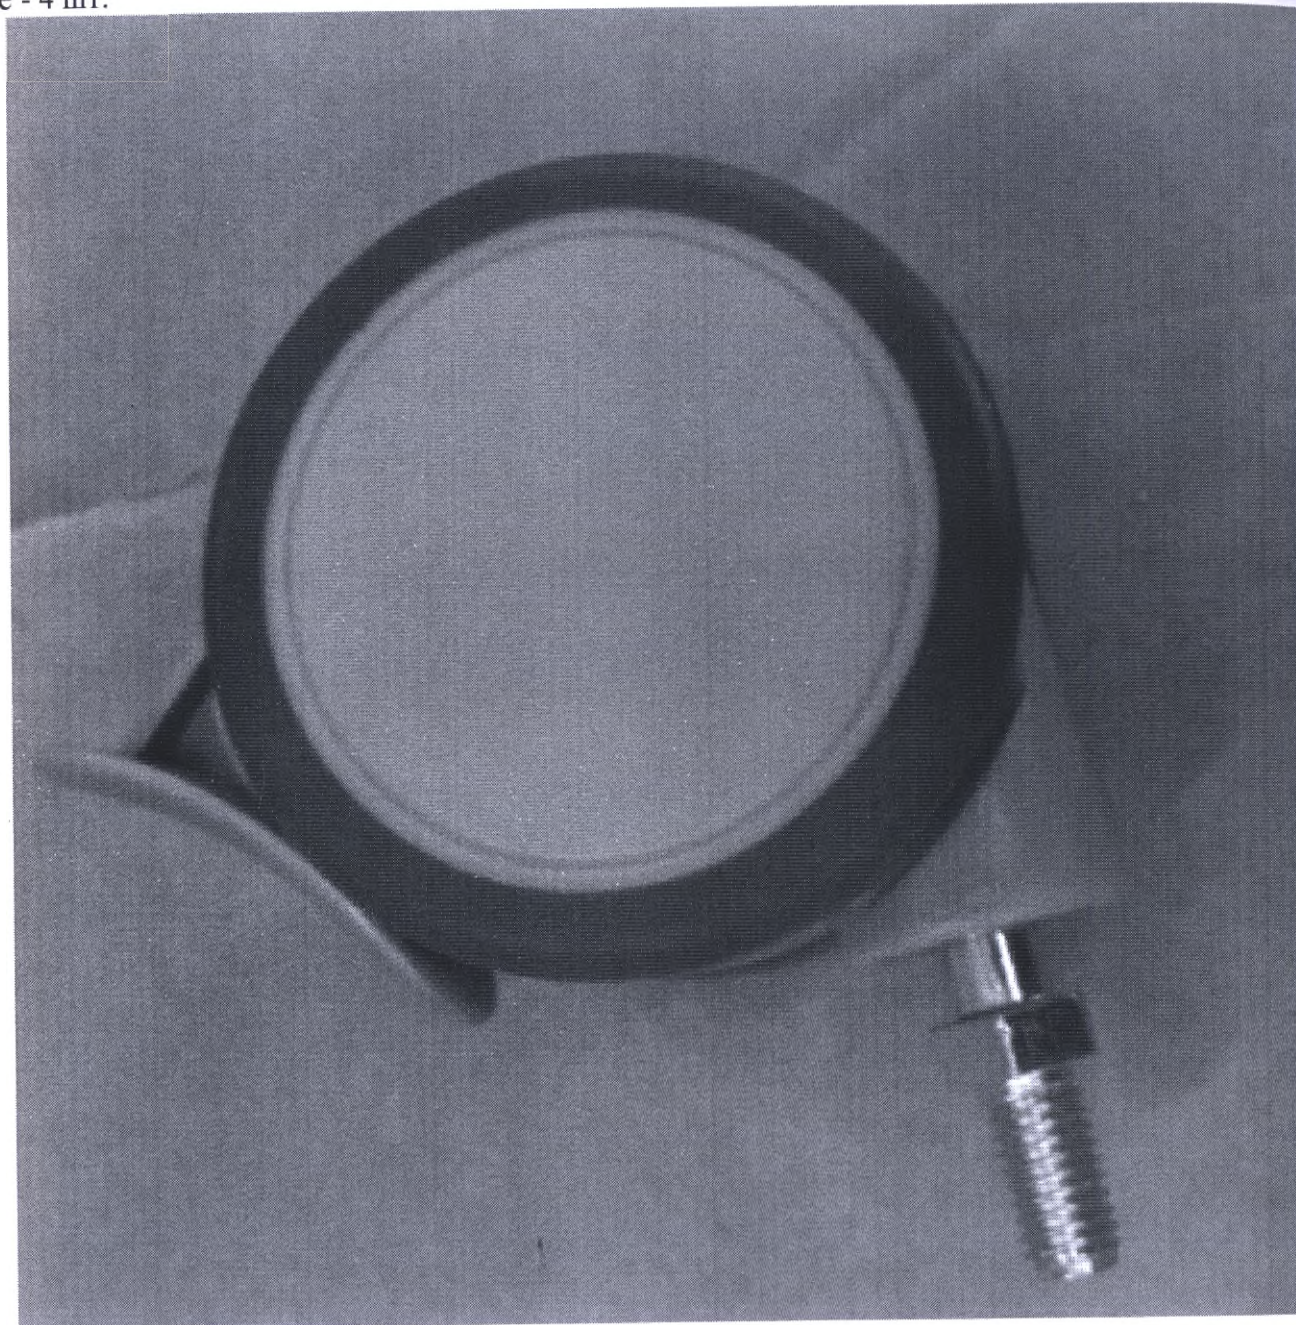


4.5. Кабель сетевой - 1 шт.

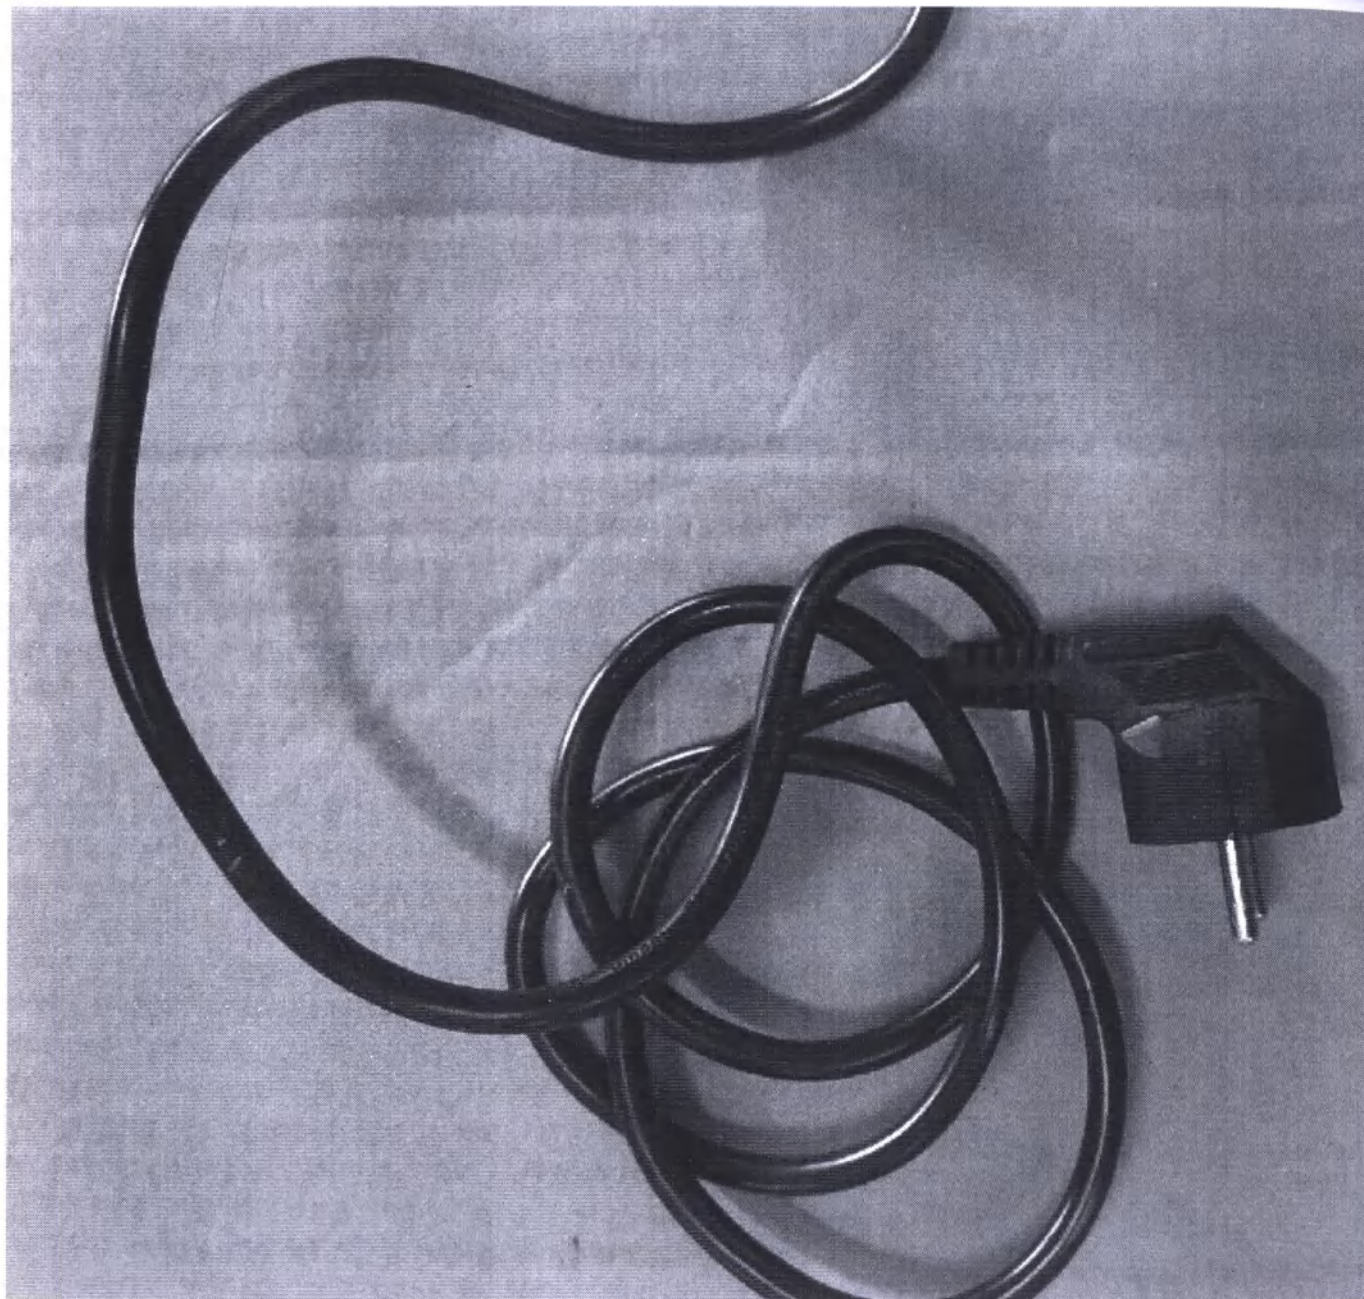


4.6. Пульт управления - 1 шт.

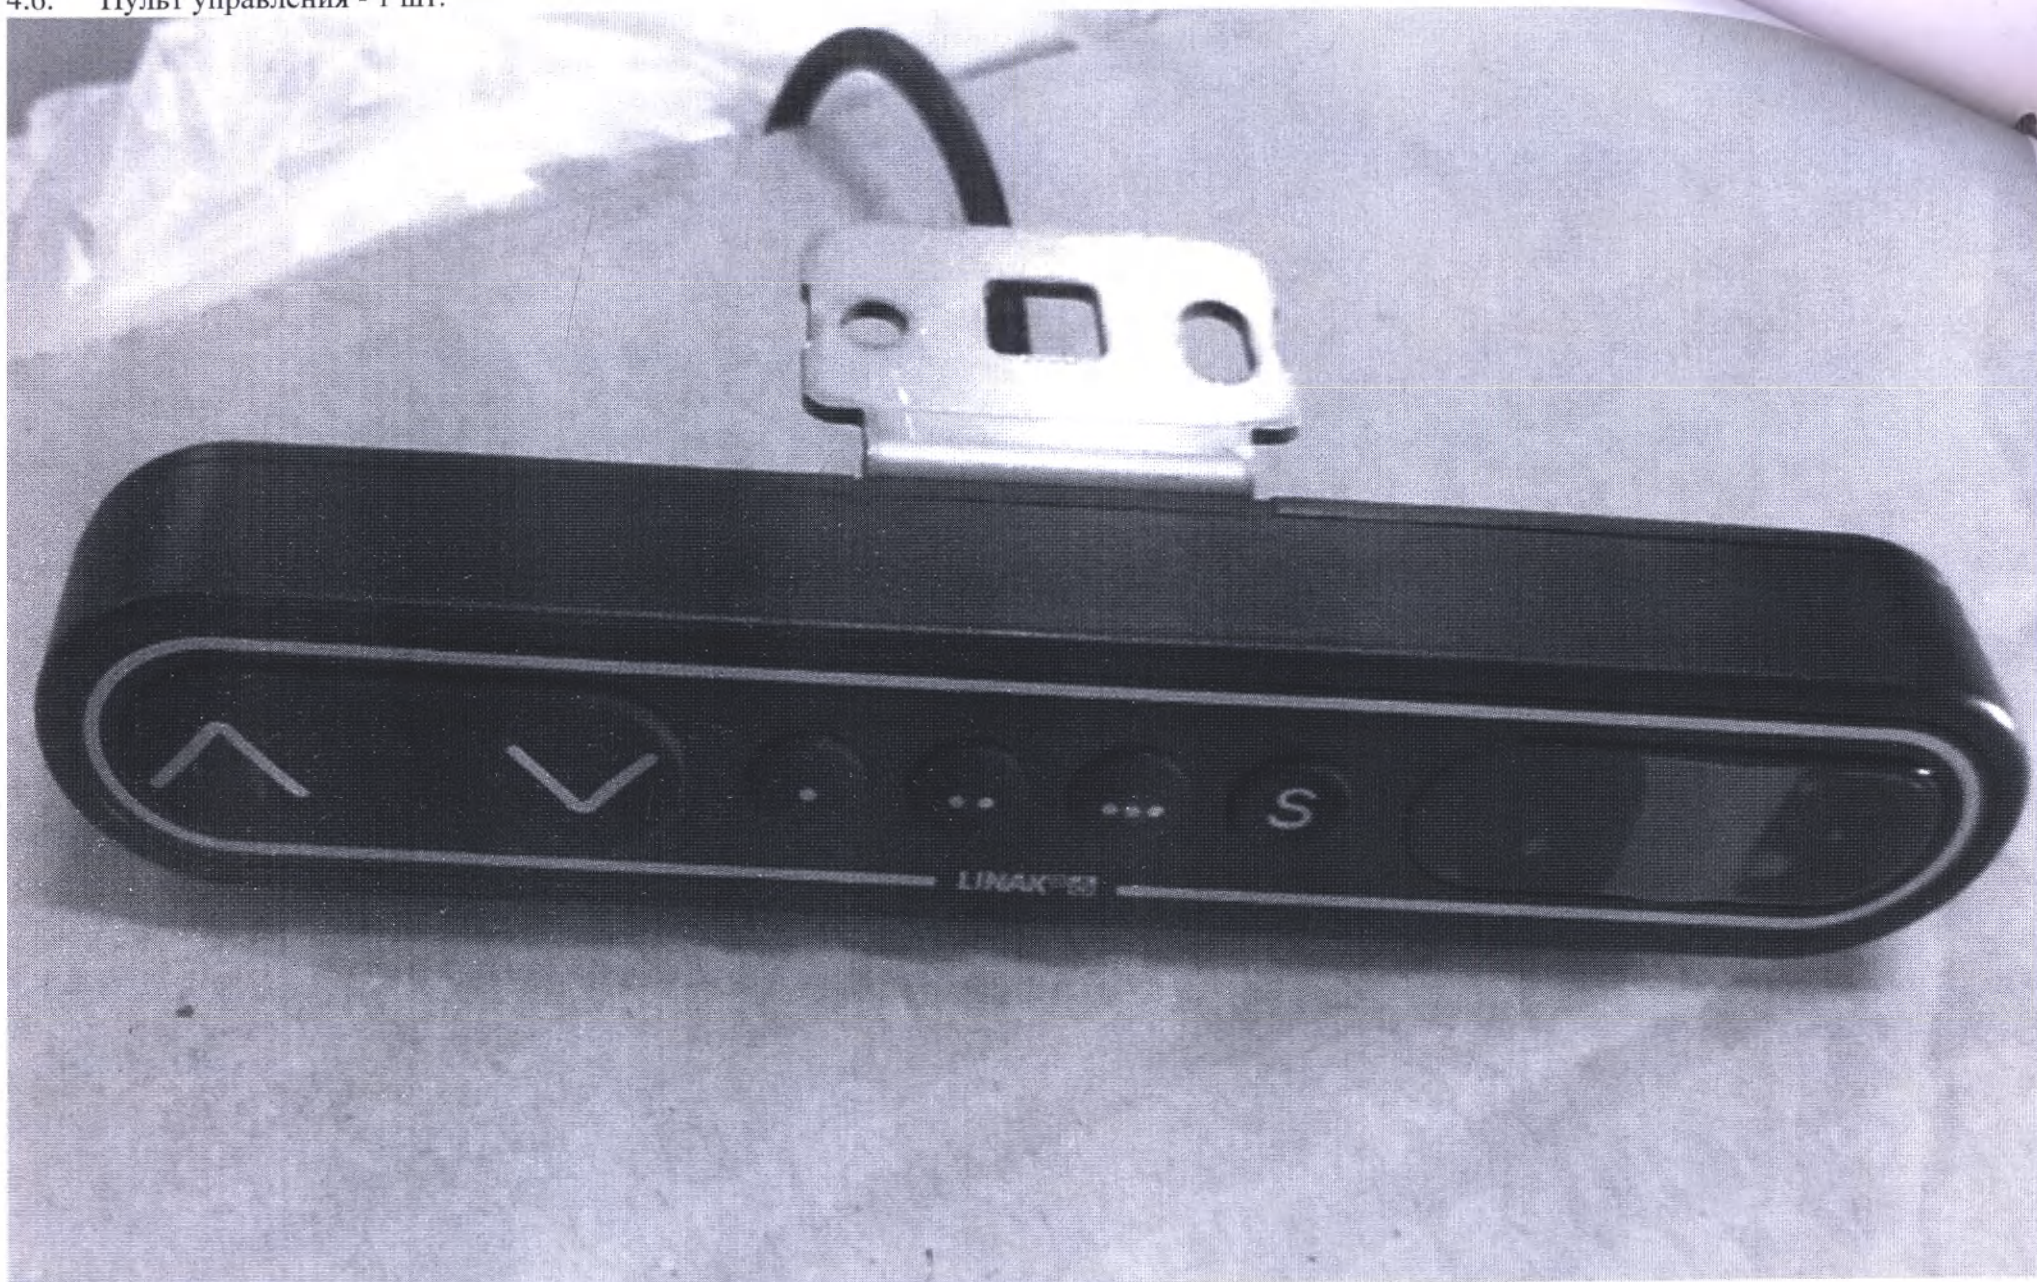

4.7. Заглушка пластиковая - 2 шт.

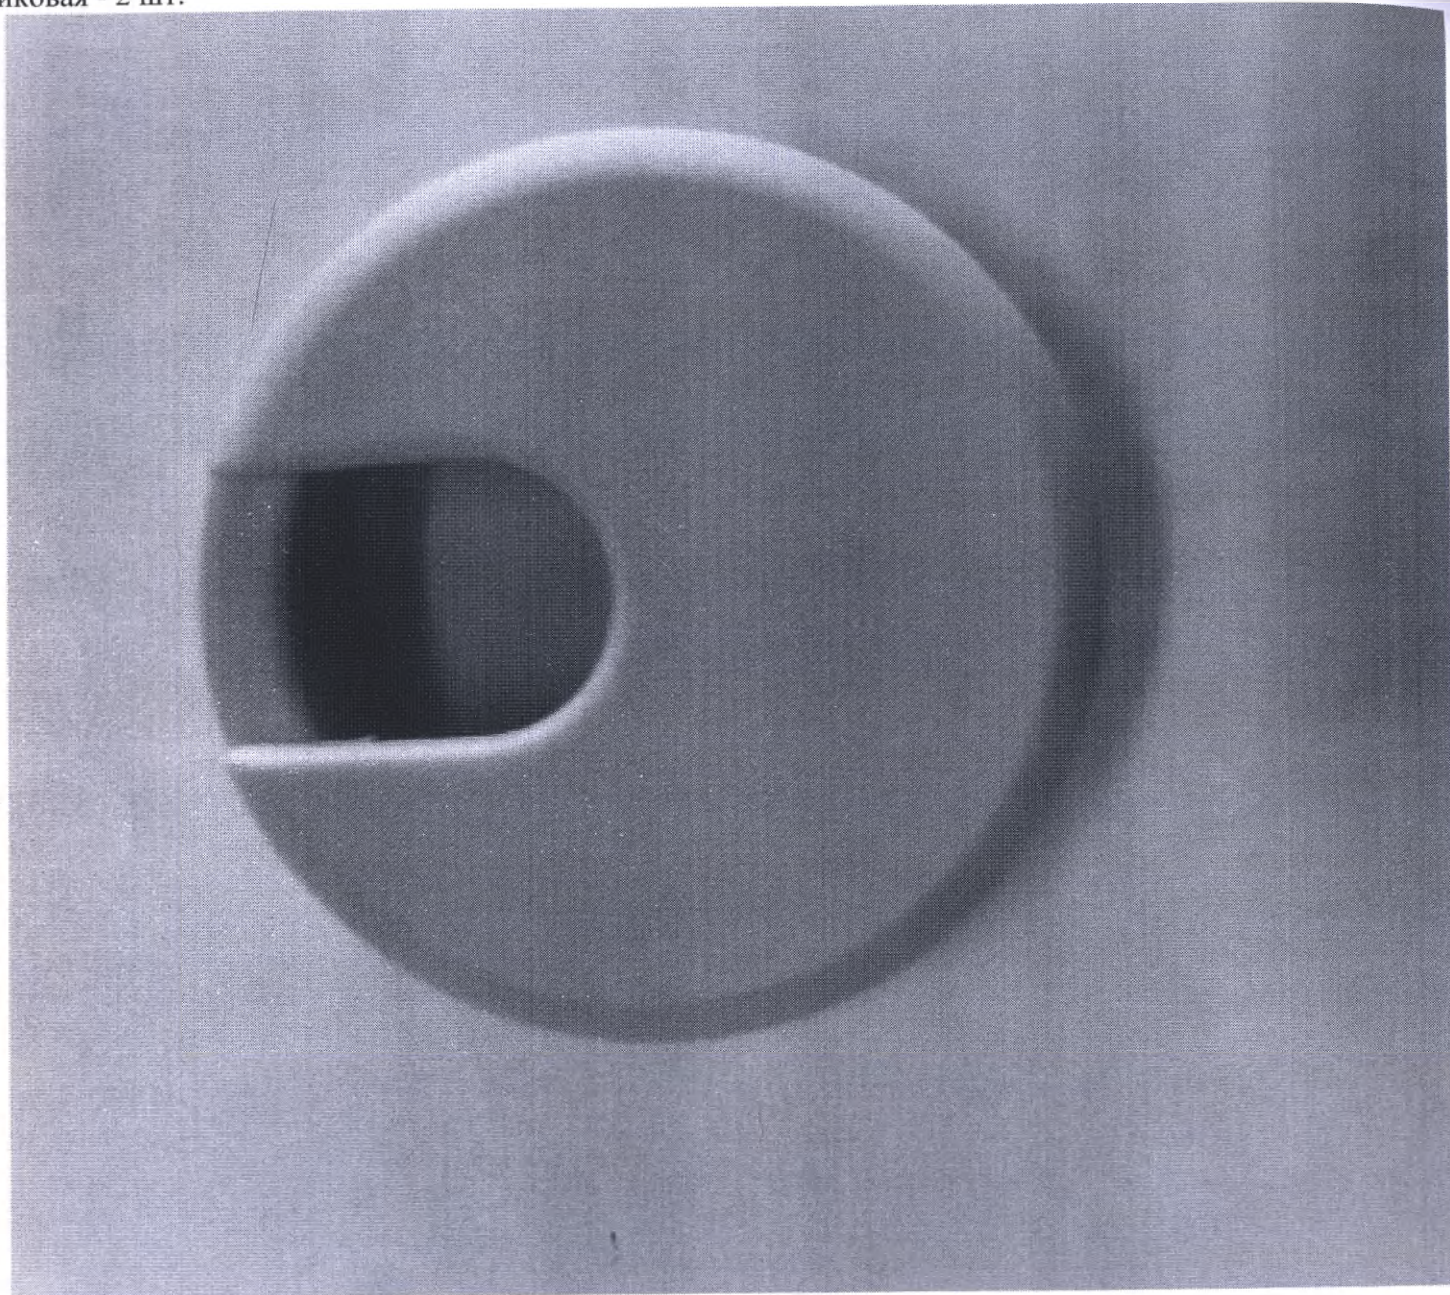

4.8. Бокс металлический для системного блока - 1 шт.

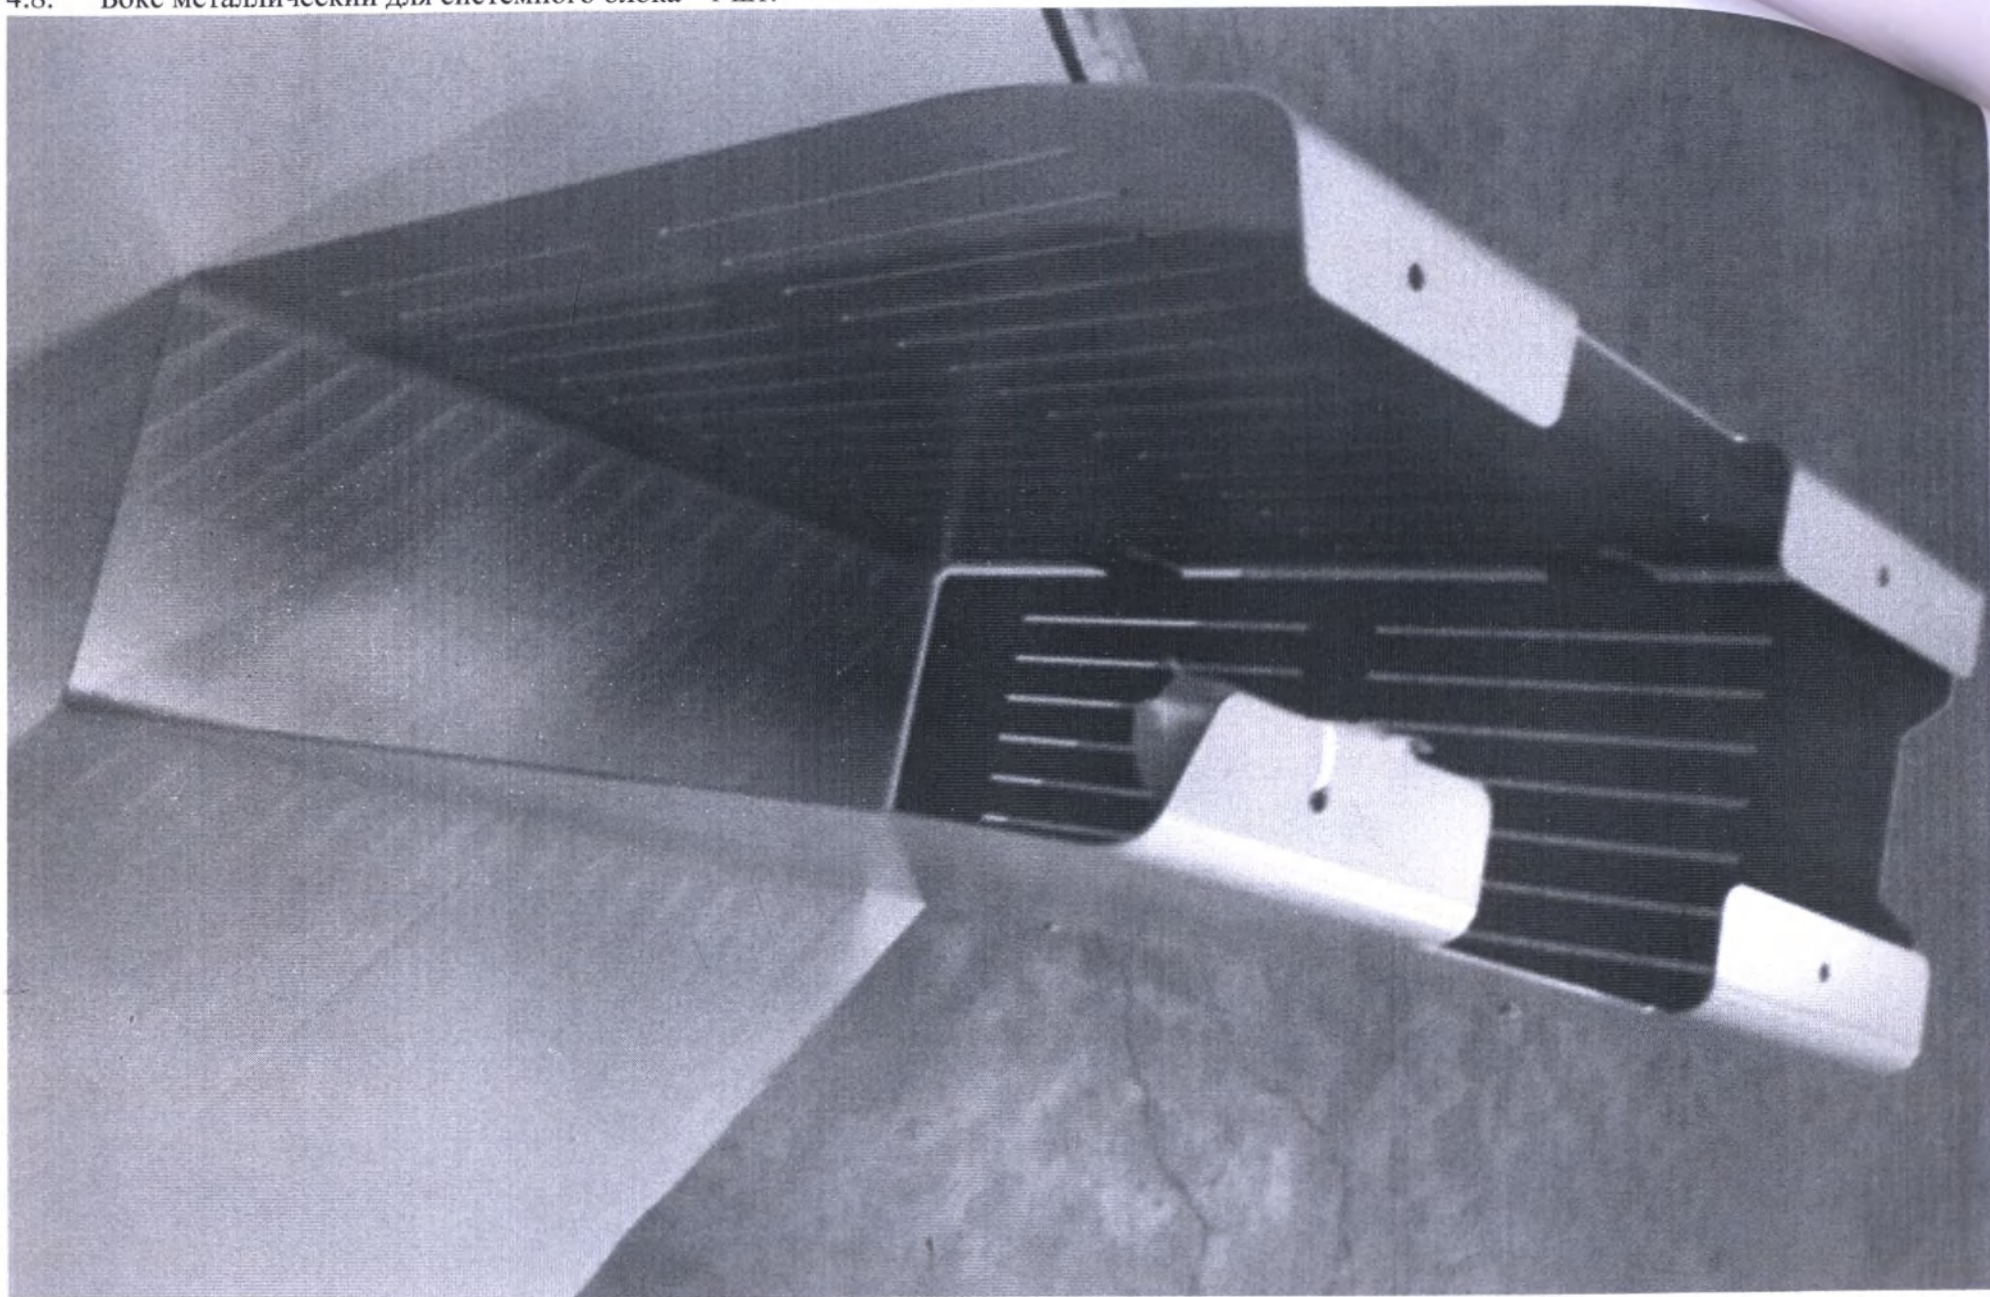

 Стол офтальмологический электрический «АТЕ»	Руководство по эксплуатации на МИ	Номер документа: RU-2020/08/TOPCON/ATE	
		Версия: 1	Страница: 1 из 49
Производитель: "АНТОНИ КАРЛЕС, С.А." (ANTONI CARLES, S.A.)	Уполномоченный представитель в РФ: Общество с ограниченной ответственностью "Тринити Медикал Системс"		Дата выпуска: 2020-08-02

Руководство по эксплуатации

Стол офтальмологический электрический «АТЕ» Варианты исполнения:


Стол офтальмологический электрический АТЕ-300 в составе
Стол офтальмологический электрический АТЕ-600 в составе
Стол офтальмологический электрический АТЕ-700 в составе
Стол офтальмологический электрический АТЕ-700РС BOX в составе
Стол офтальмологический электрический АТЕ-800 в составе

(Настоящее руководство подготовлено для предоставления сведений в целях регистрации медицинского изделия на территории Российской Федерации. Сведения представлены в объеме, требуемом в соответствии с Правилами регистрации медицинских изделий (постановление Правительства РФ от 27.12.2012 №1416)

Производитель:
"АНТОНИ КАРЛЕС, С.А."
(ANTONI CARLES, S.A.)

2020


5. Стол офтальмологический электрический АТЕ-800 в составе:
5.1. Столешница изогнутая, составная с блоком питания - 1 шт.

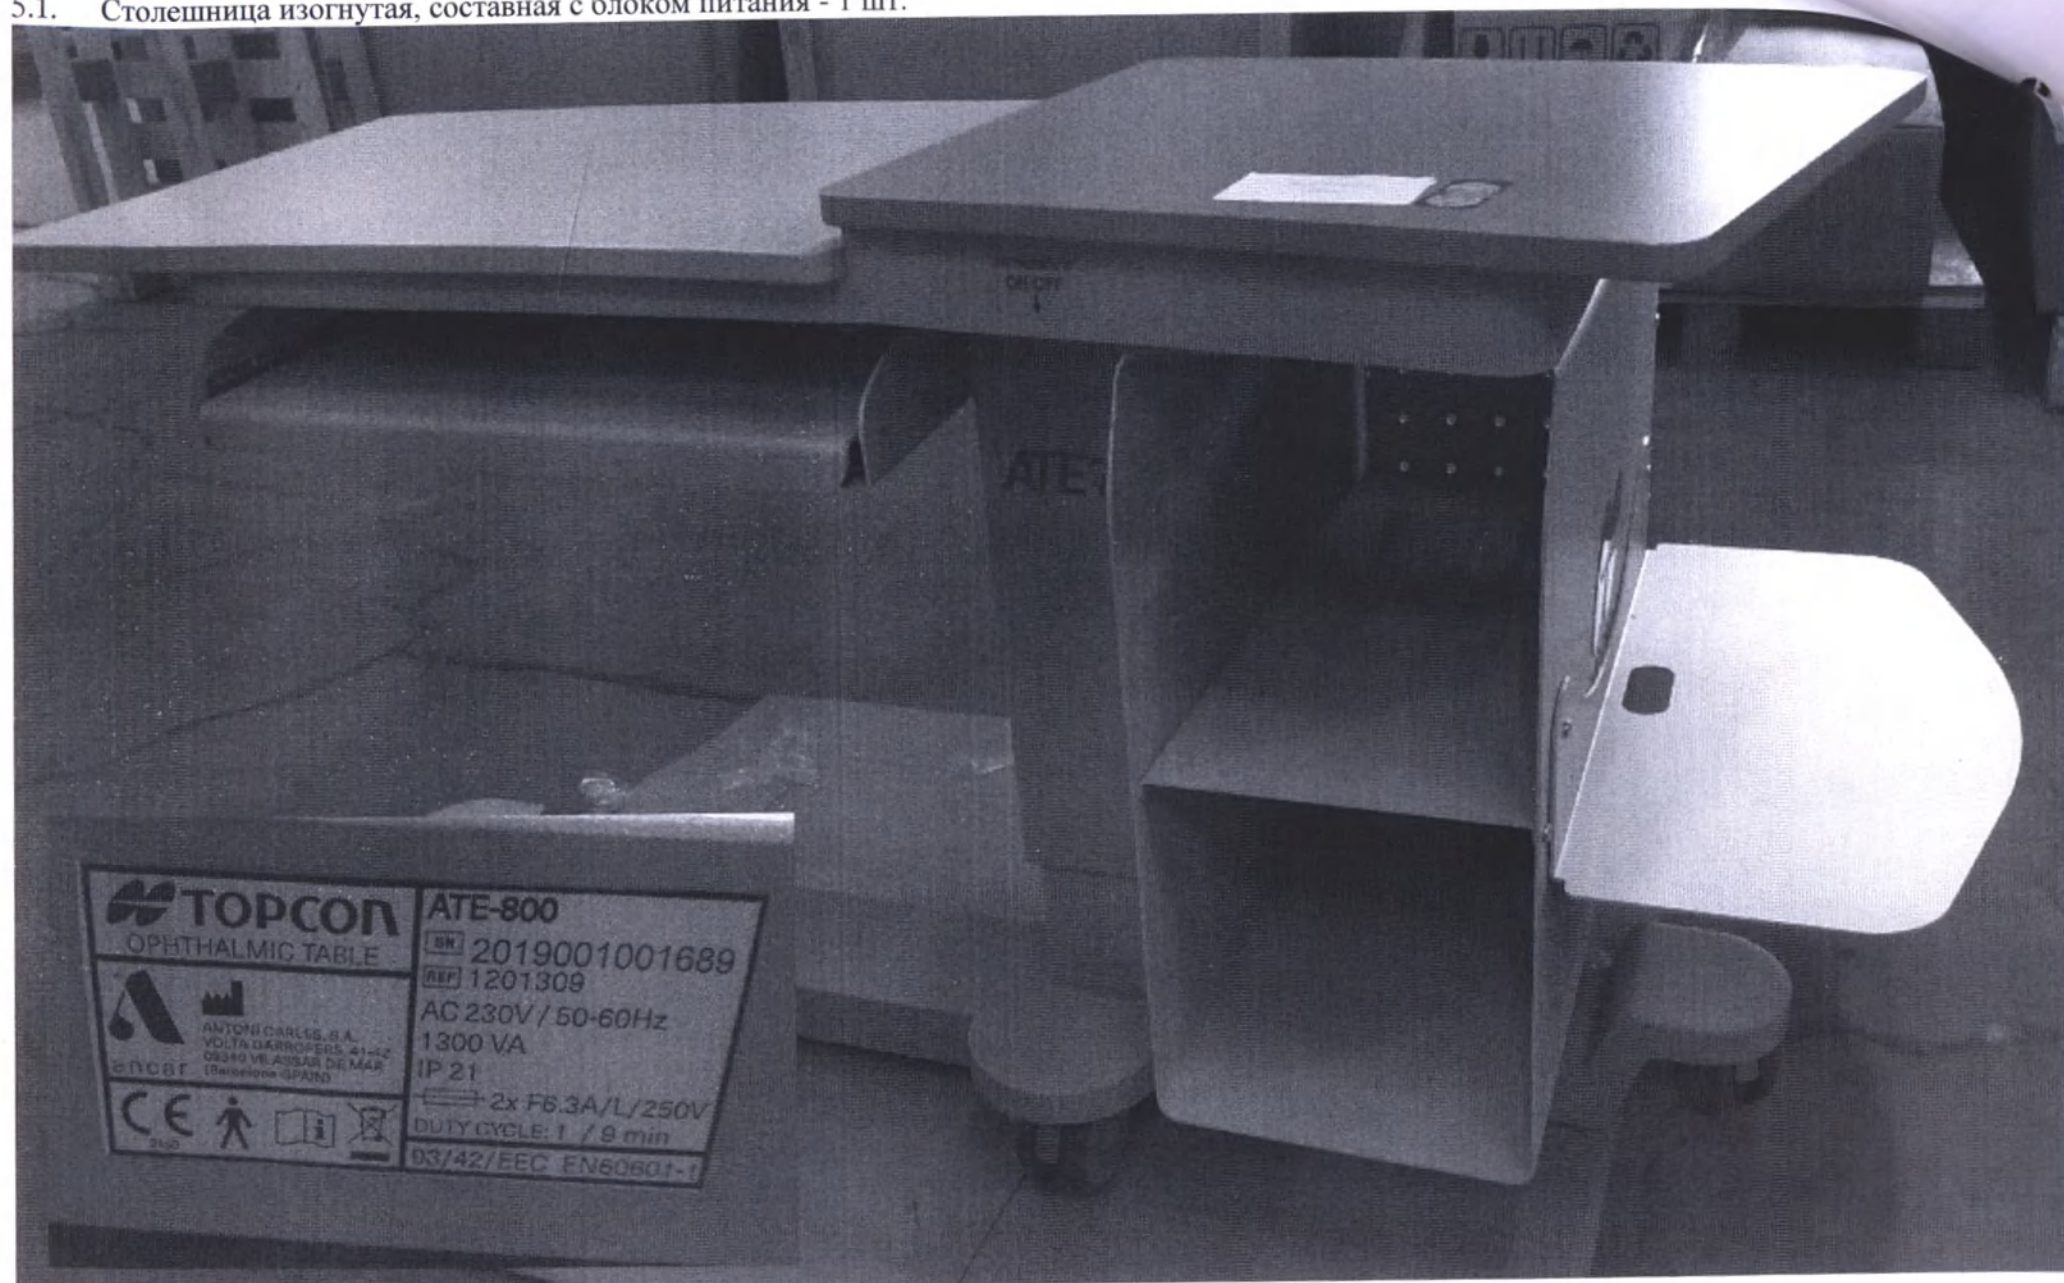


5.2. Колонна электромеханическая телескопическая - 1 шт.




5.3. Основание под колонну крестообразное - 1 шт.

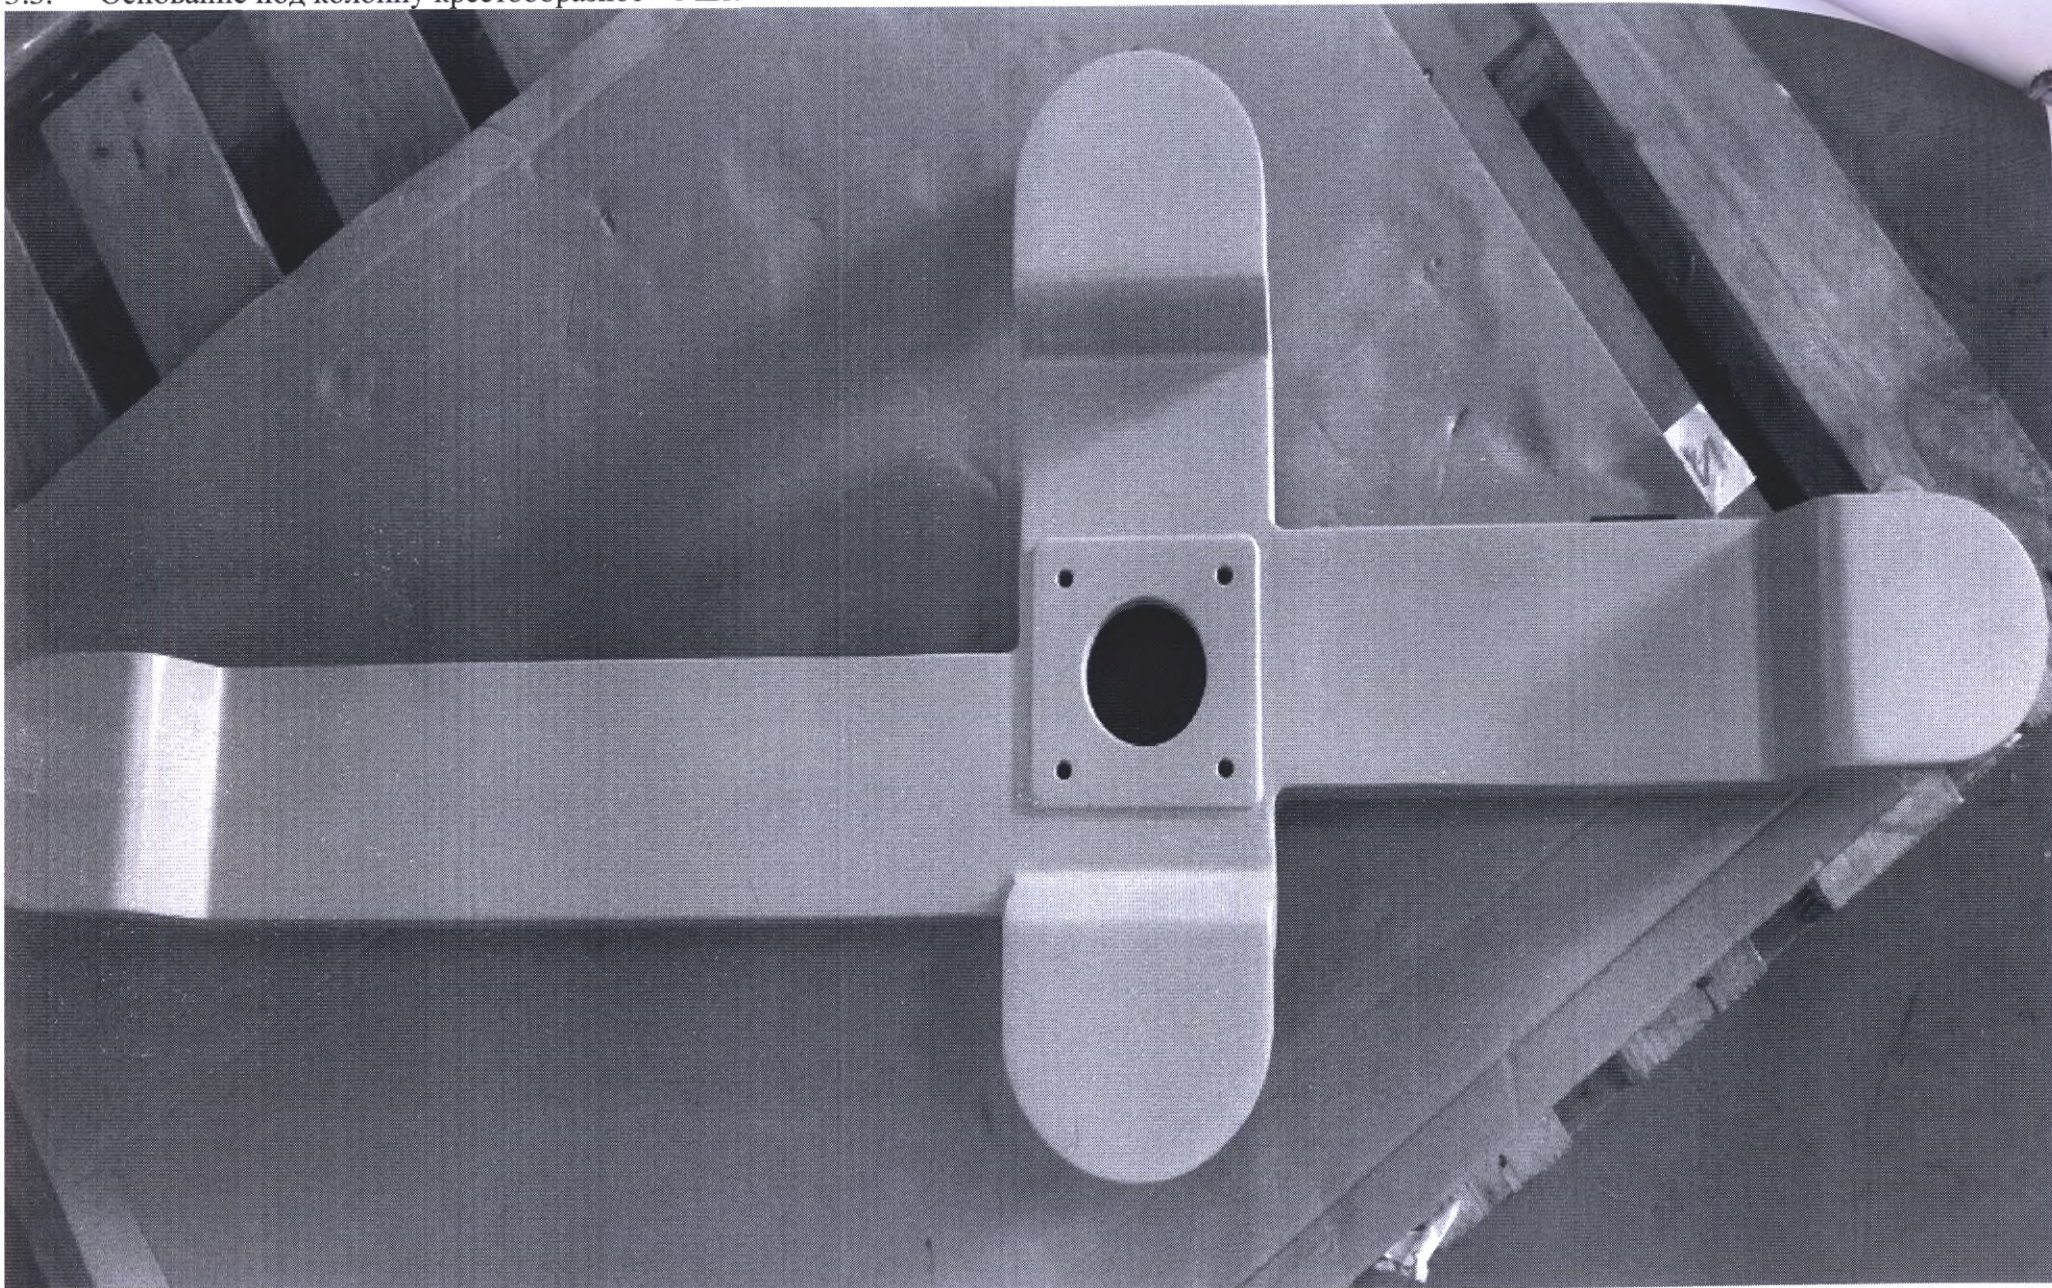


5.4. Колеса под основание - 4 шт.

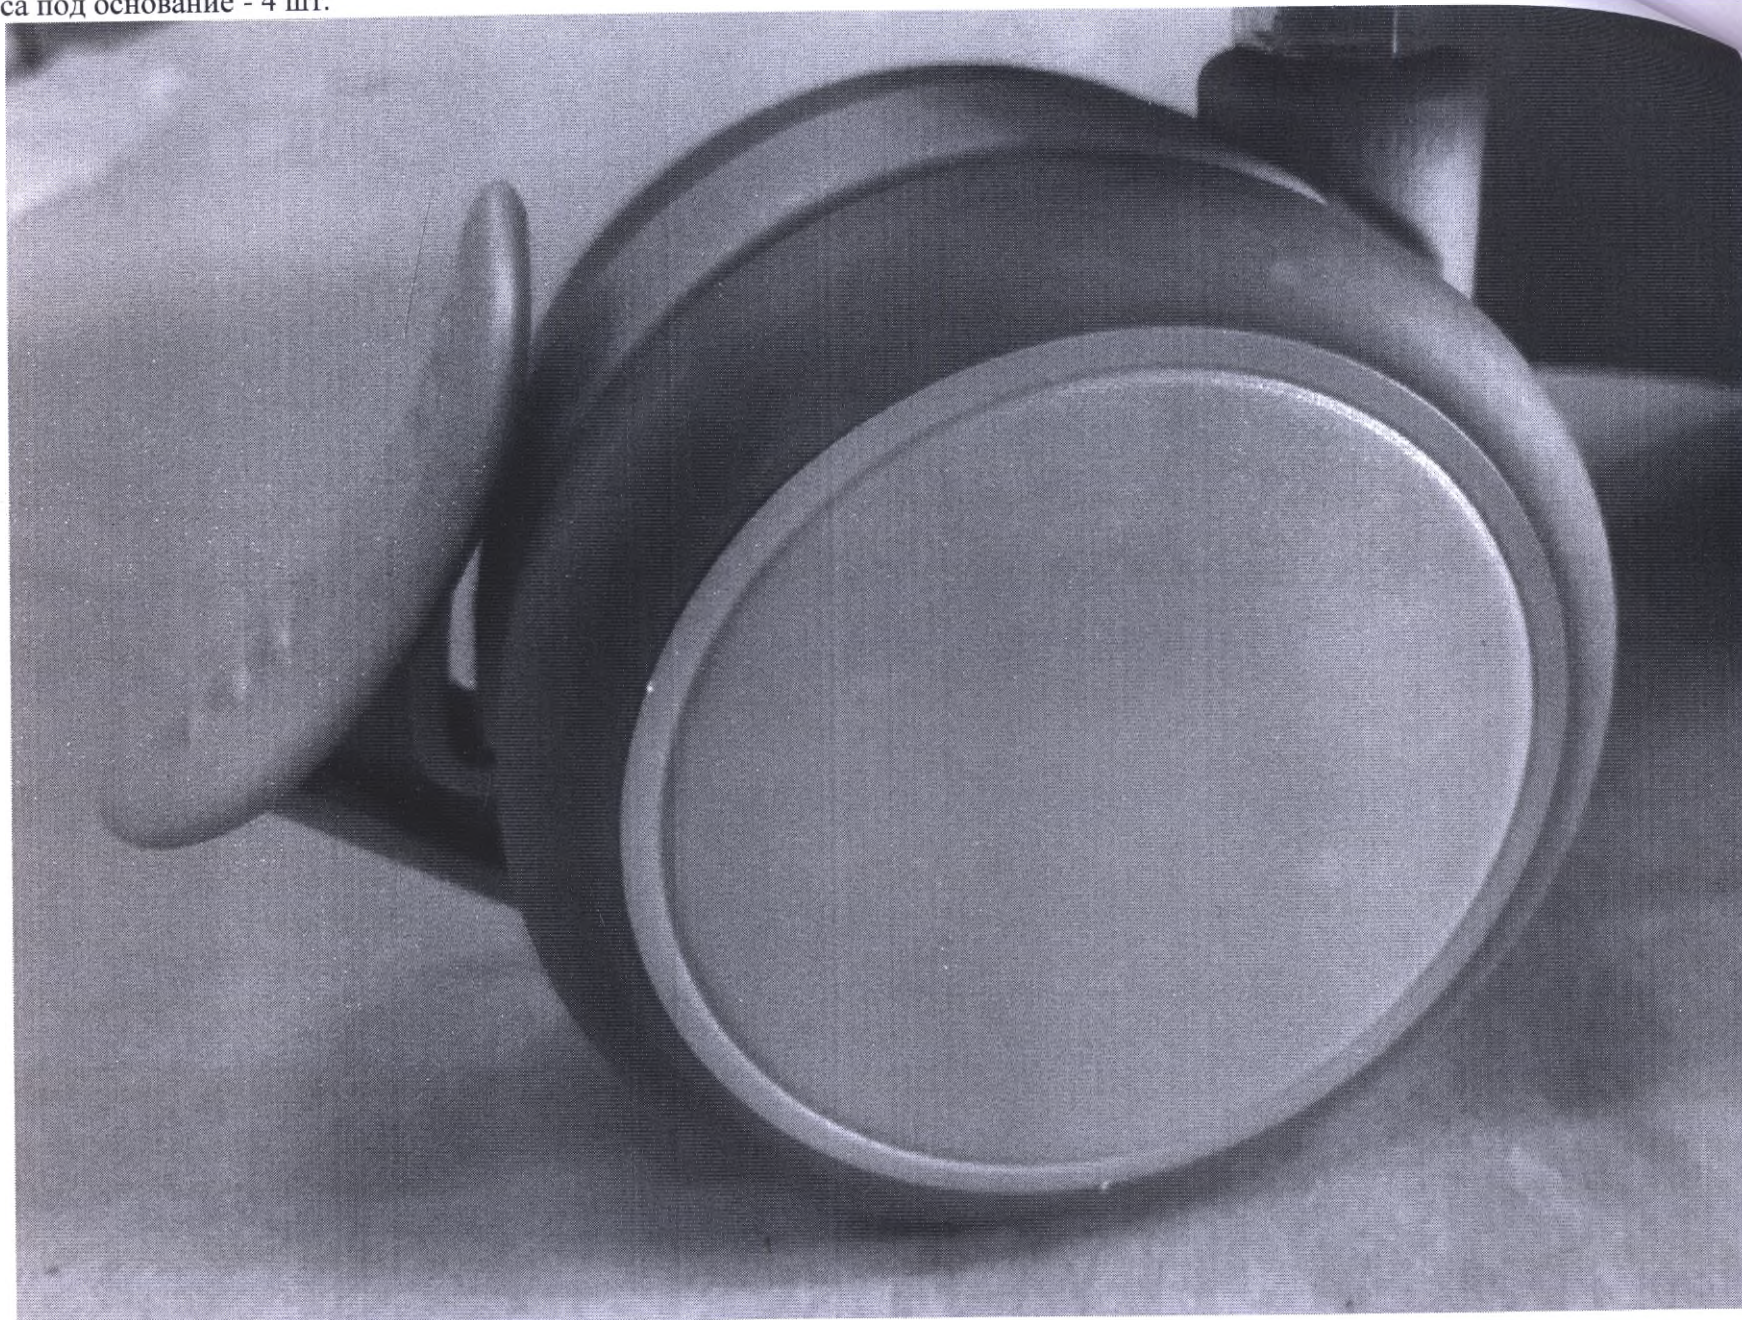


5.5. Бокс металлический для системного блока - 1 шт. (при необходимости).

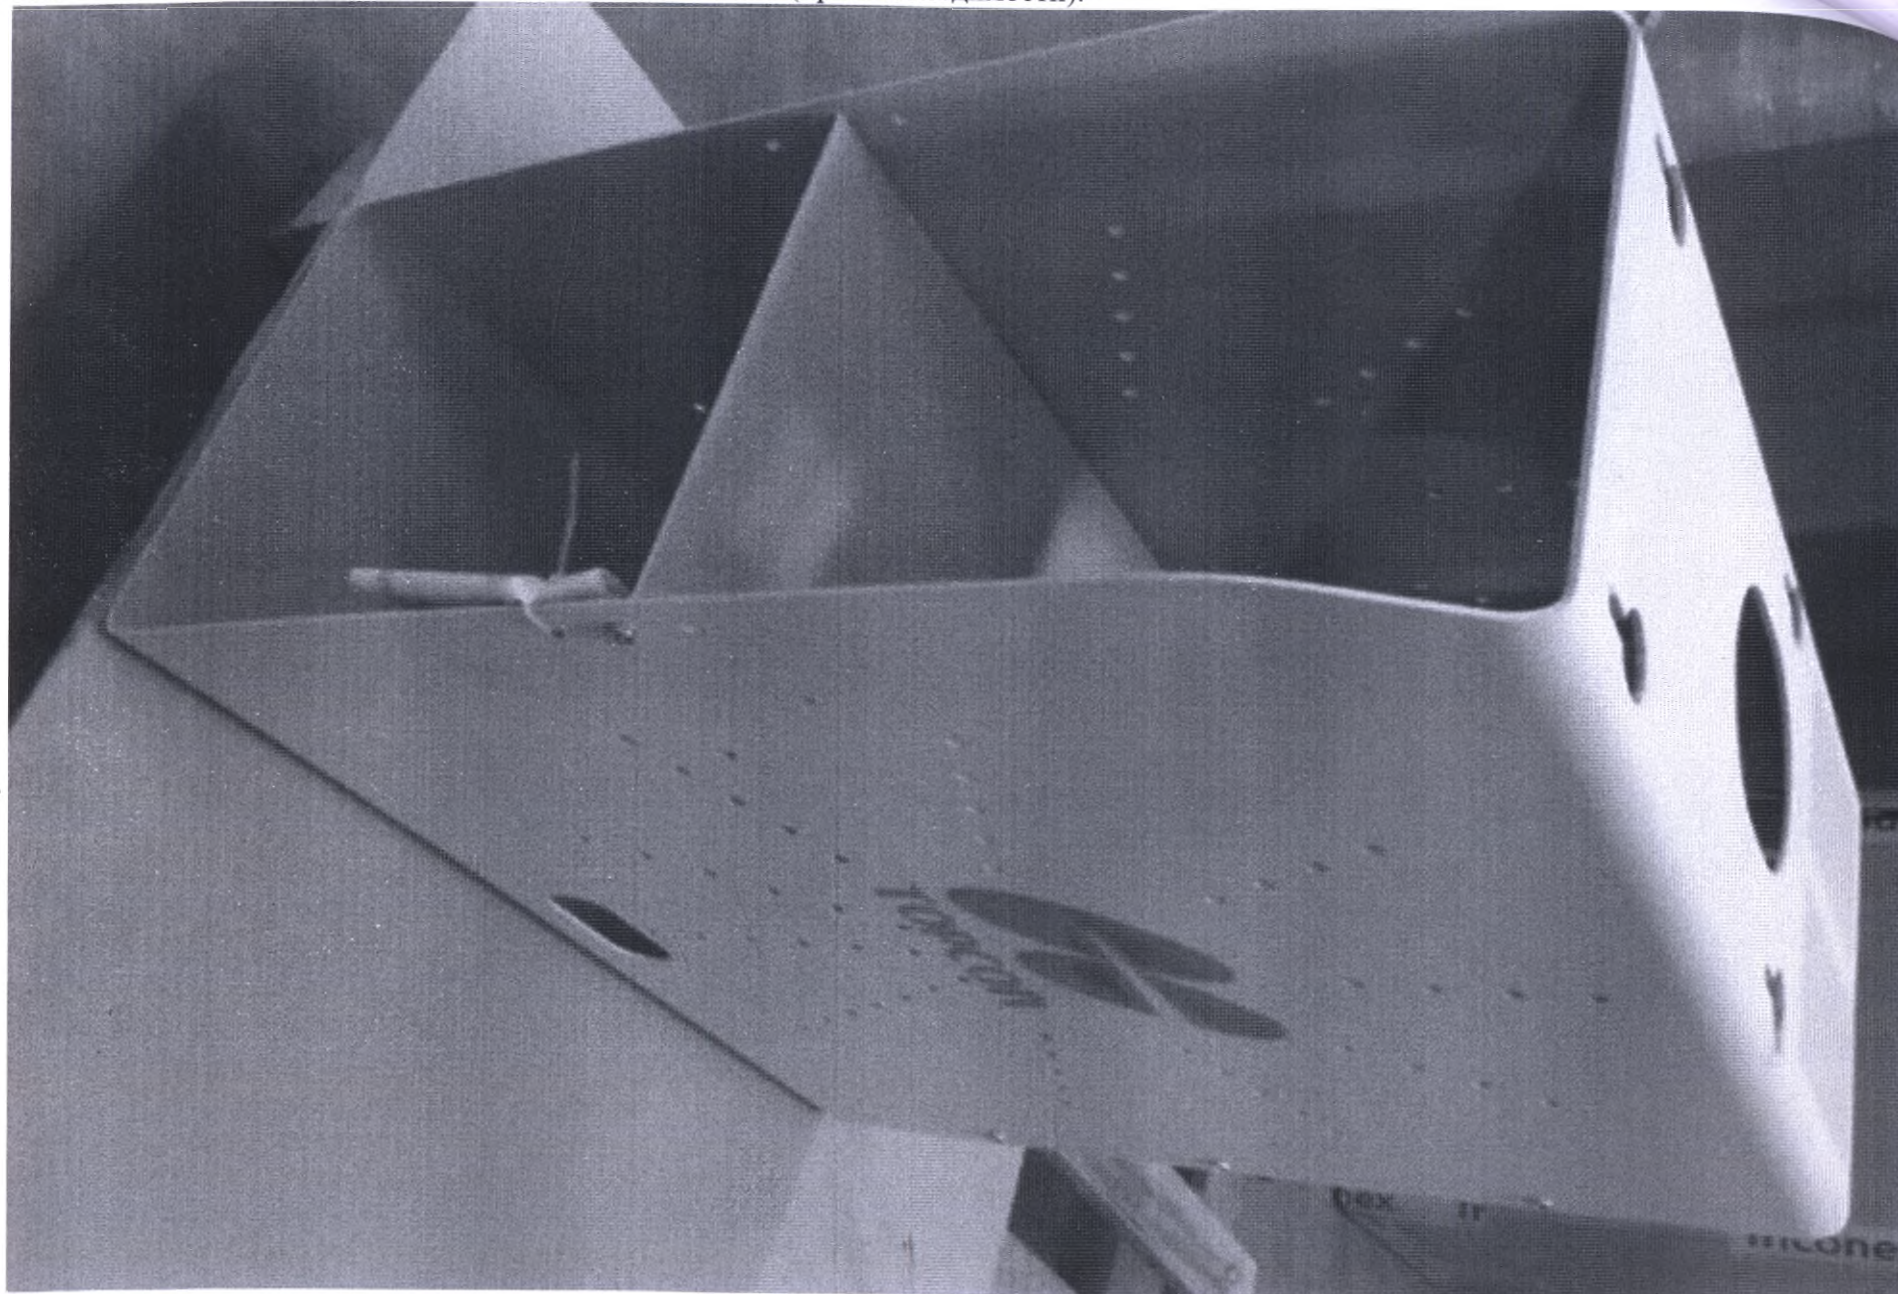


5.6. Подставка для принтера металлическая - 1 шт. (при необходимости).

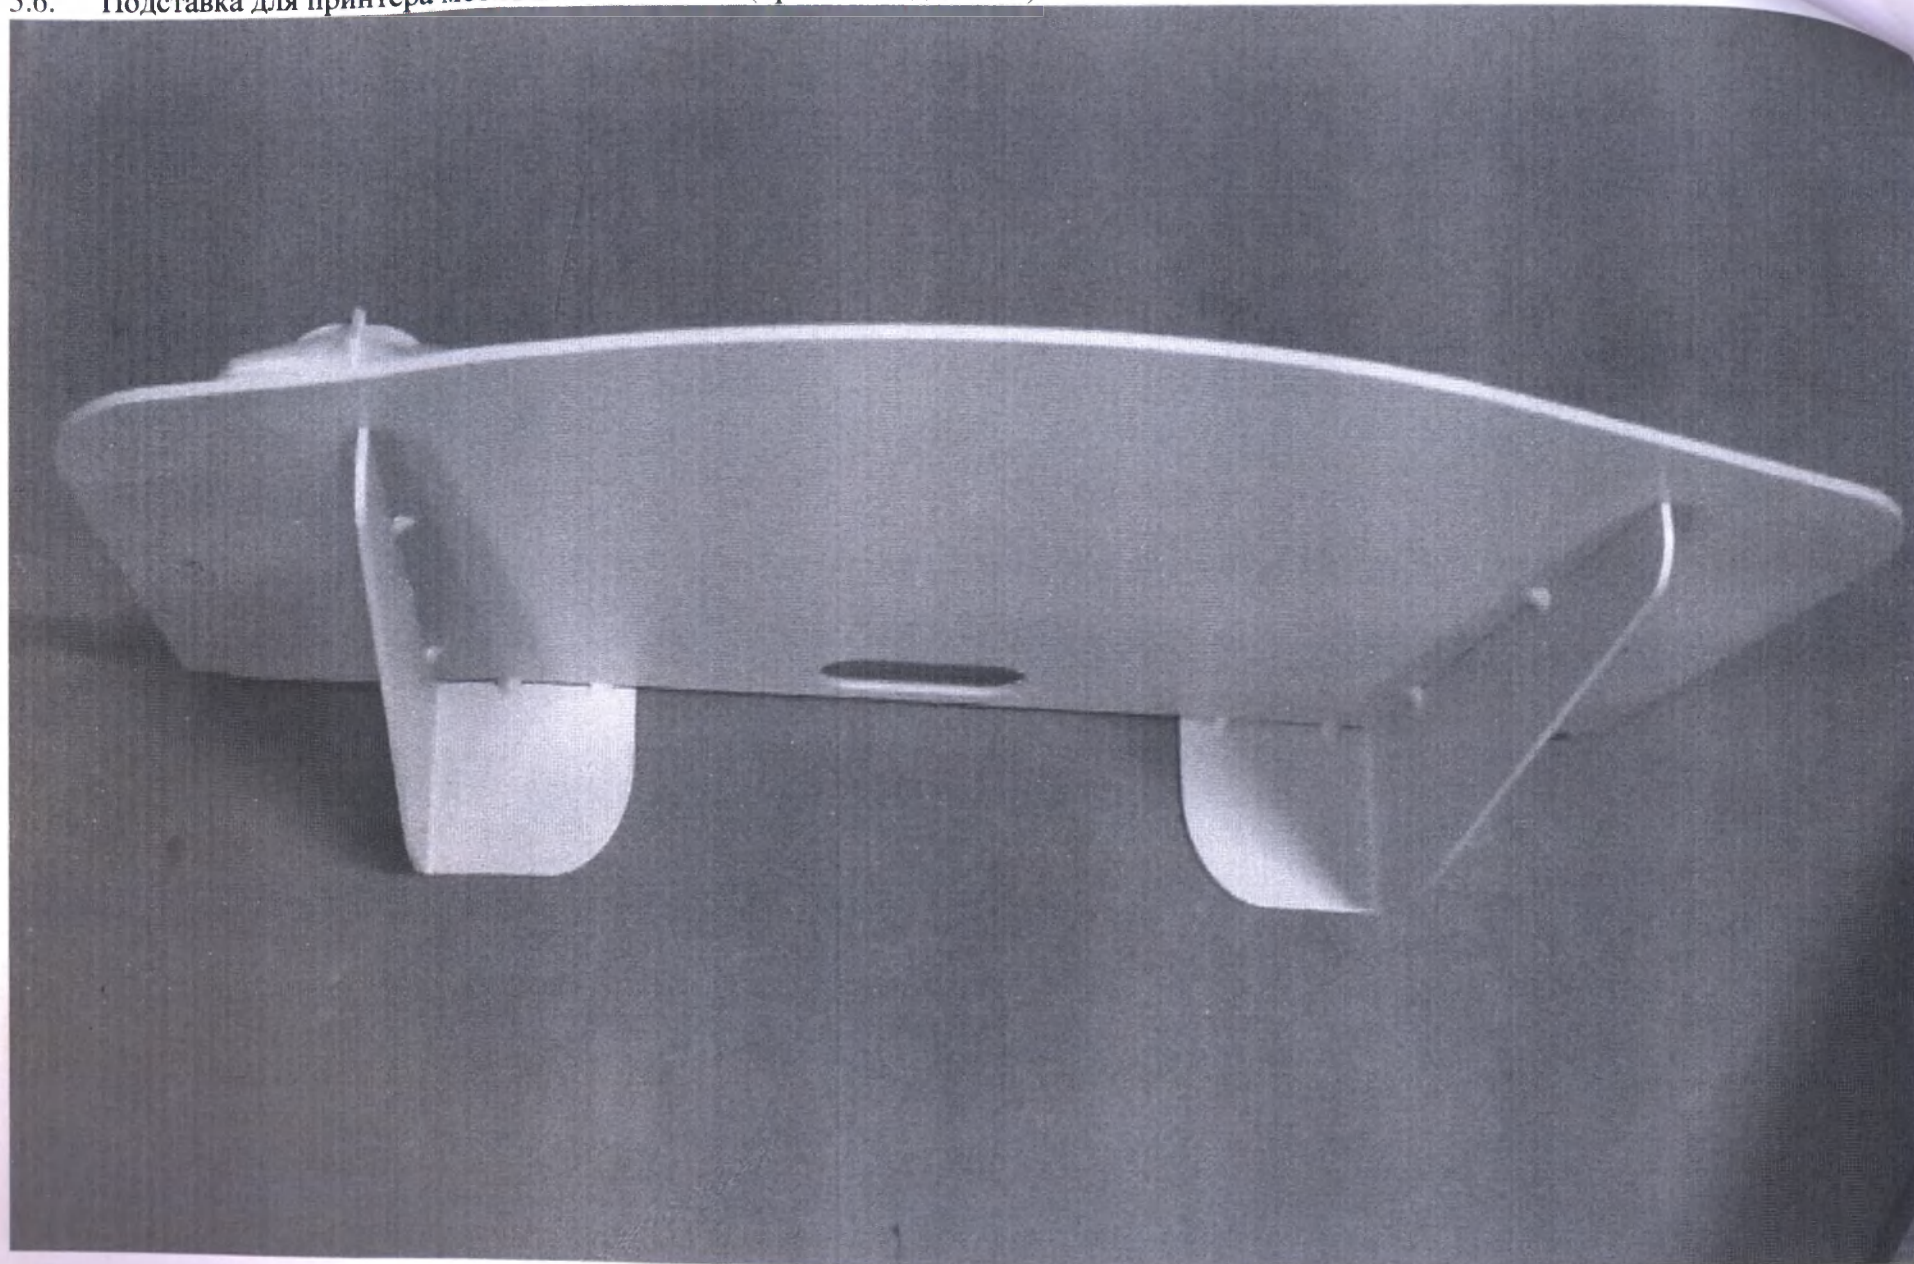


5.7. Поставка под клавиатуру выдвижная металлическая - 1 шт. (при необходимости).

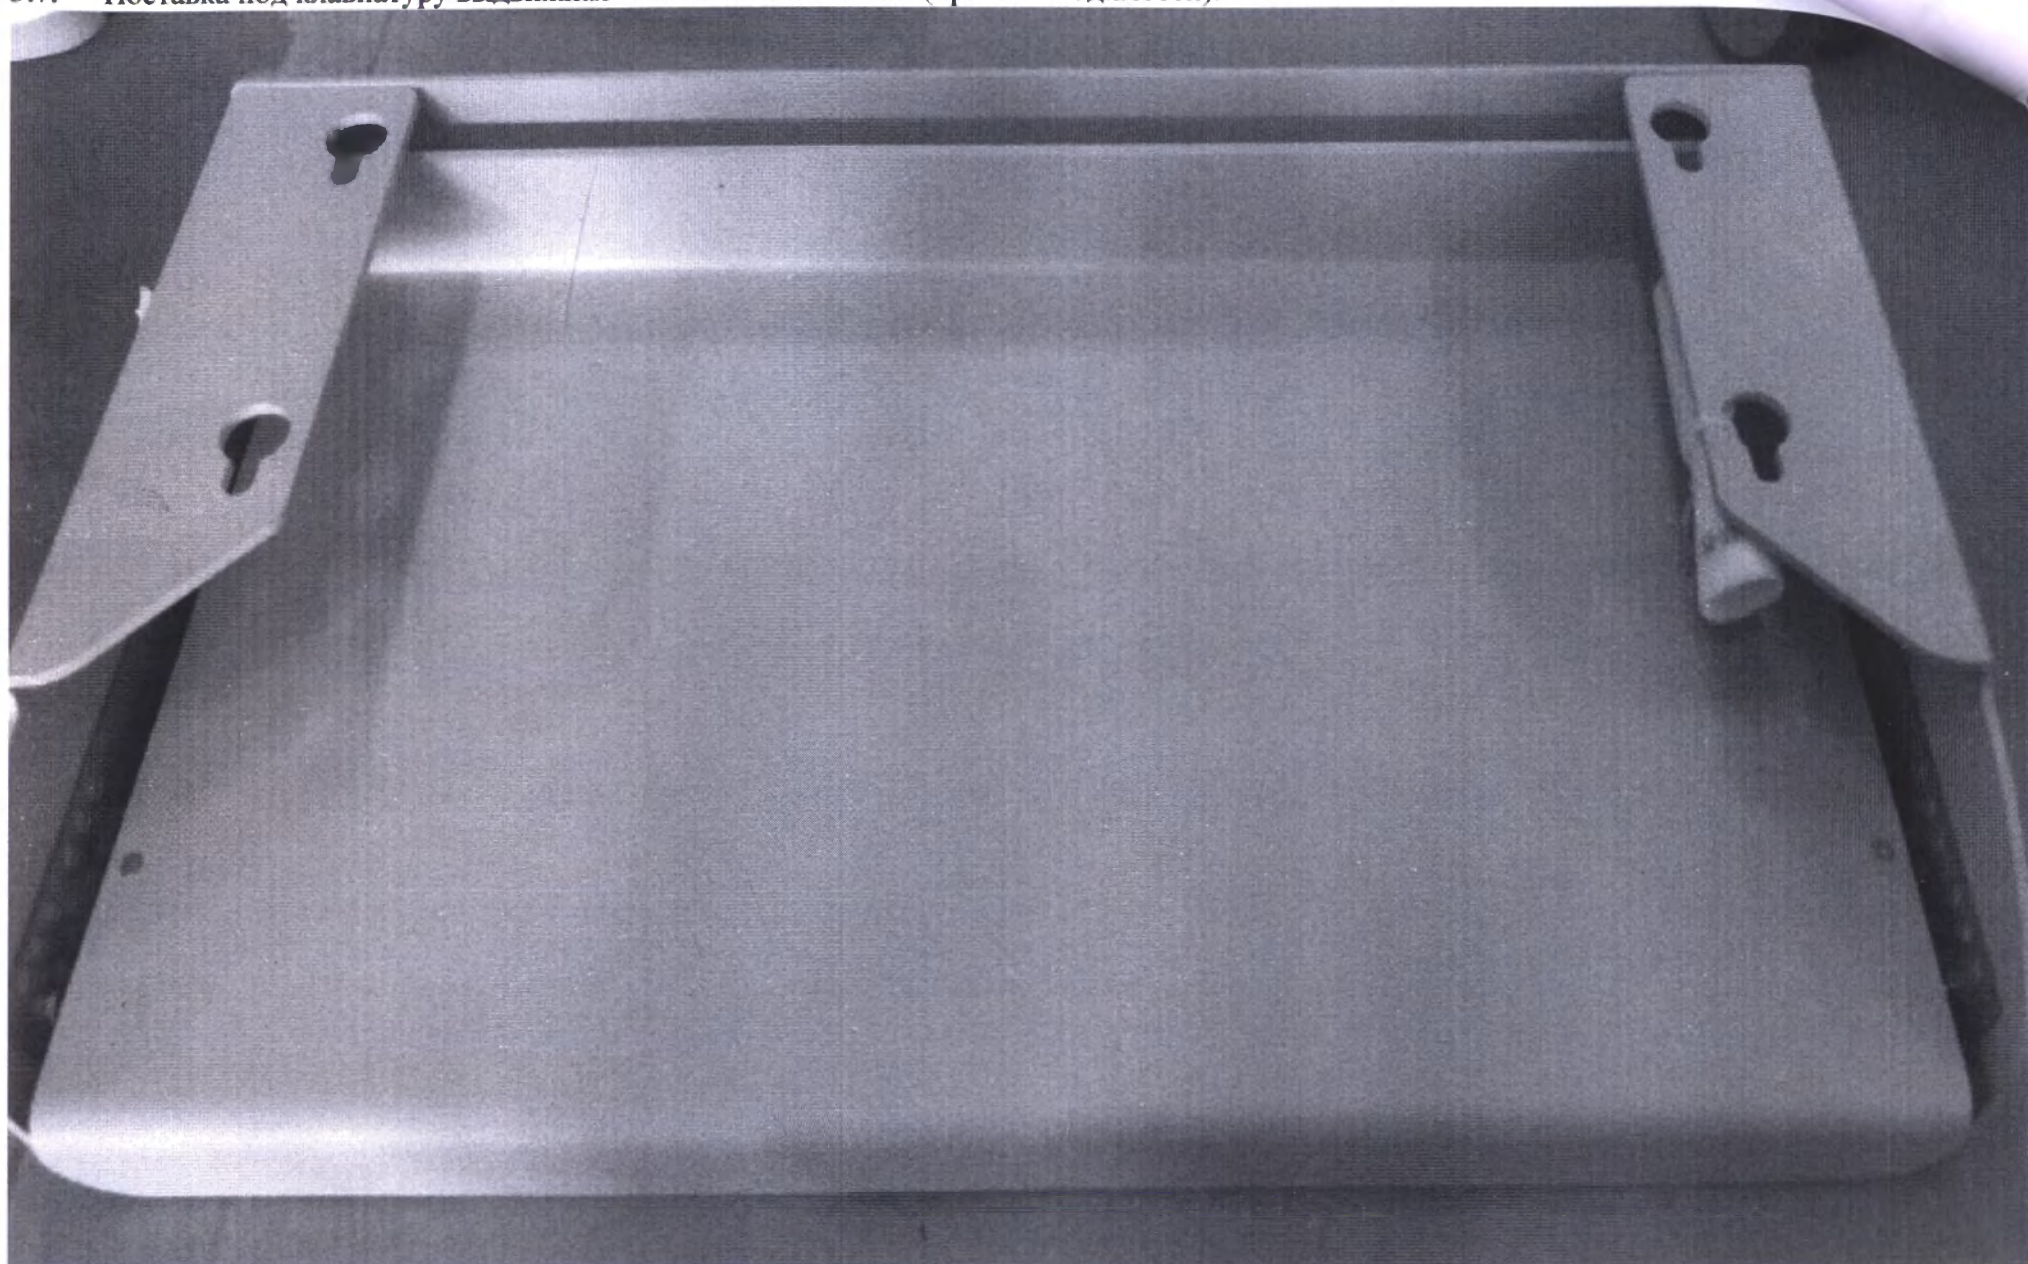


5.8. Кабель сетевой - 1 шт.

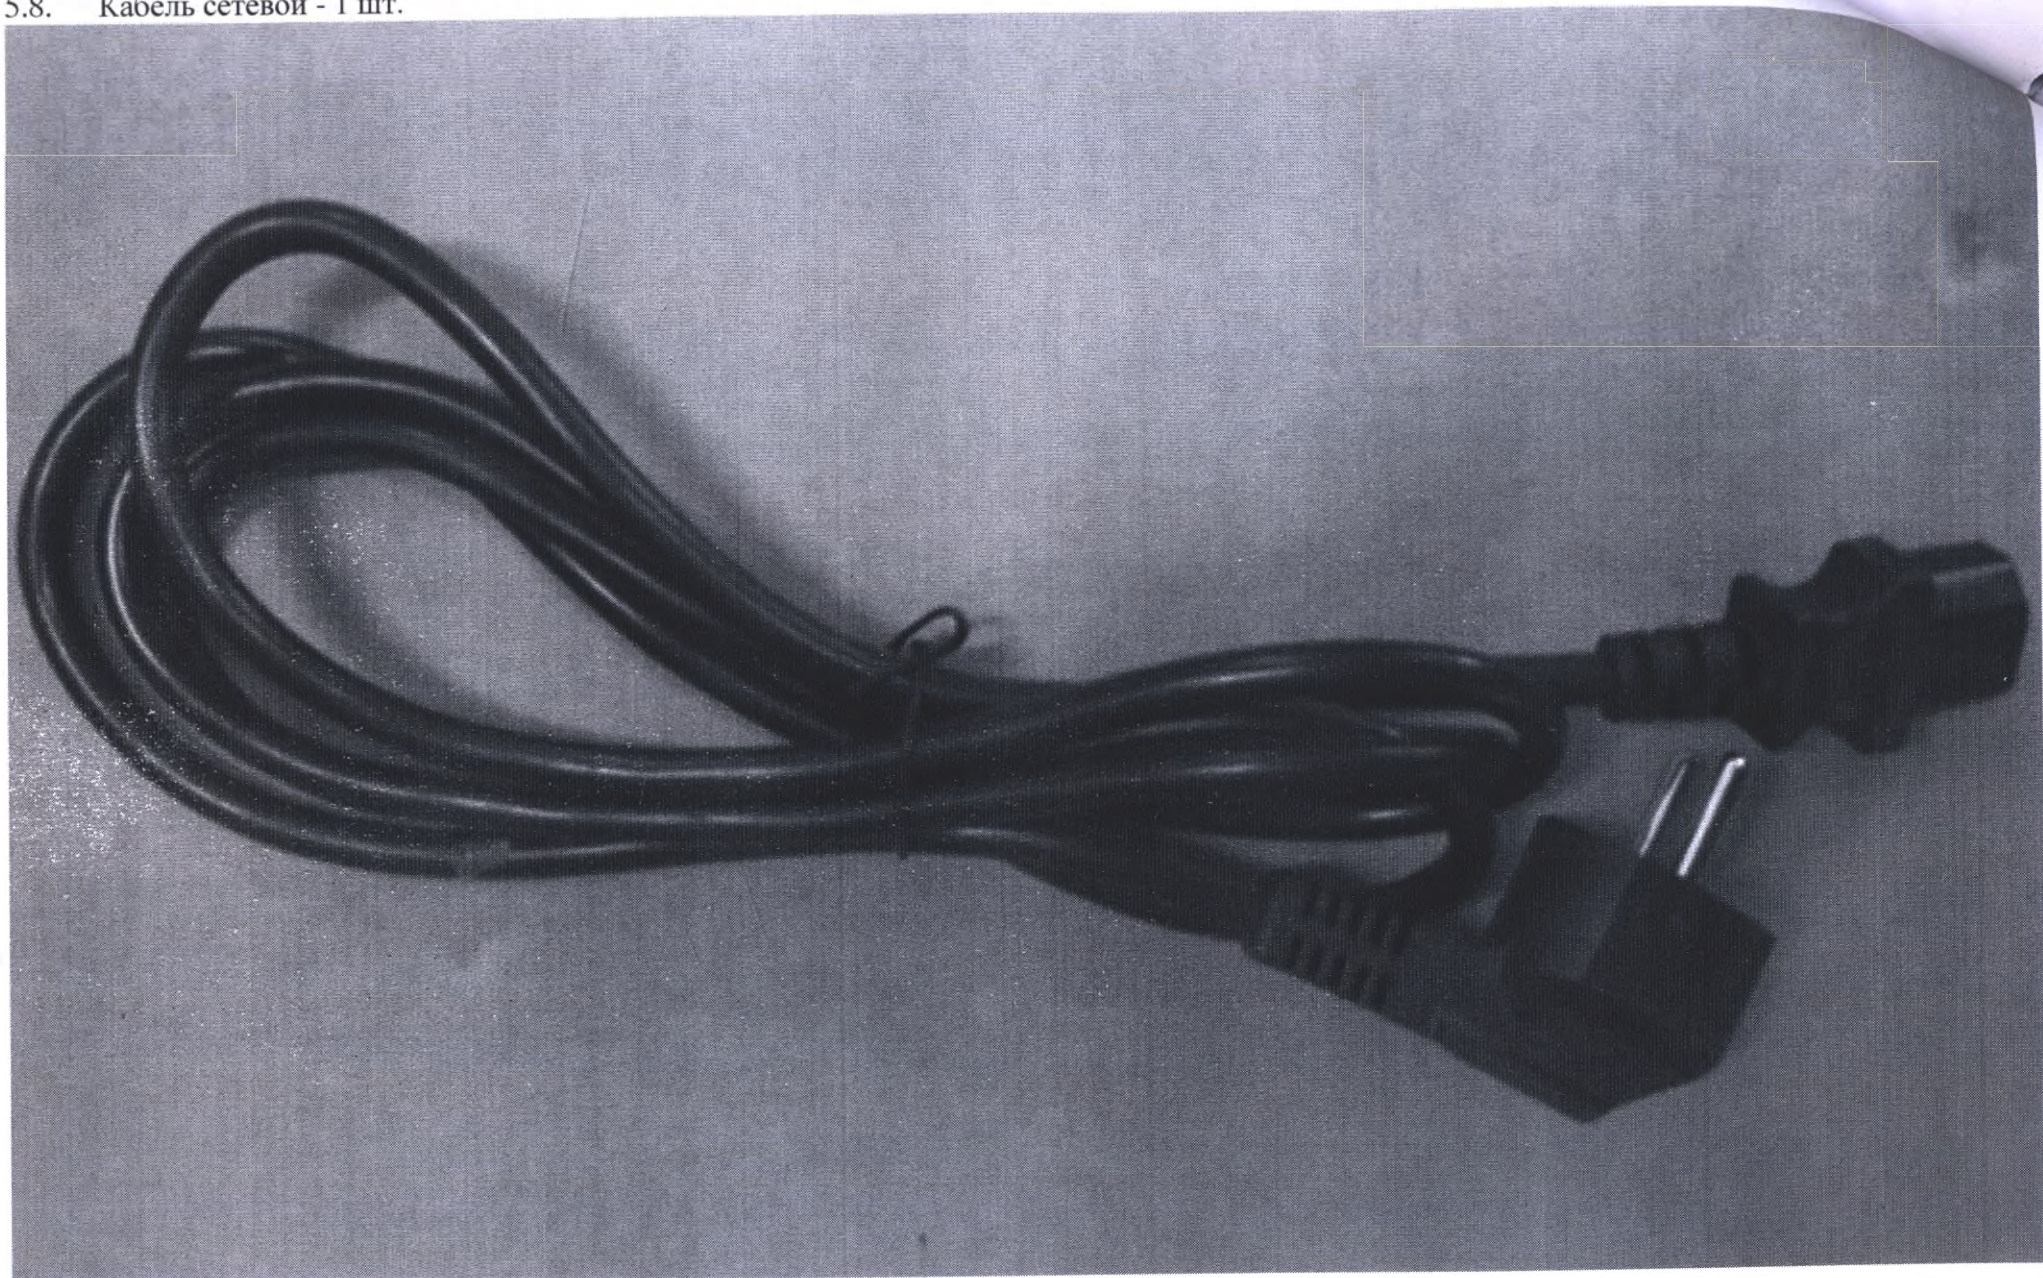

5.9. Панель управления - 1 шт.

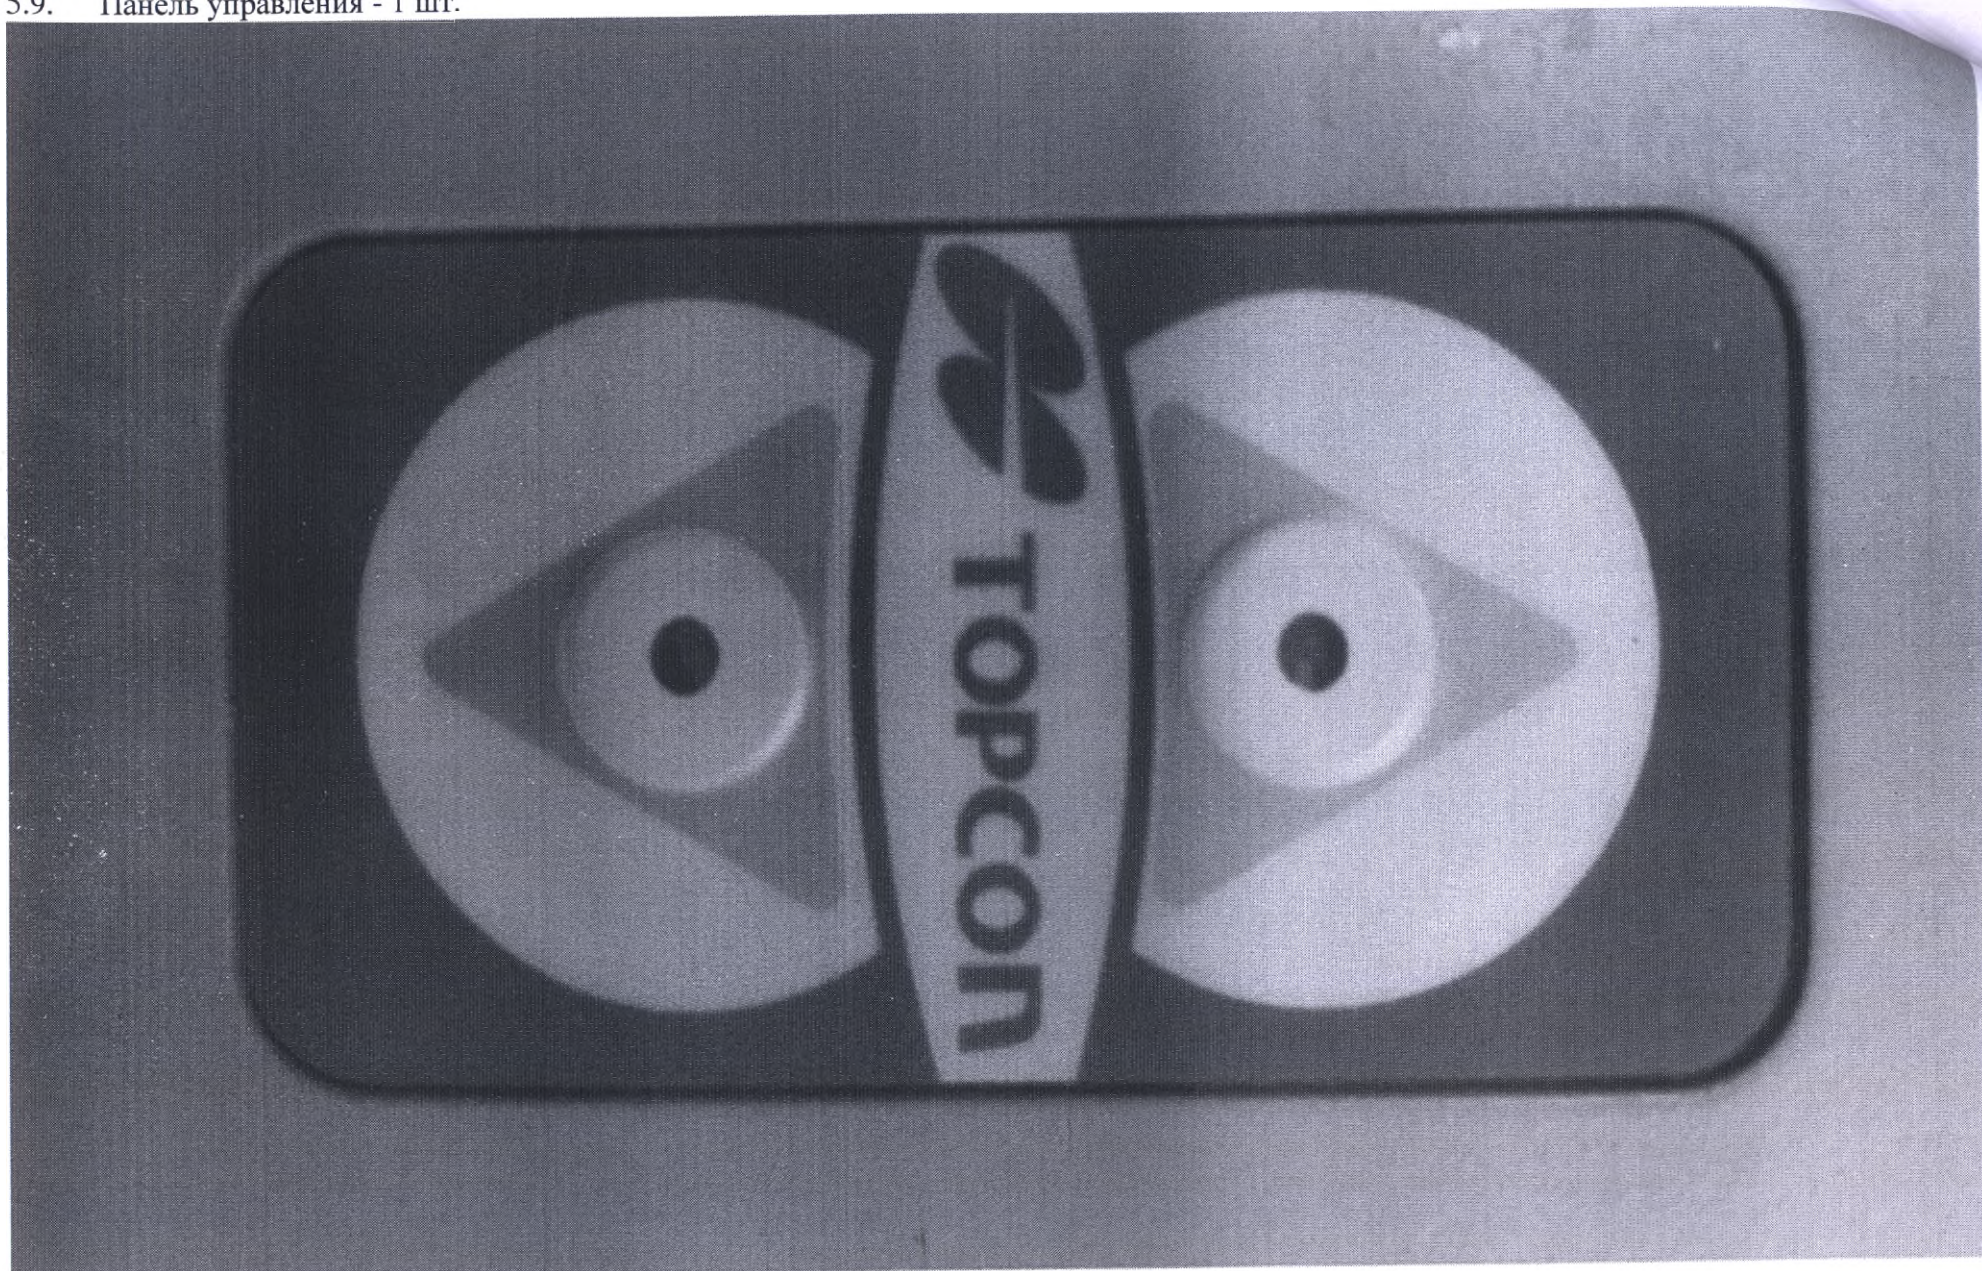

 Стол офтальмологический электрический «АТЕ»	Руководство по эксплуатации на МИ	Номер документа: RU-2020/08/TOPCON/ATE	
		Версия: 1	Страница: 1 из 49
Производитель: "АНТОНИ КАРЛЕС, С.А." (ANTONI CARLES, S.A.)	Уполномоченный представитель в РФ: Общество с ограниченной ответственностью "Тринити Медикал Системс"	Дата выпуска: 2020-08-02	

Руководство по эксплуатации

Стол офтальмологический электрический «АТЕ» Варианты исполнения:

Стол офтальмологический электрический АТЕ-300 в составе
 Стол офтальмологический электрический АТЕ-600 в составе
 Стол офтальмологический электрический АТЕ-700 в составе
 Стол офтальмологический электрический АТЕ-700РС BOX в составе
 Стол офтальмологический электрический АТЕ-800 в составе

(Настоящее руководство подготовлено для предоставления сведений в целях регистрации
 медицинского изделия на территории Российской Федерации. Сведения представлены в объеме,
 требуемом в соответствии с Правилами регистрации медицинских изделий (постановление
 Правительства РФ от 27.12.2012 №1416)

Производитель:
 "АНТОНИ КАРЛЕС, С.А."
 (ANTONI CARLES, S.A.)

2020

Прошито, пронумеровано 46 листов
и скреплено печатью

Генеральный директор
ООО «ТМС»

Серегин Р.В.

