

Фотографии медицинского изделия
«Отсасыватель медицинский «Armed»,
производство: Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd., Китай

- I. Отсасыватель медицинский «Armed», вариант исполнения 7E-A, в составе (рис. 1-8);
- II. Отсасыватель медицинский «Armed», вариант исполнения 7E-B, в составе (рис. 9-15);
- III. Отсасыватель медицинский «Armed», вариант исполнения 7E-C, в составе (рис. 16-24);
- IV. Отсасыватель медицинский «Armed», вариант исполнения 7E-D, в составе (рис. 25-35);
- V. Отсасыватель медицинский «Armed», вариант исполнения 7E-G, в составе (рис. 36-46);
- VI. Отсасыватель медицинский «Armed», вариант исполнения 7A-23B, в составе (рис. 47-55);
- VII. Отсасыватель медицинский «Armed», вариант исполнения 7A-23B-1, в составе (рис. 56-64);
- VIII. Отсасыватель медицинский «Armed», вариант исполнения 7A-23D, в составе (рис. 65-73);
- IX. Отсасыватель медицинский «Armed», вариант исполнения 7E-B5, в составе (рис. 74-79);
- X. Упаковка медицинского изделия (рис. 80-83);
- XI. Маркировка медицинского изделия (рис. 84-86).

Генеральный директор
(должность)



(А.М. Леонтьев)
(И.О. Фамилия)

от имени Общества с ограниченной ответственностью «МЕДИМПОРТ» (ООО «МЕДИМПОРТ»)
(наименование организации-заявителя)

I. Отсасыватель медицинский «Armed», вариант исполнения 7E-A, в составе:

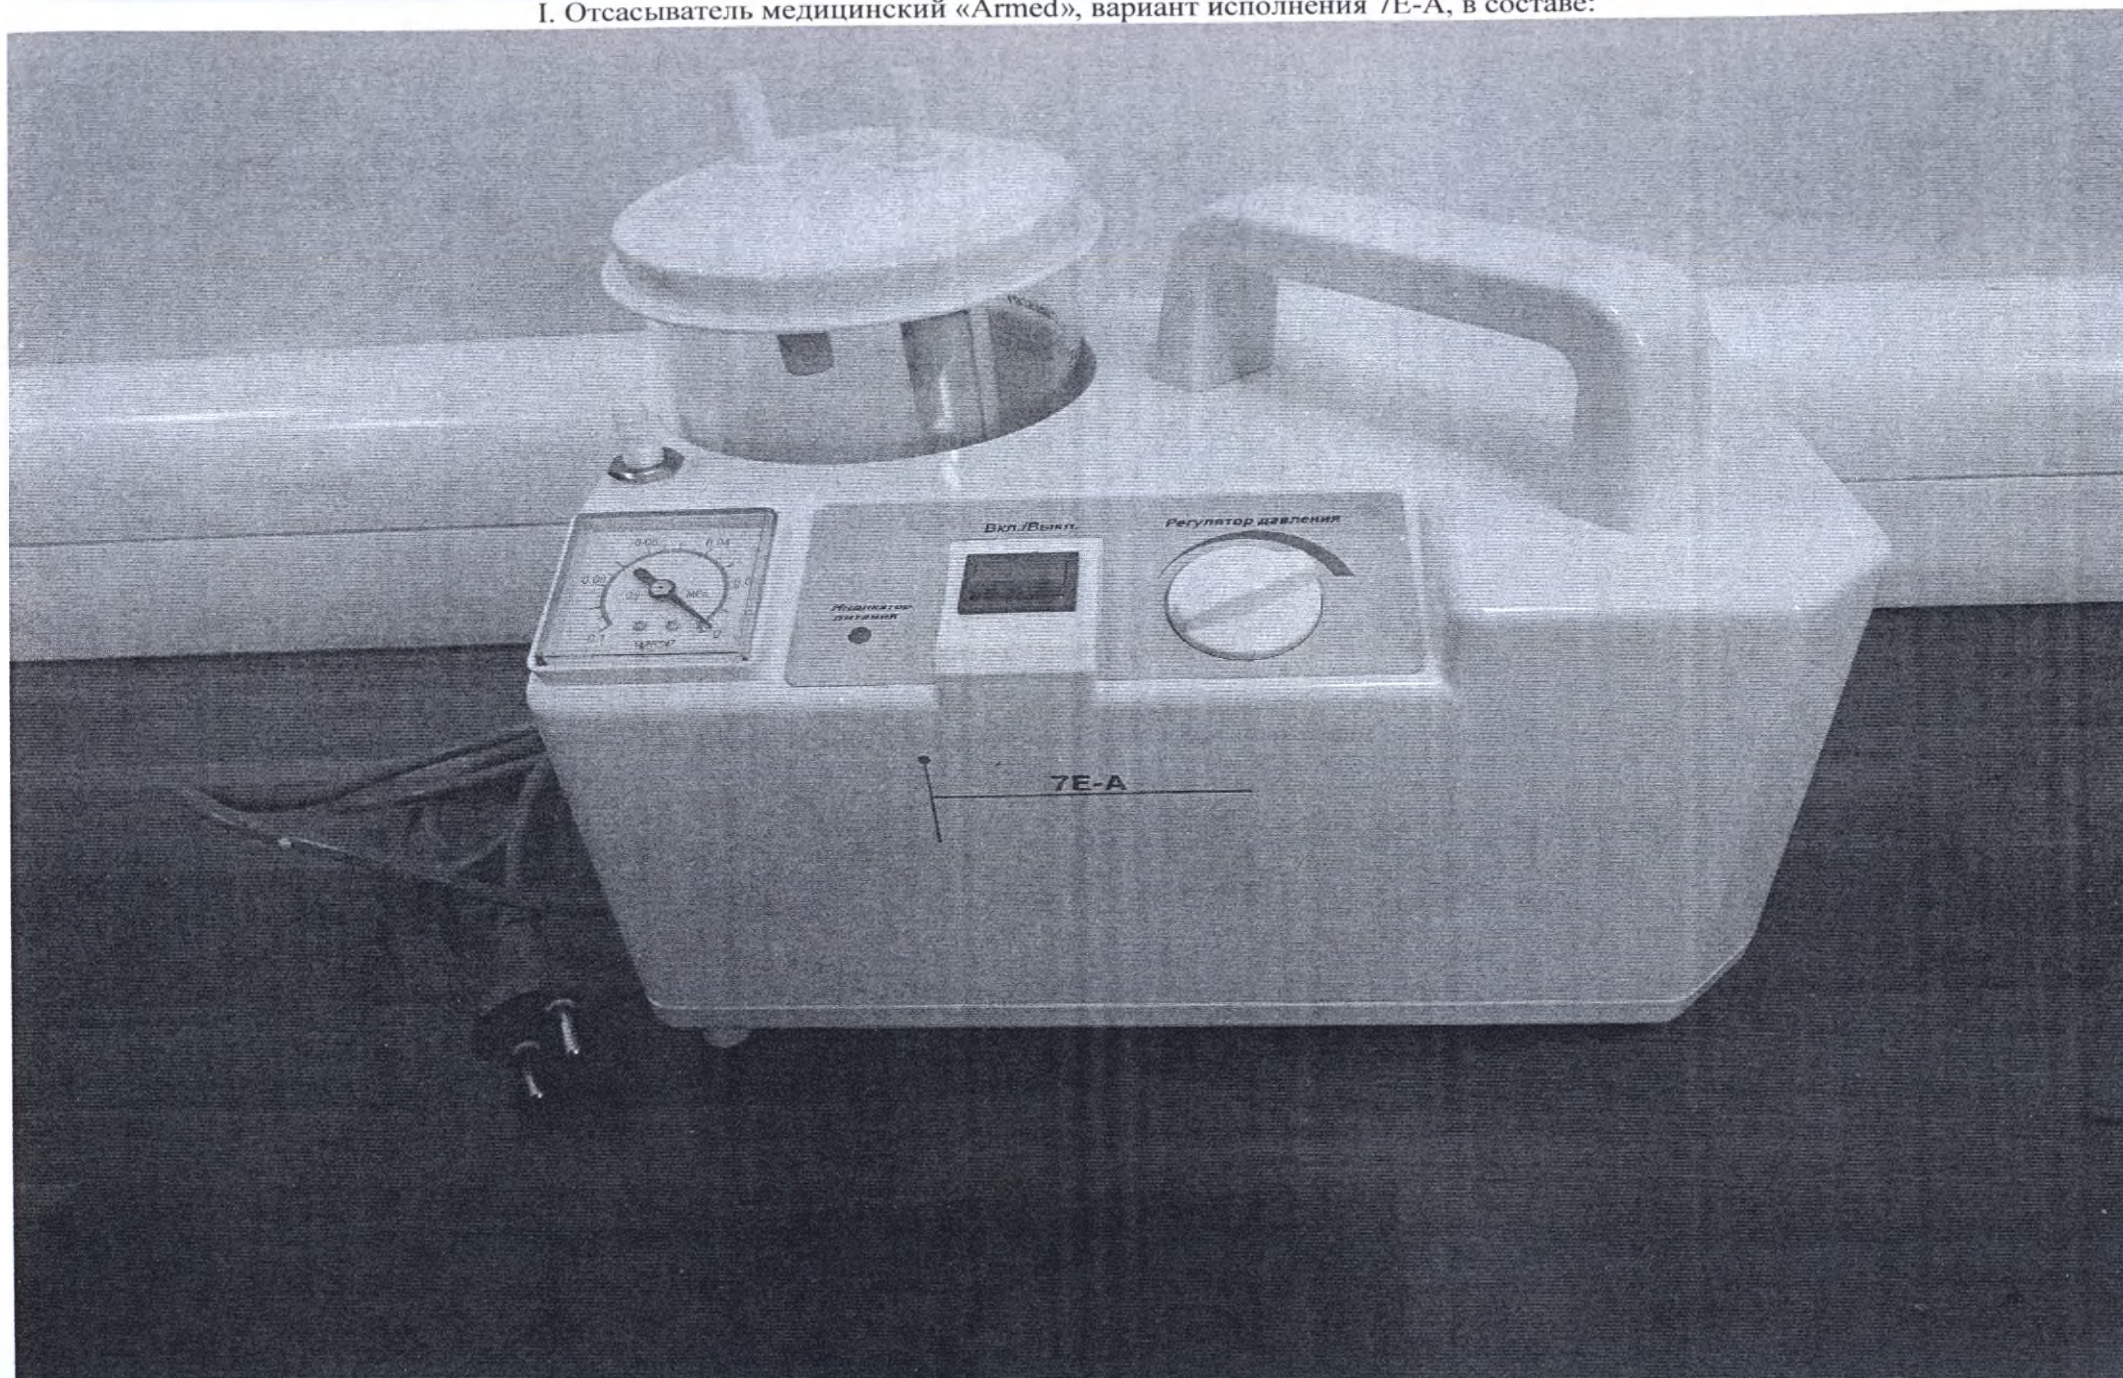


Рис. 1 – Отсасыватель






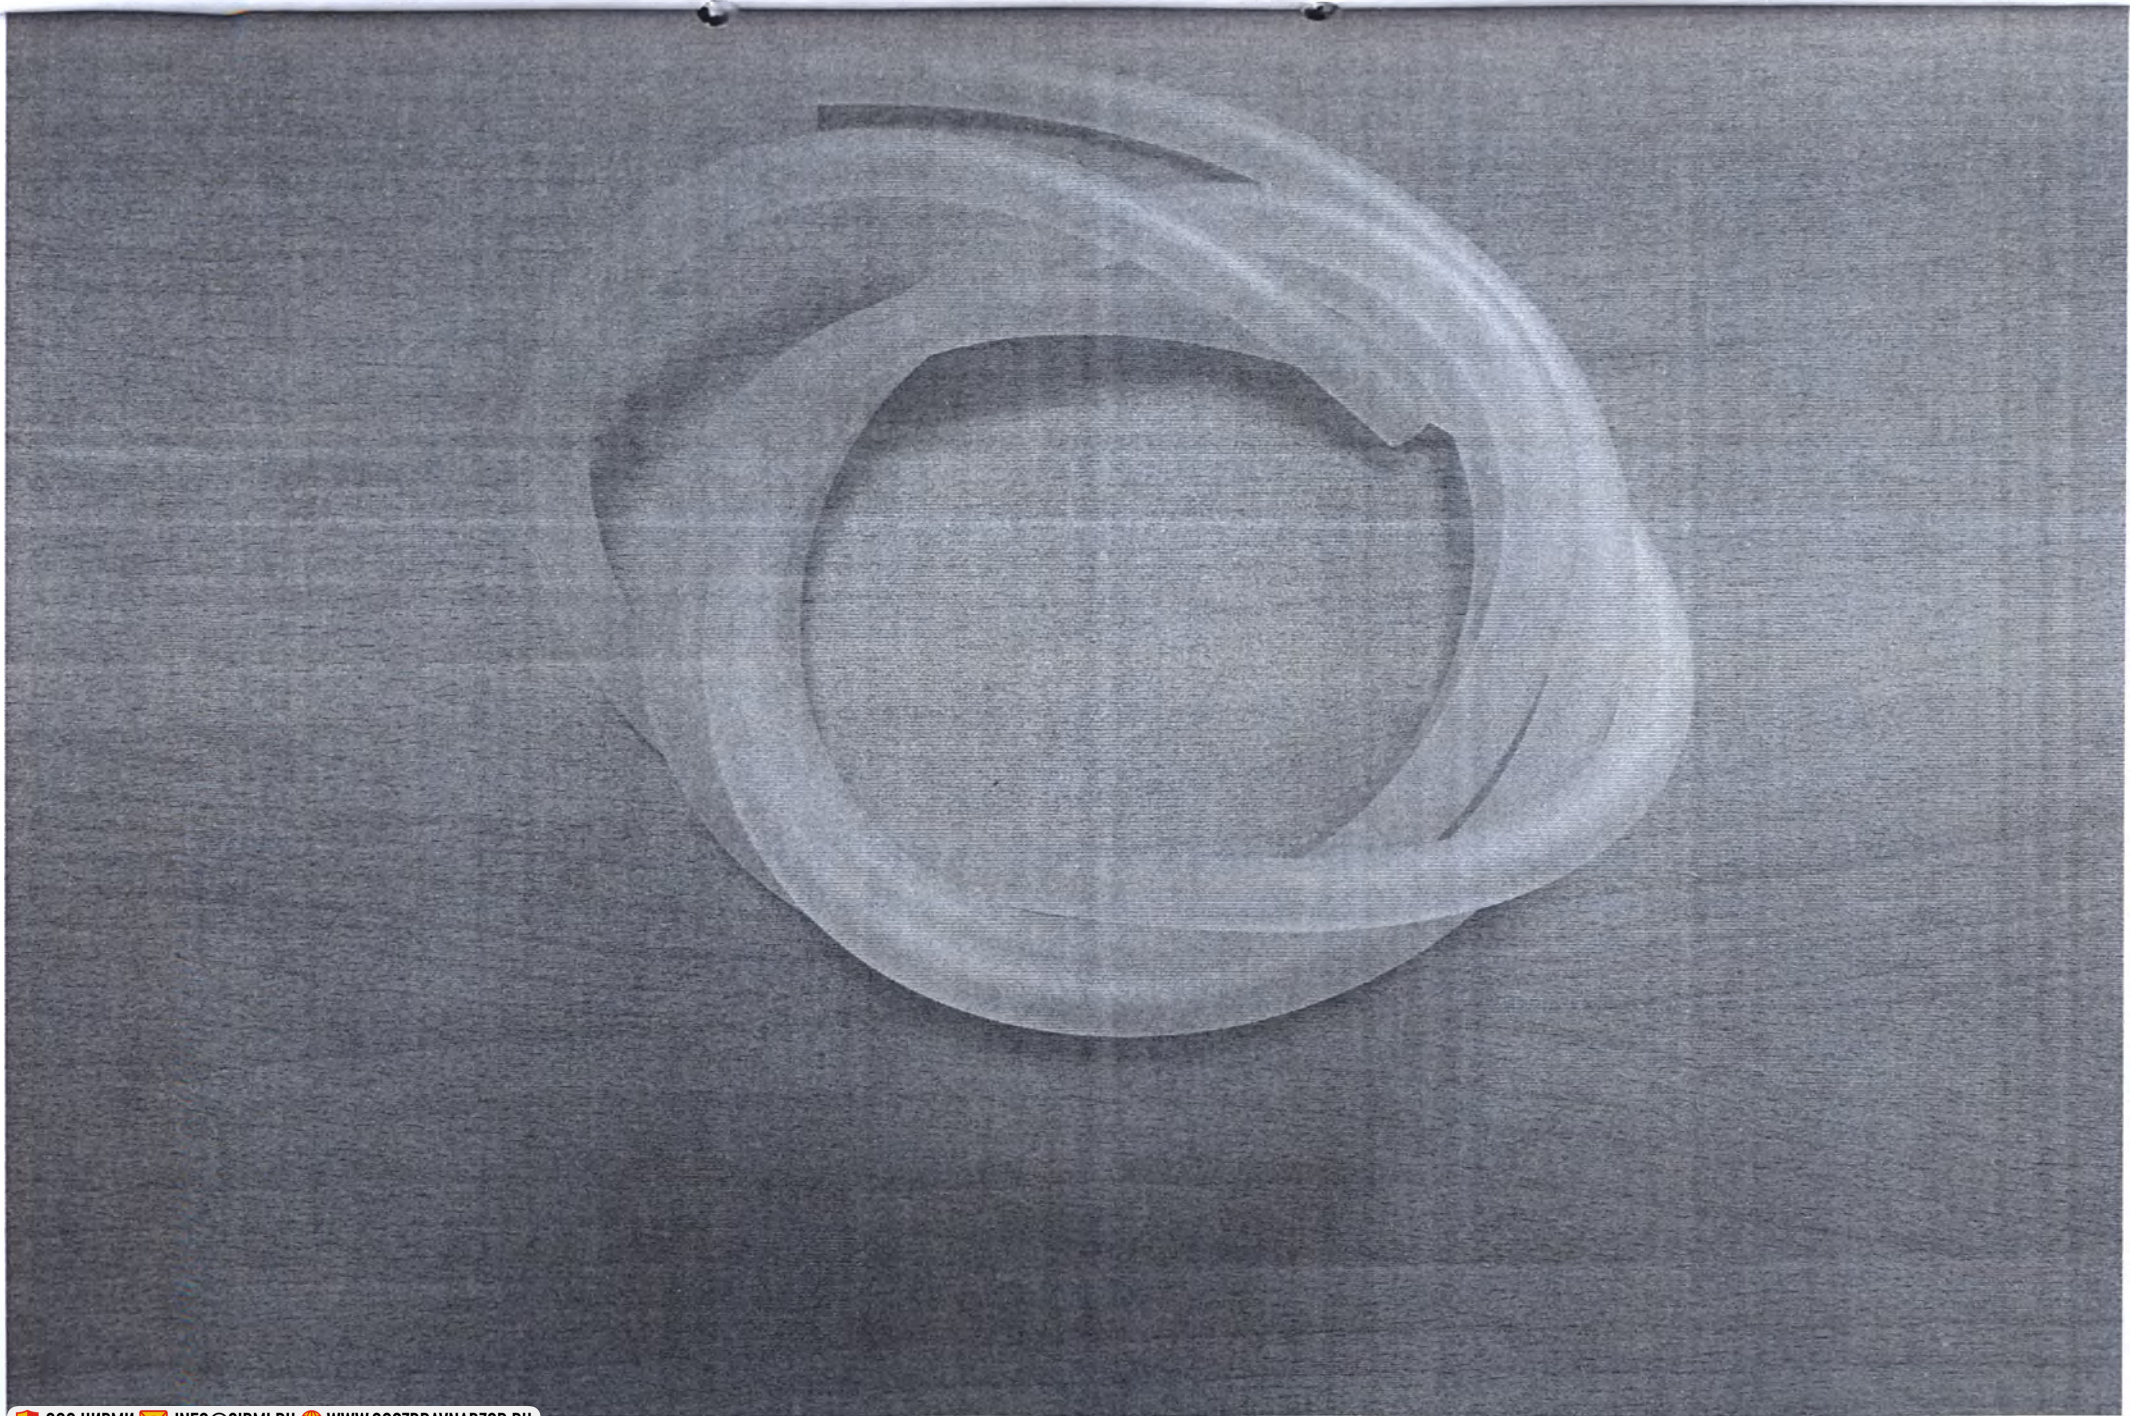


Рис. 4 – Трубка аспирационная

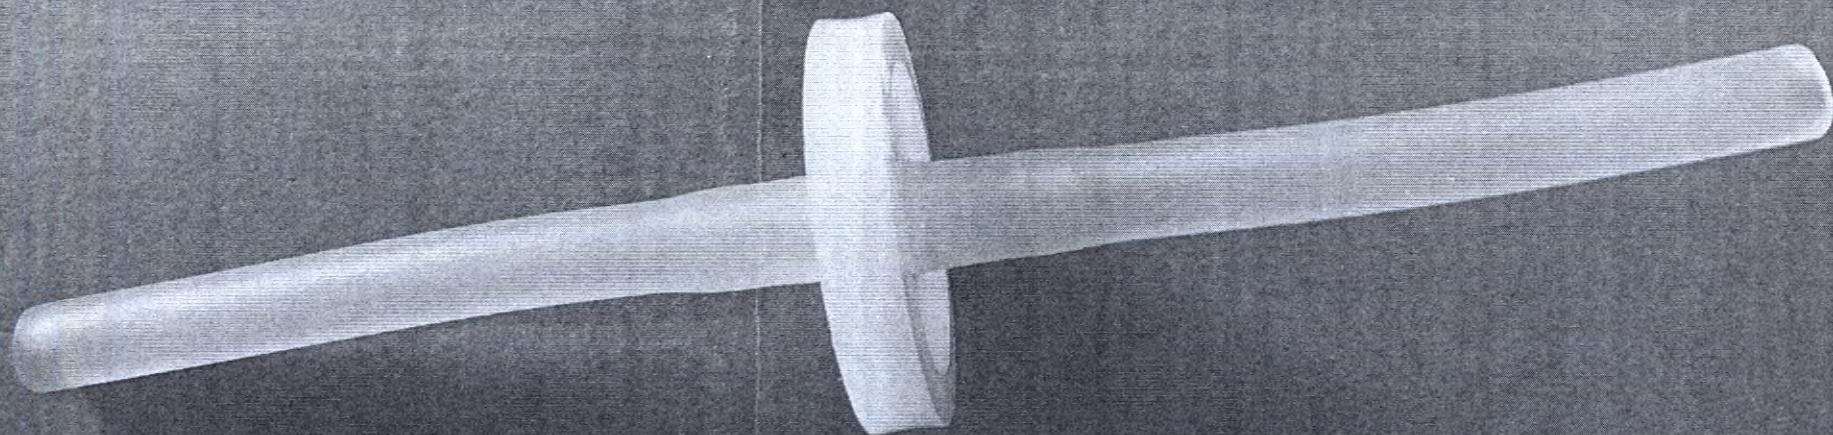

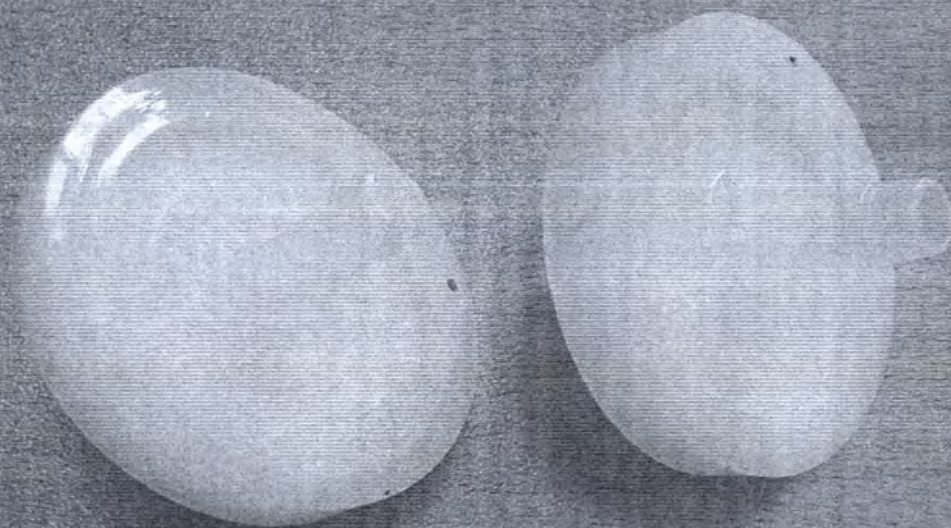


Рис. 6 – Фильтр воздушный (2 шт.)

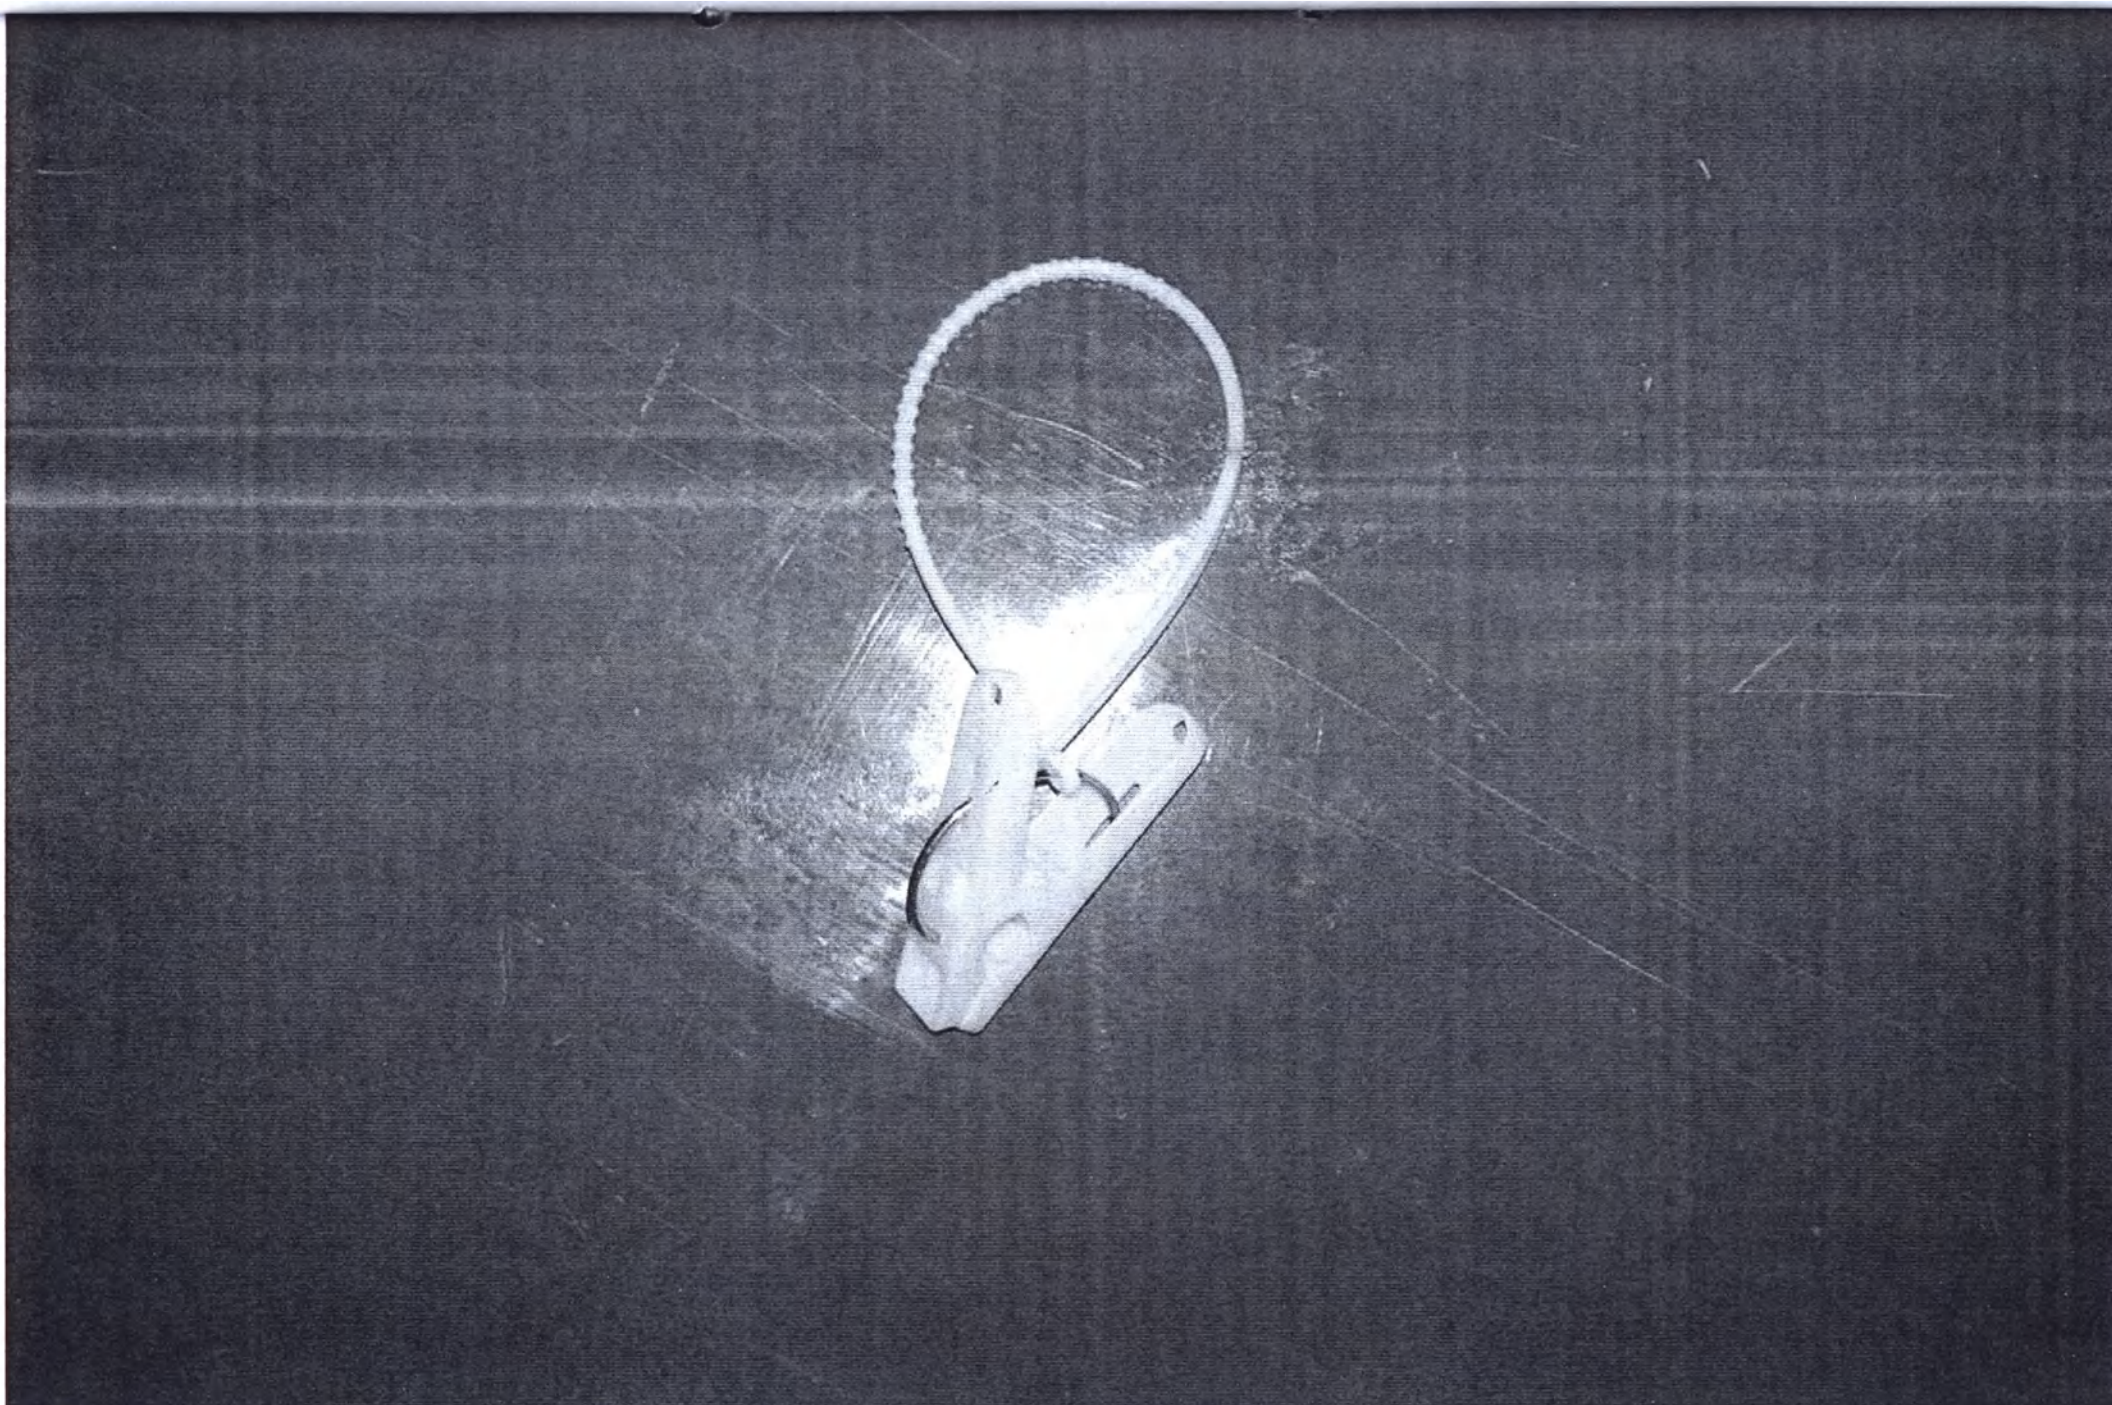


Рис. 7 – Зажим






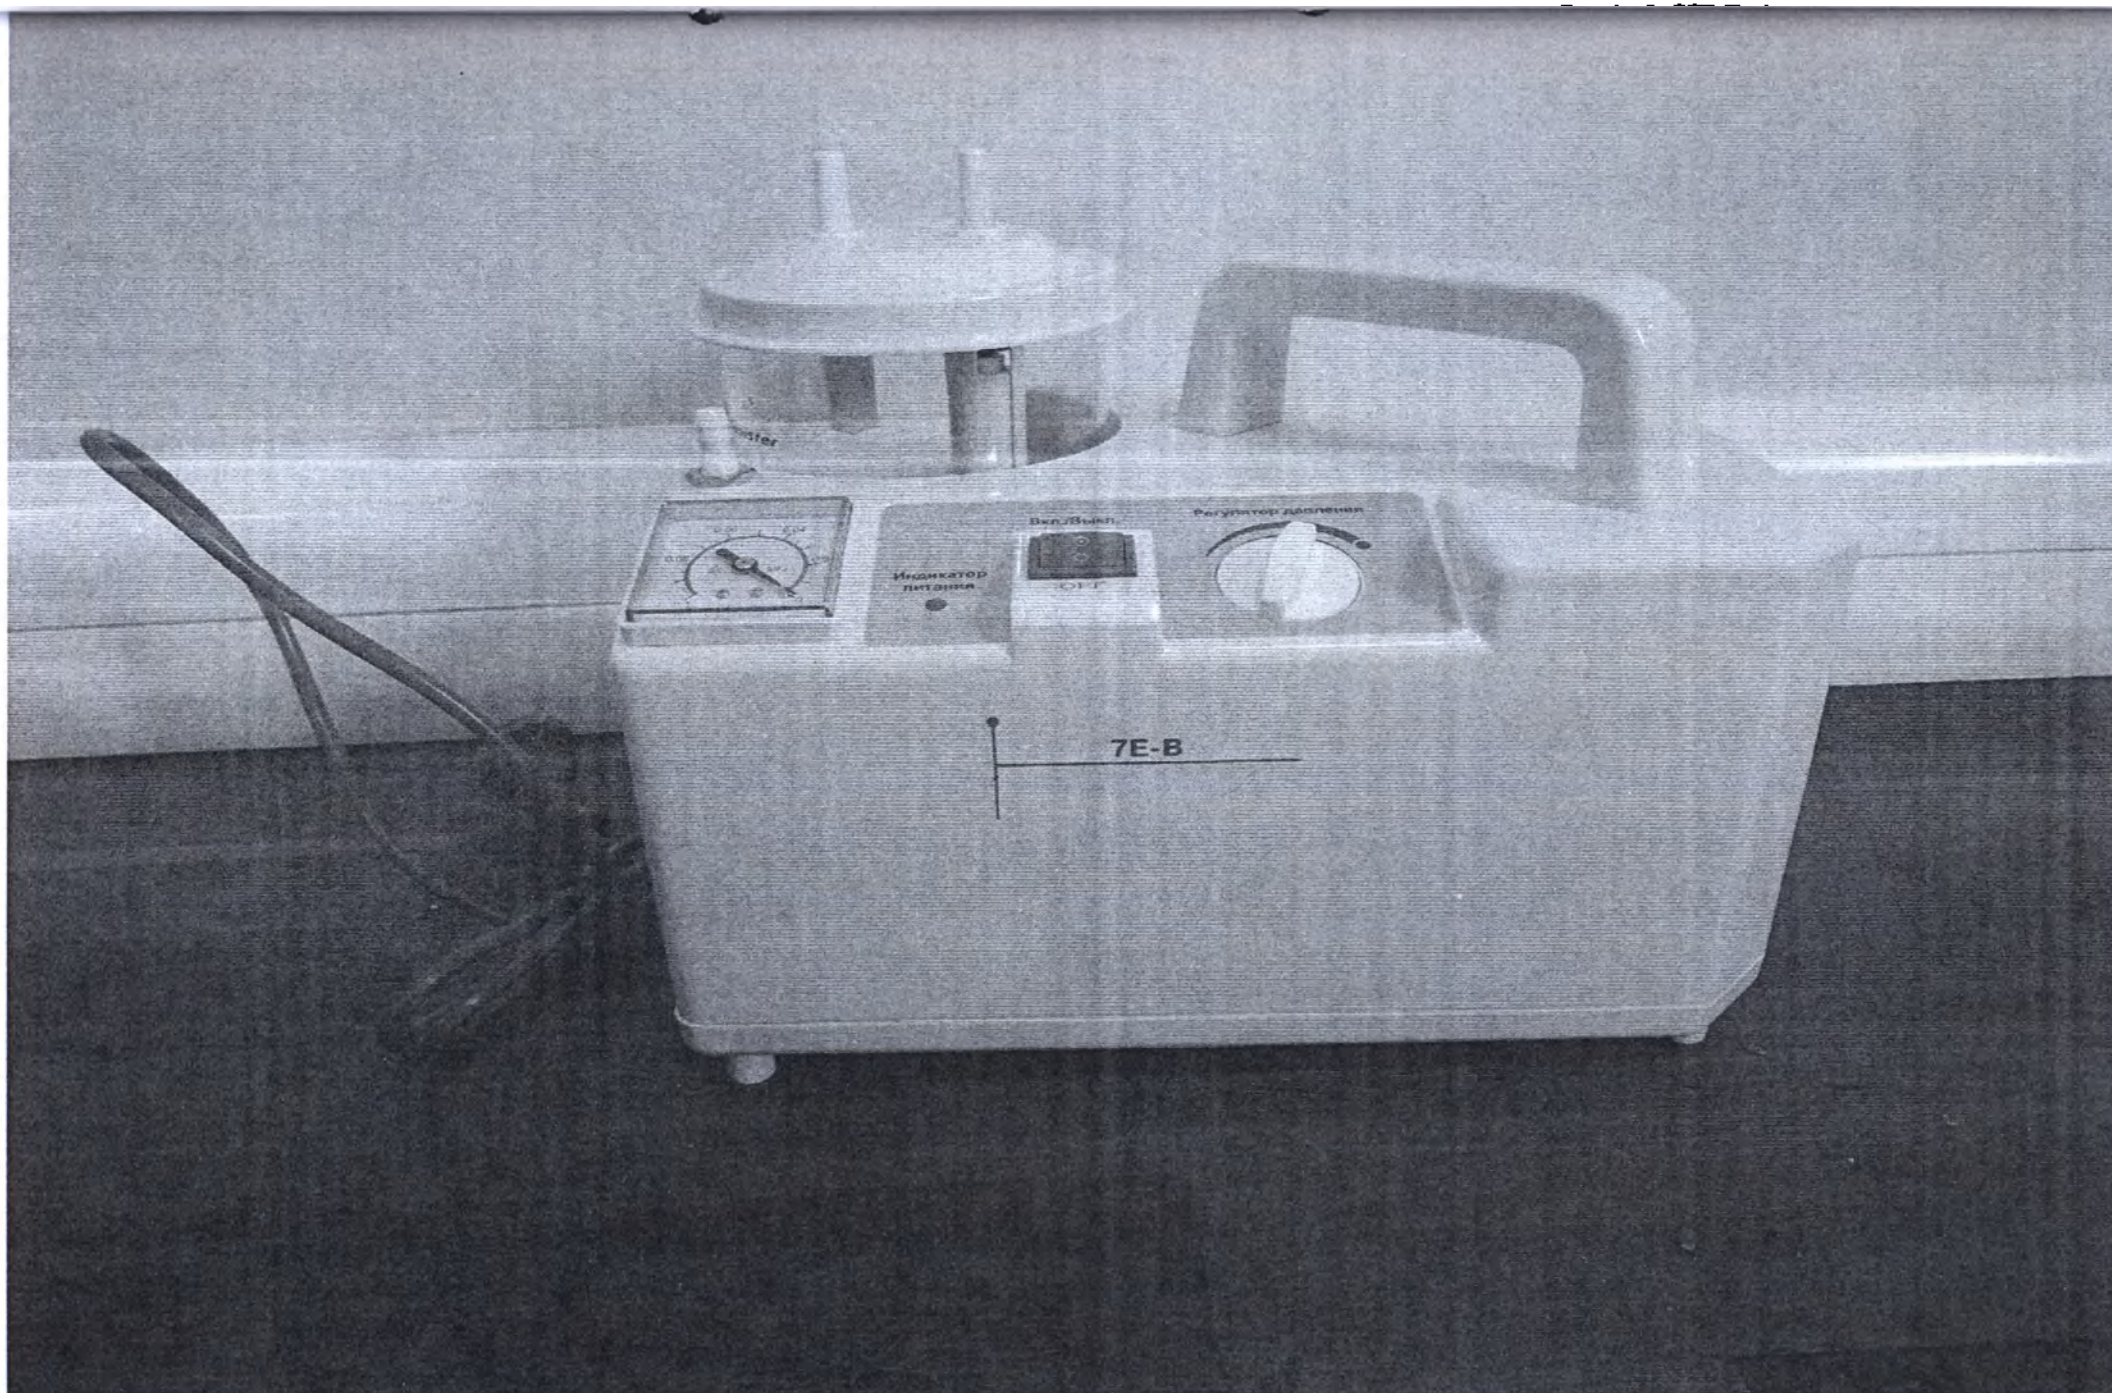



Рис. 9 – Отсасыватель

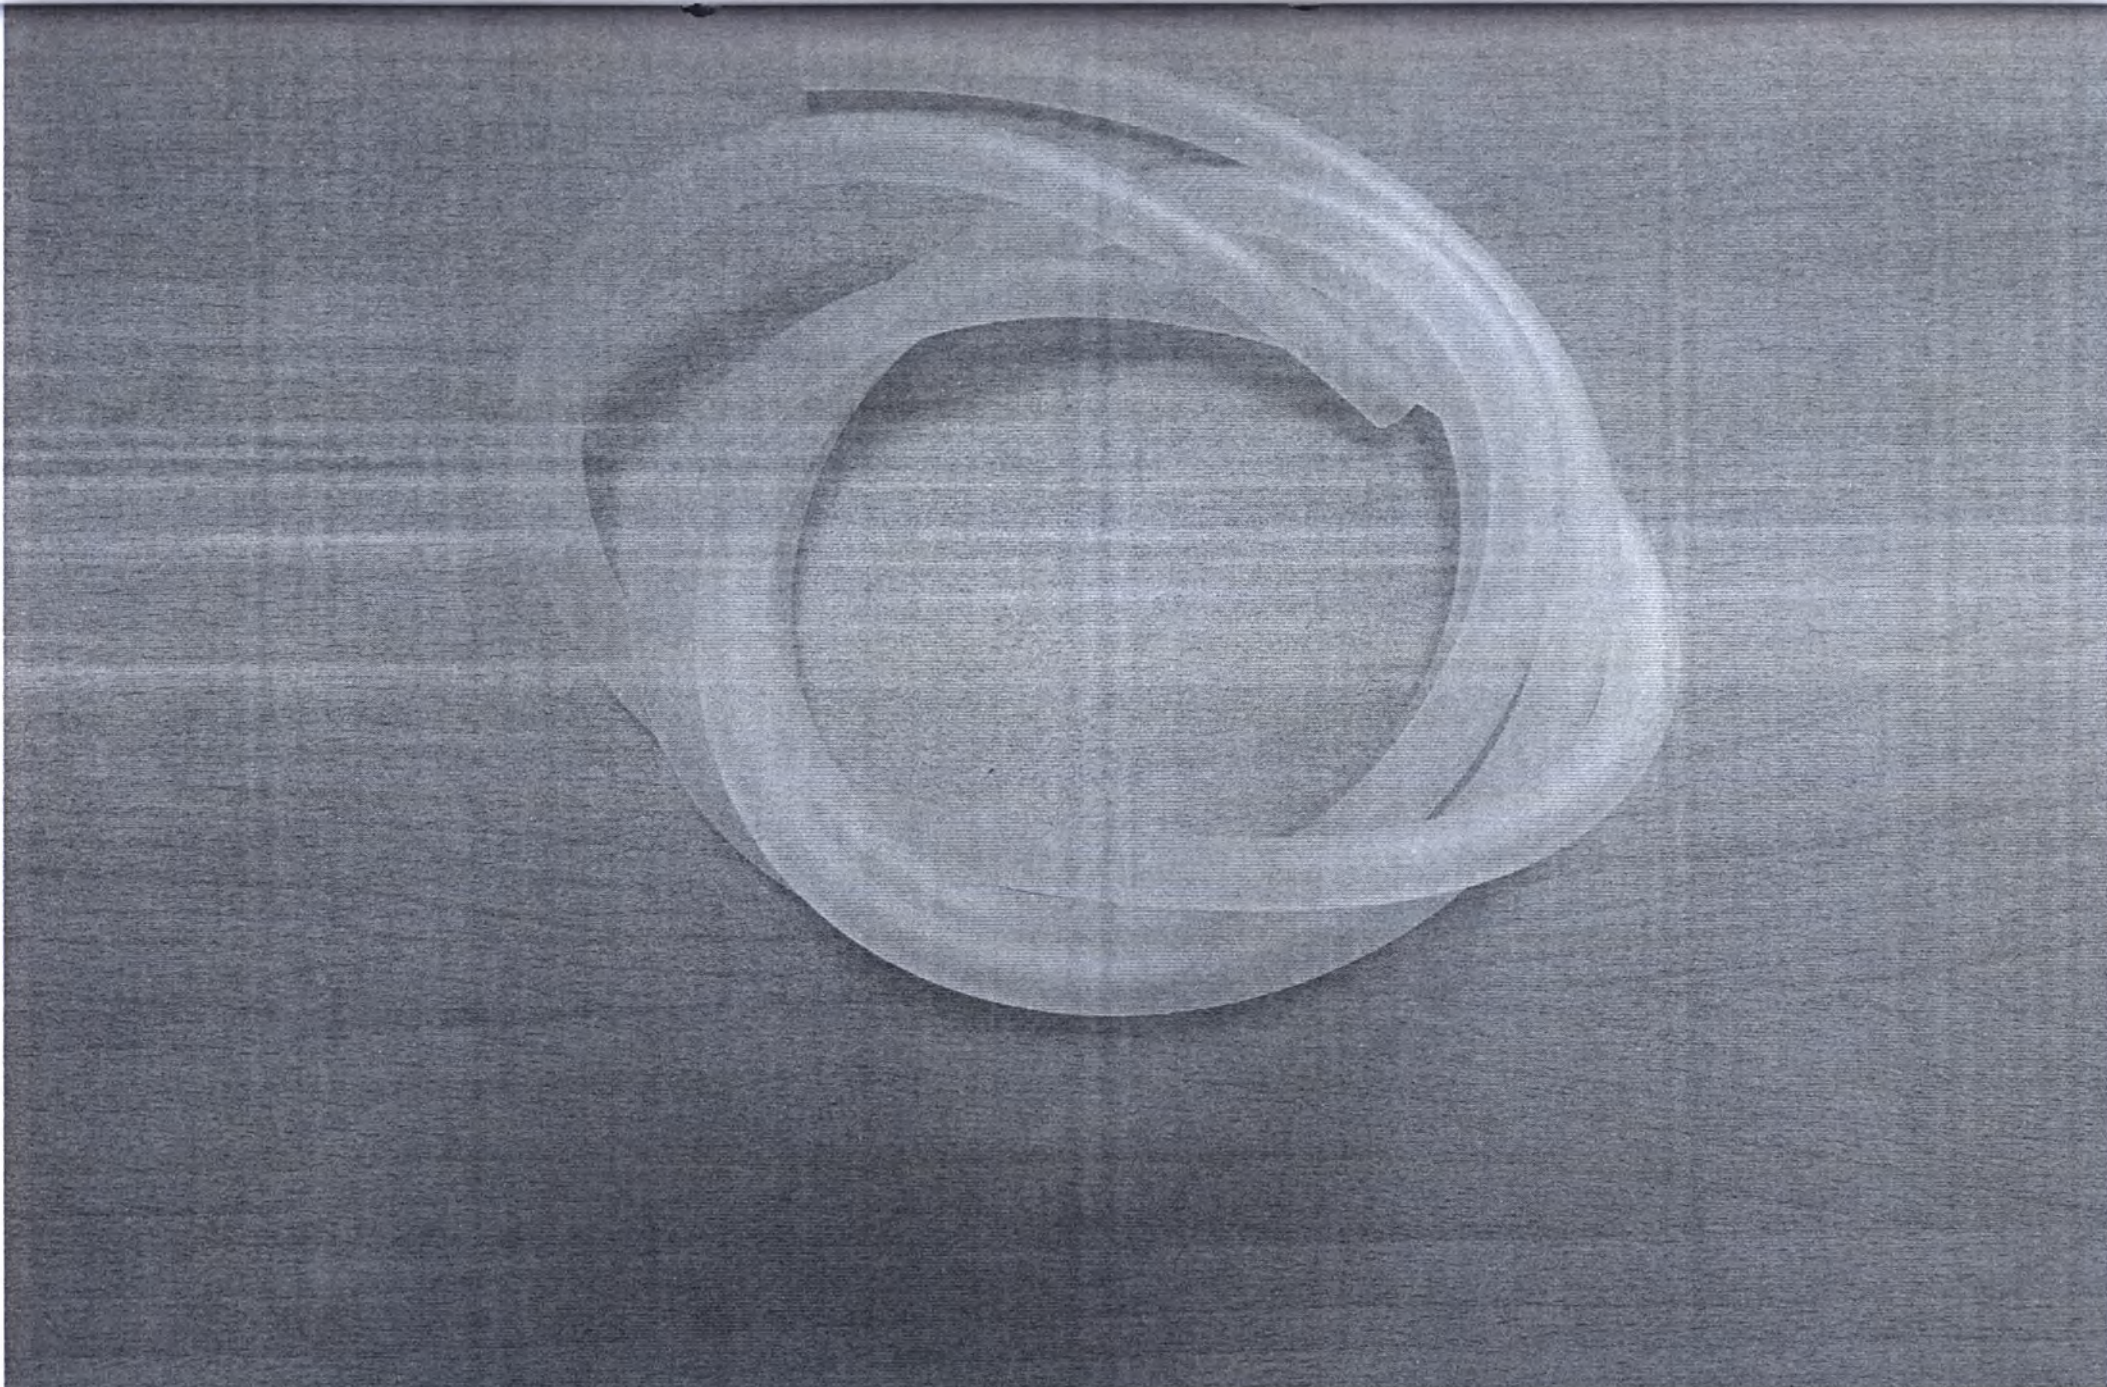

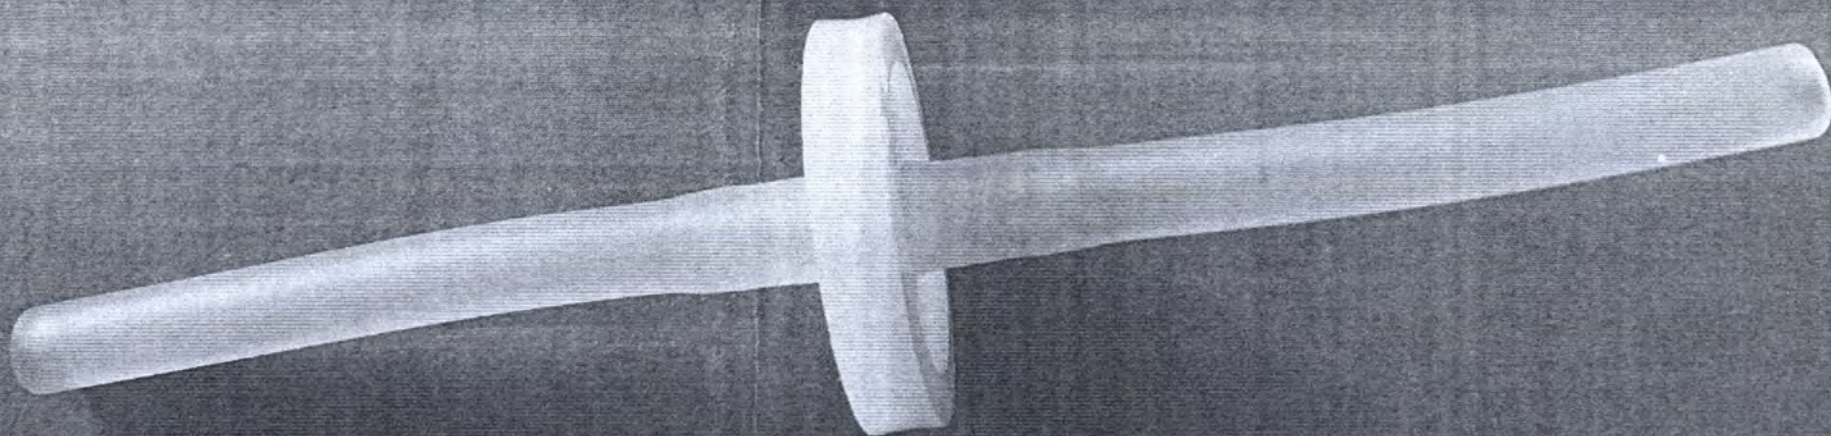


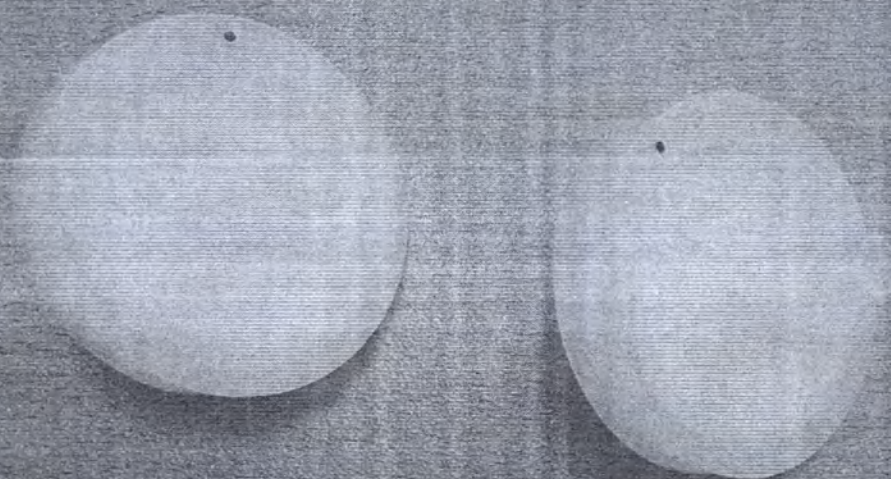




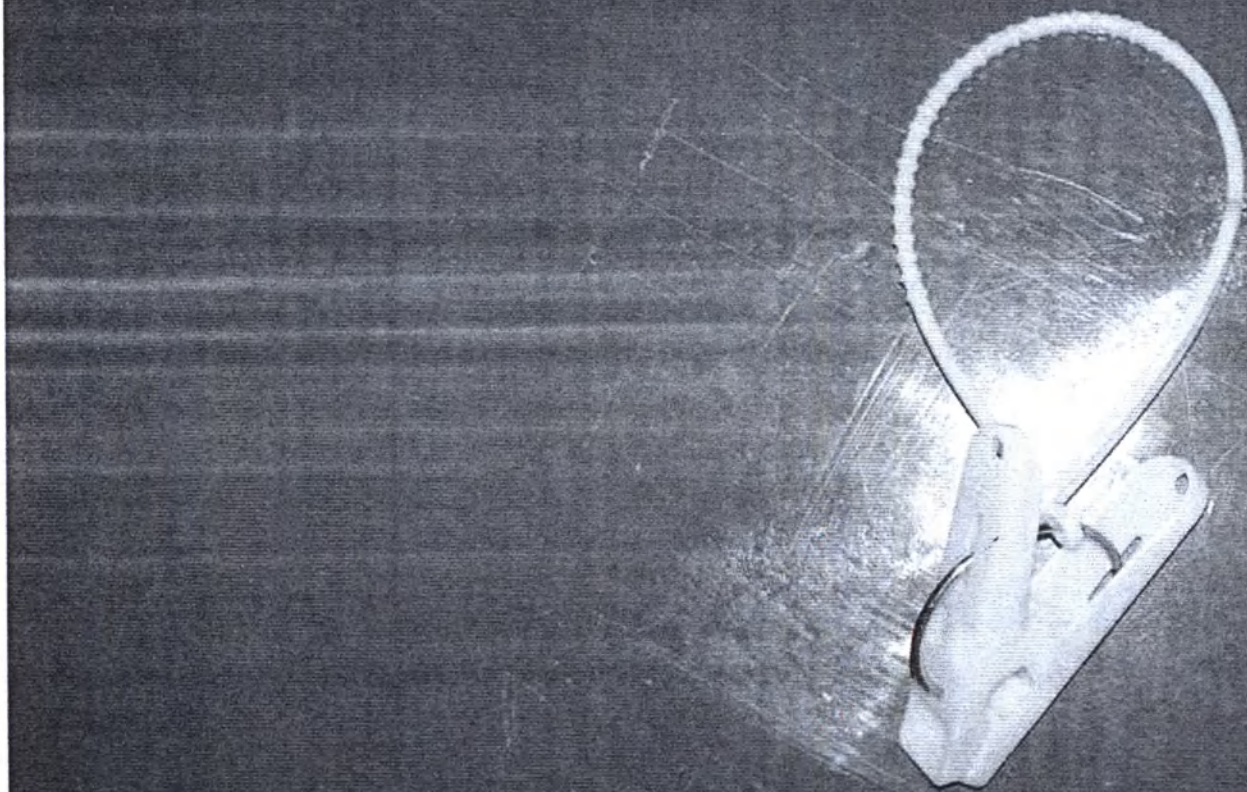



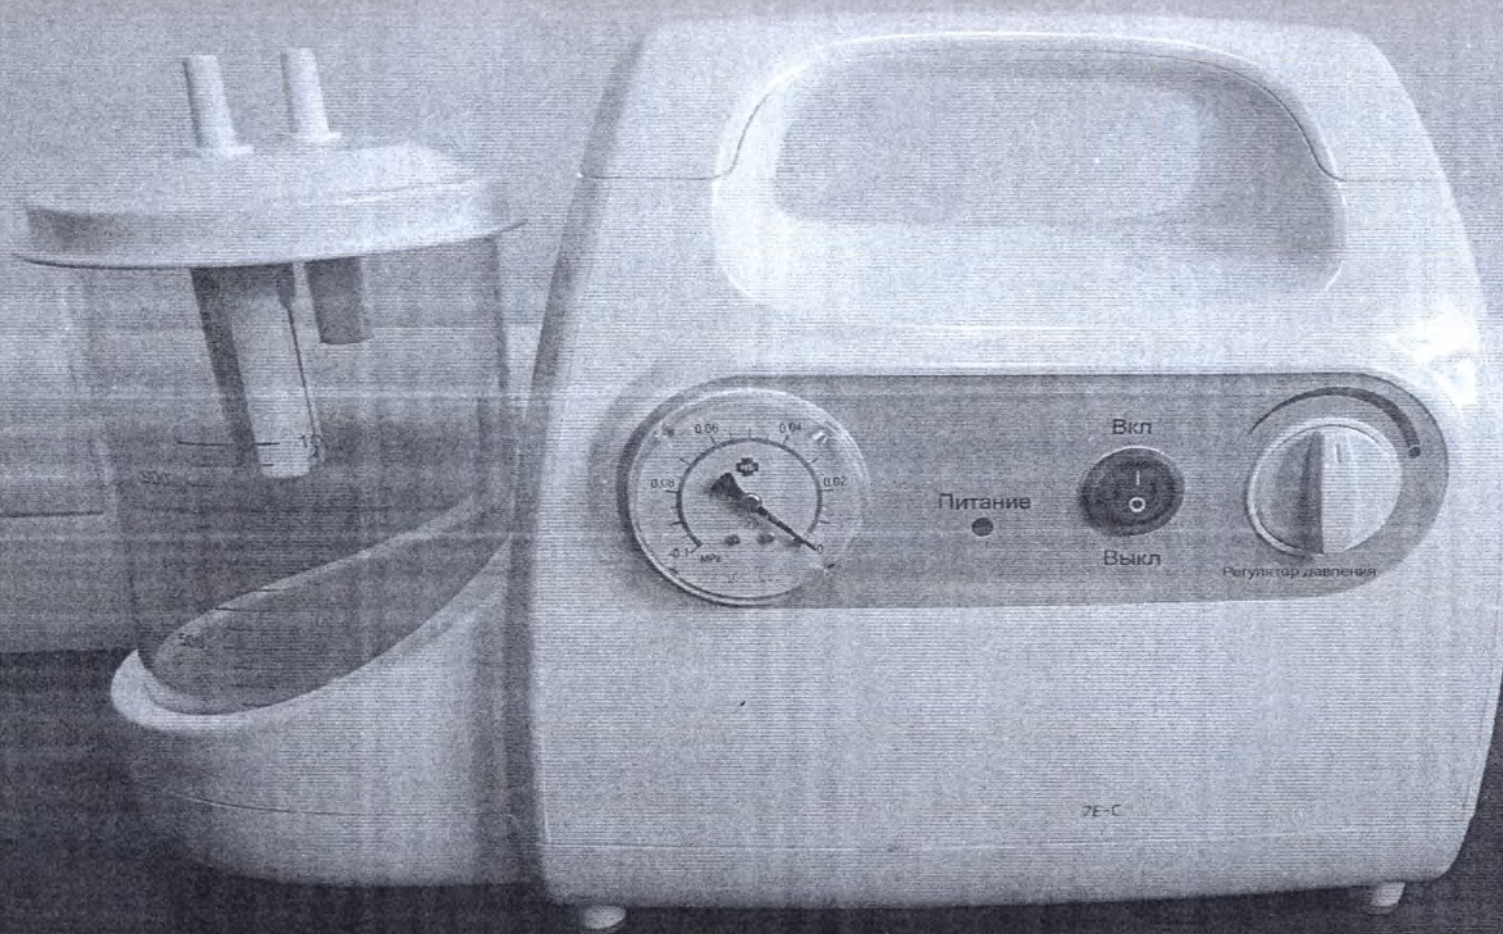



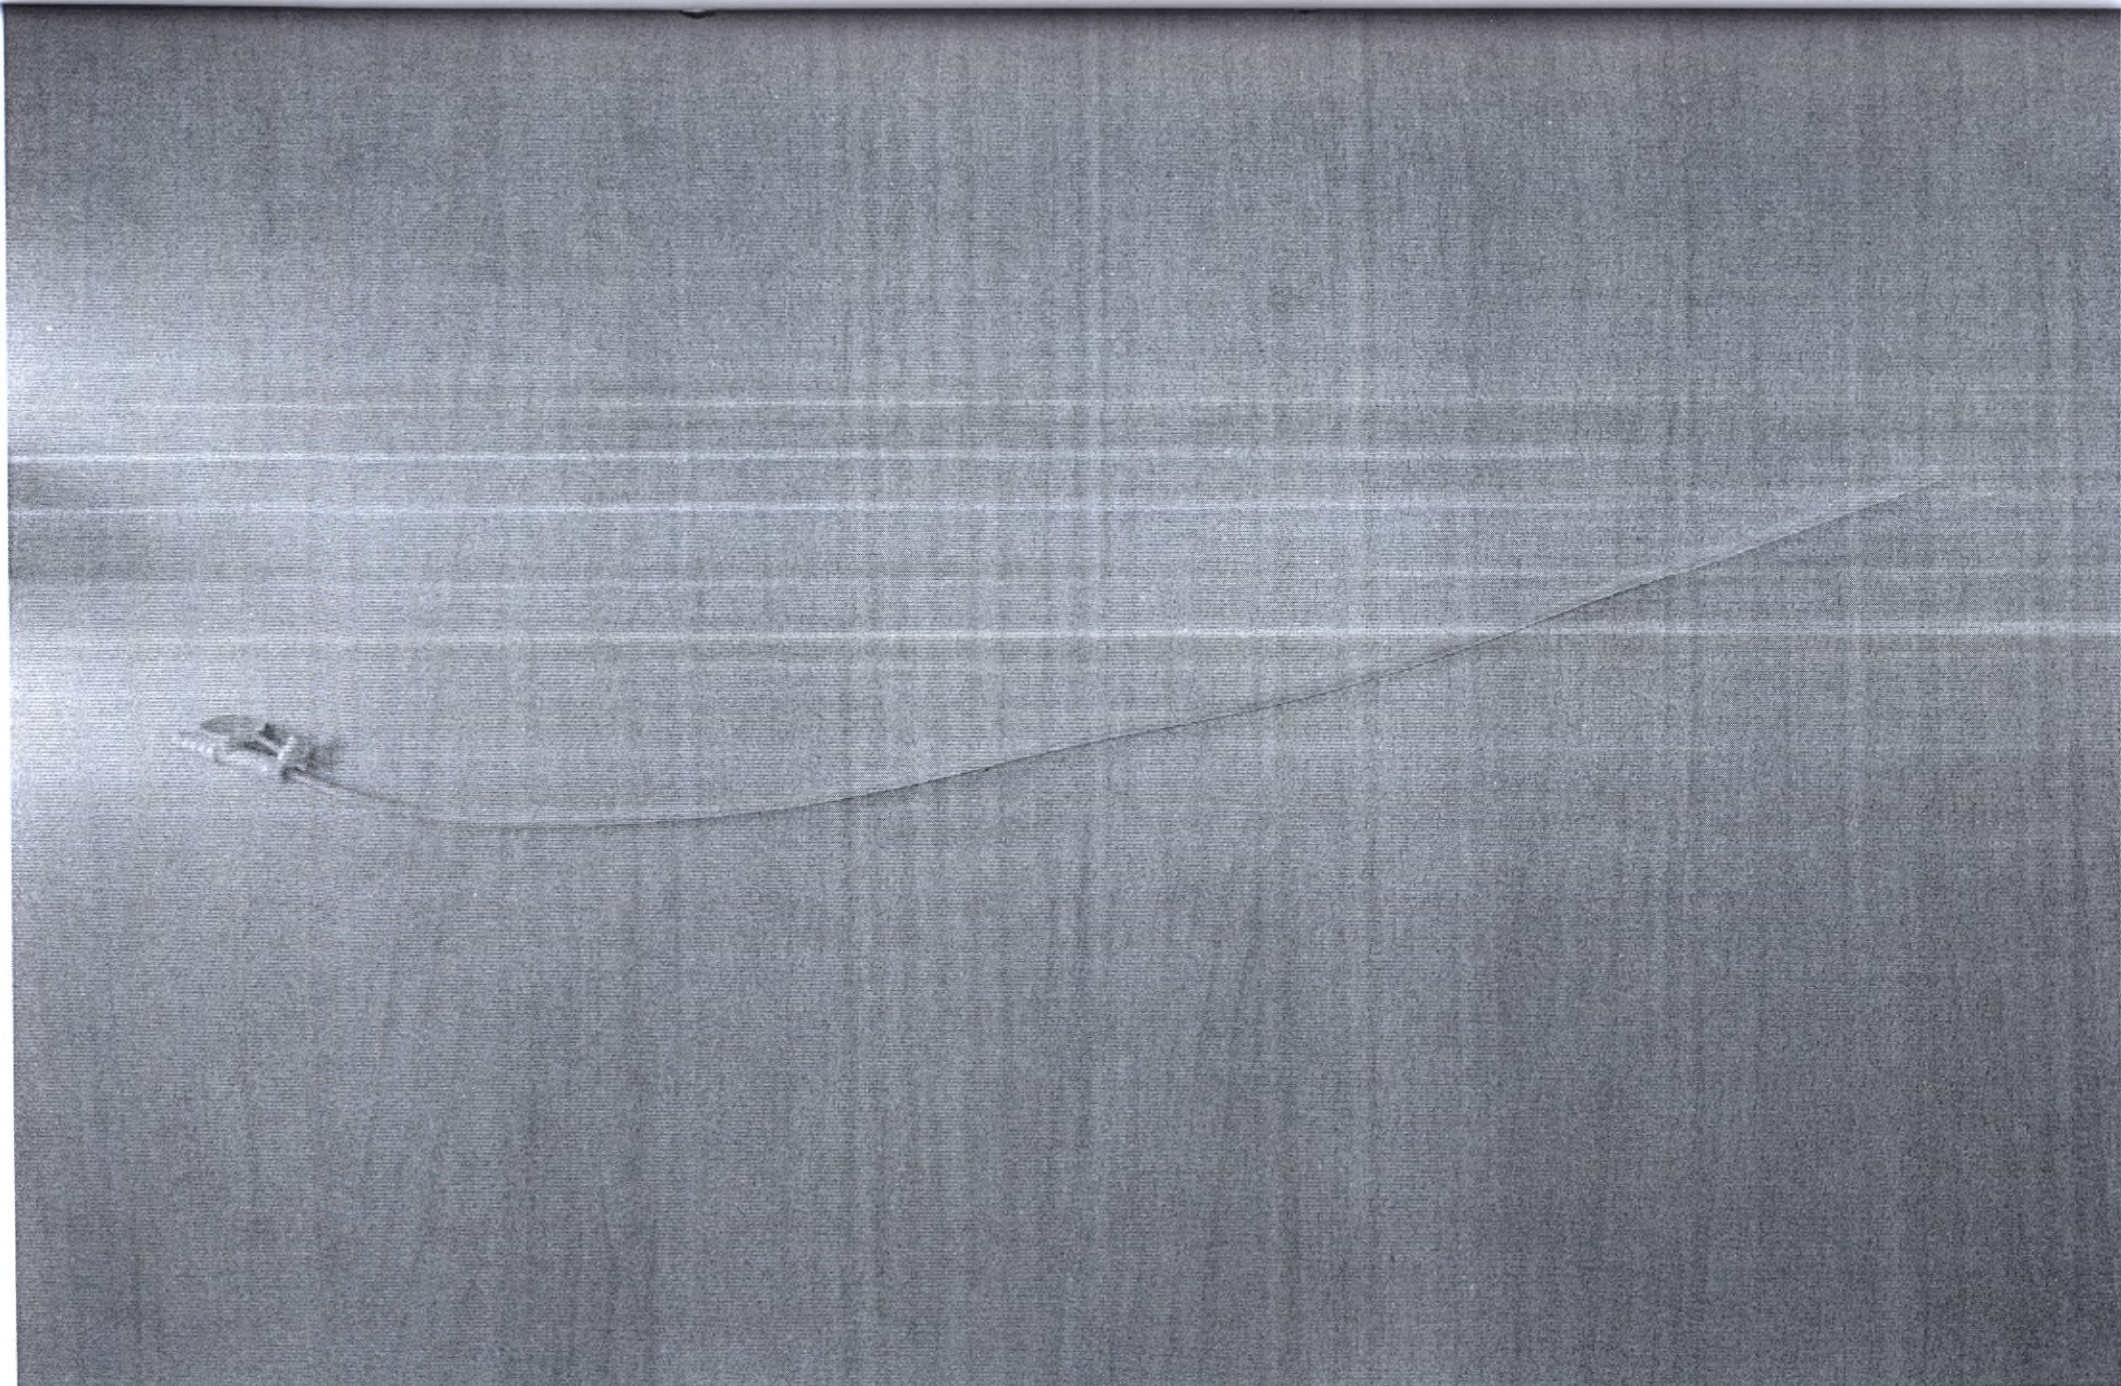




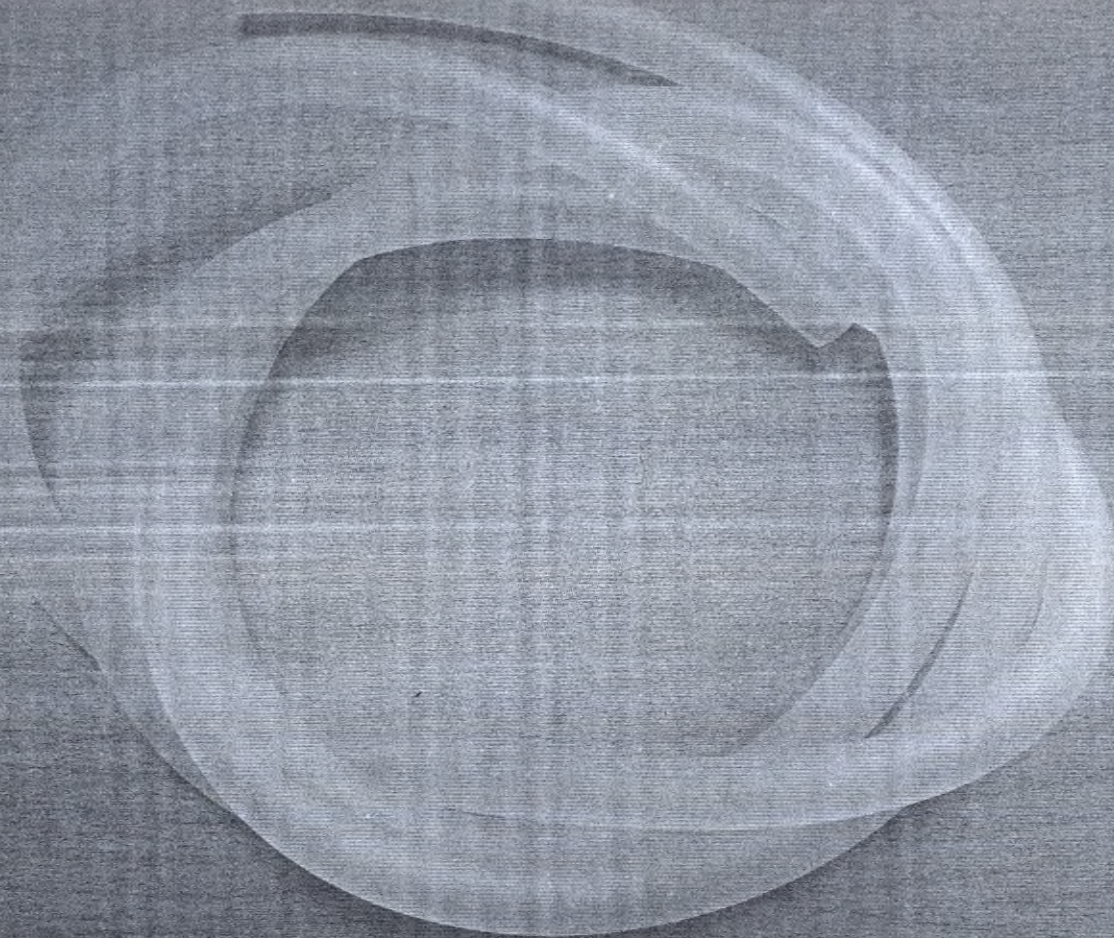


Рис. 19 – Трубка аспирационная

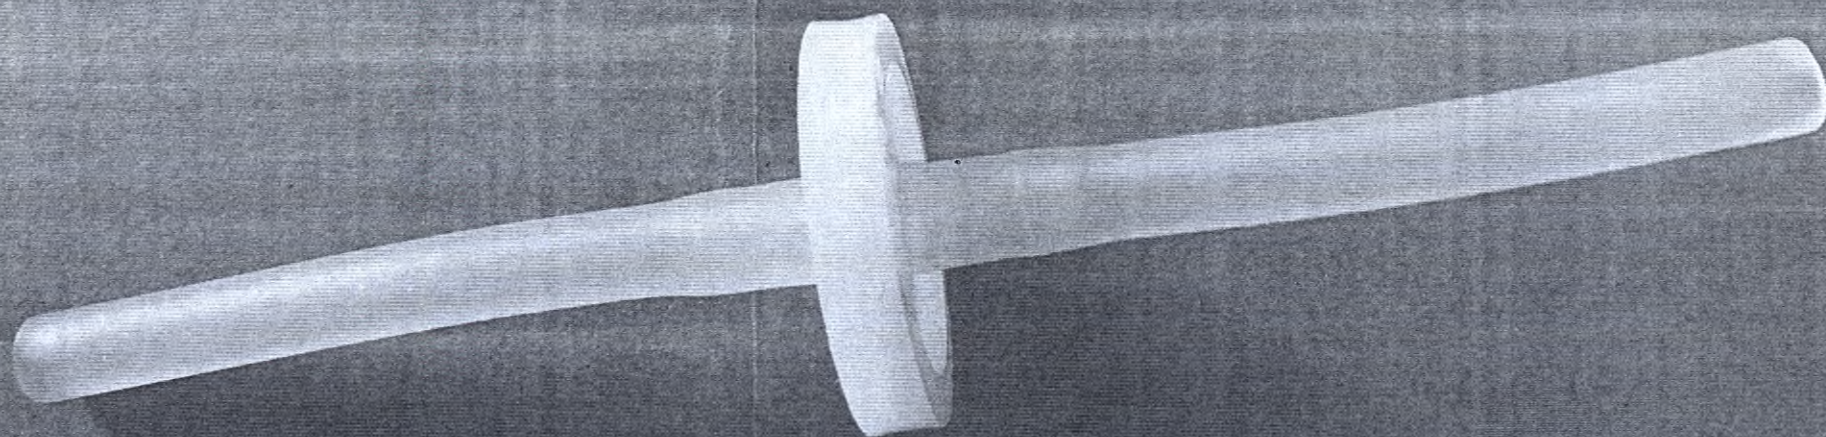


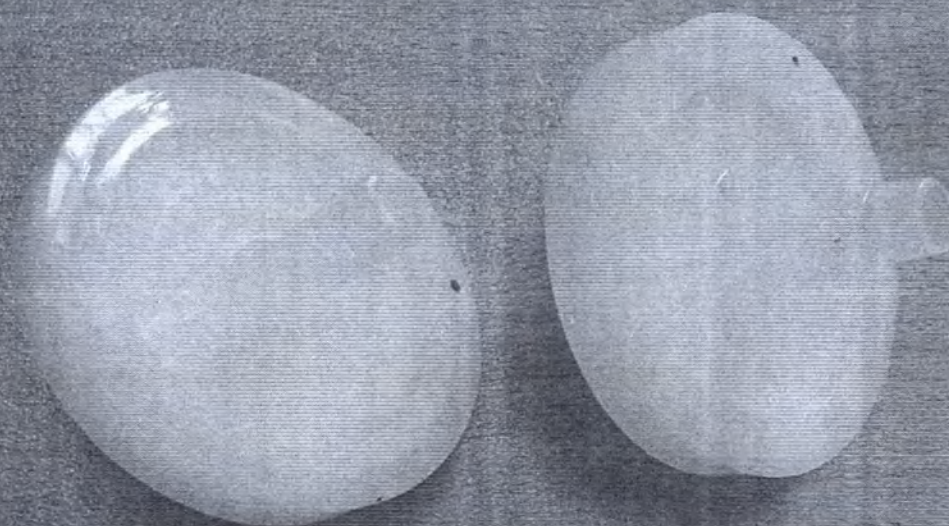

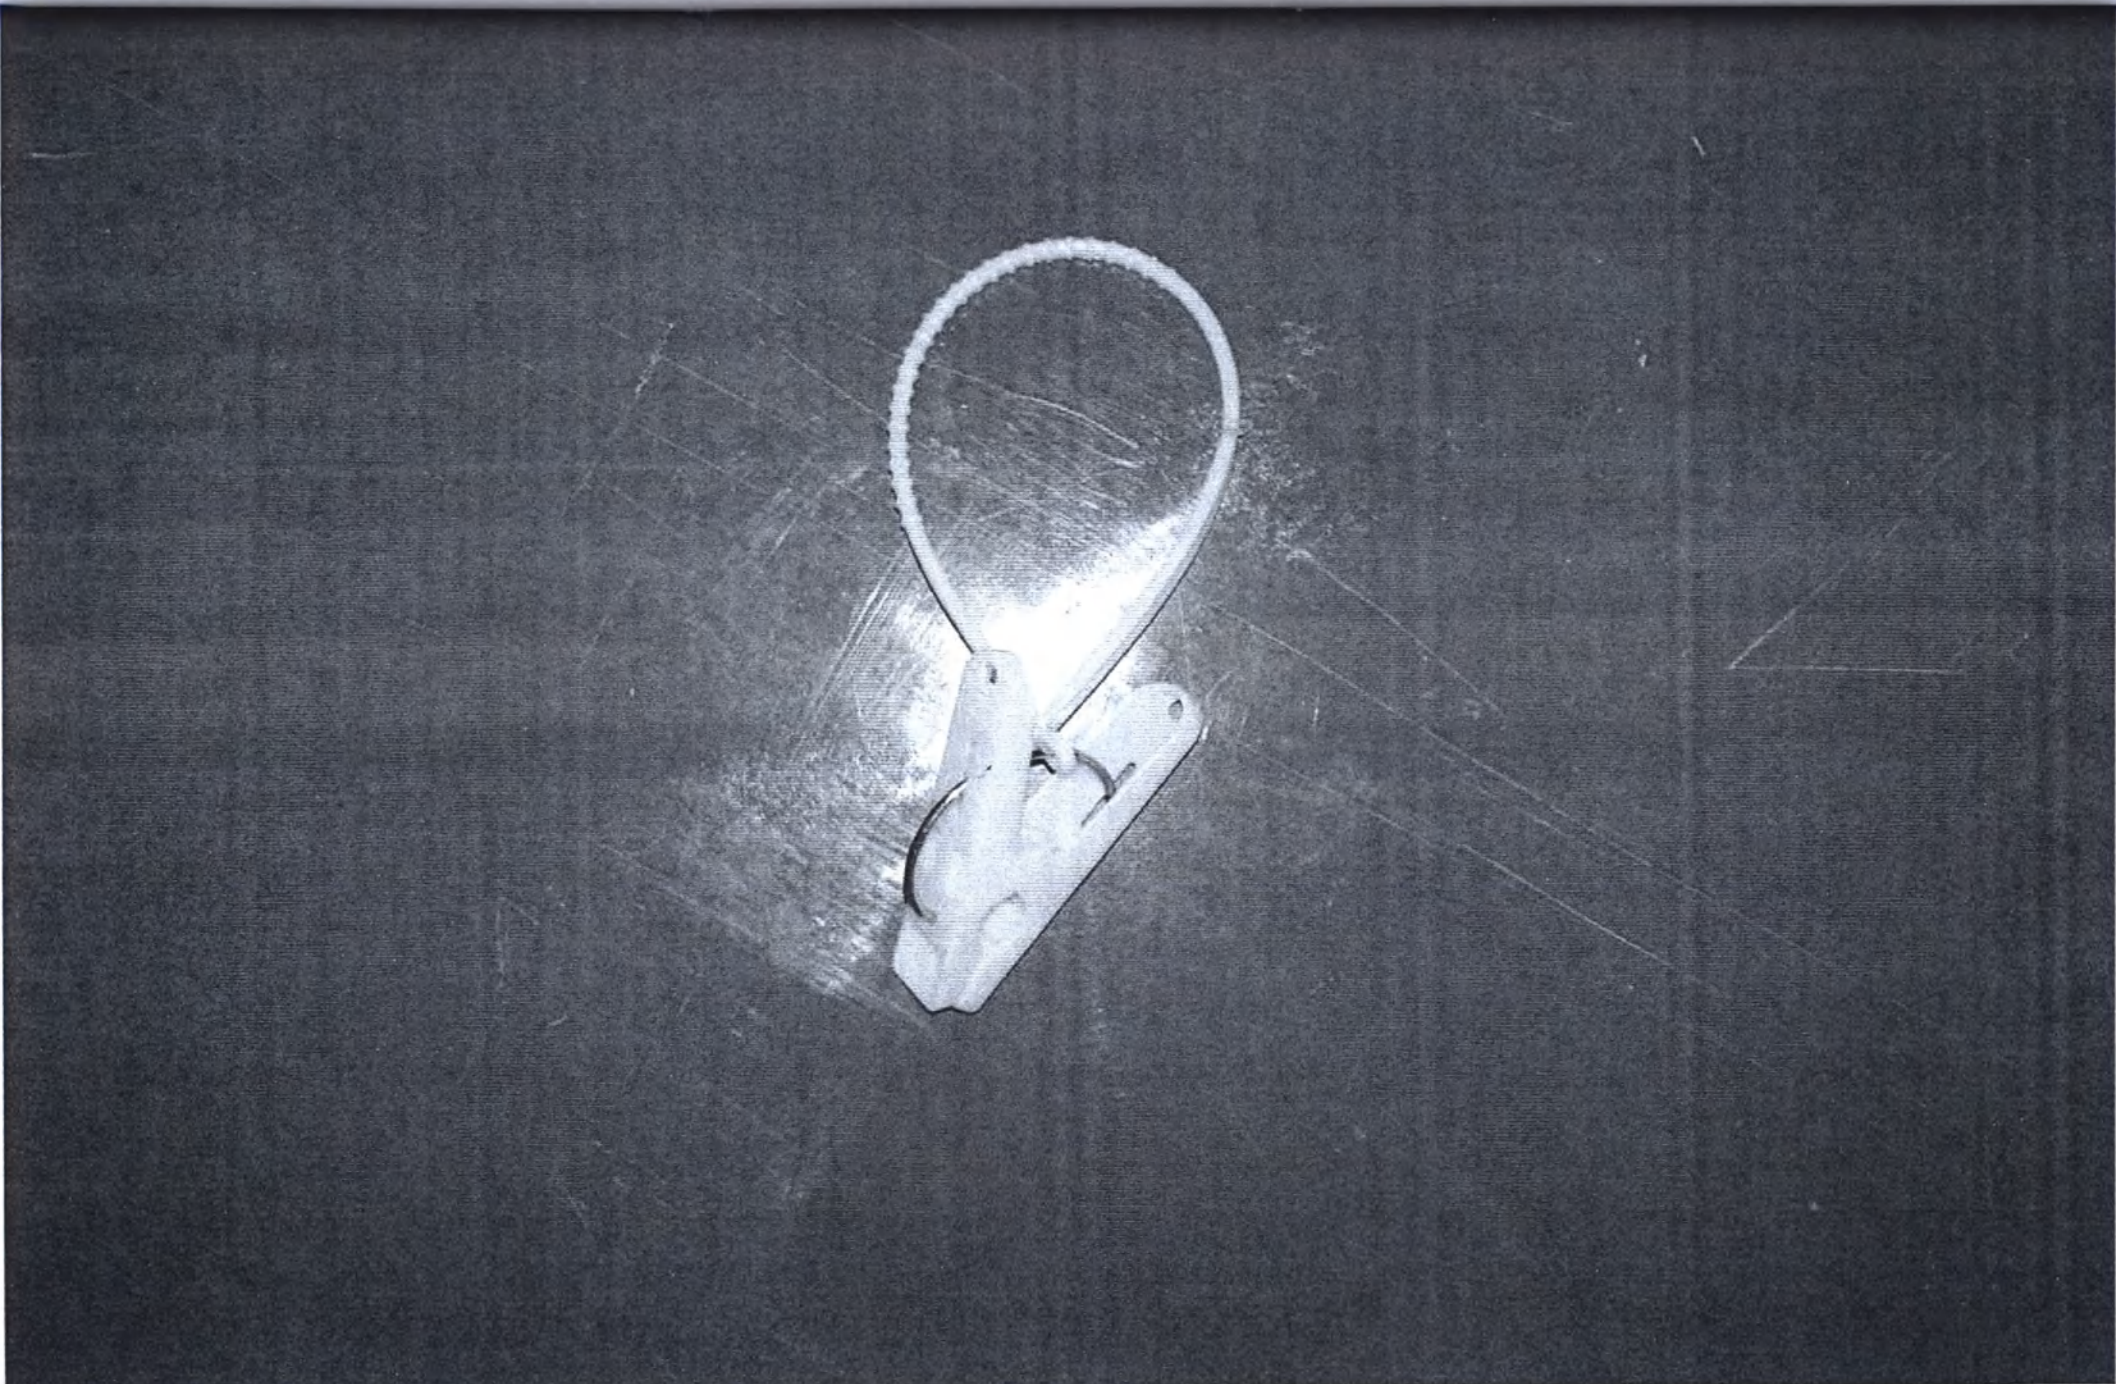





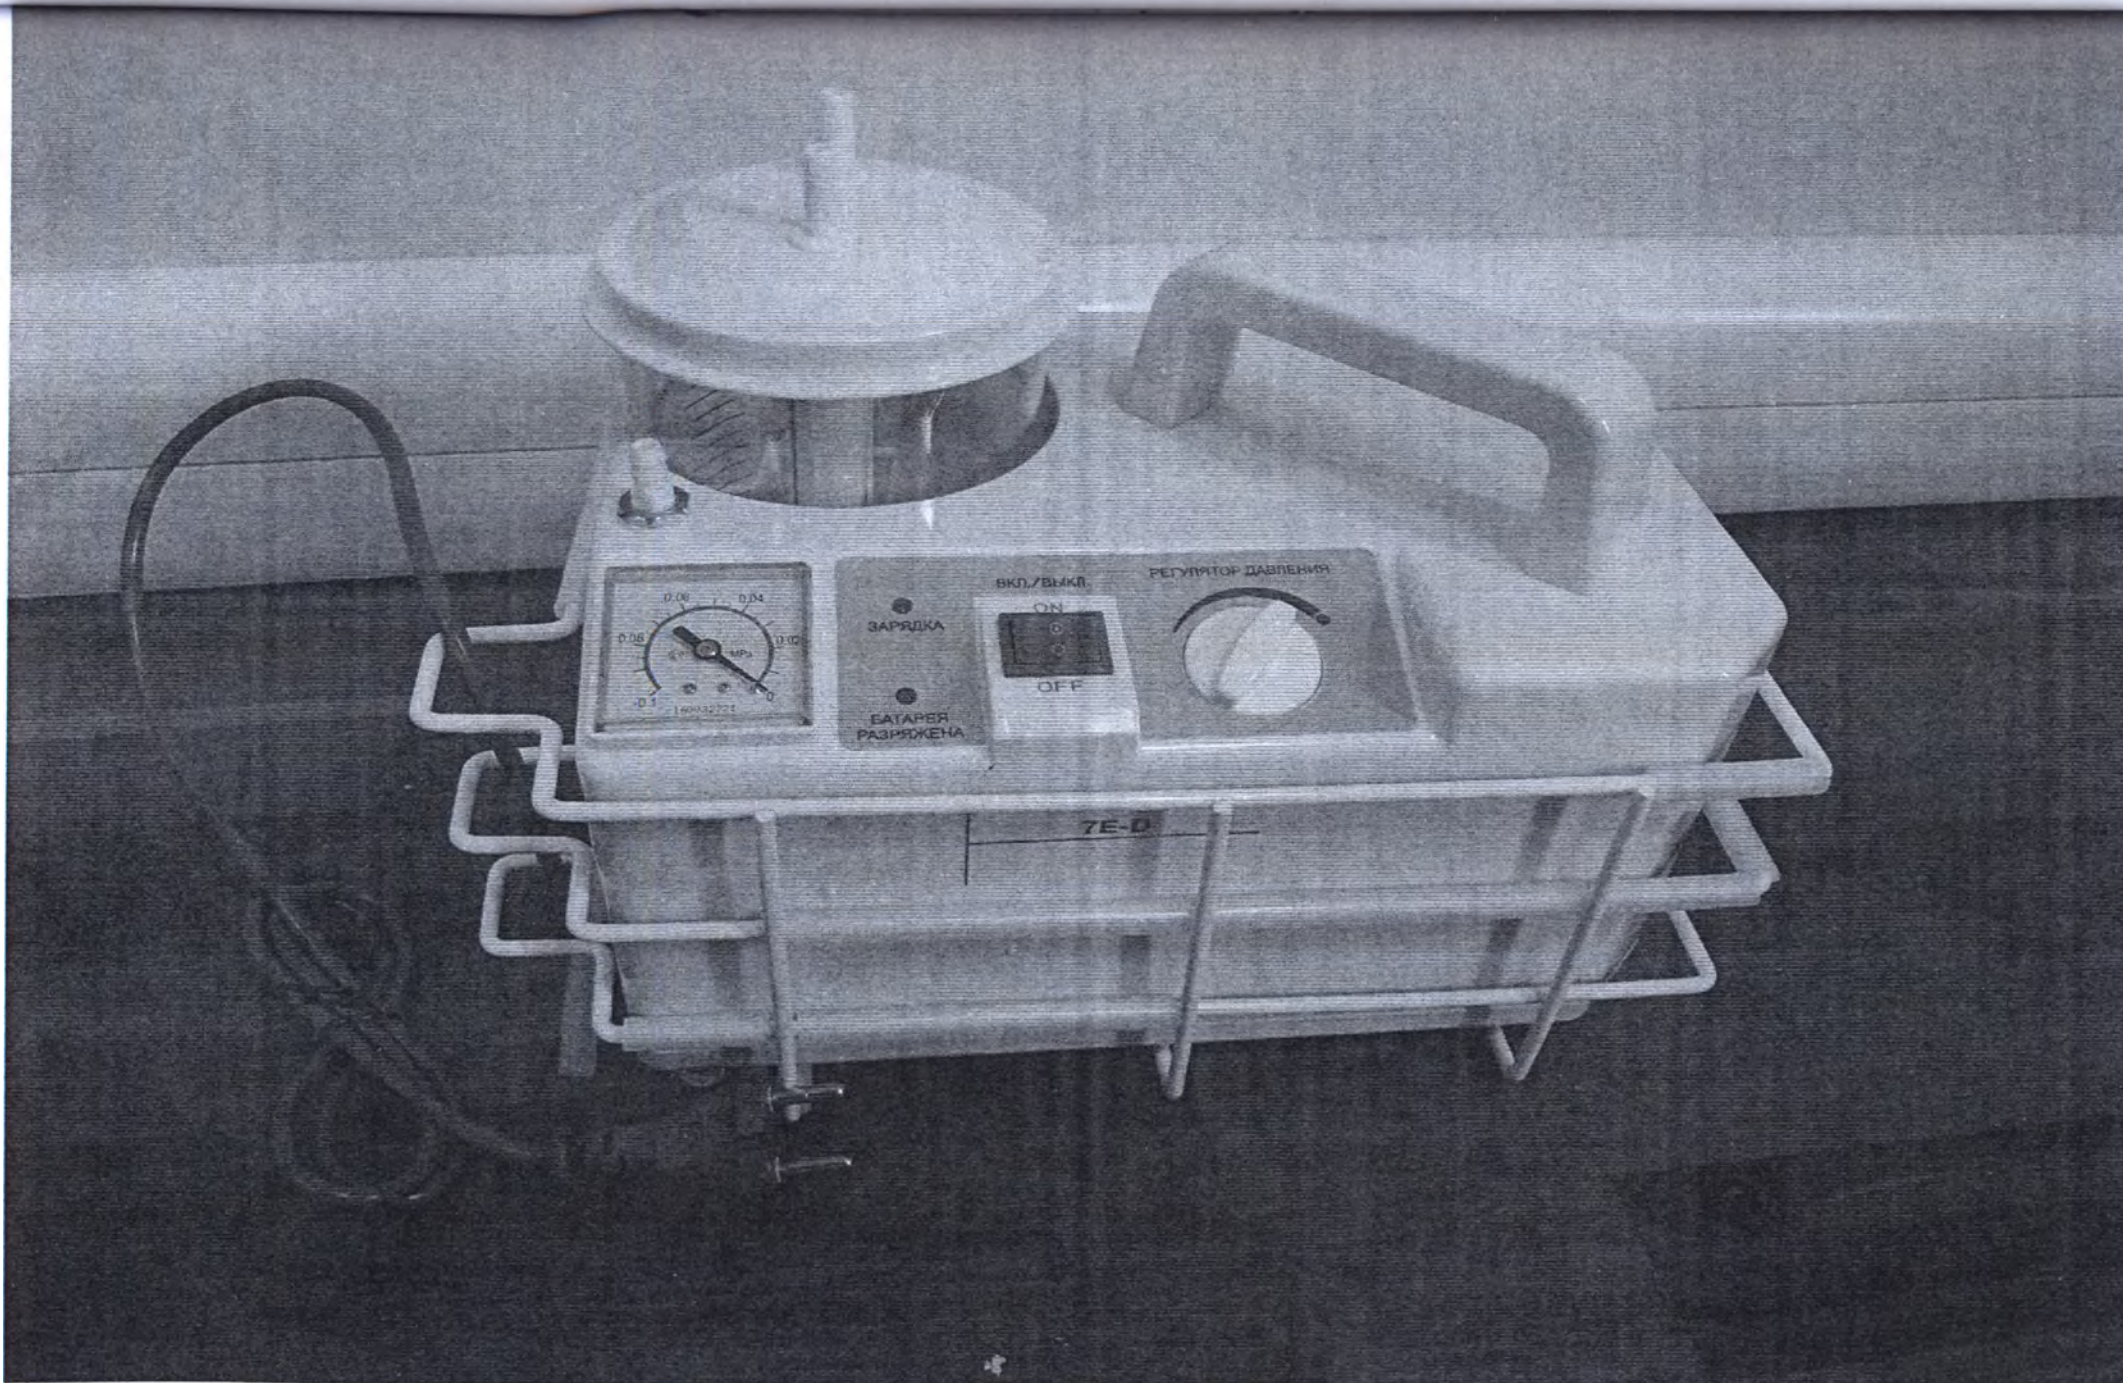









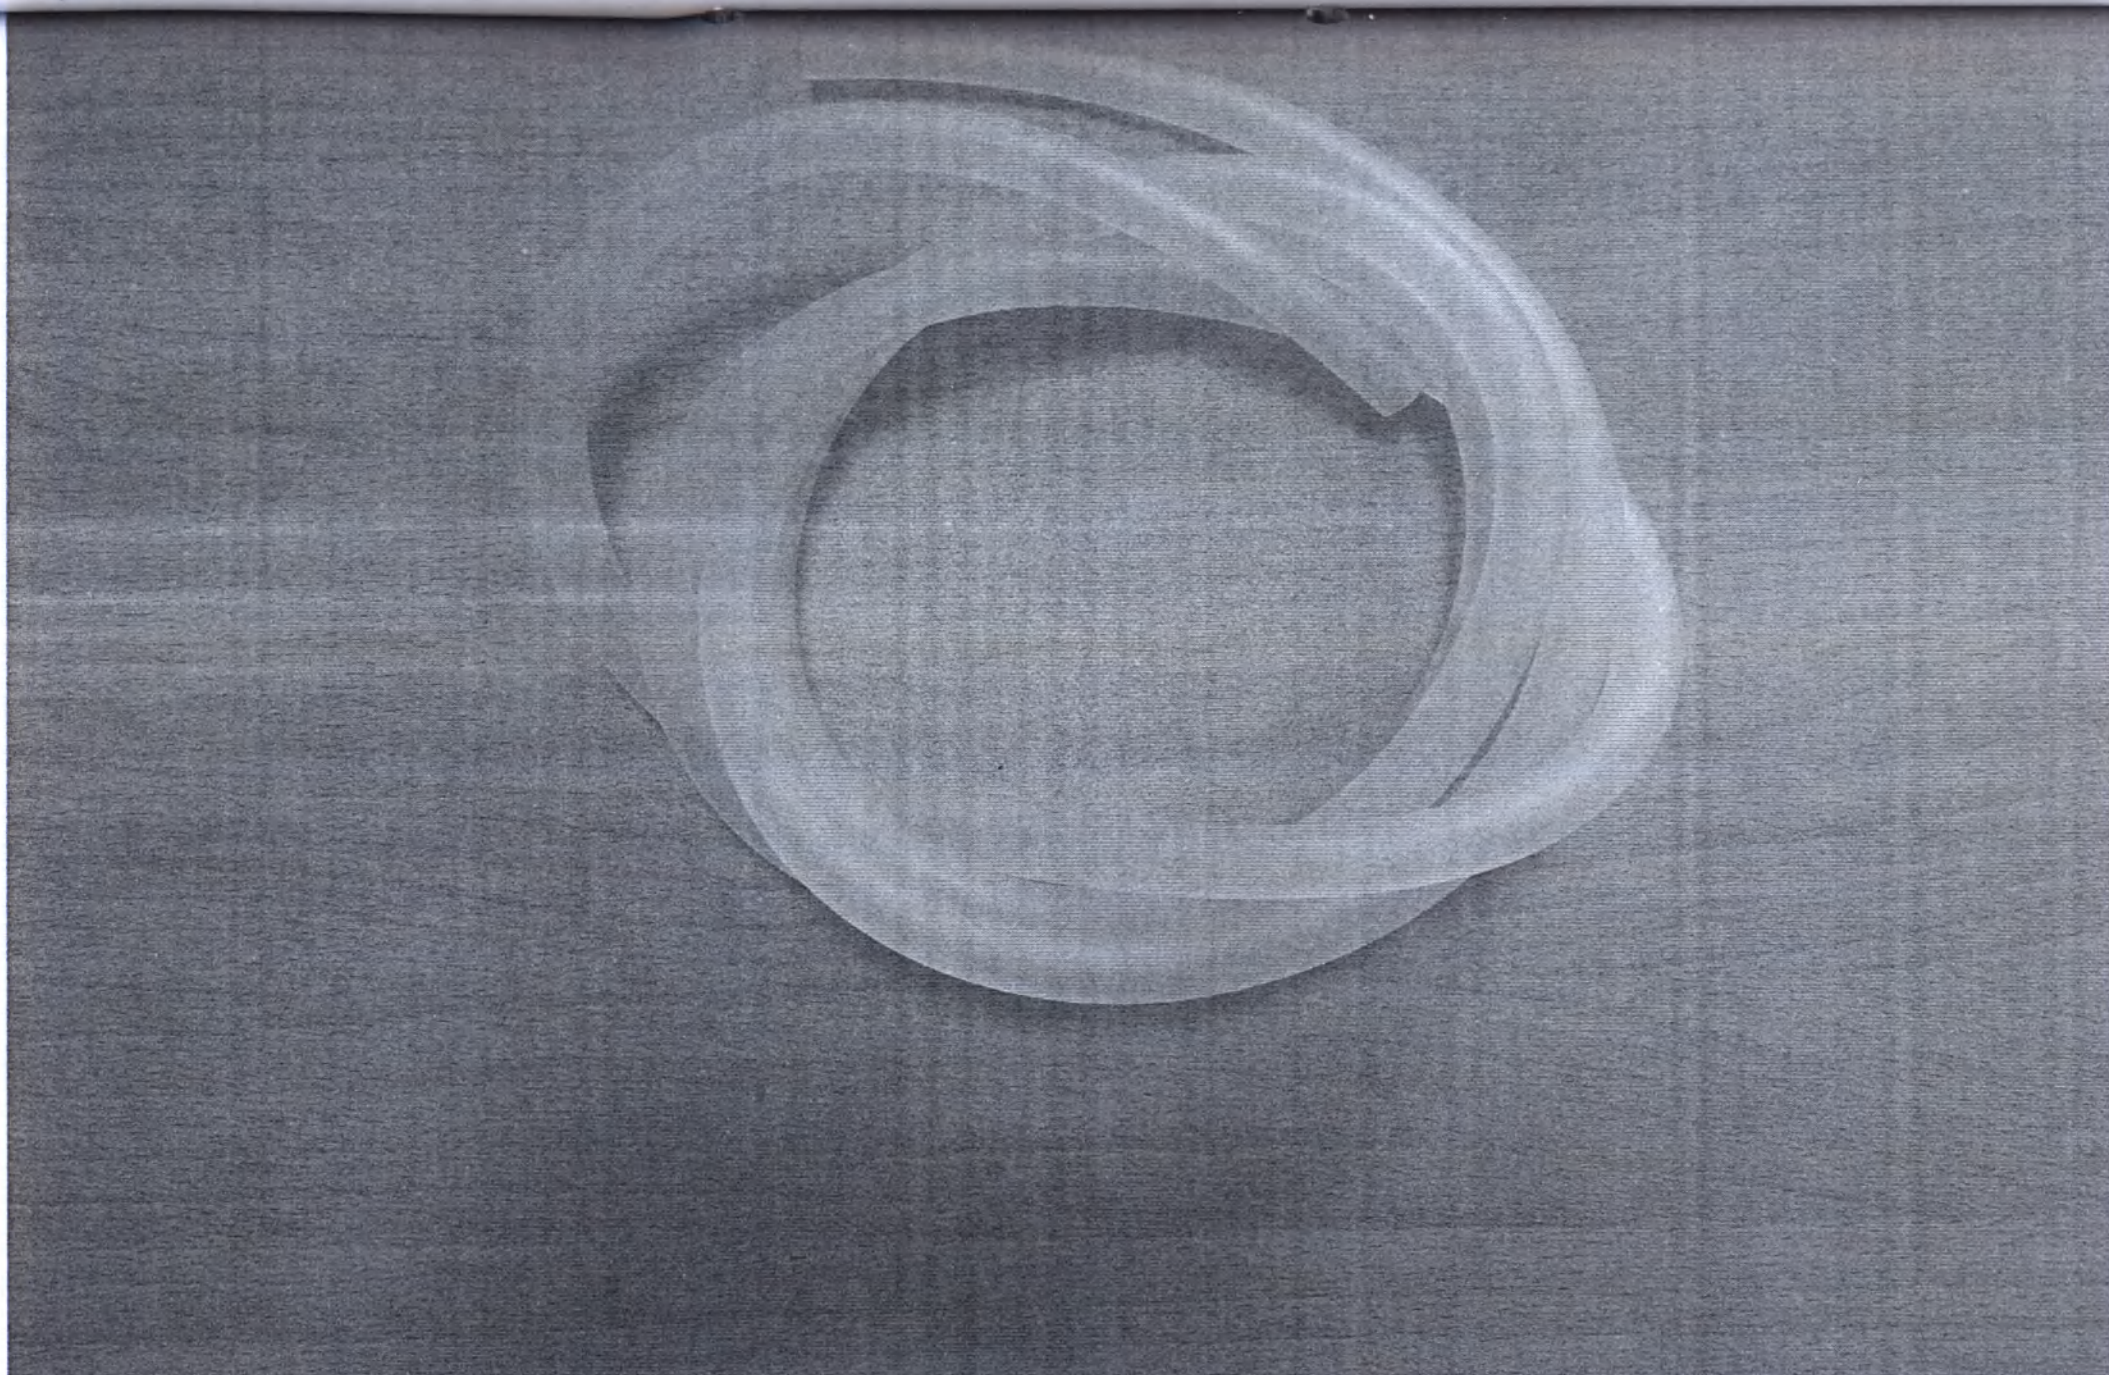



Рис. 28 – Трубка аспирационная

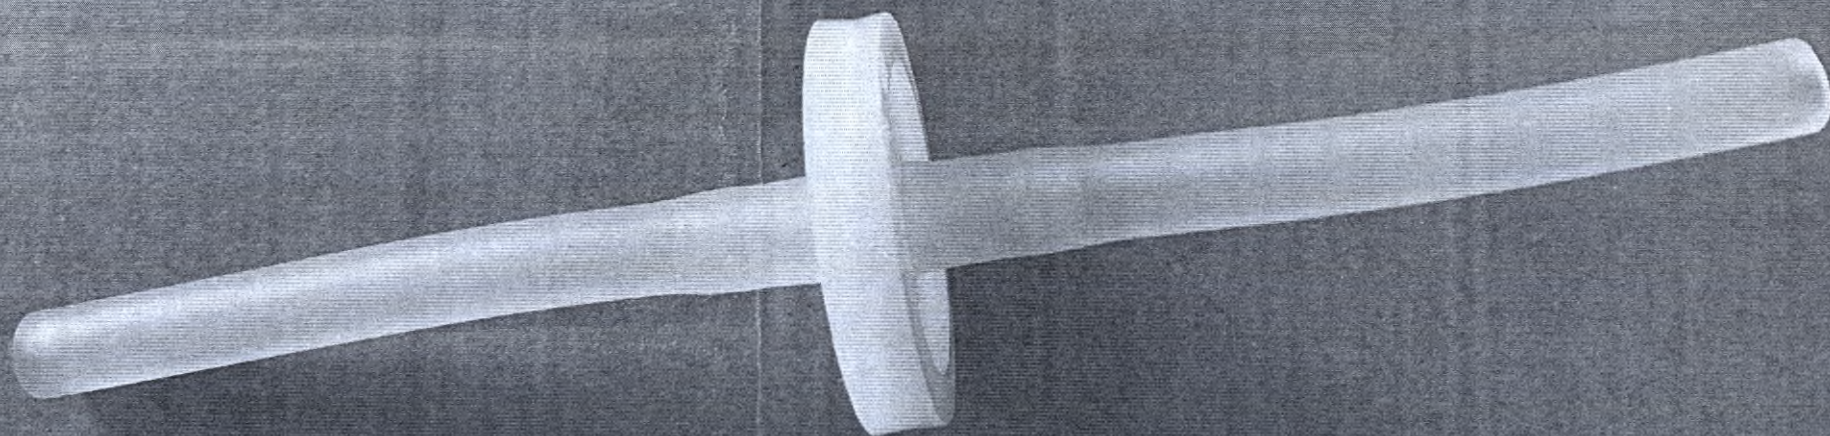

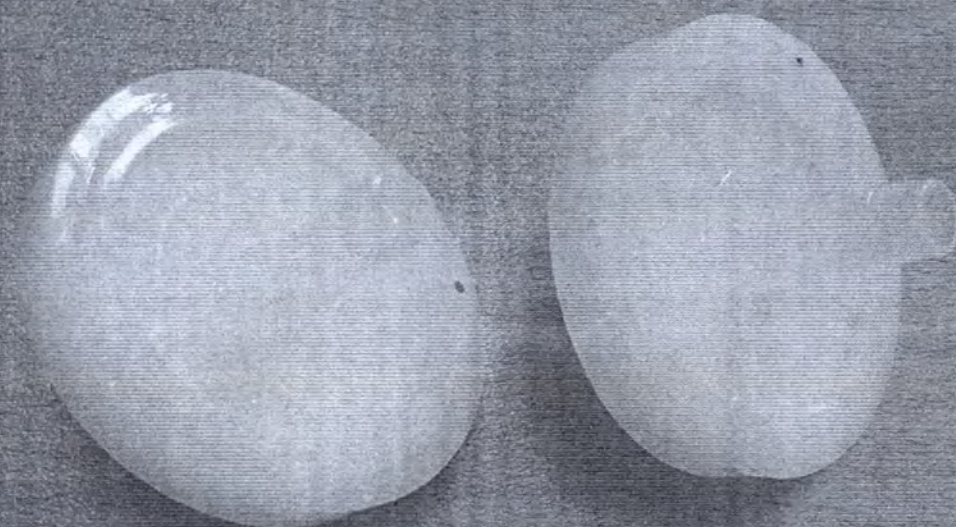

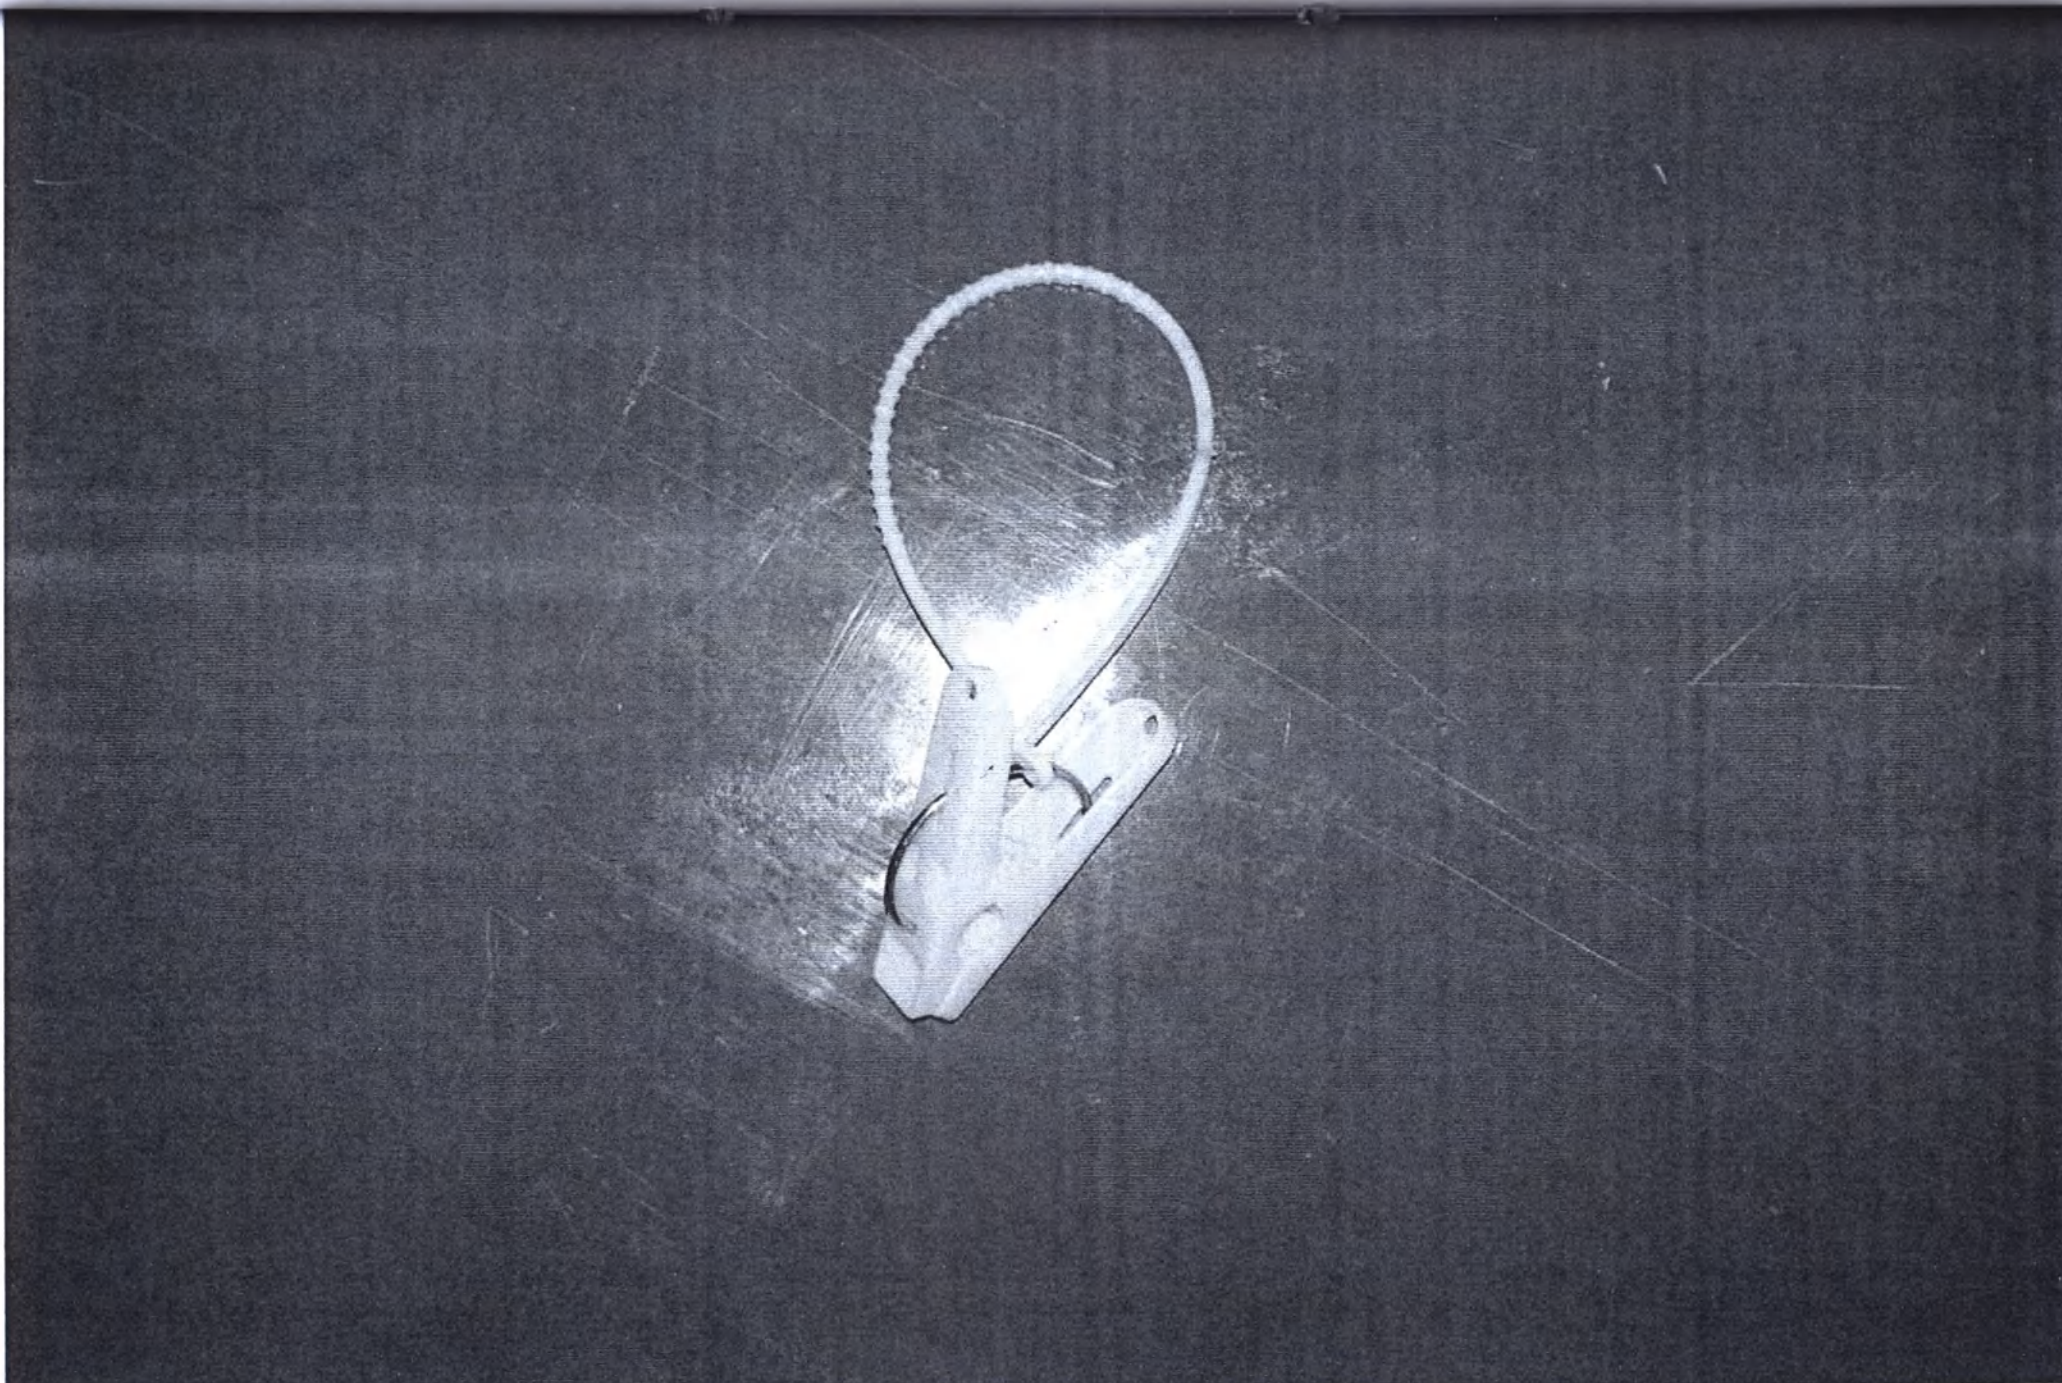

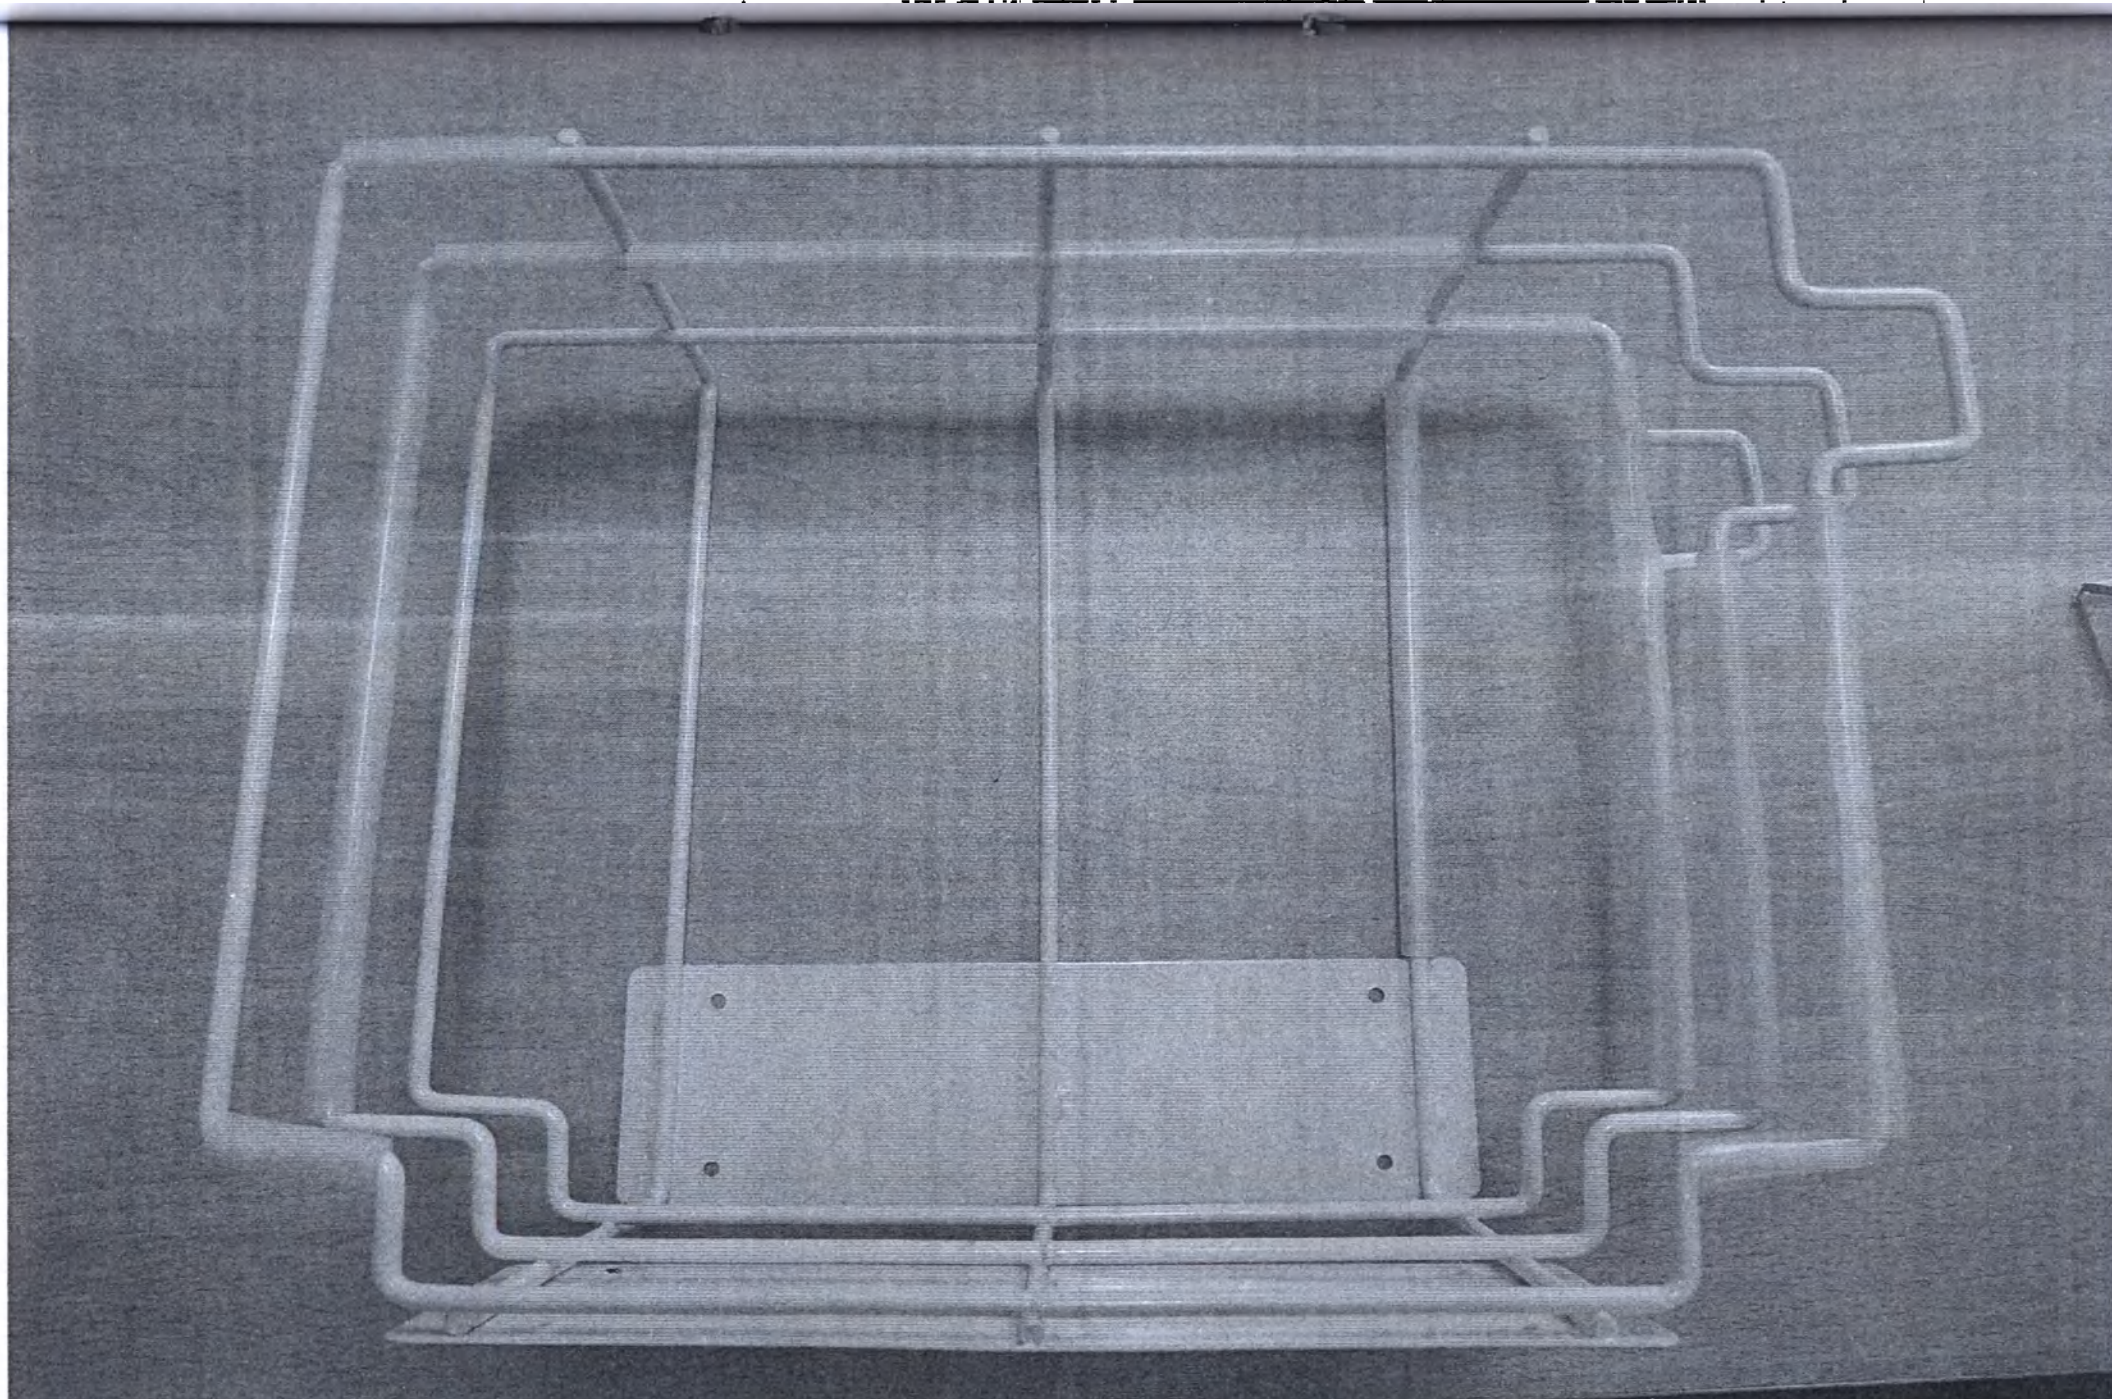

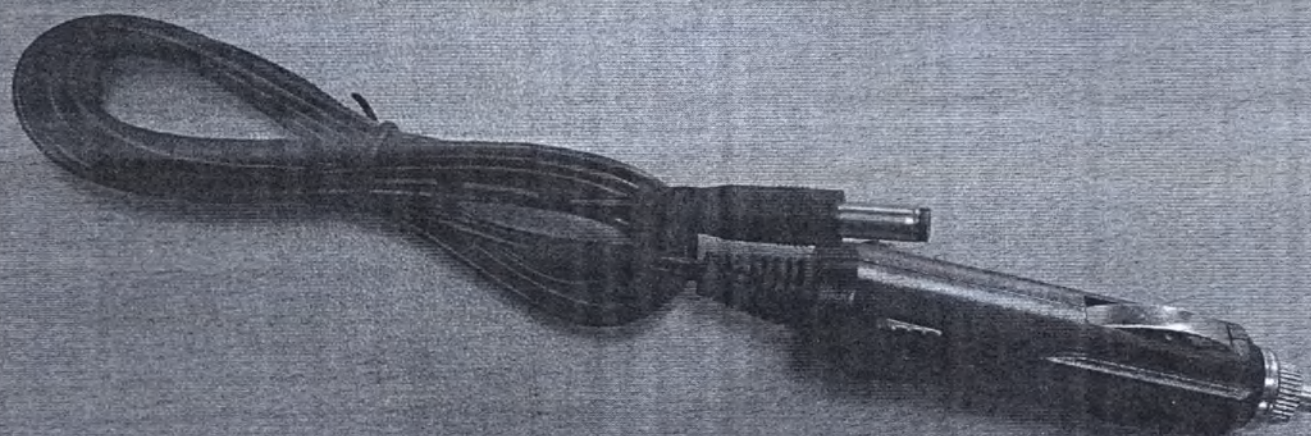




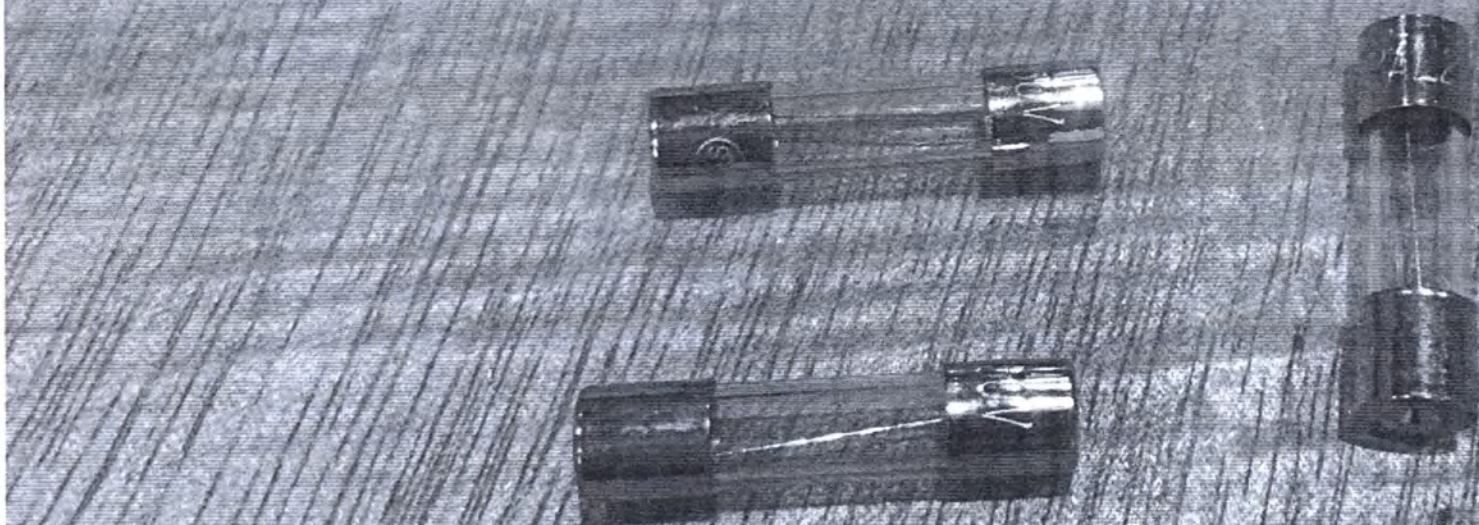


Рис. 35 – Предохранитель плавкий 3А (3 шт.)

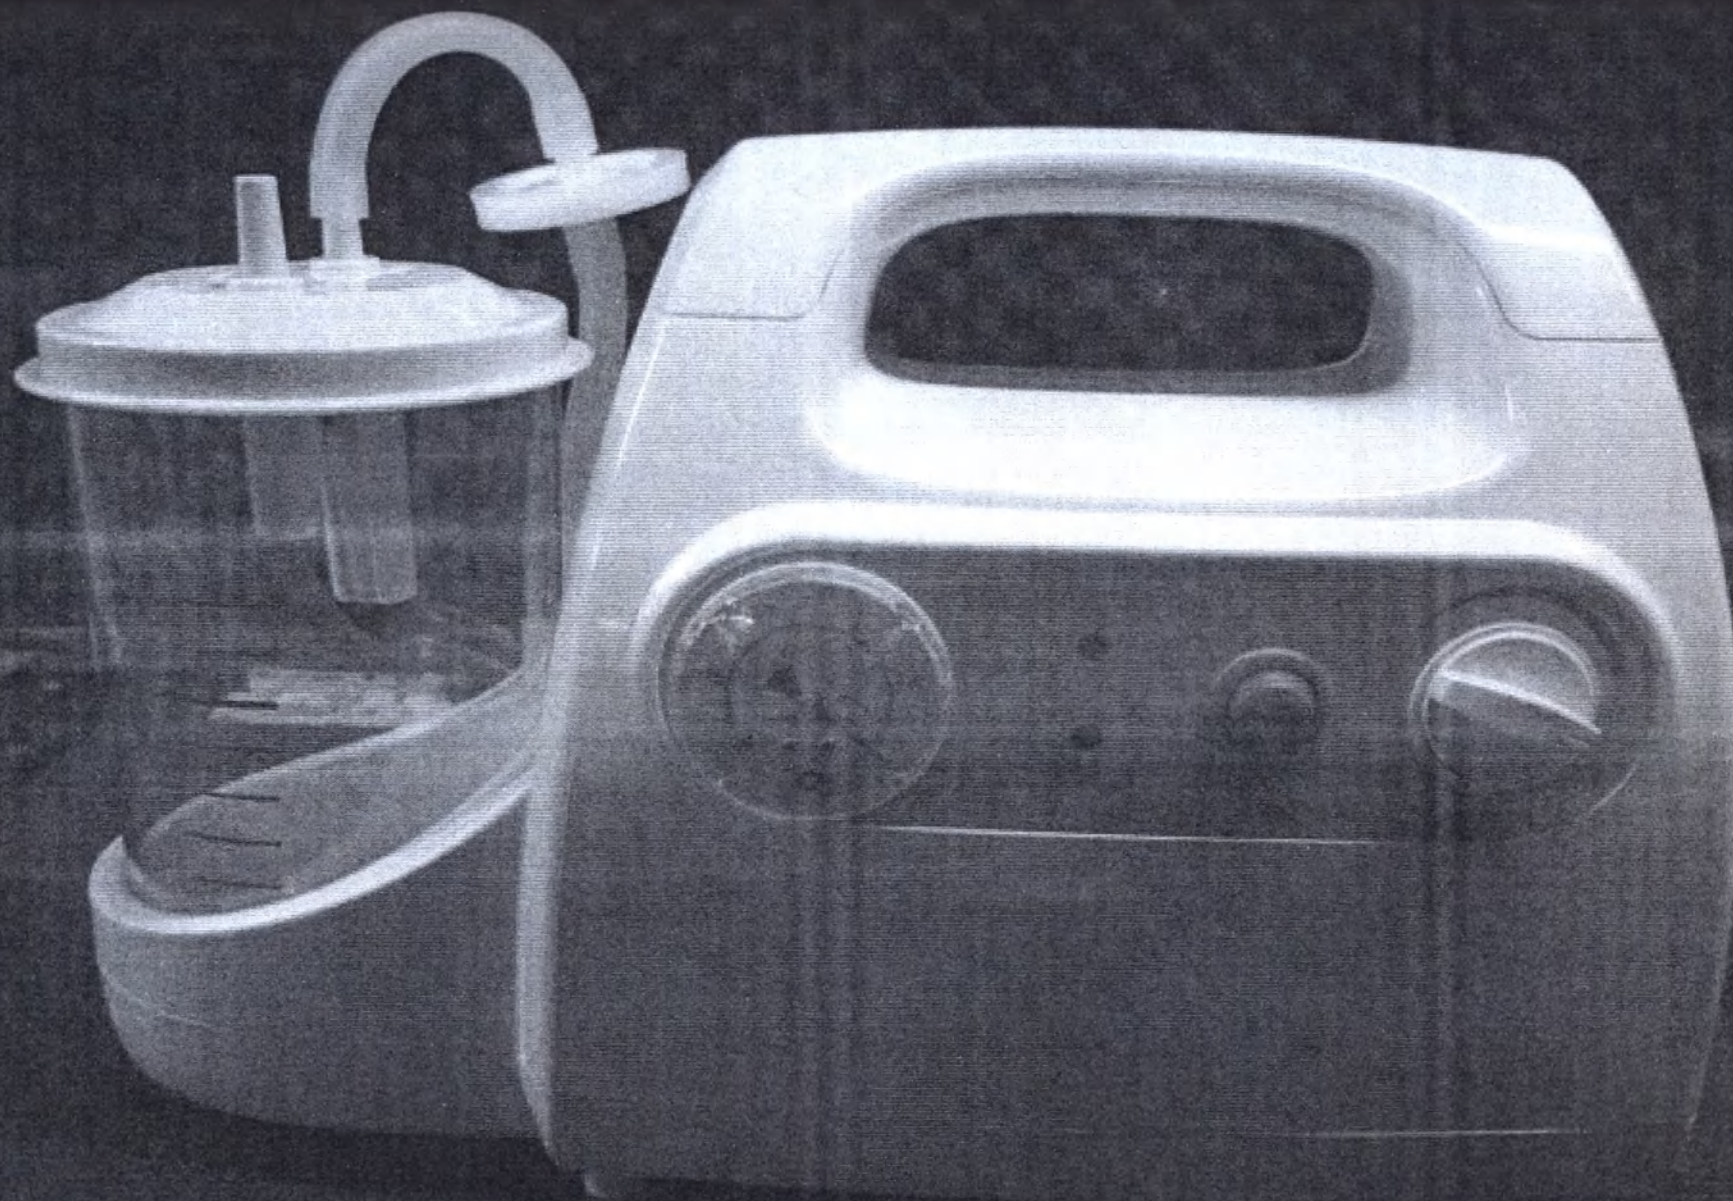






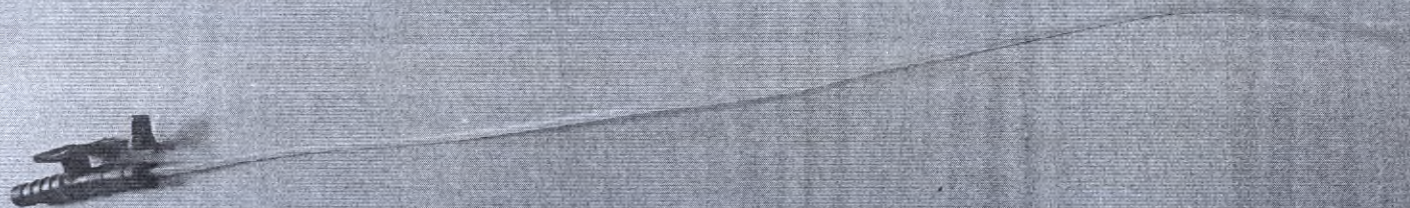Рис. 38 – Катетер F12



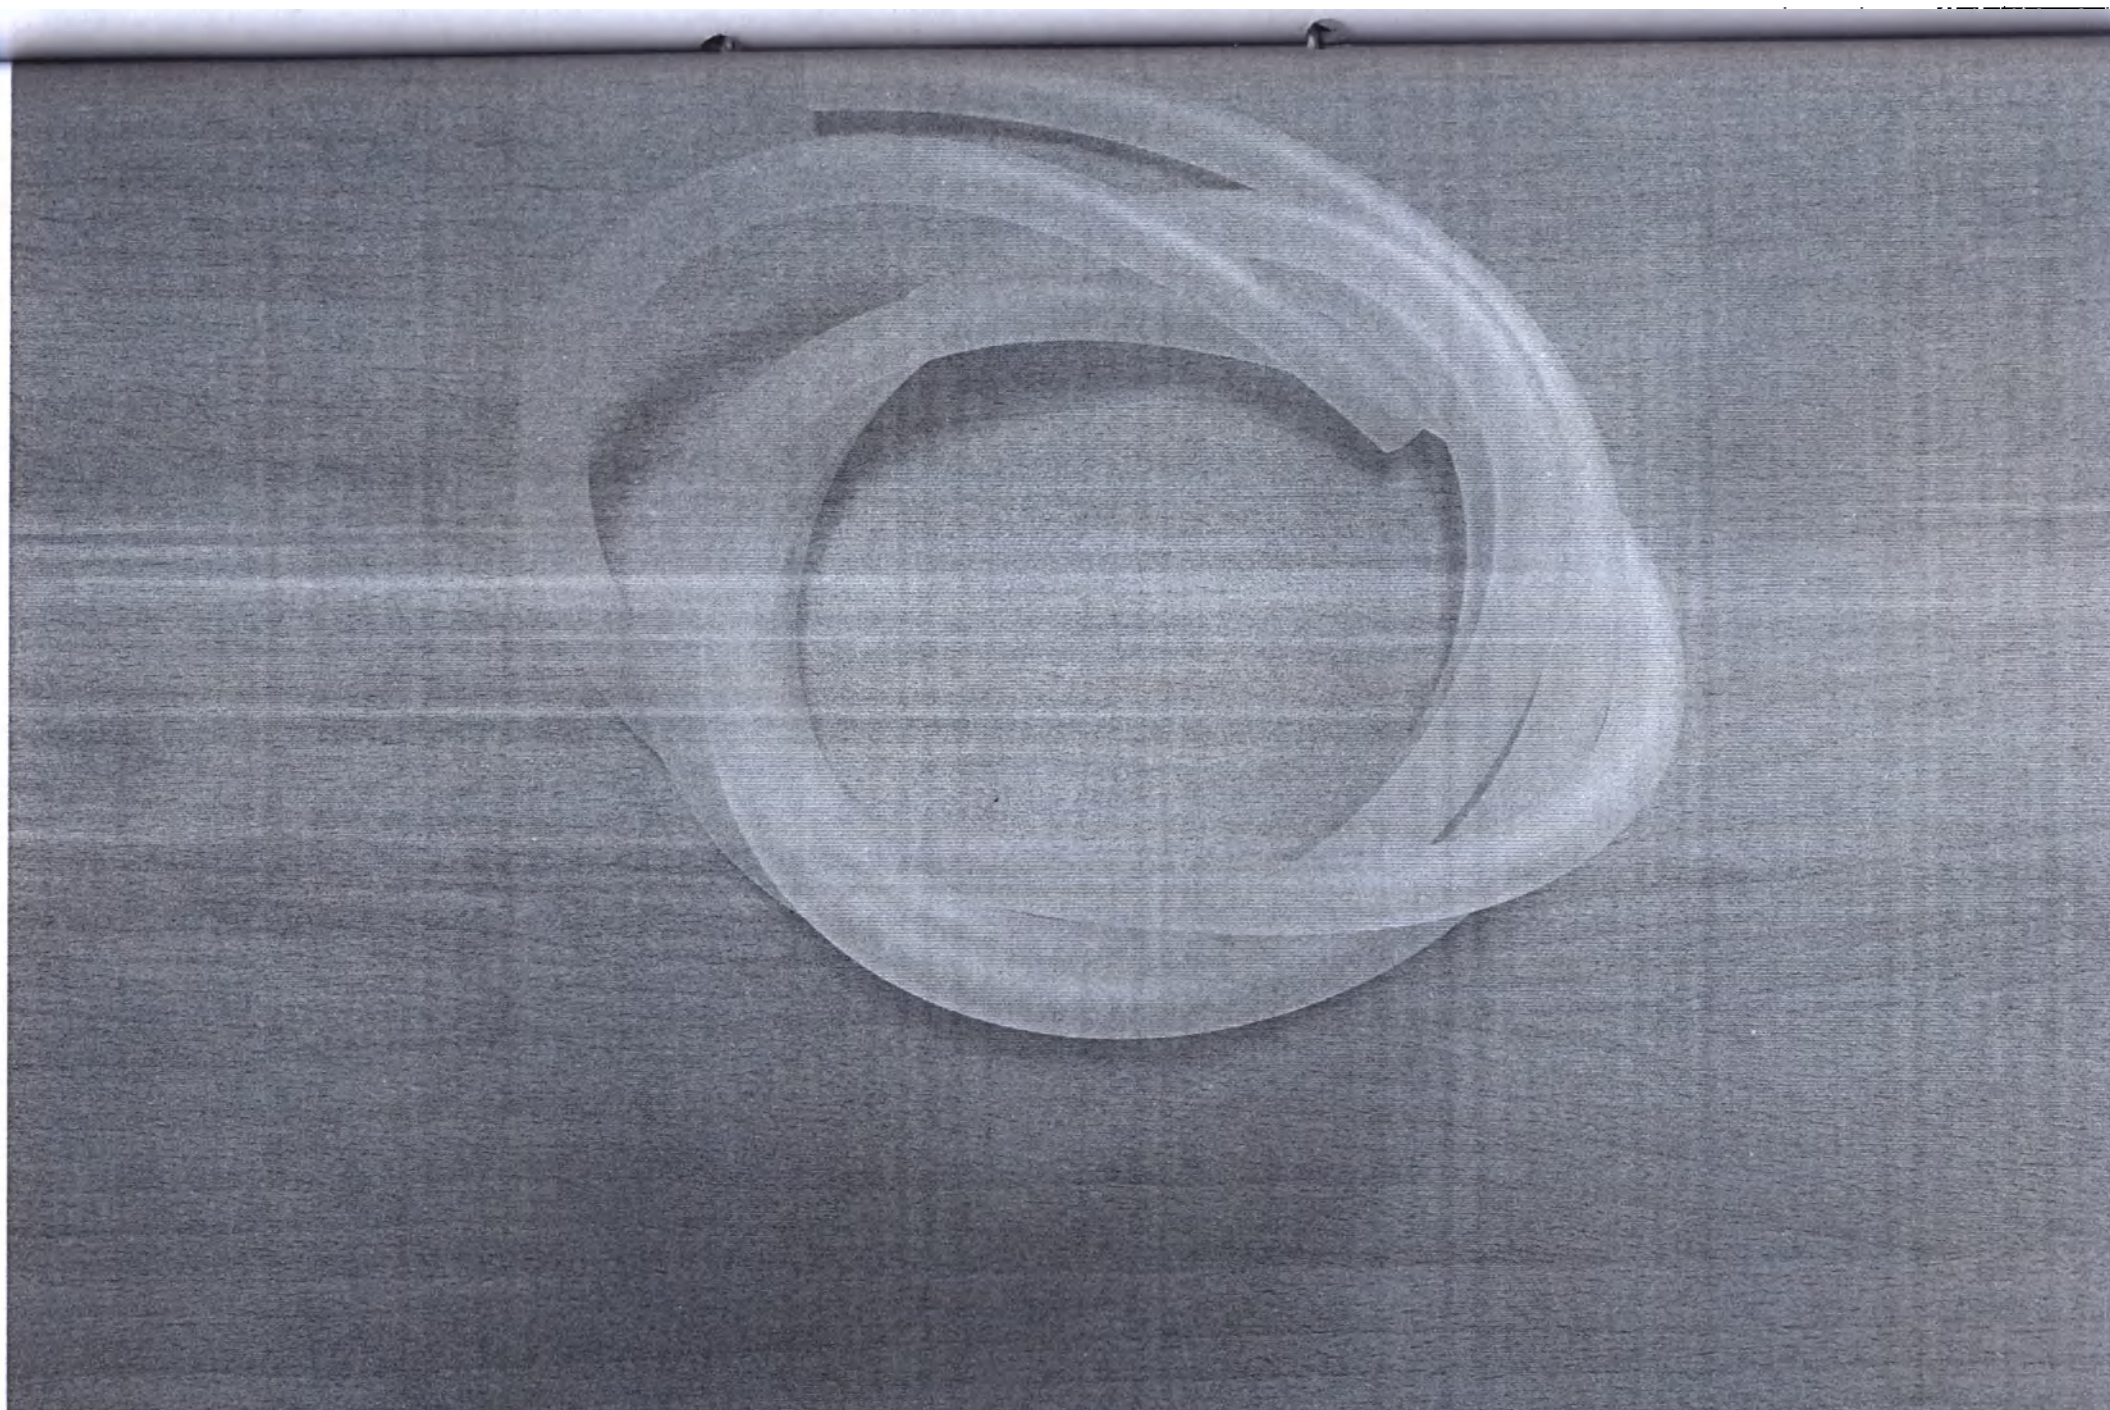


Рис. 39 – Трубка аспирационная

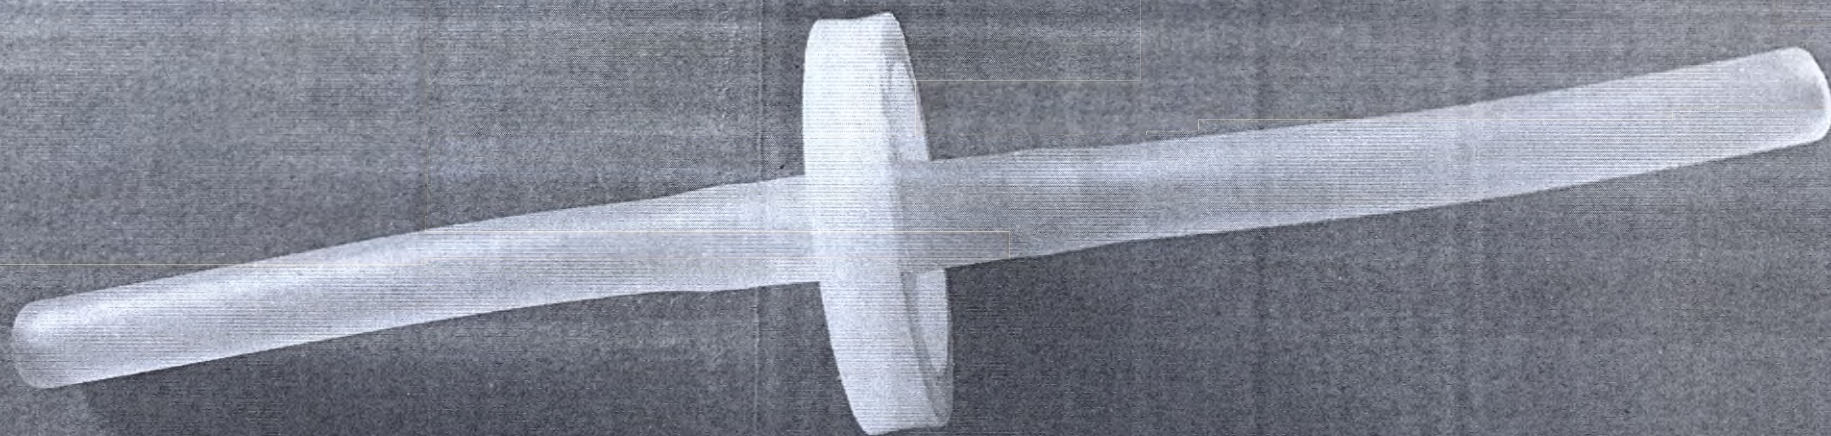

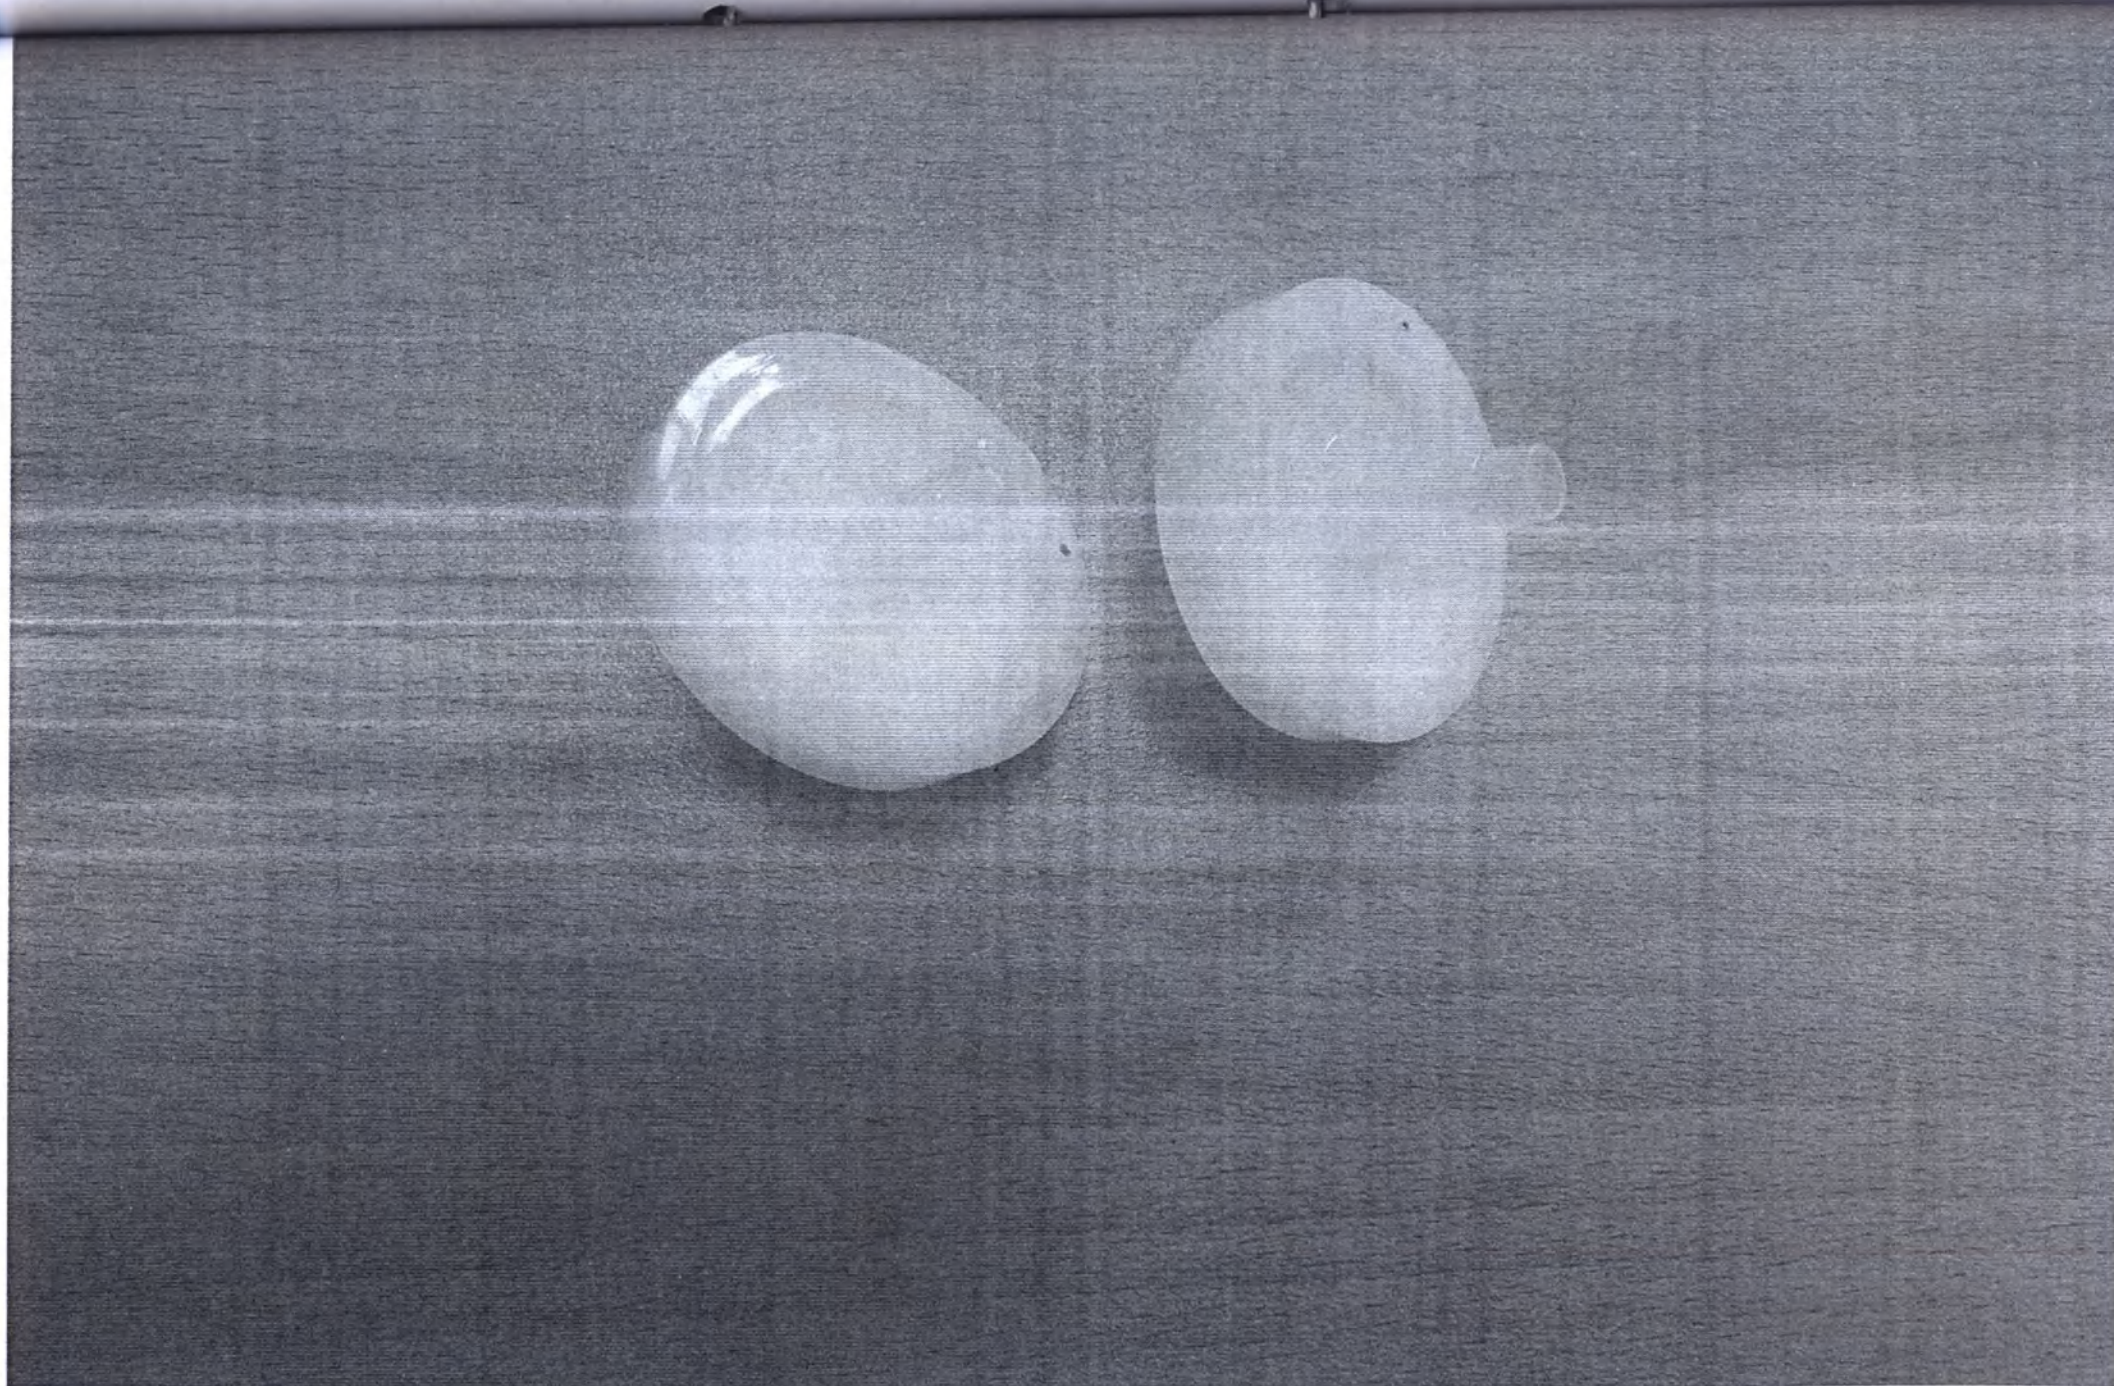

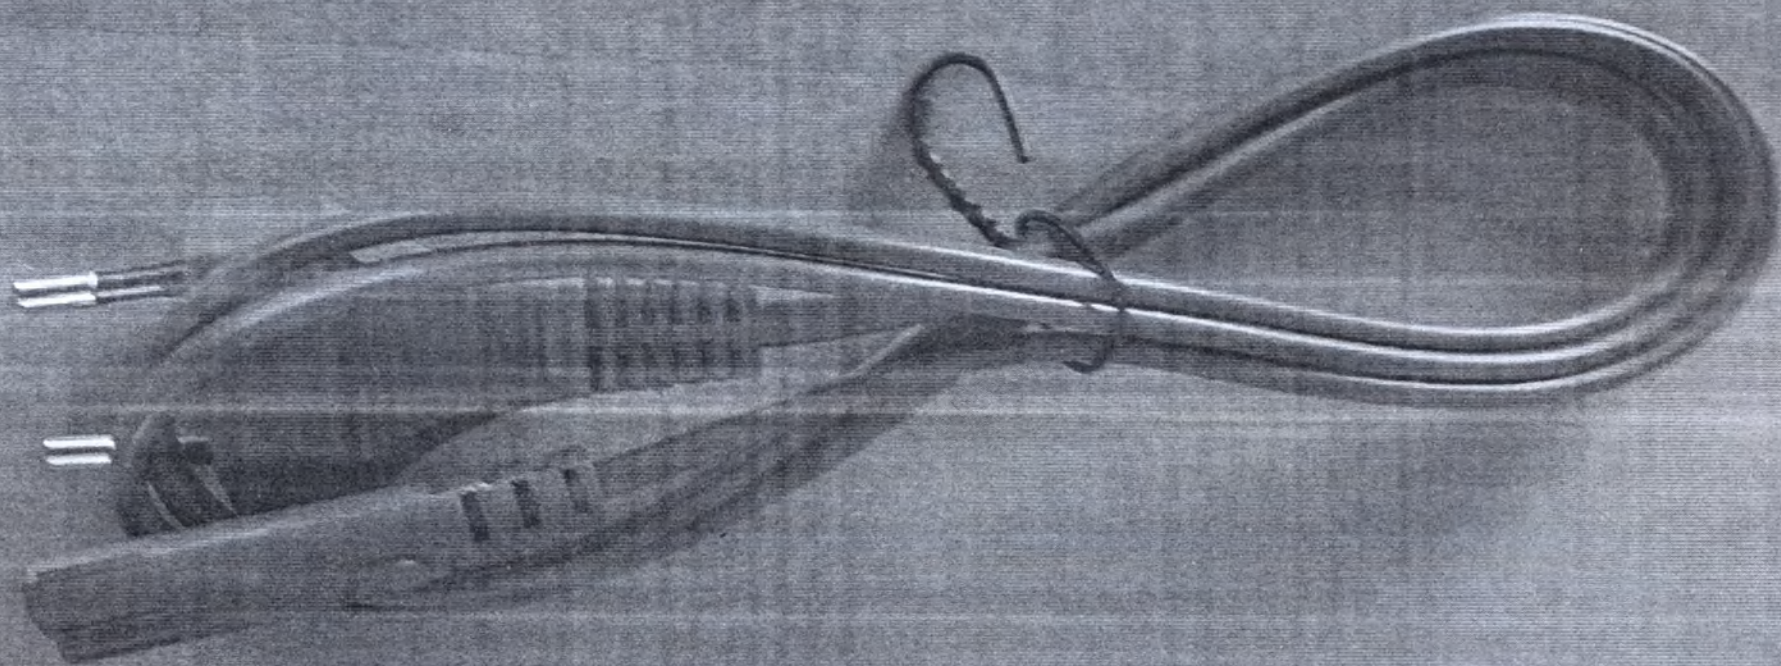


Рис. 42 – Шнур питания

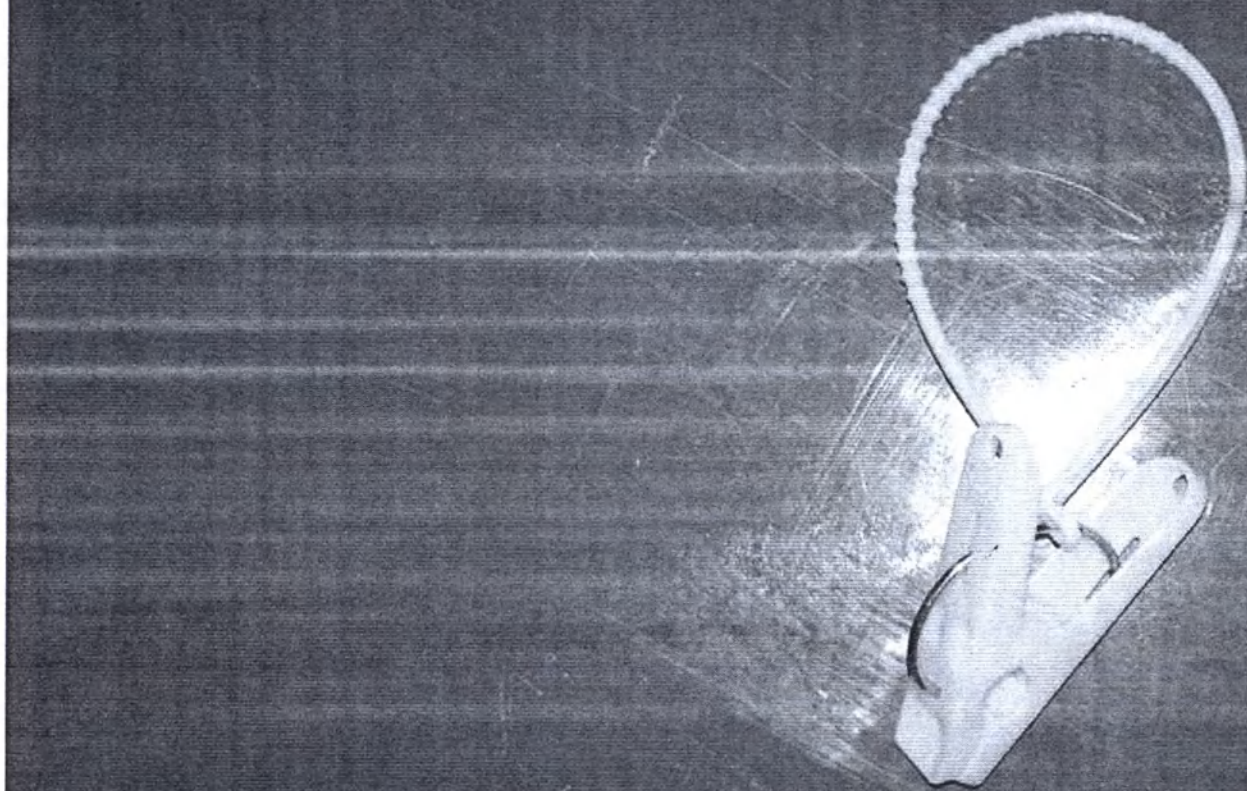


Рис. 43 – Зажим






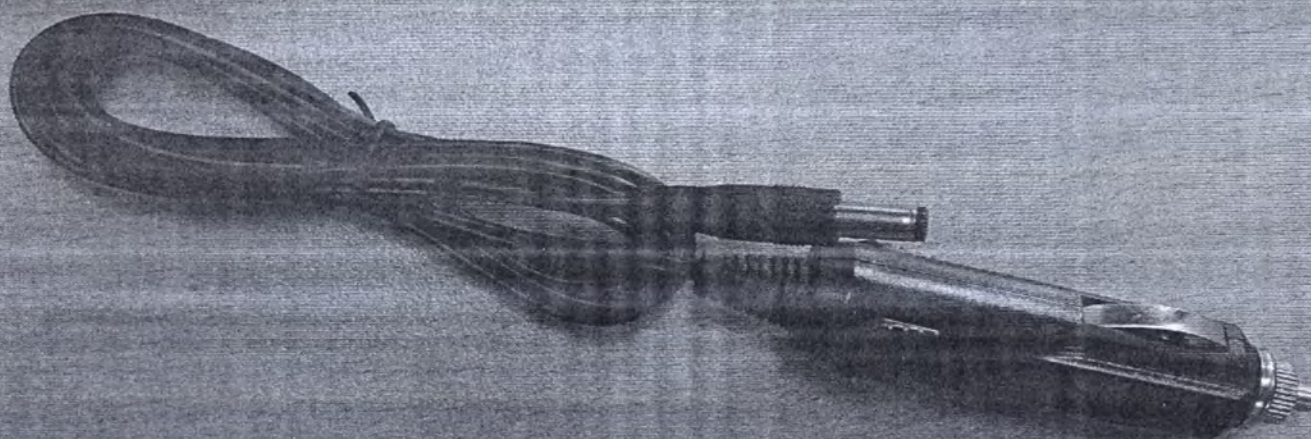Рис. 45 – Предохранитель плавкий 1,5А (2 шт.)

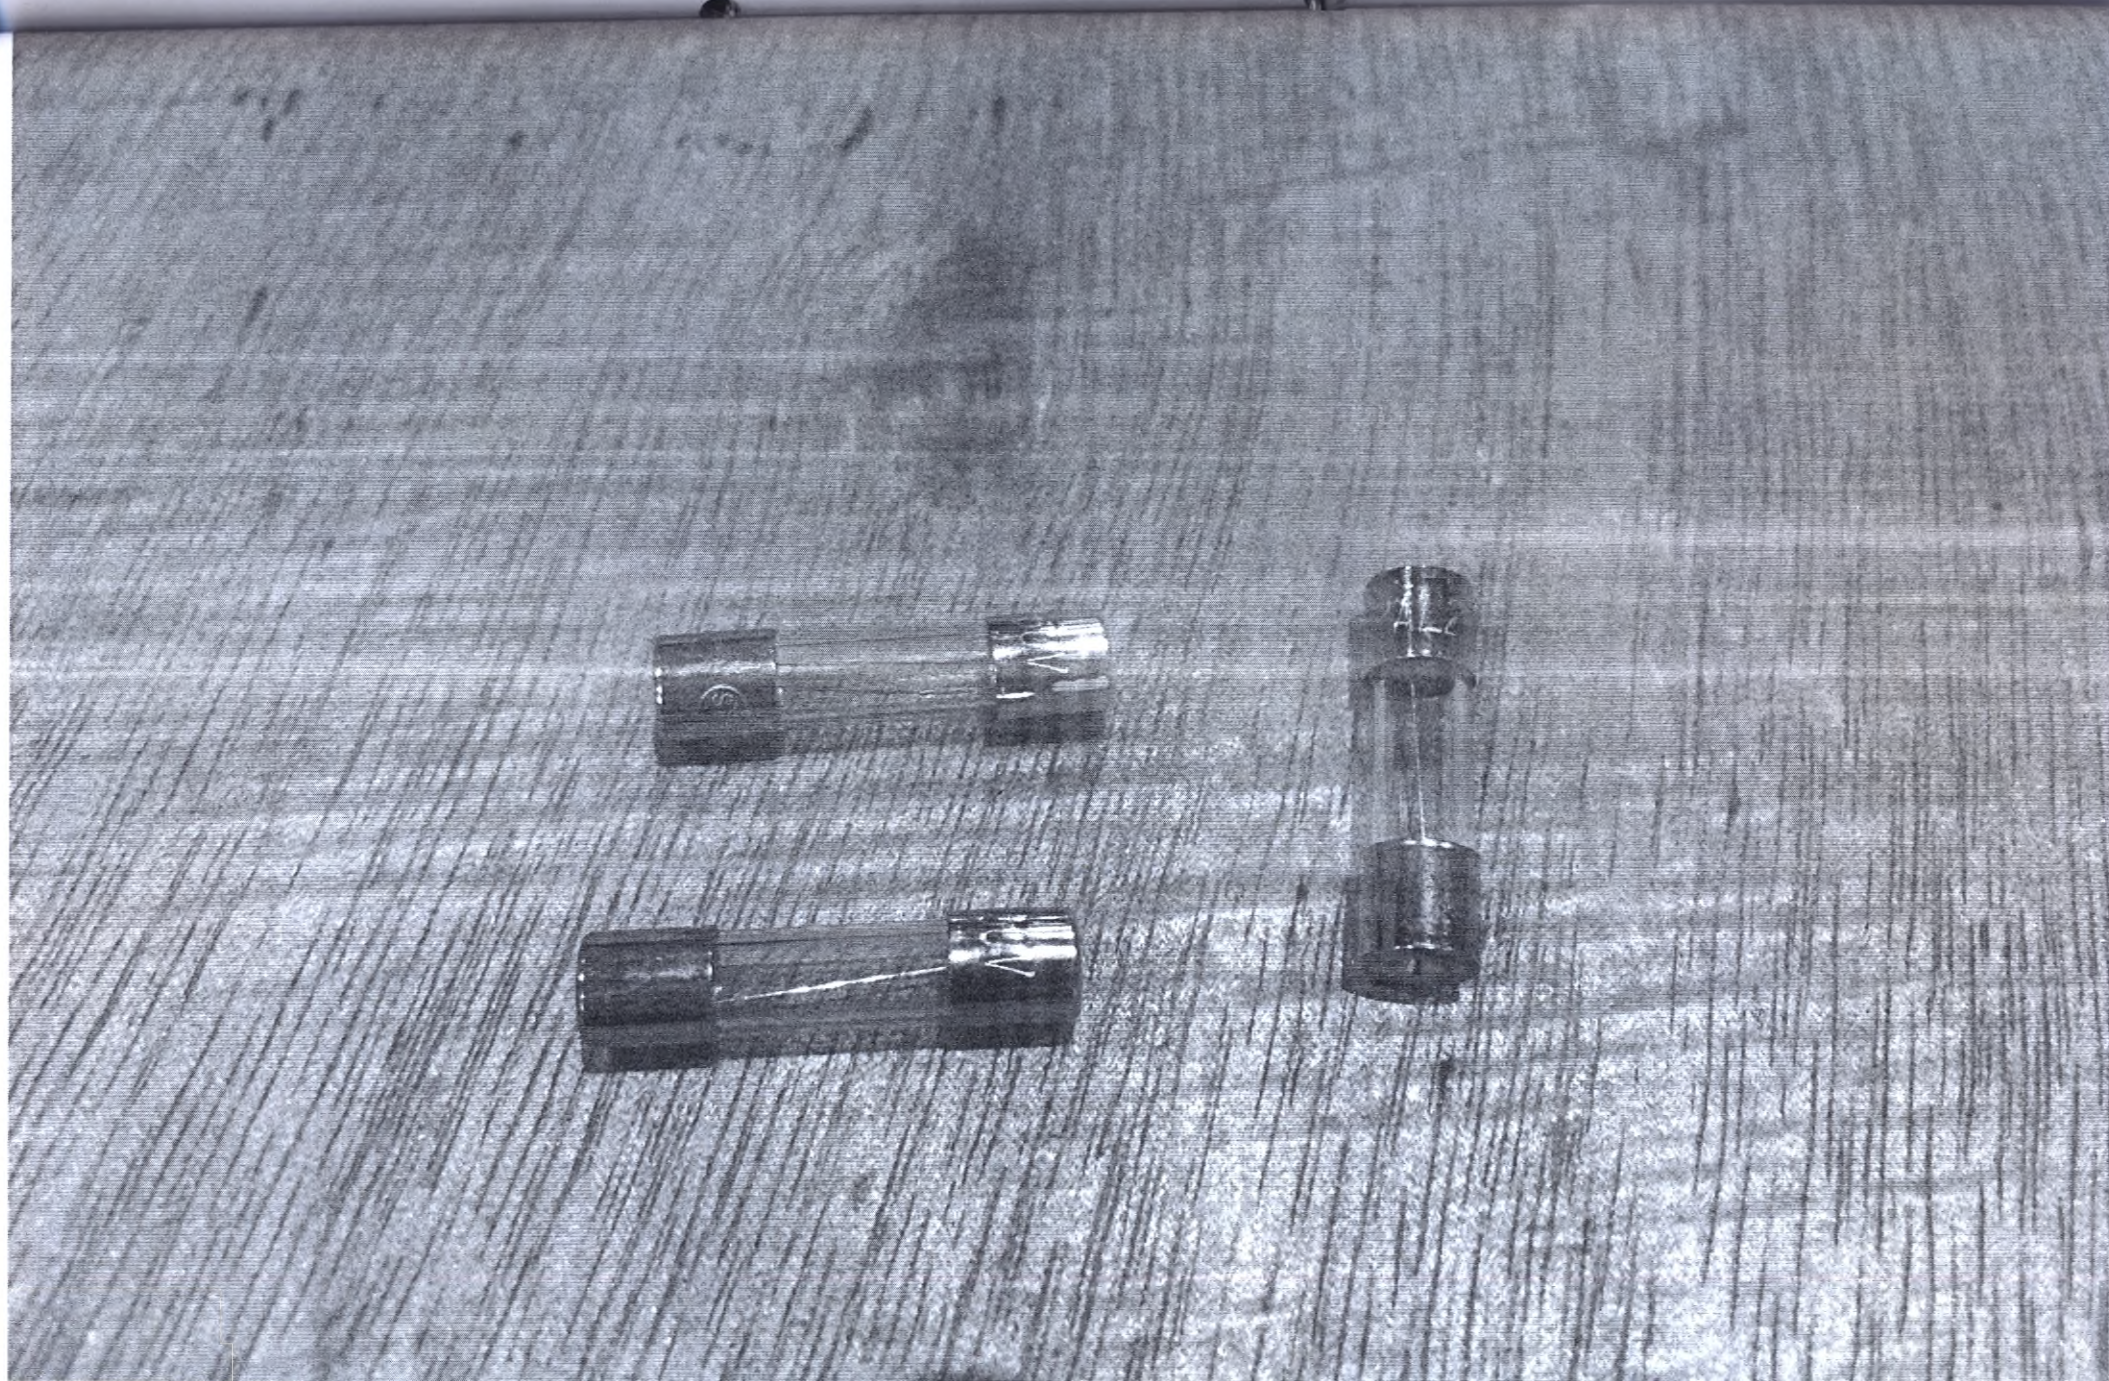


Рис. 46 – Предохранитель плавкий 4А (3 шт.)


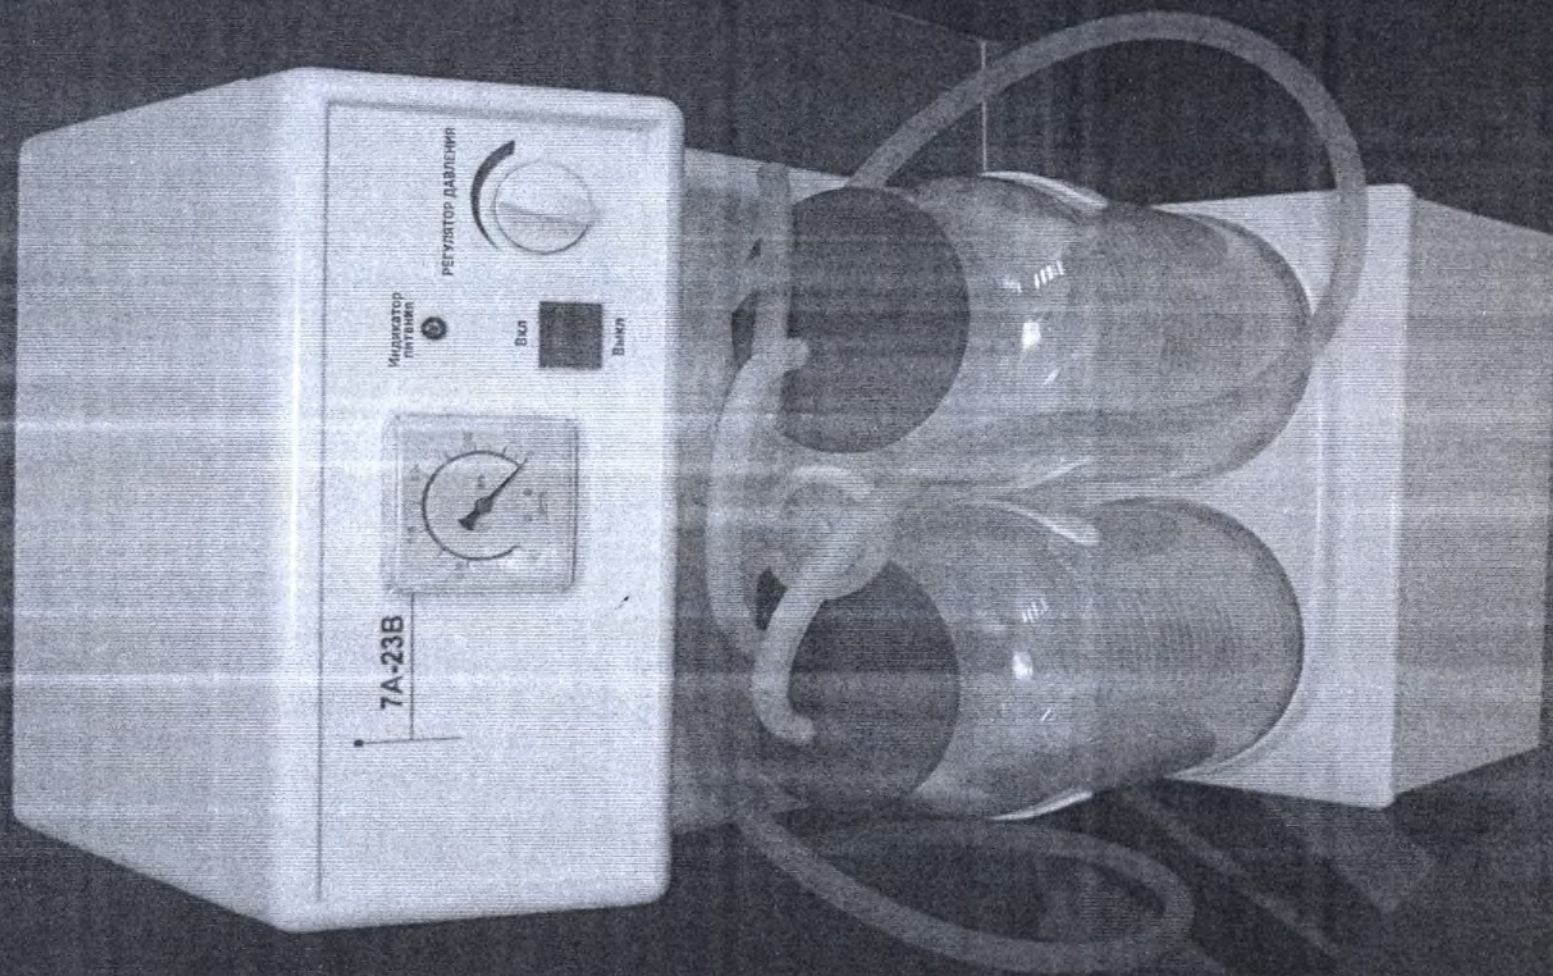


Рис. 47 – Отсасыватель

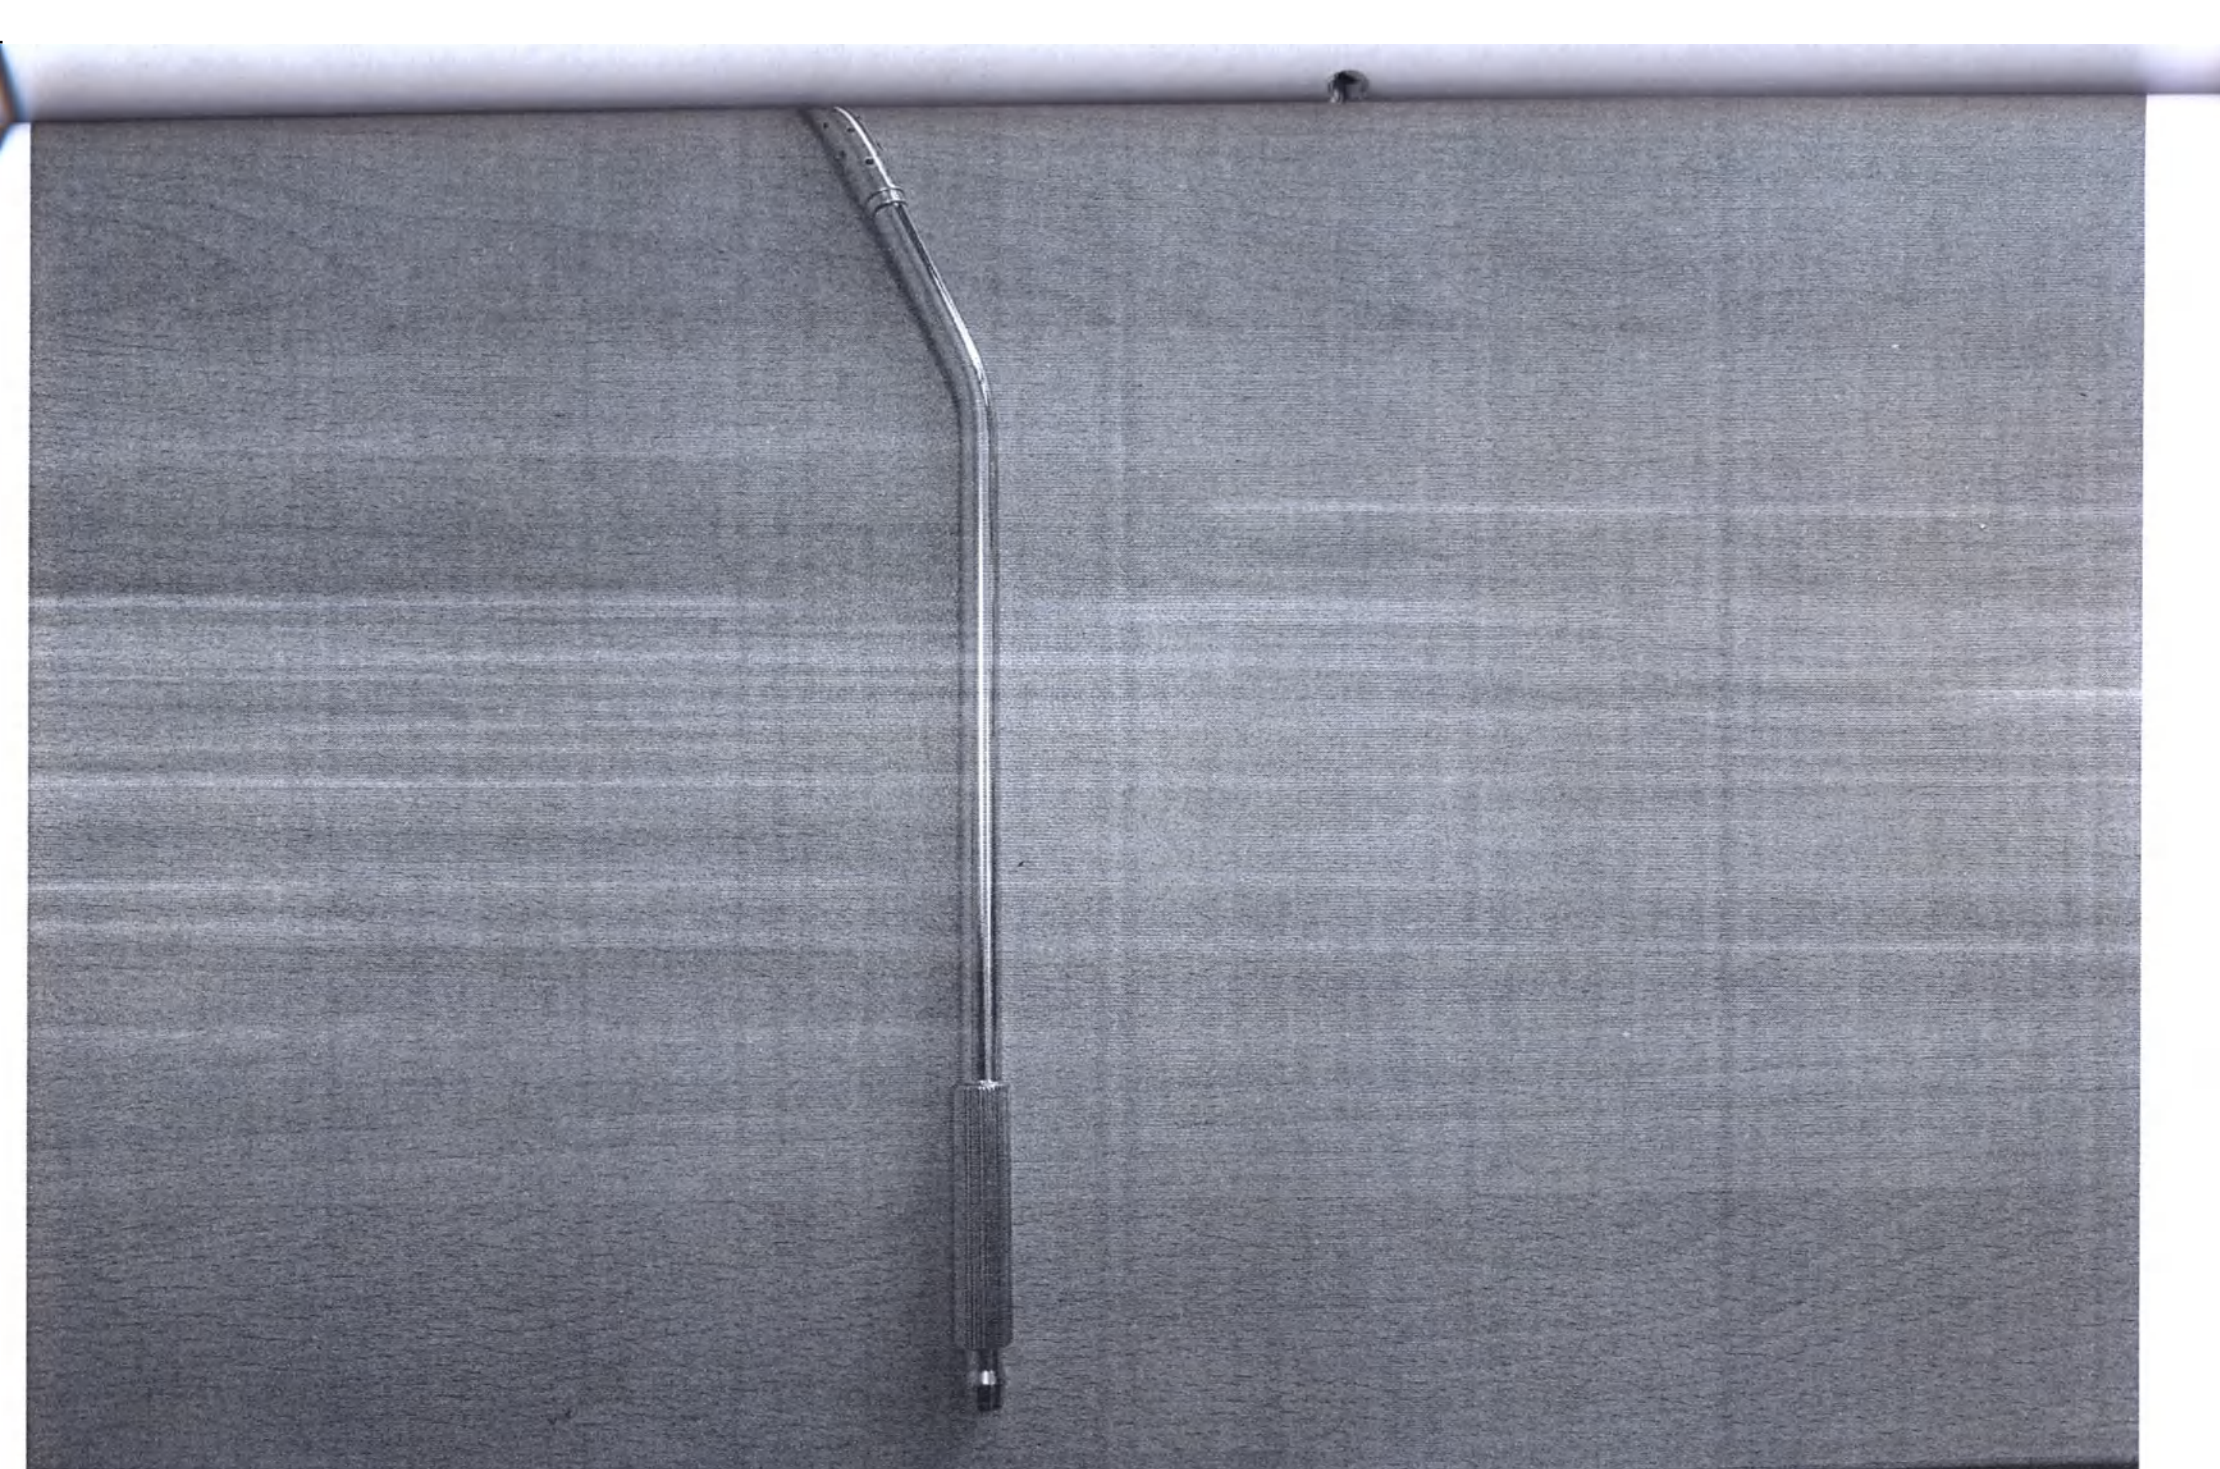

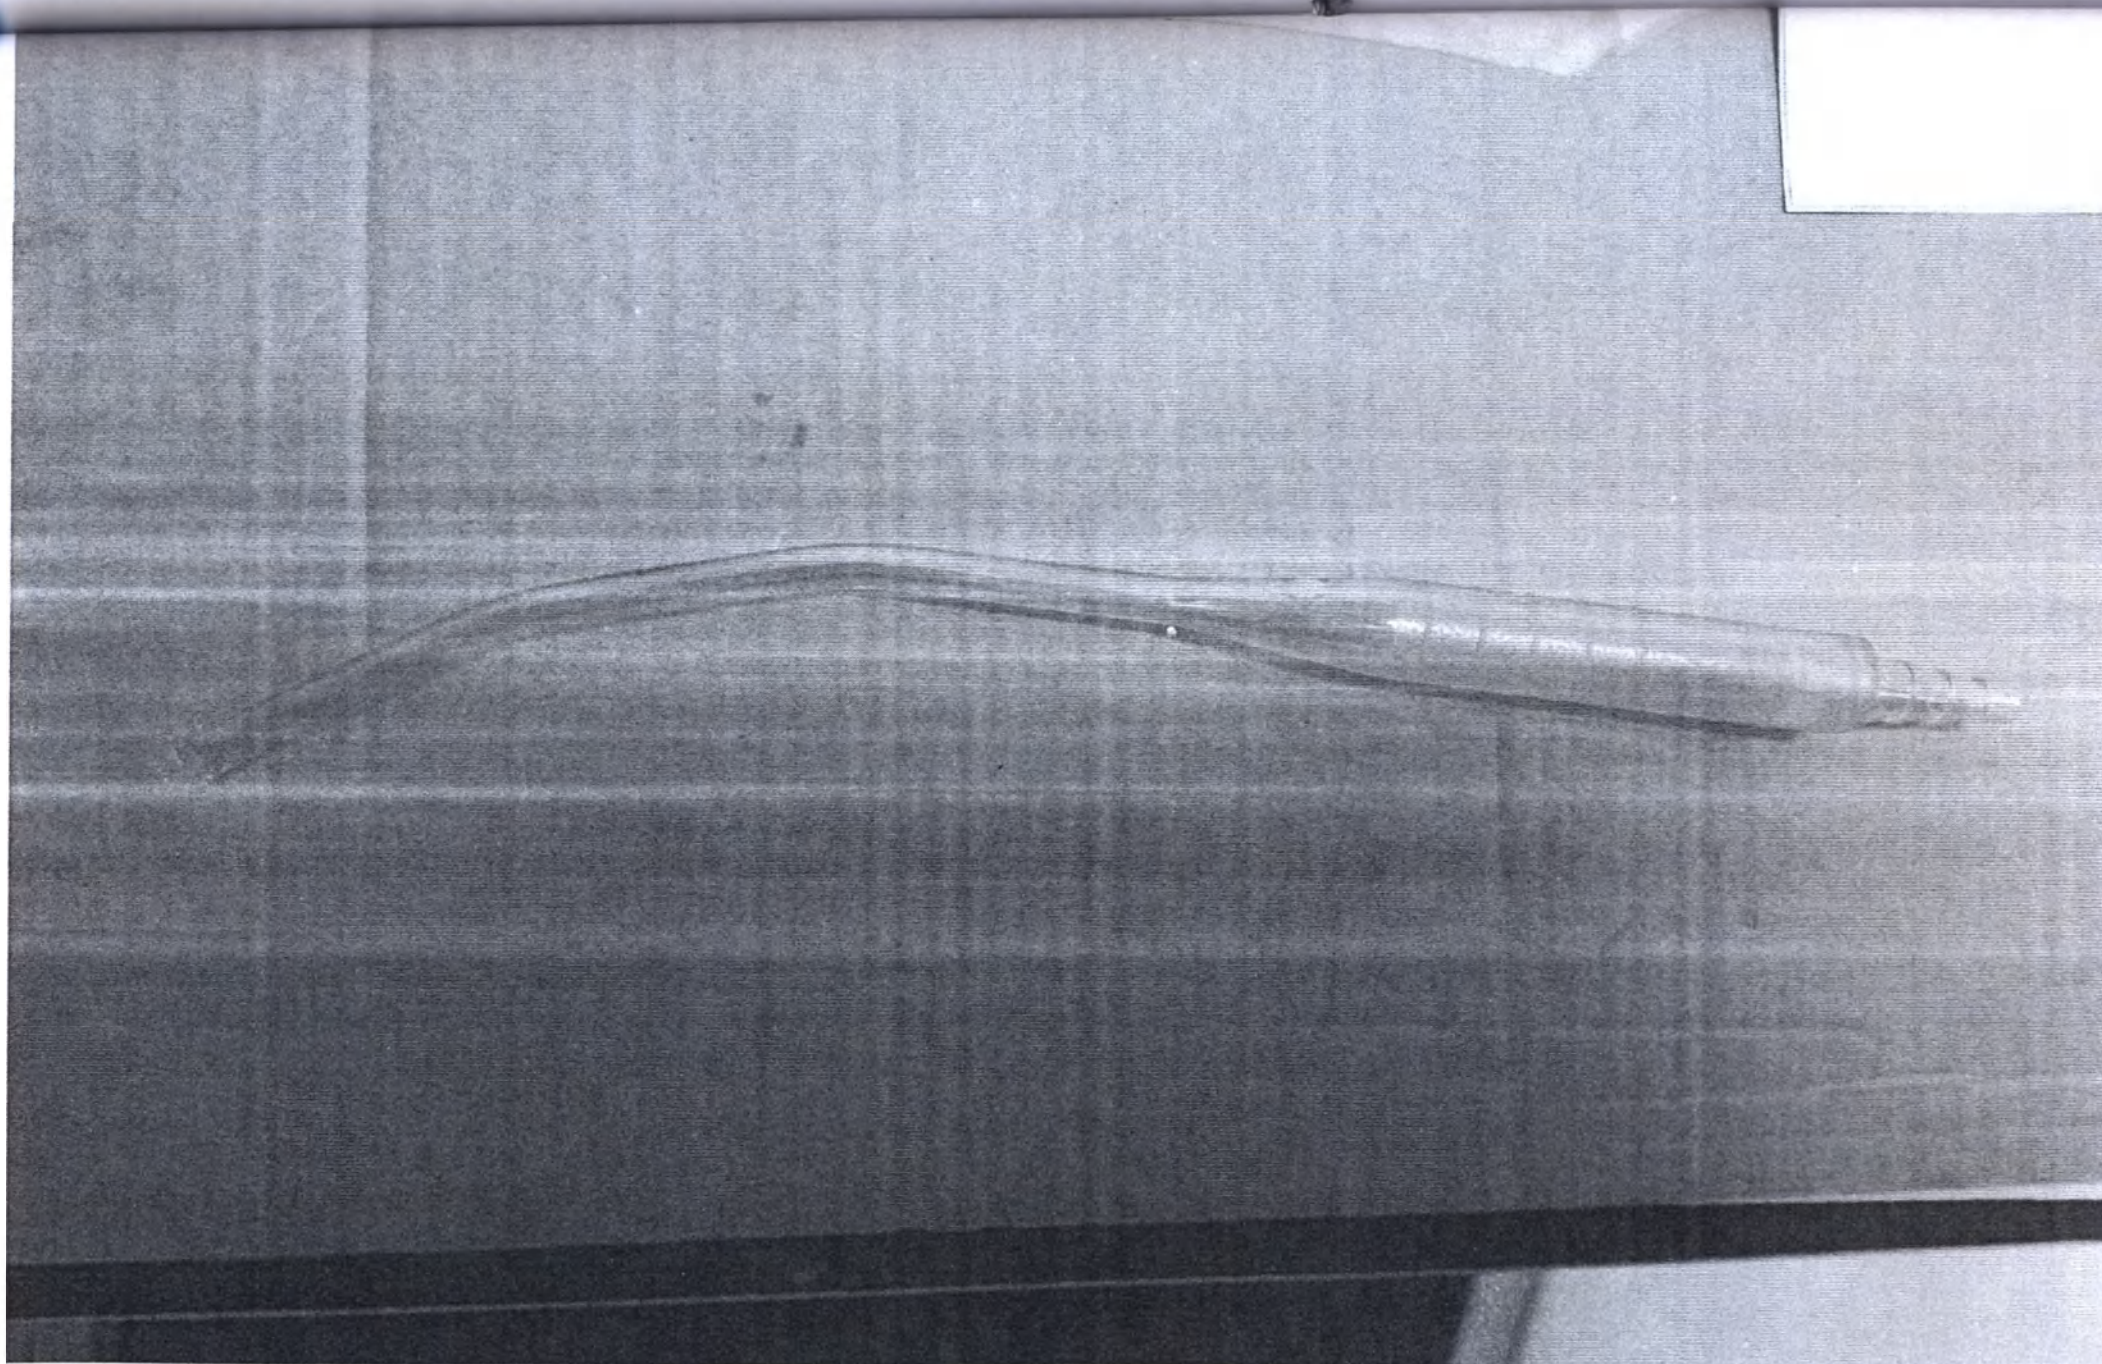


Рис. 49 – Трубка для отсасывания (по требованию)

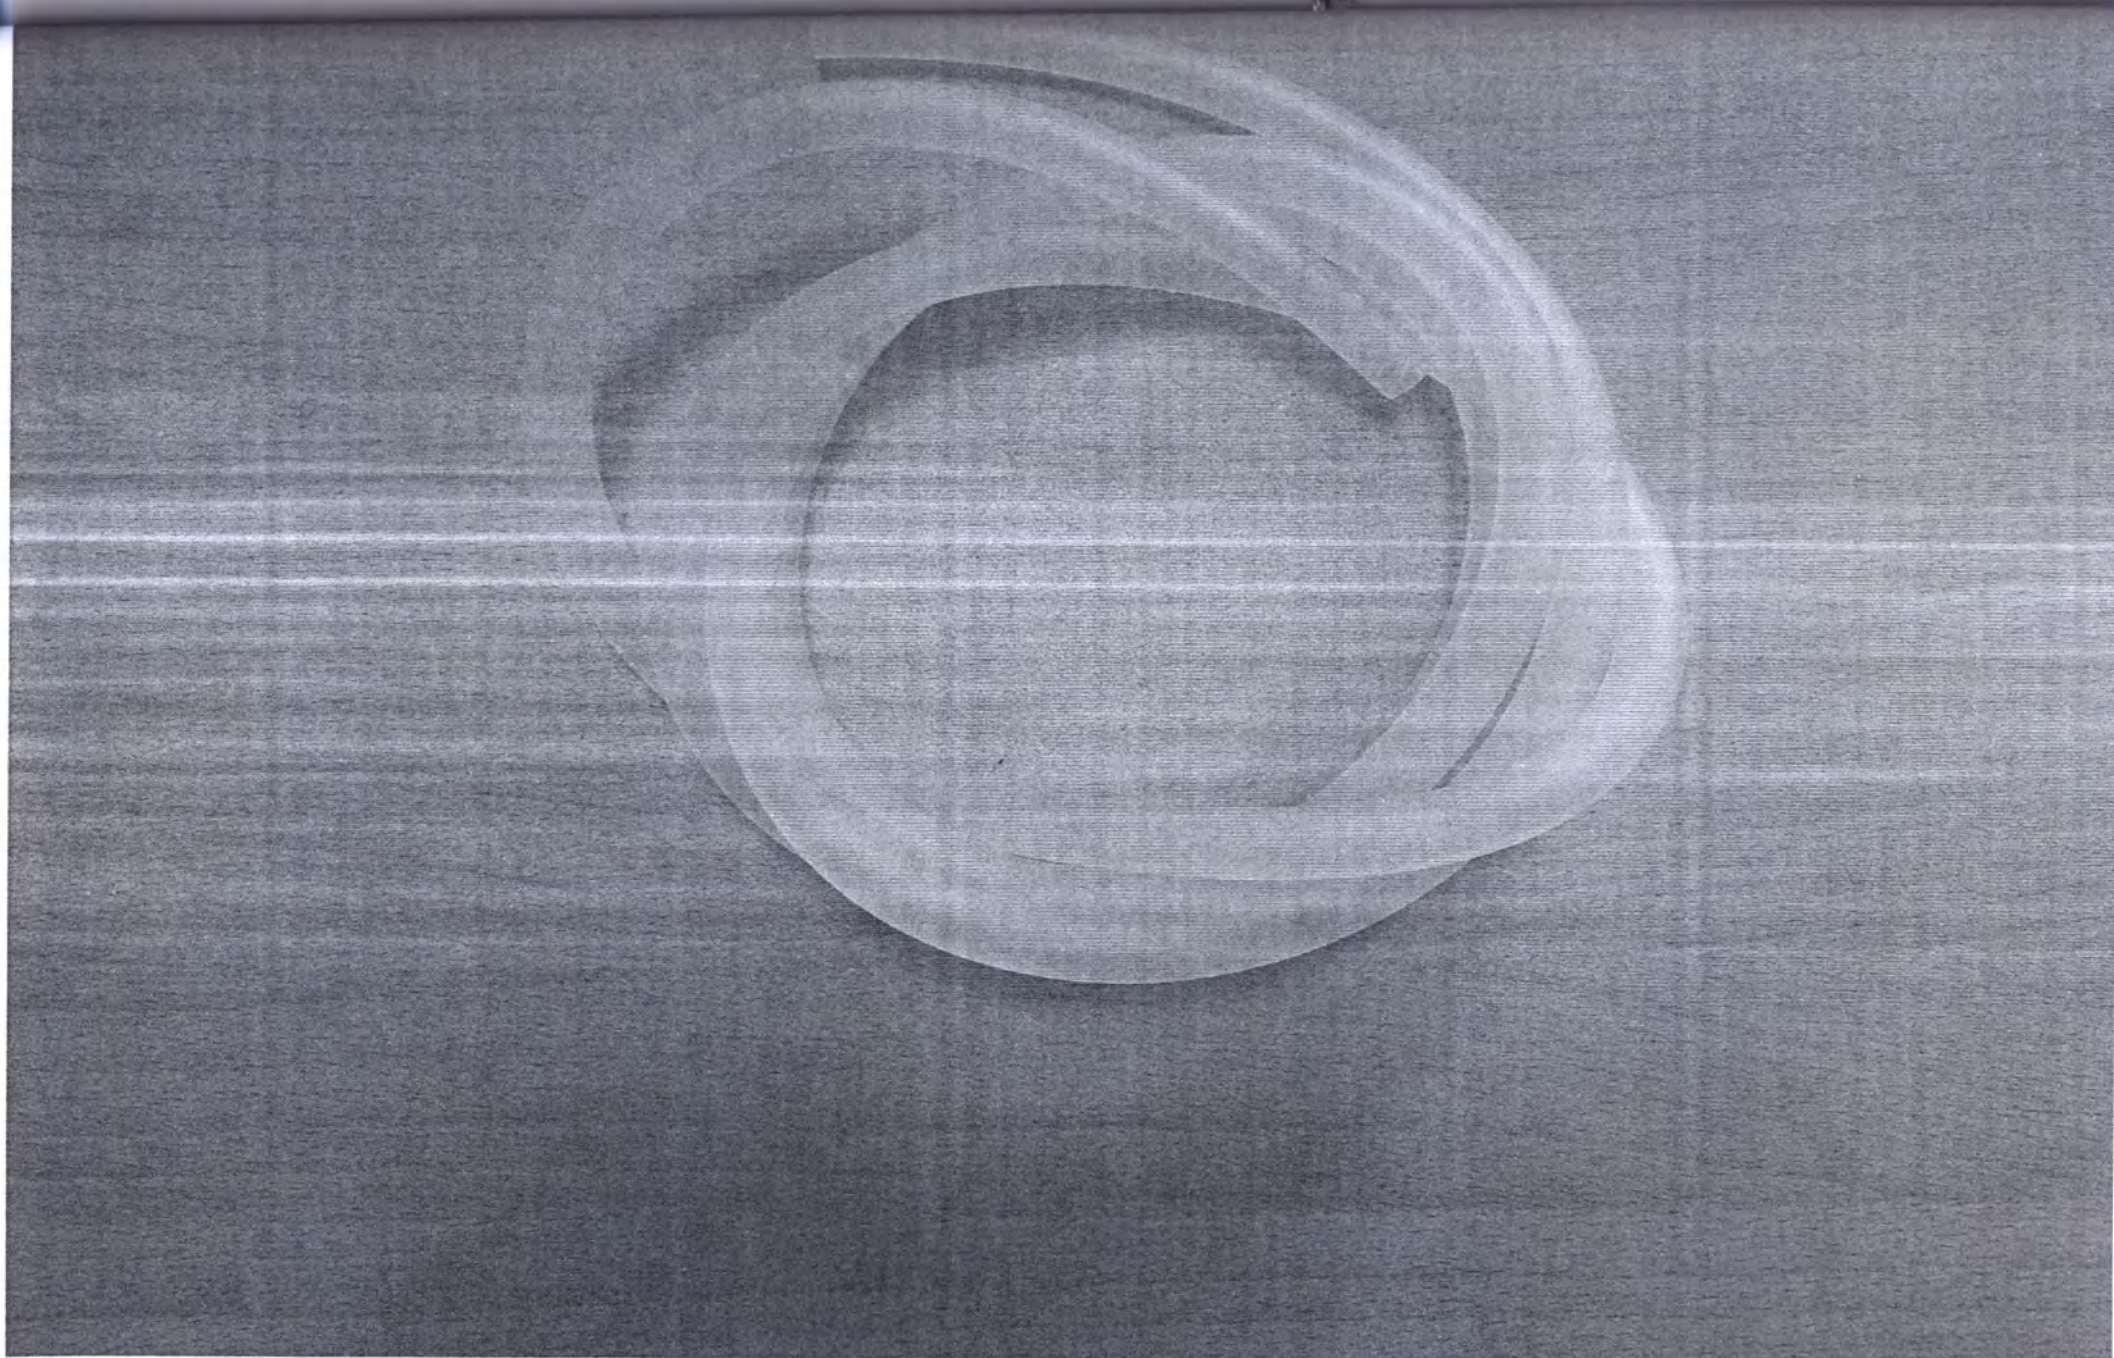


Рис. 50 – Трубка аспирационная

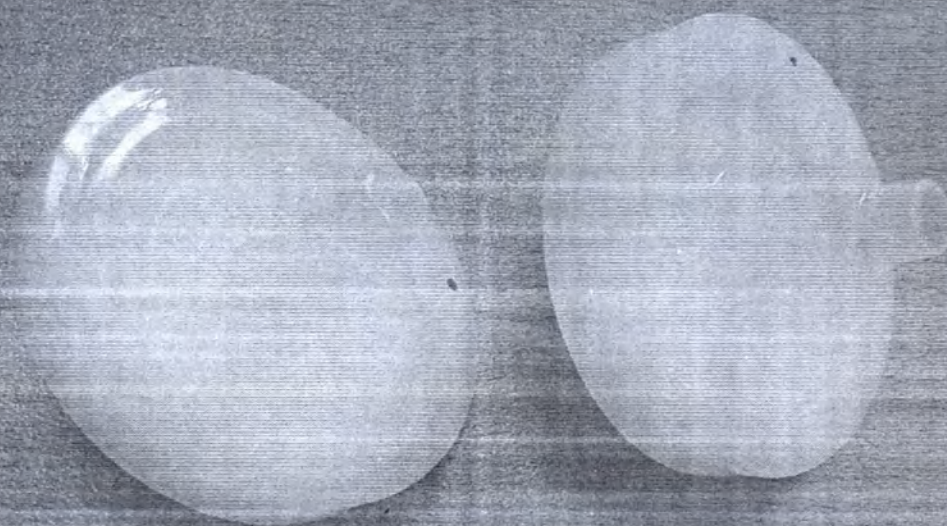


Рис. 51 – Фильтр воздушный (2 шт.)

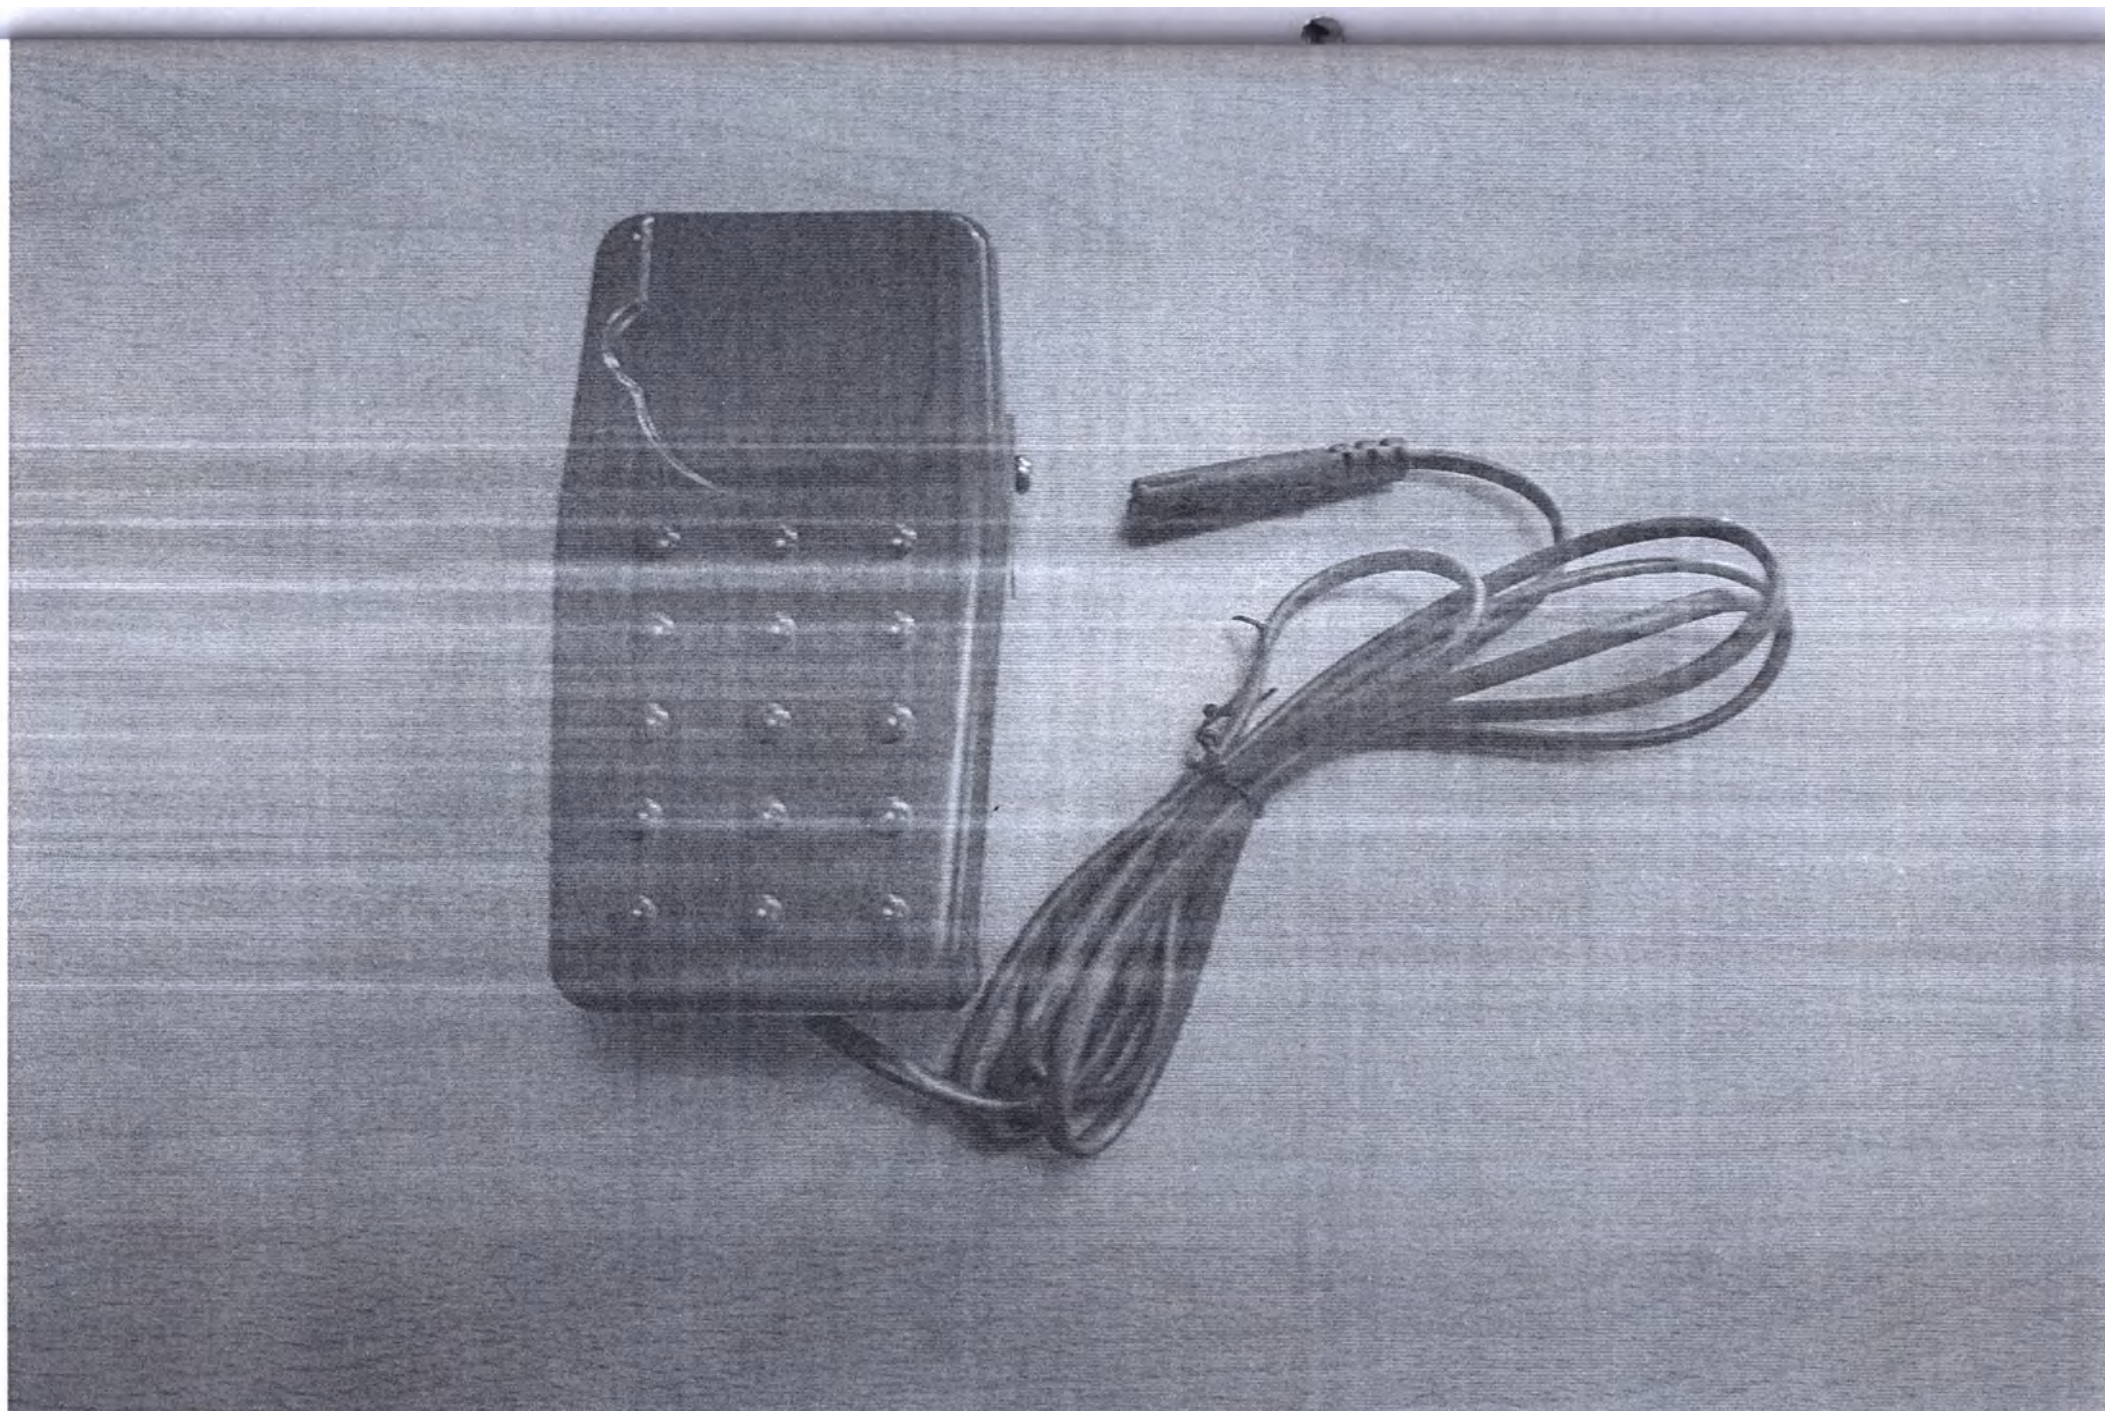


Рис. 52 – Педальный ножной выключатель

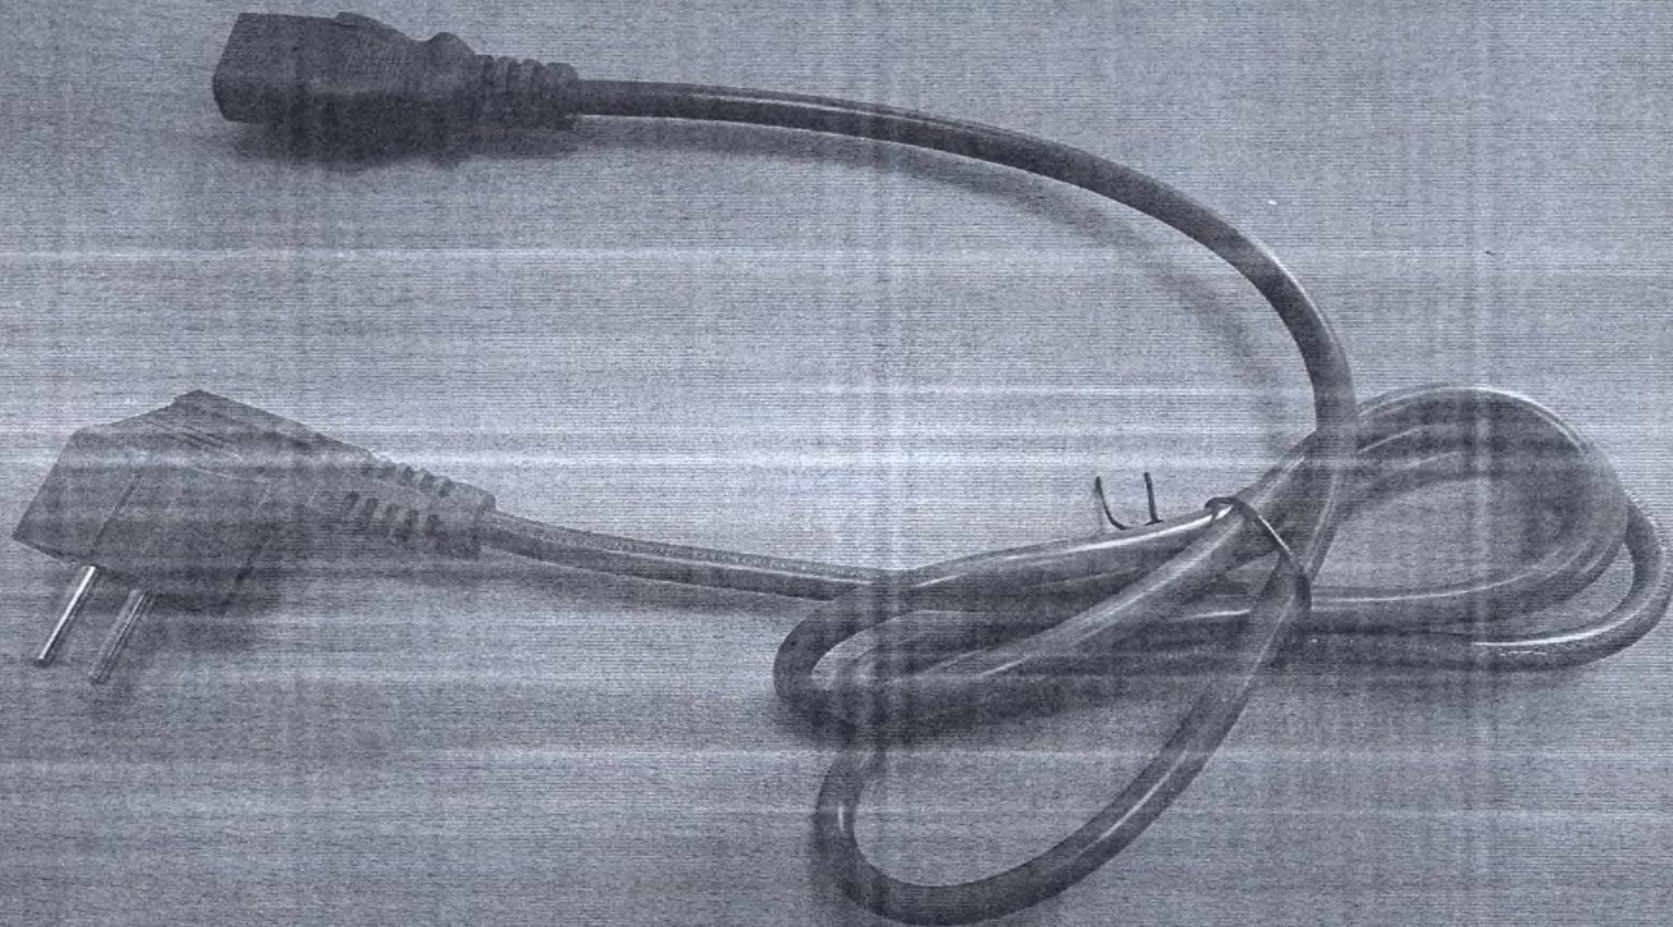


Рис. 53 – Шнур питания

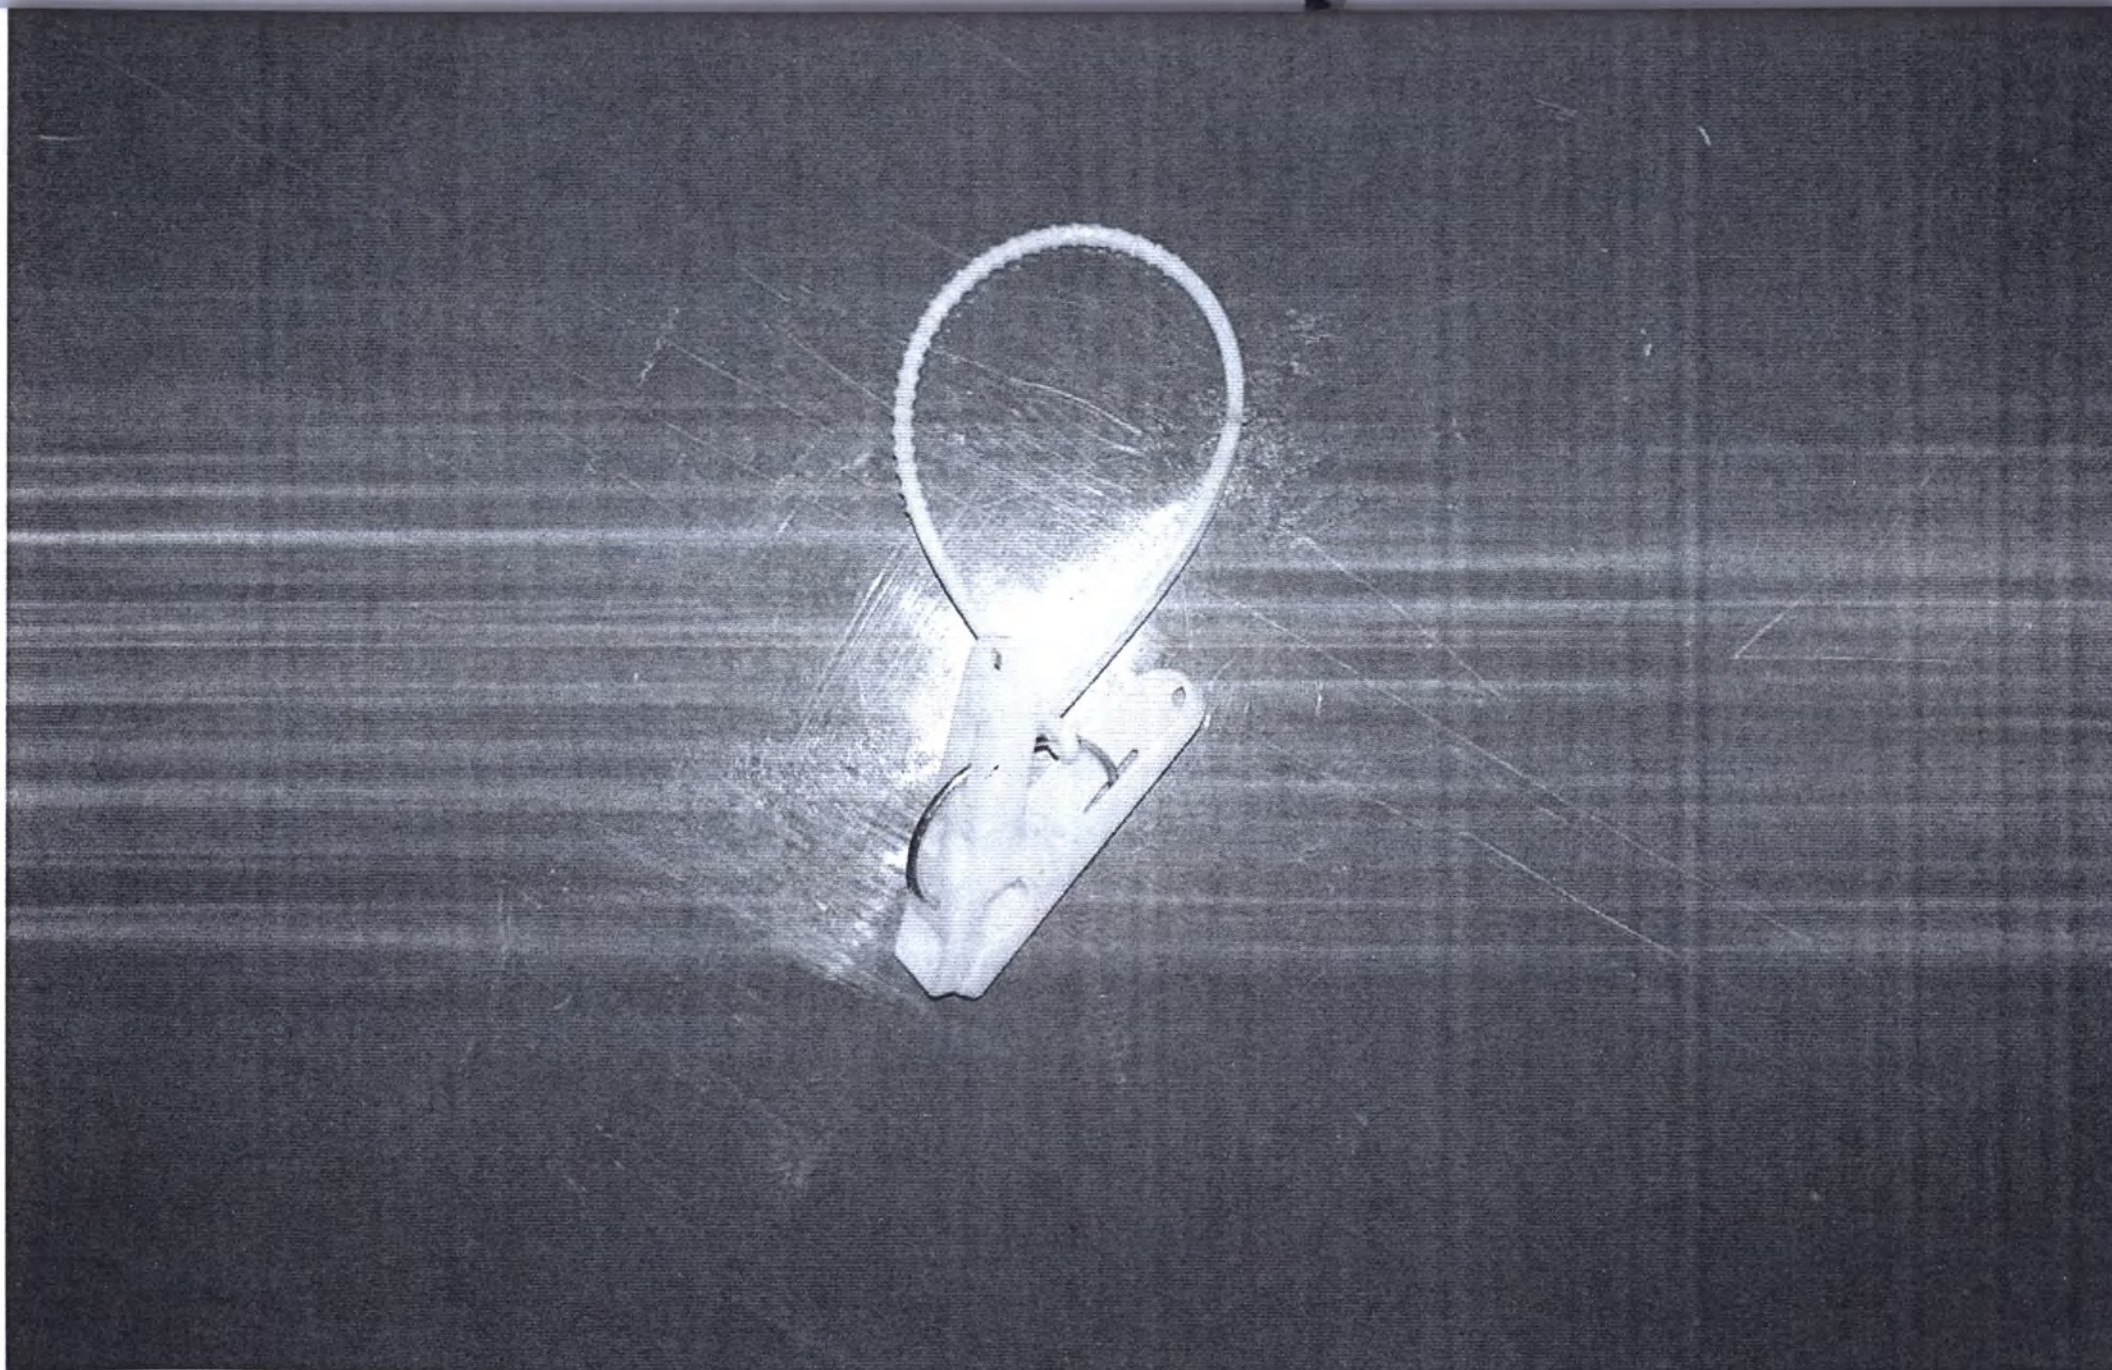


Рис. 54 – Зажим





Рис. 55 – Предохранитель плавкий 2А (2 шт.)

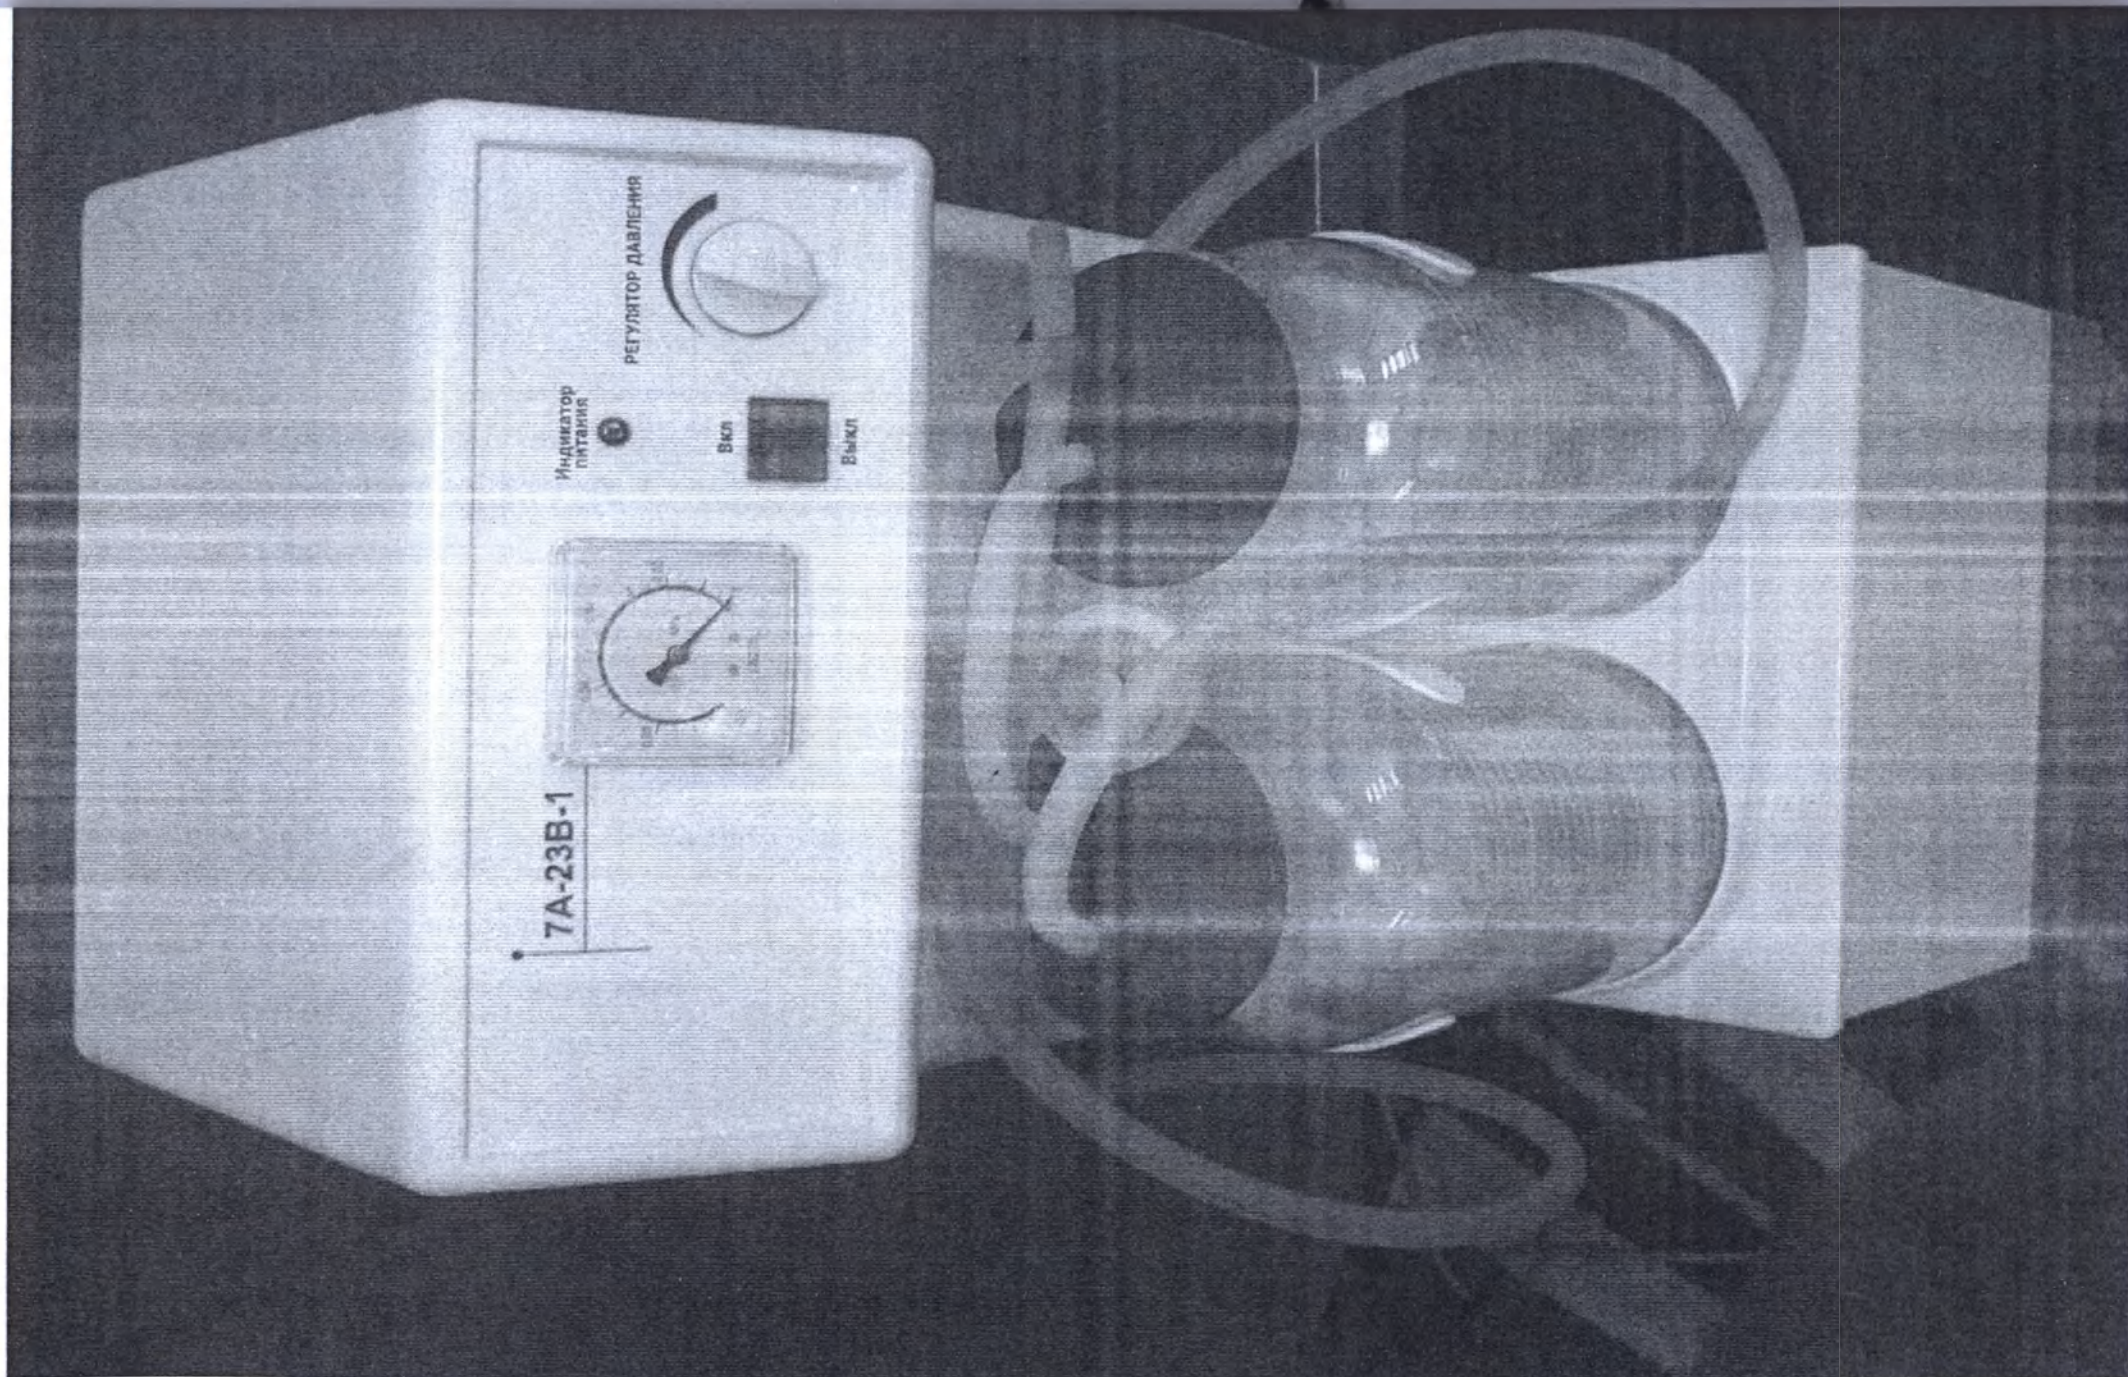

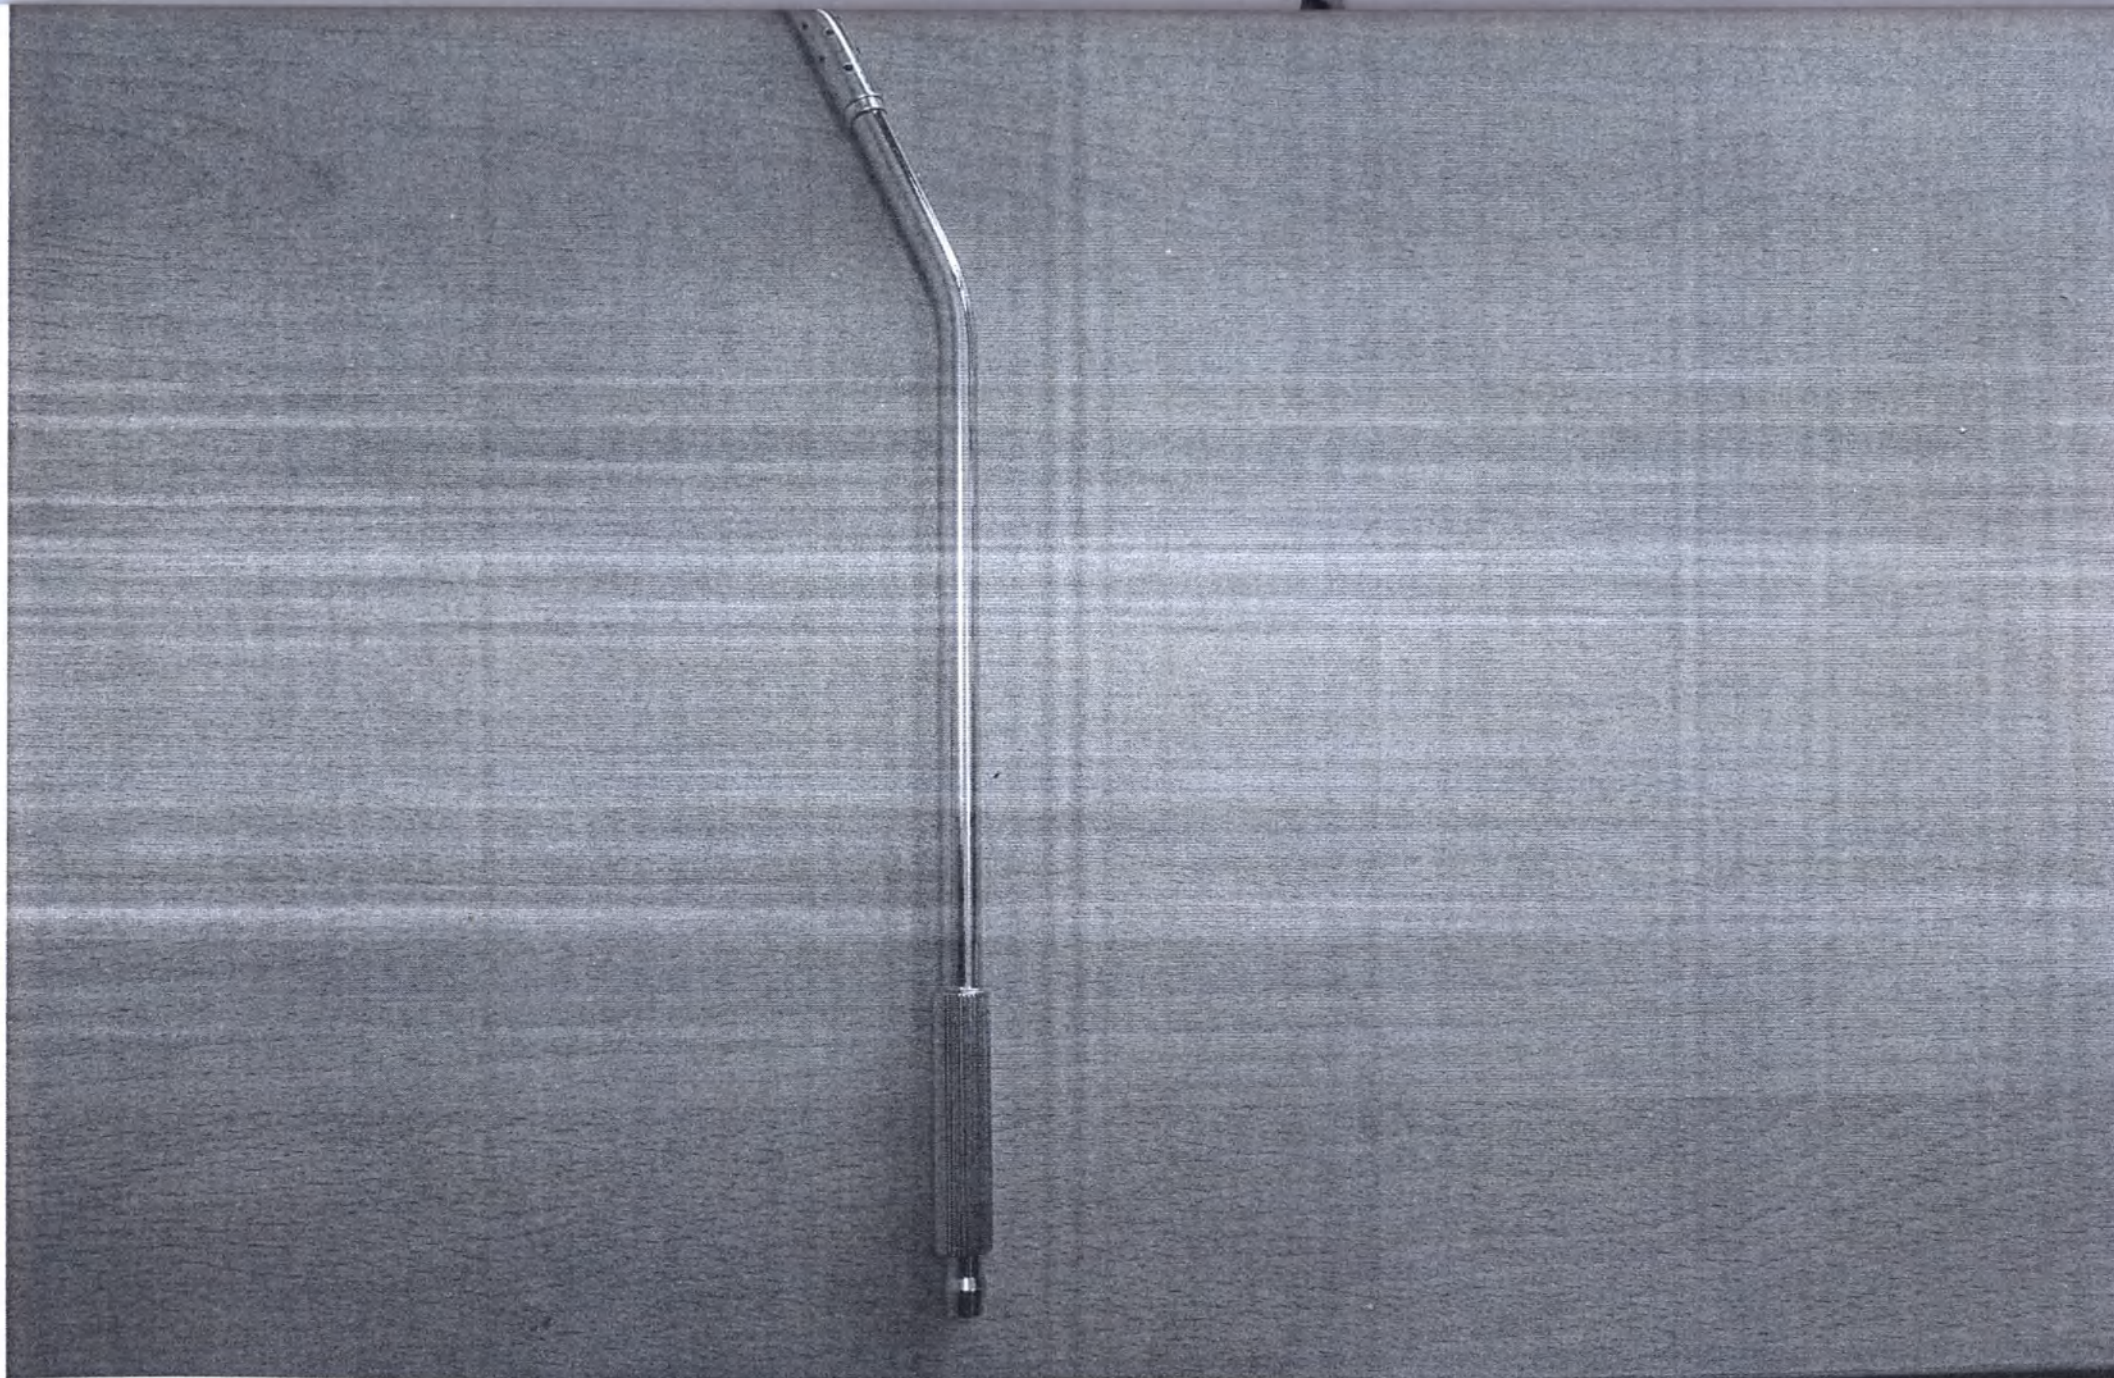


Рис. 57 – Наконечник для отсасывания

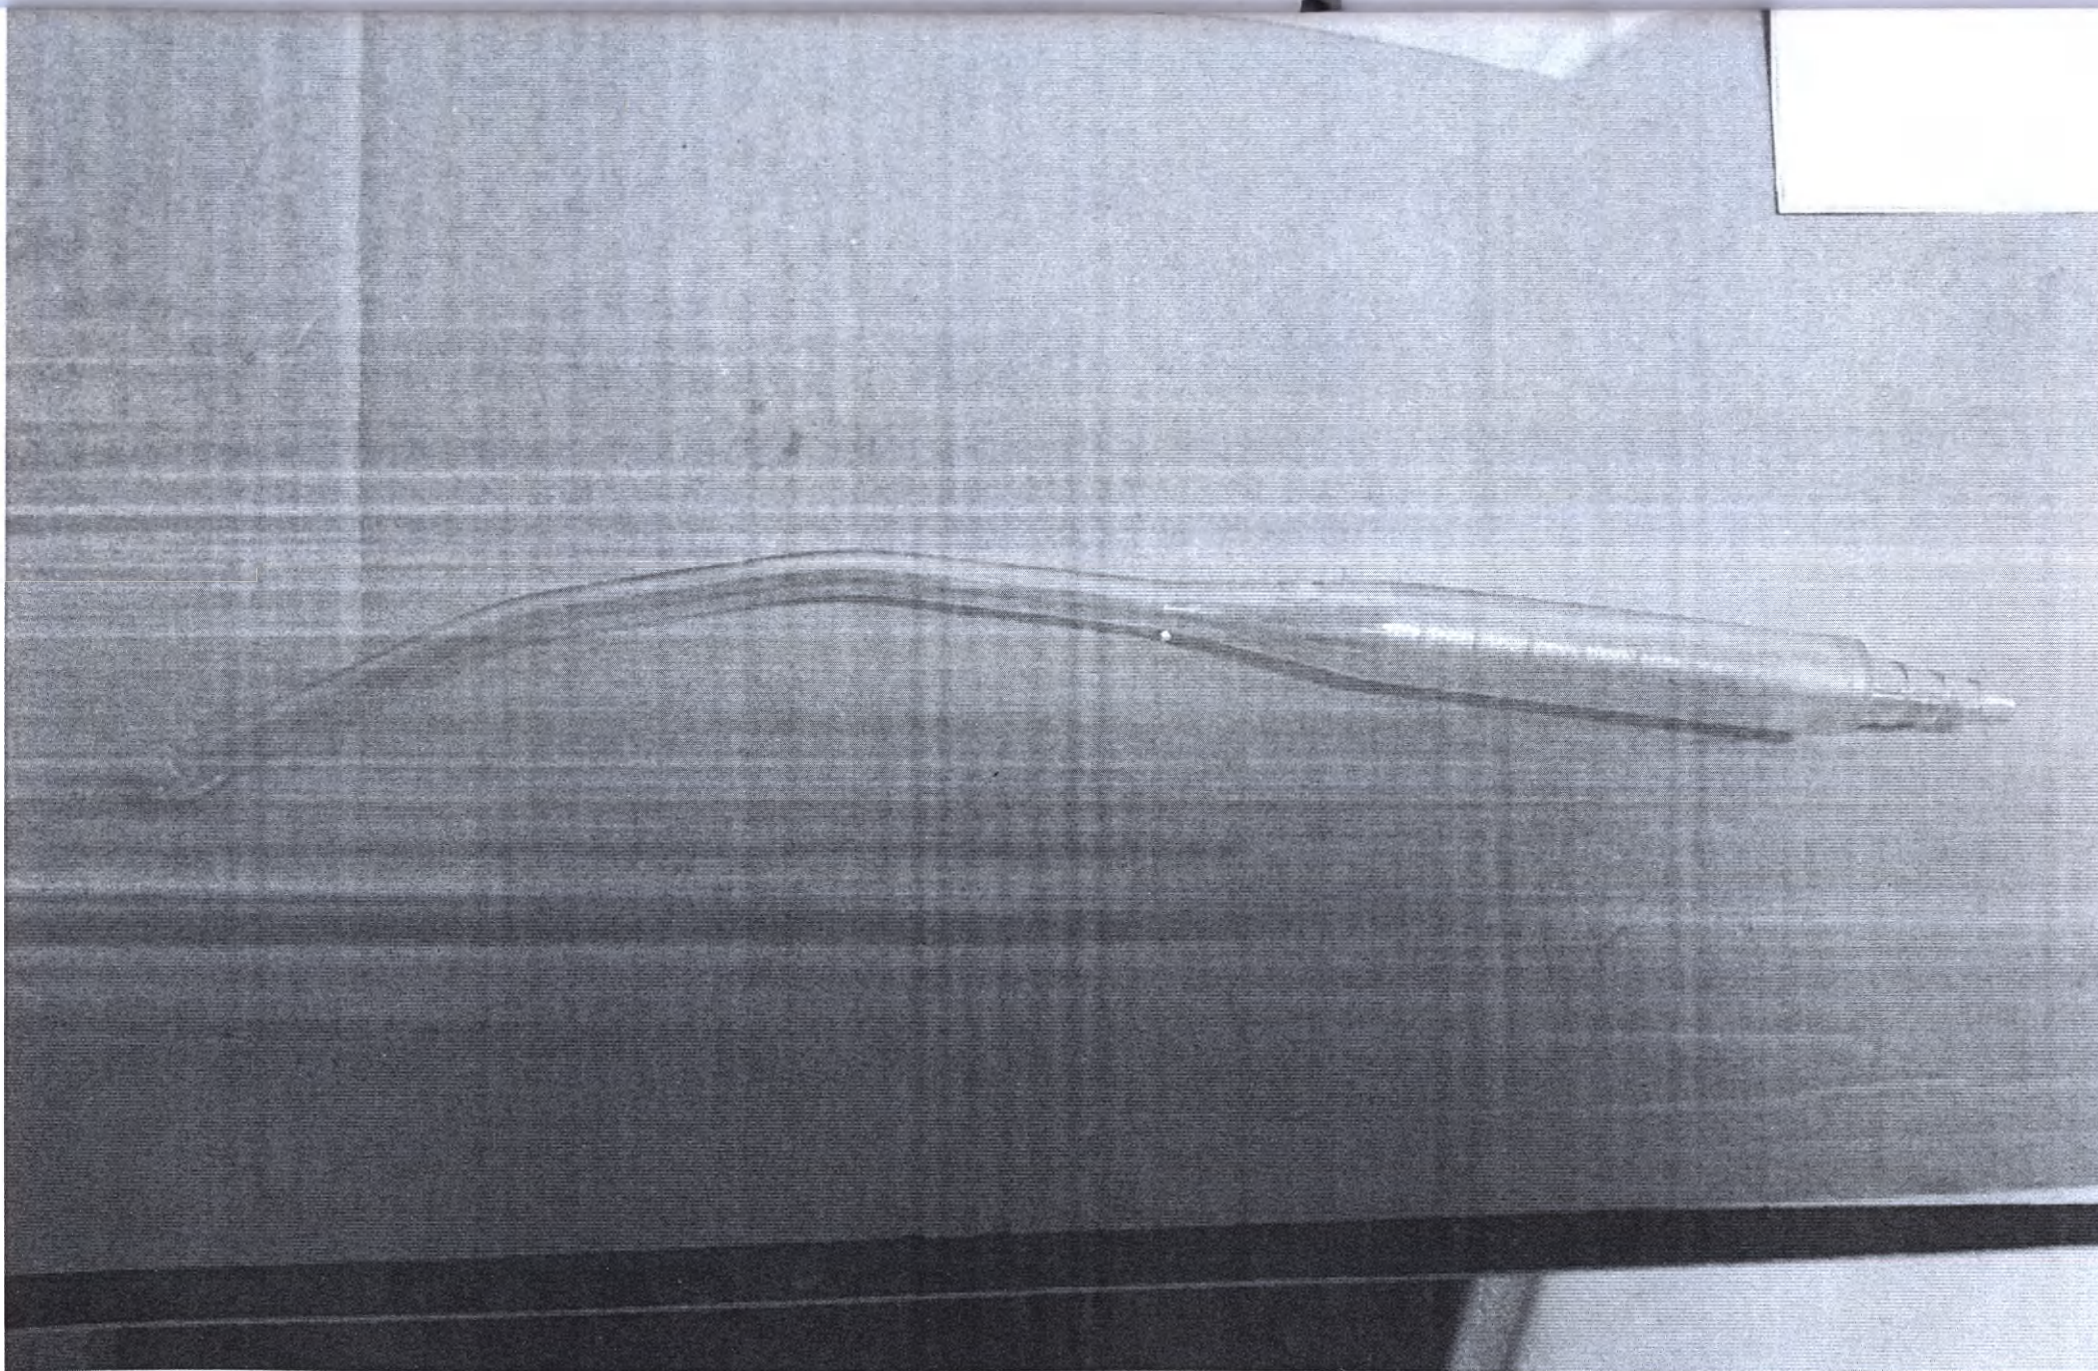


Рис. 58 – Трубка для отсасывания (по требованию)

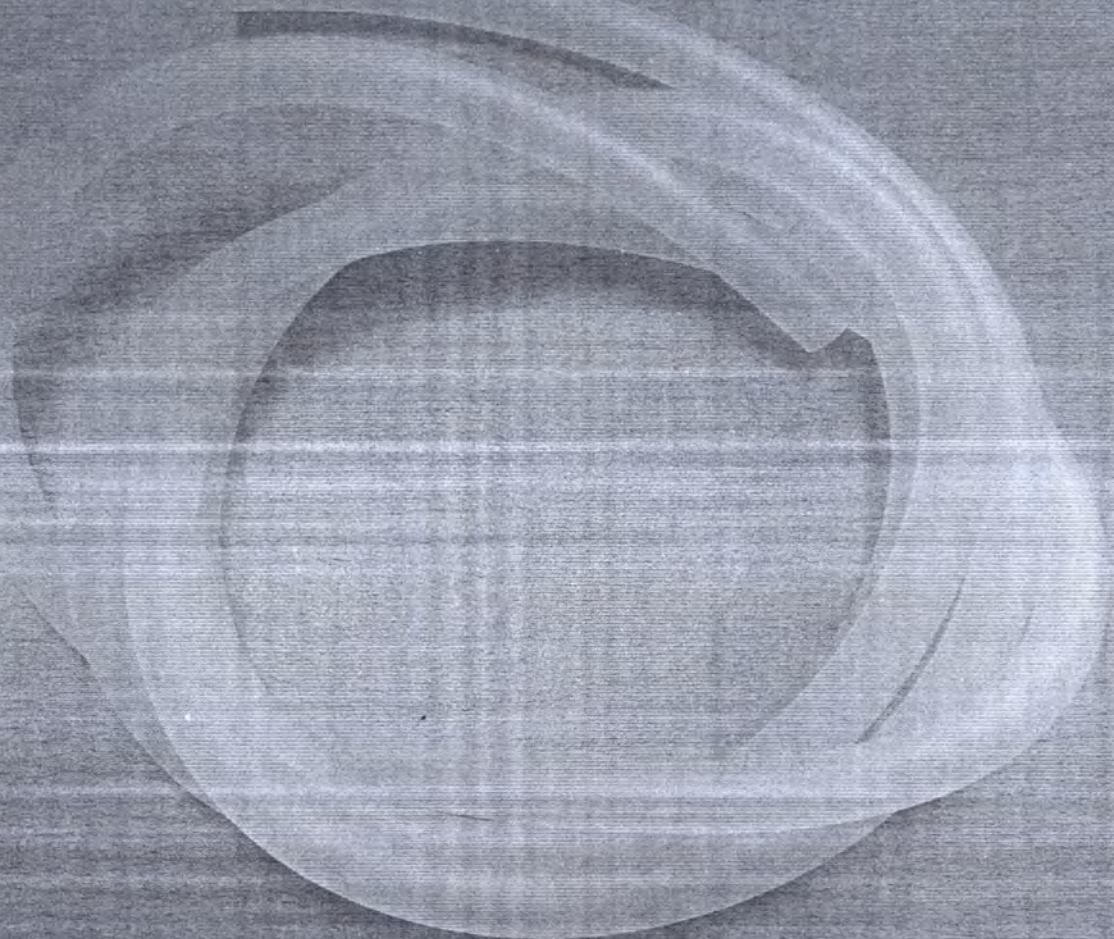


Рис. 59 – Трубка аспирационная

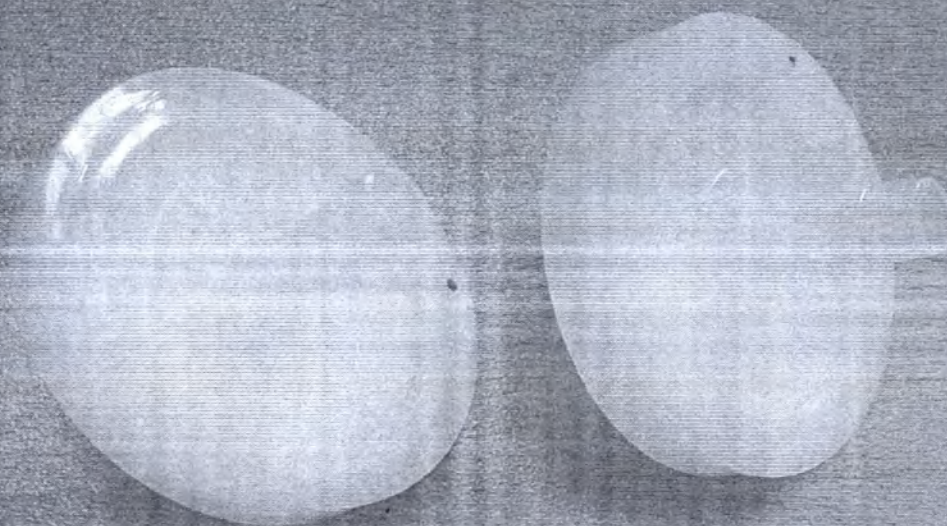


Рис. 60 – Фильтр воздушный (2 шт.)

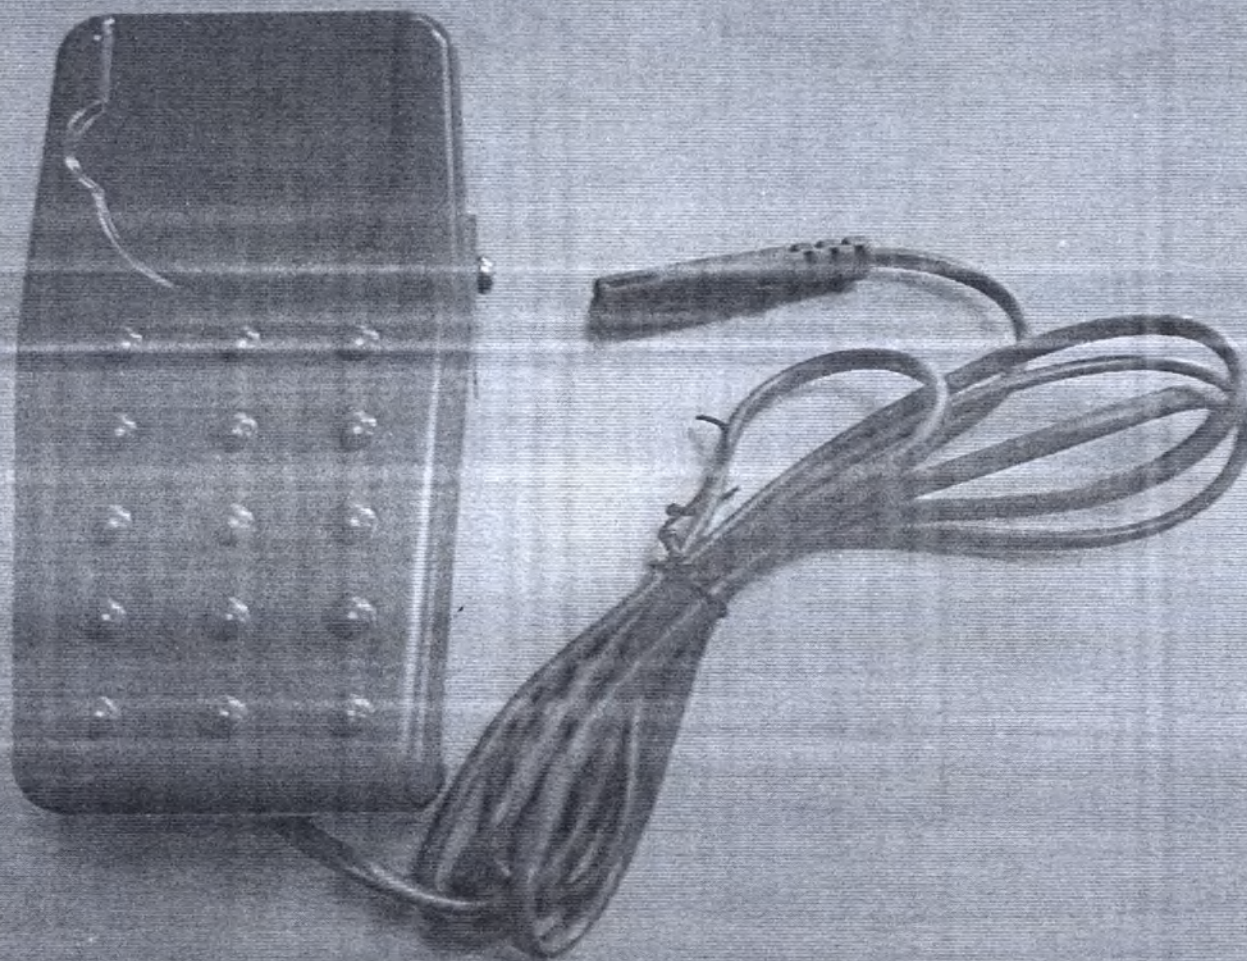


Рис. 61 – Педальный ножной выключатель

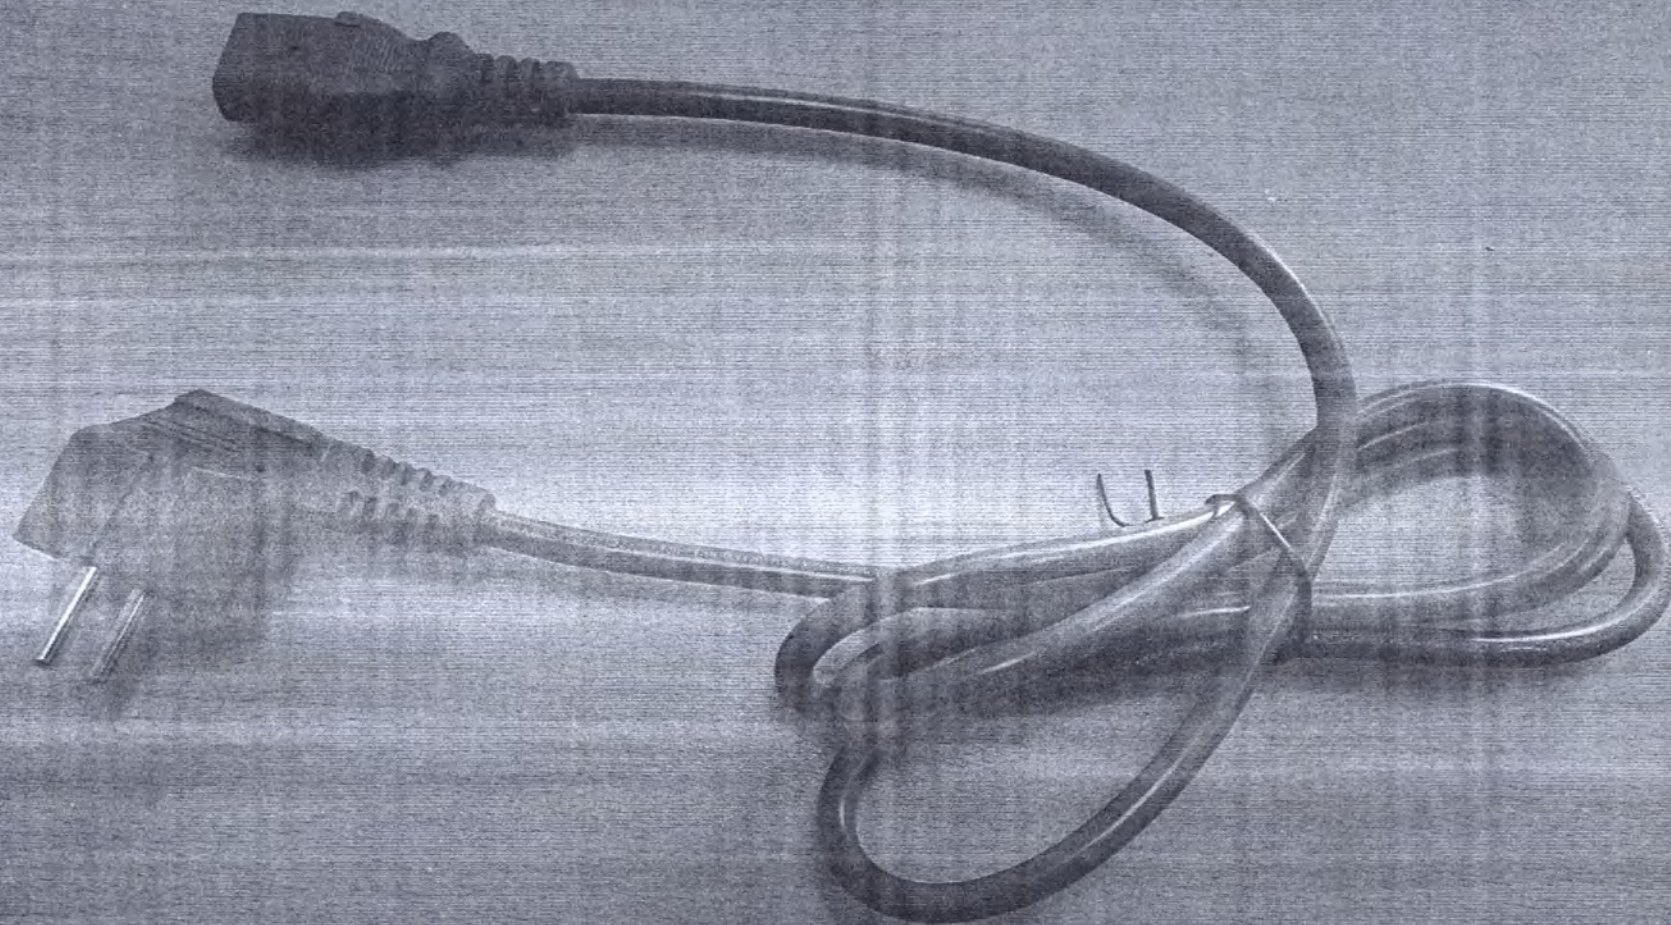


Рис. 62 – Шнур питания



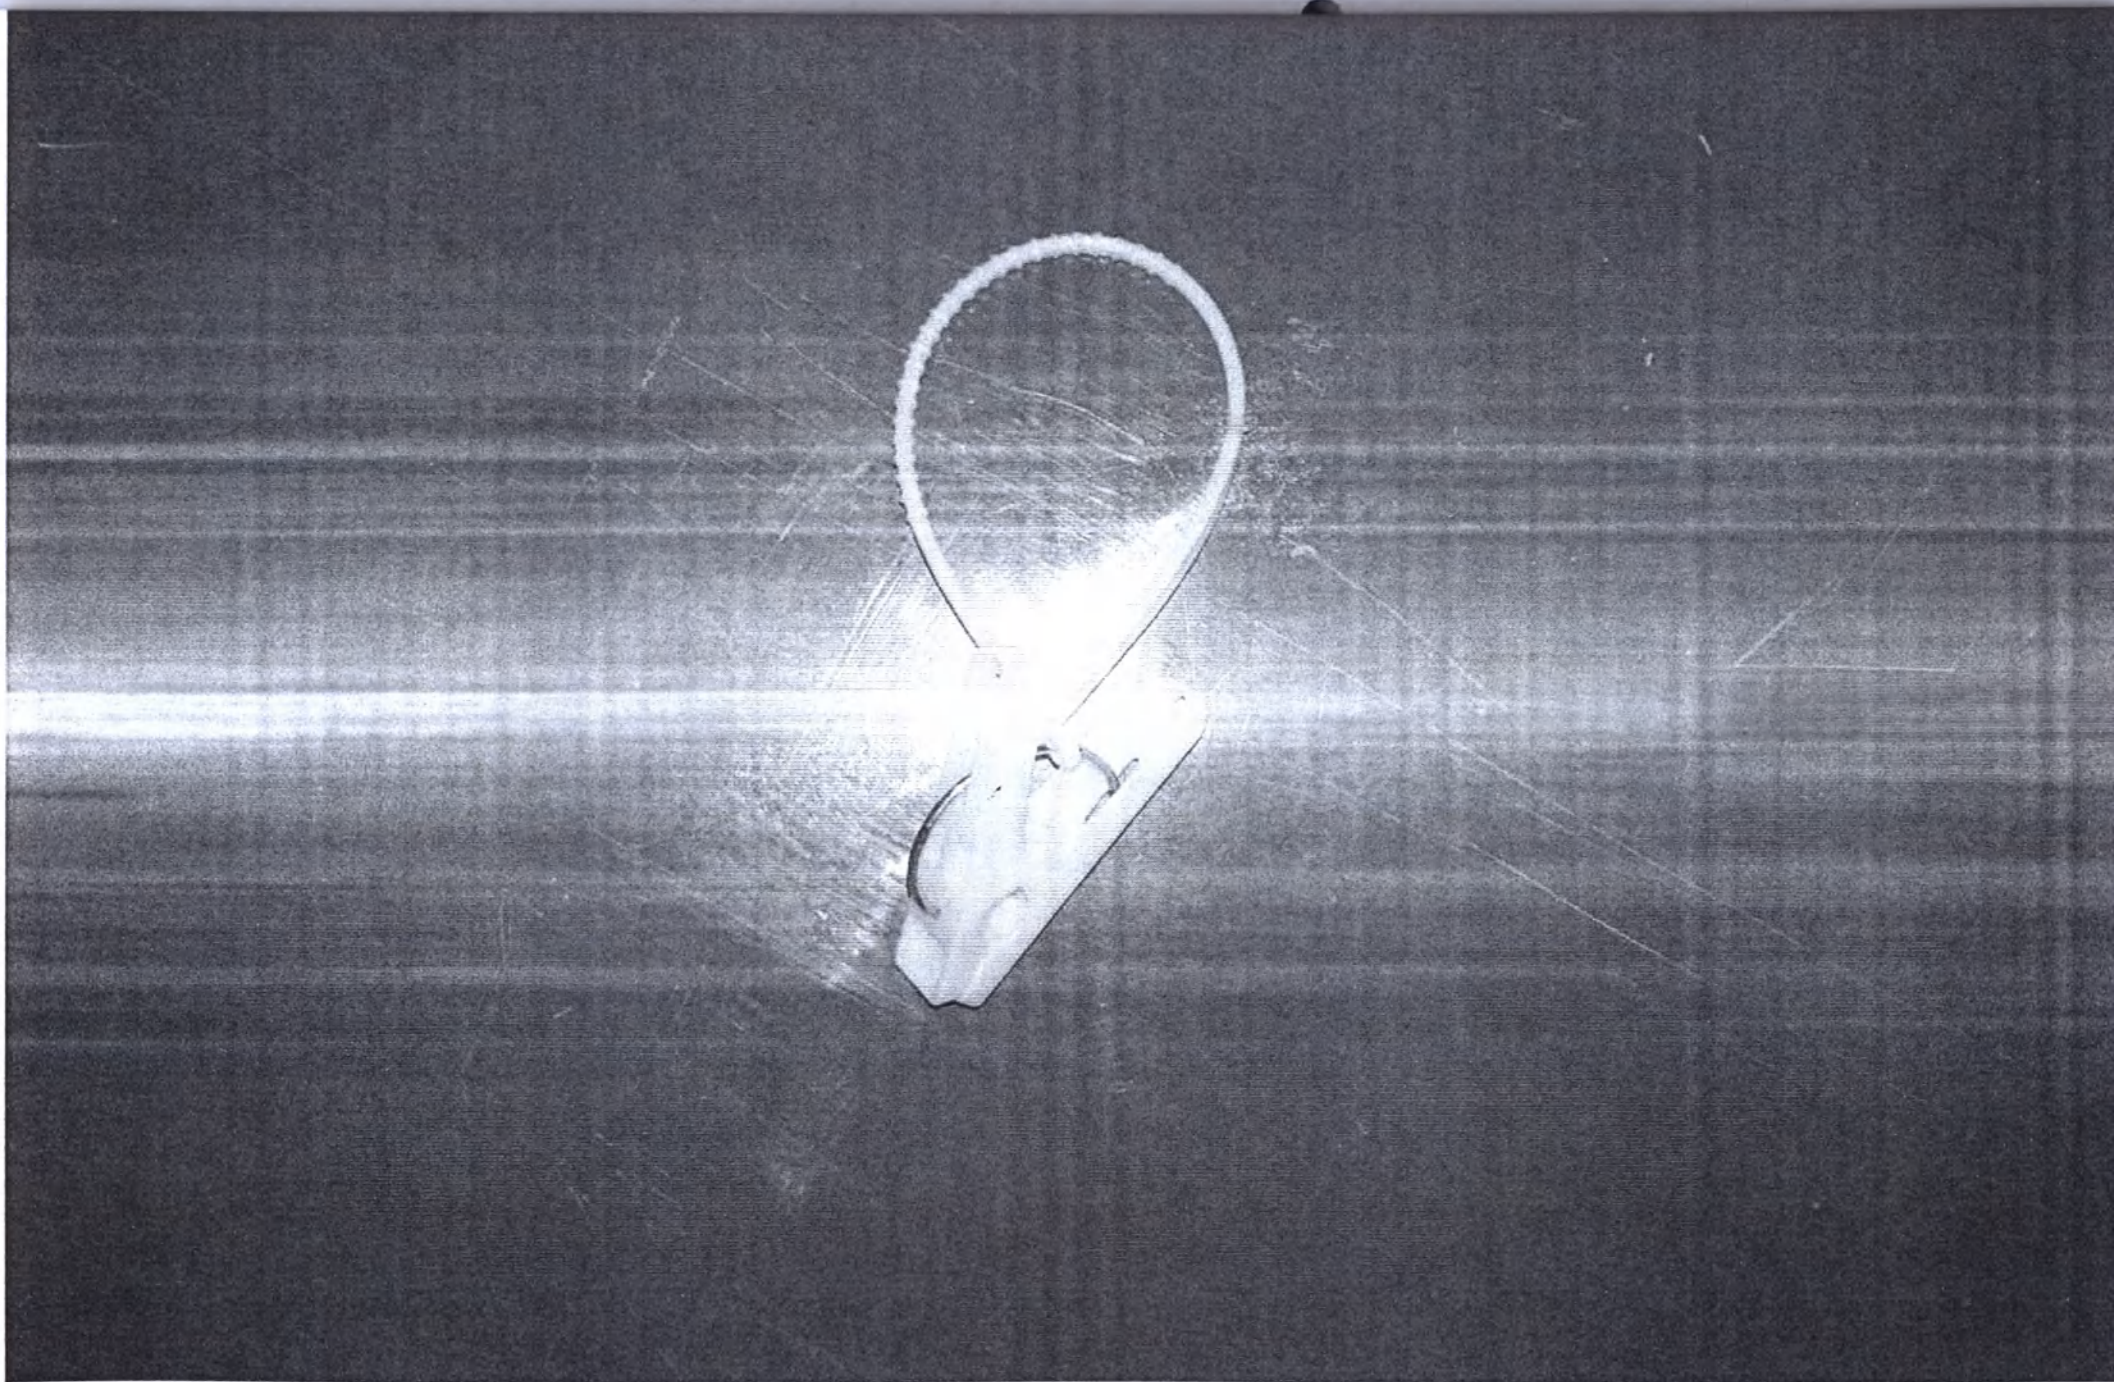


Рис. 63 – Зажим

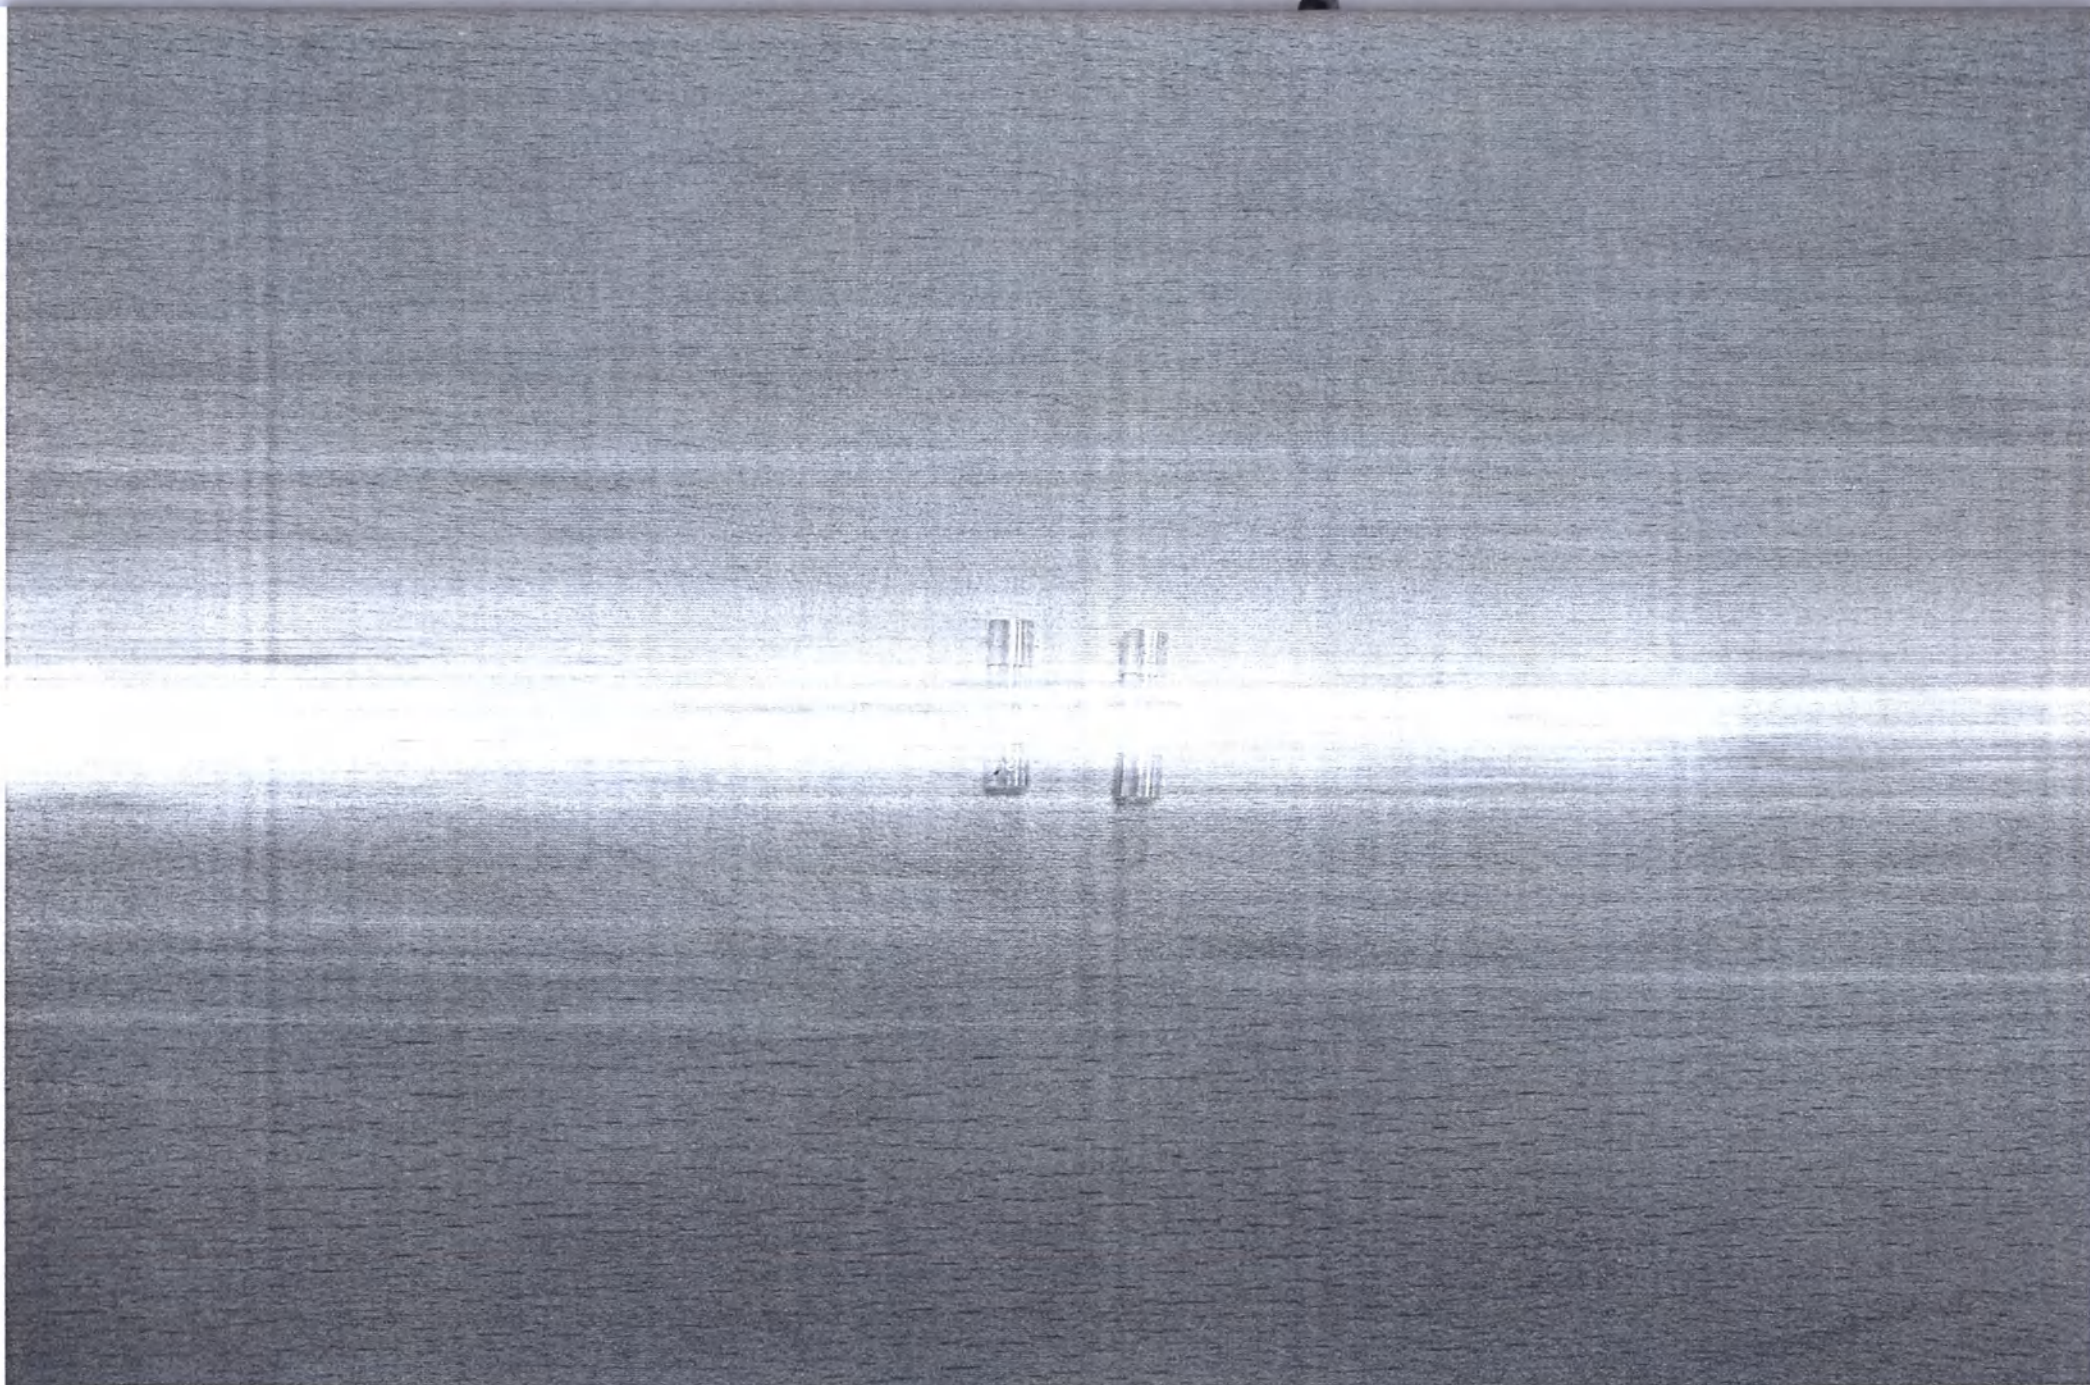

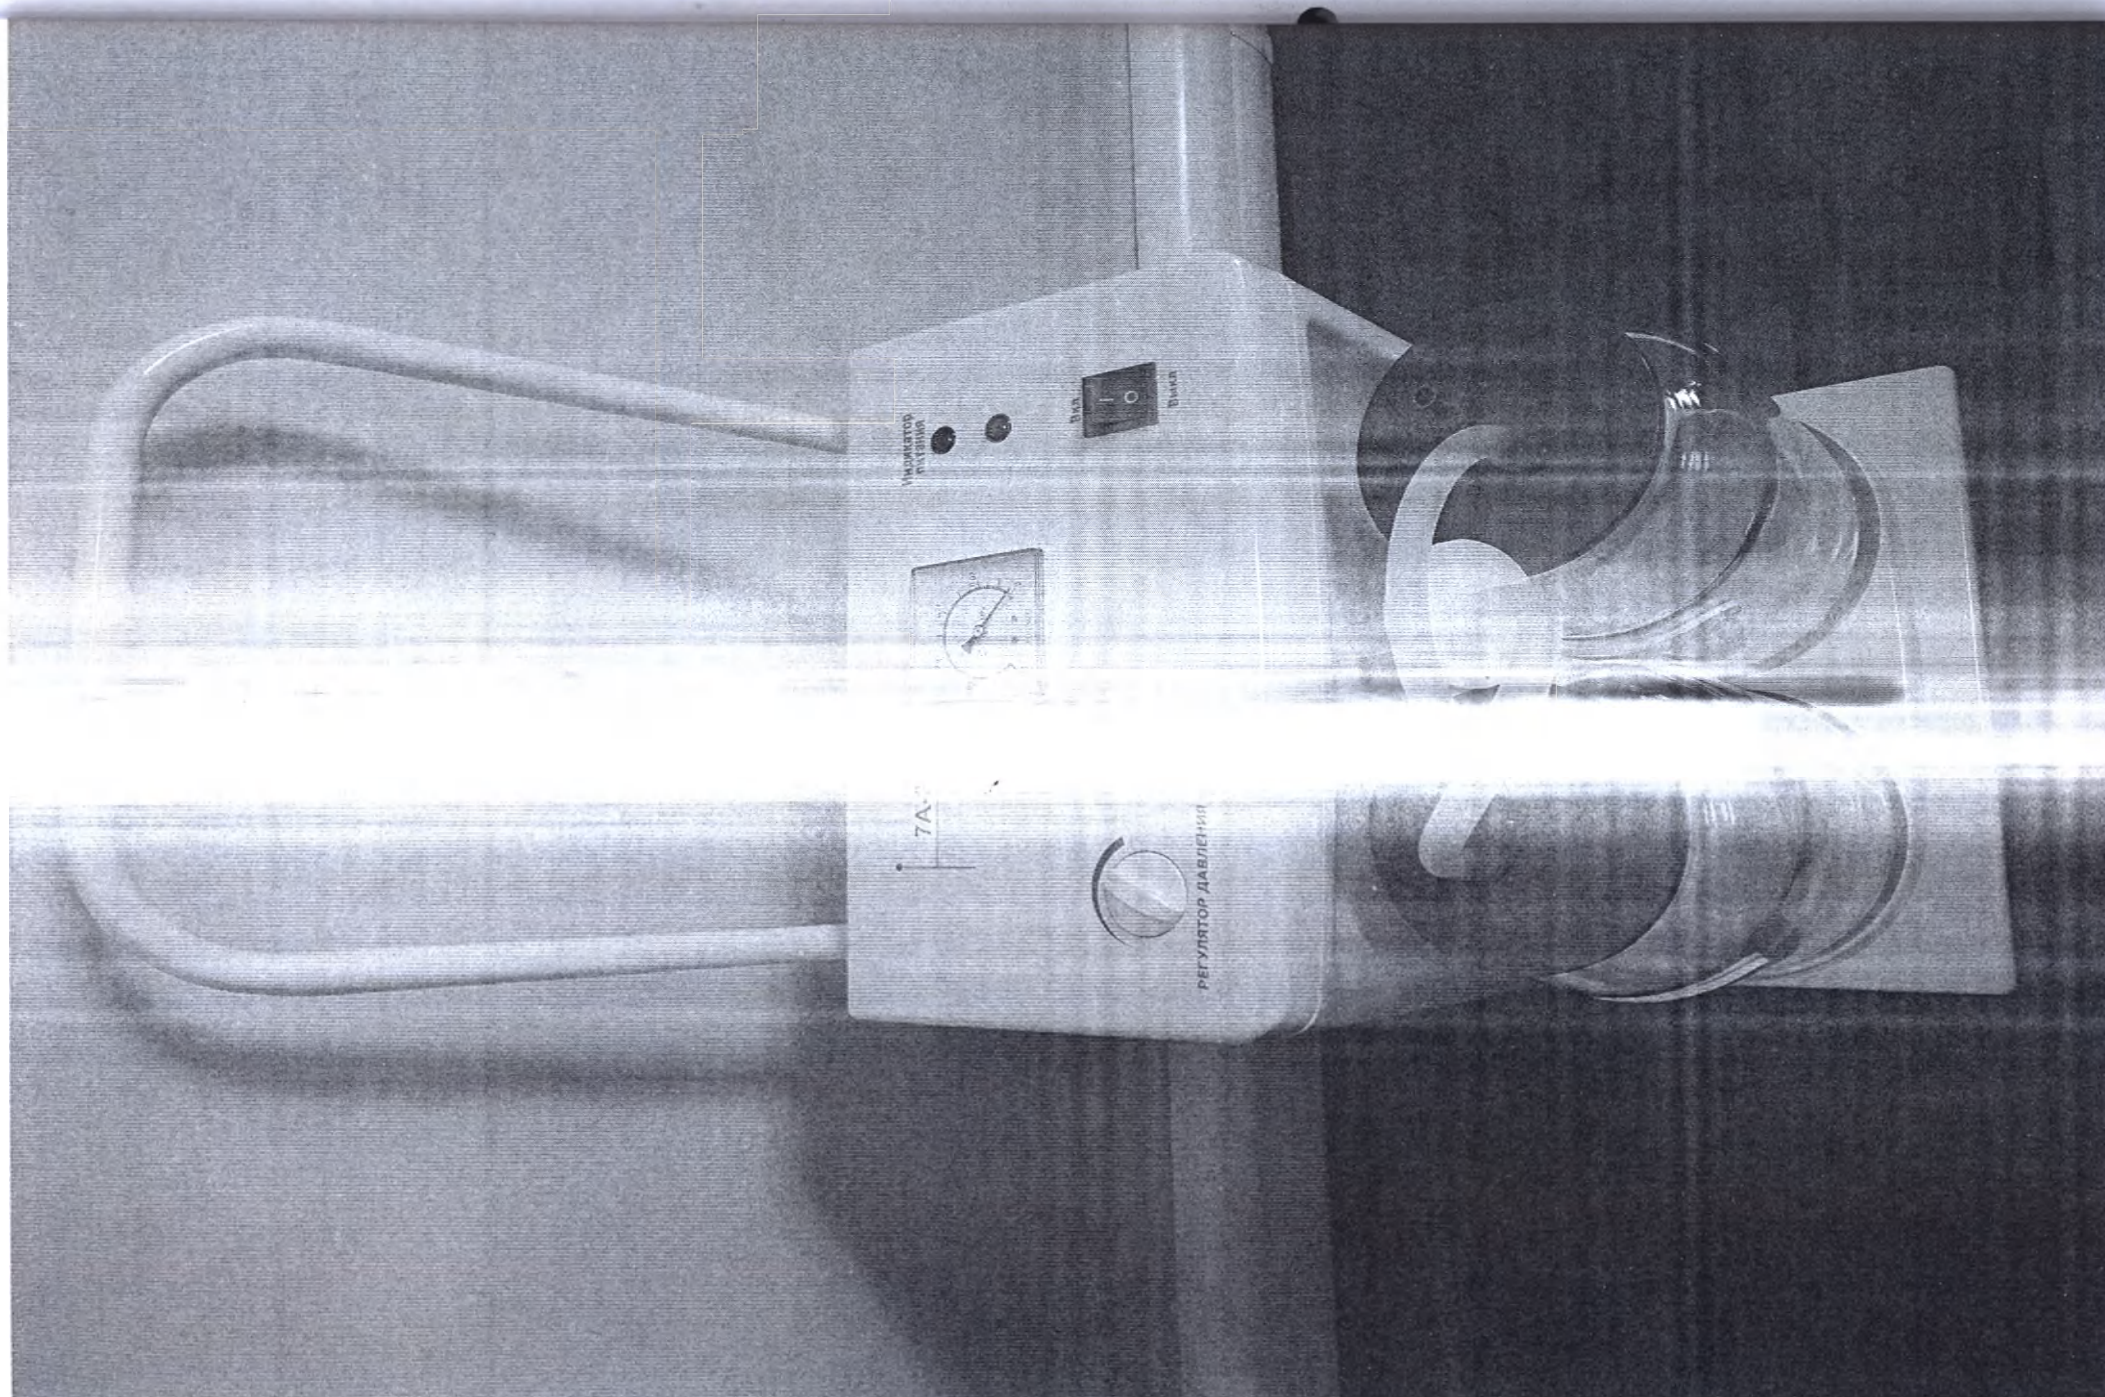

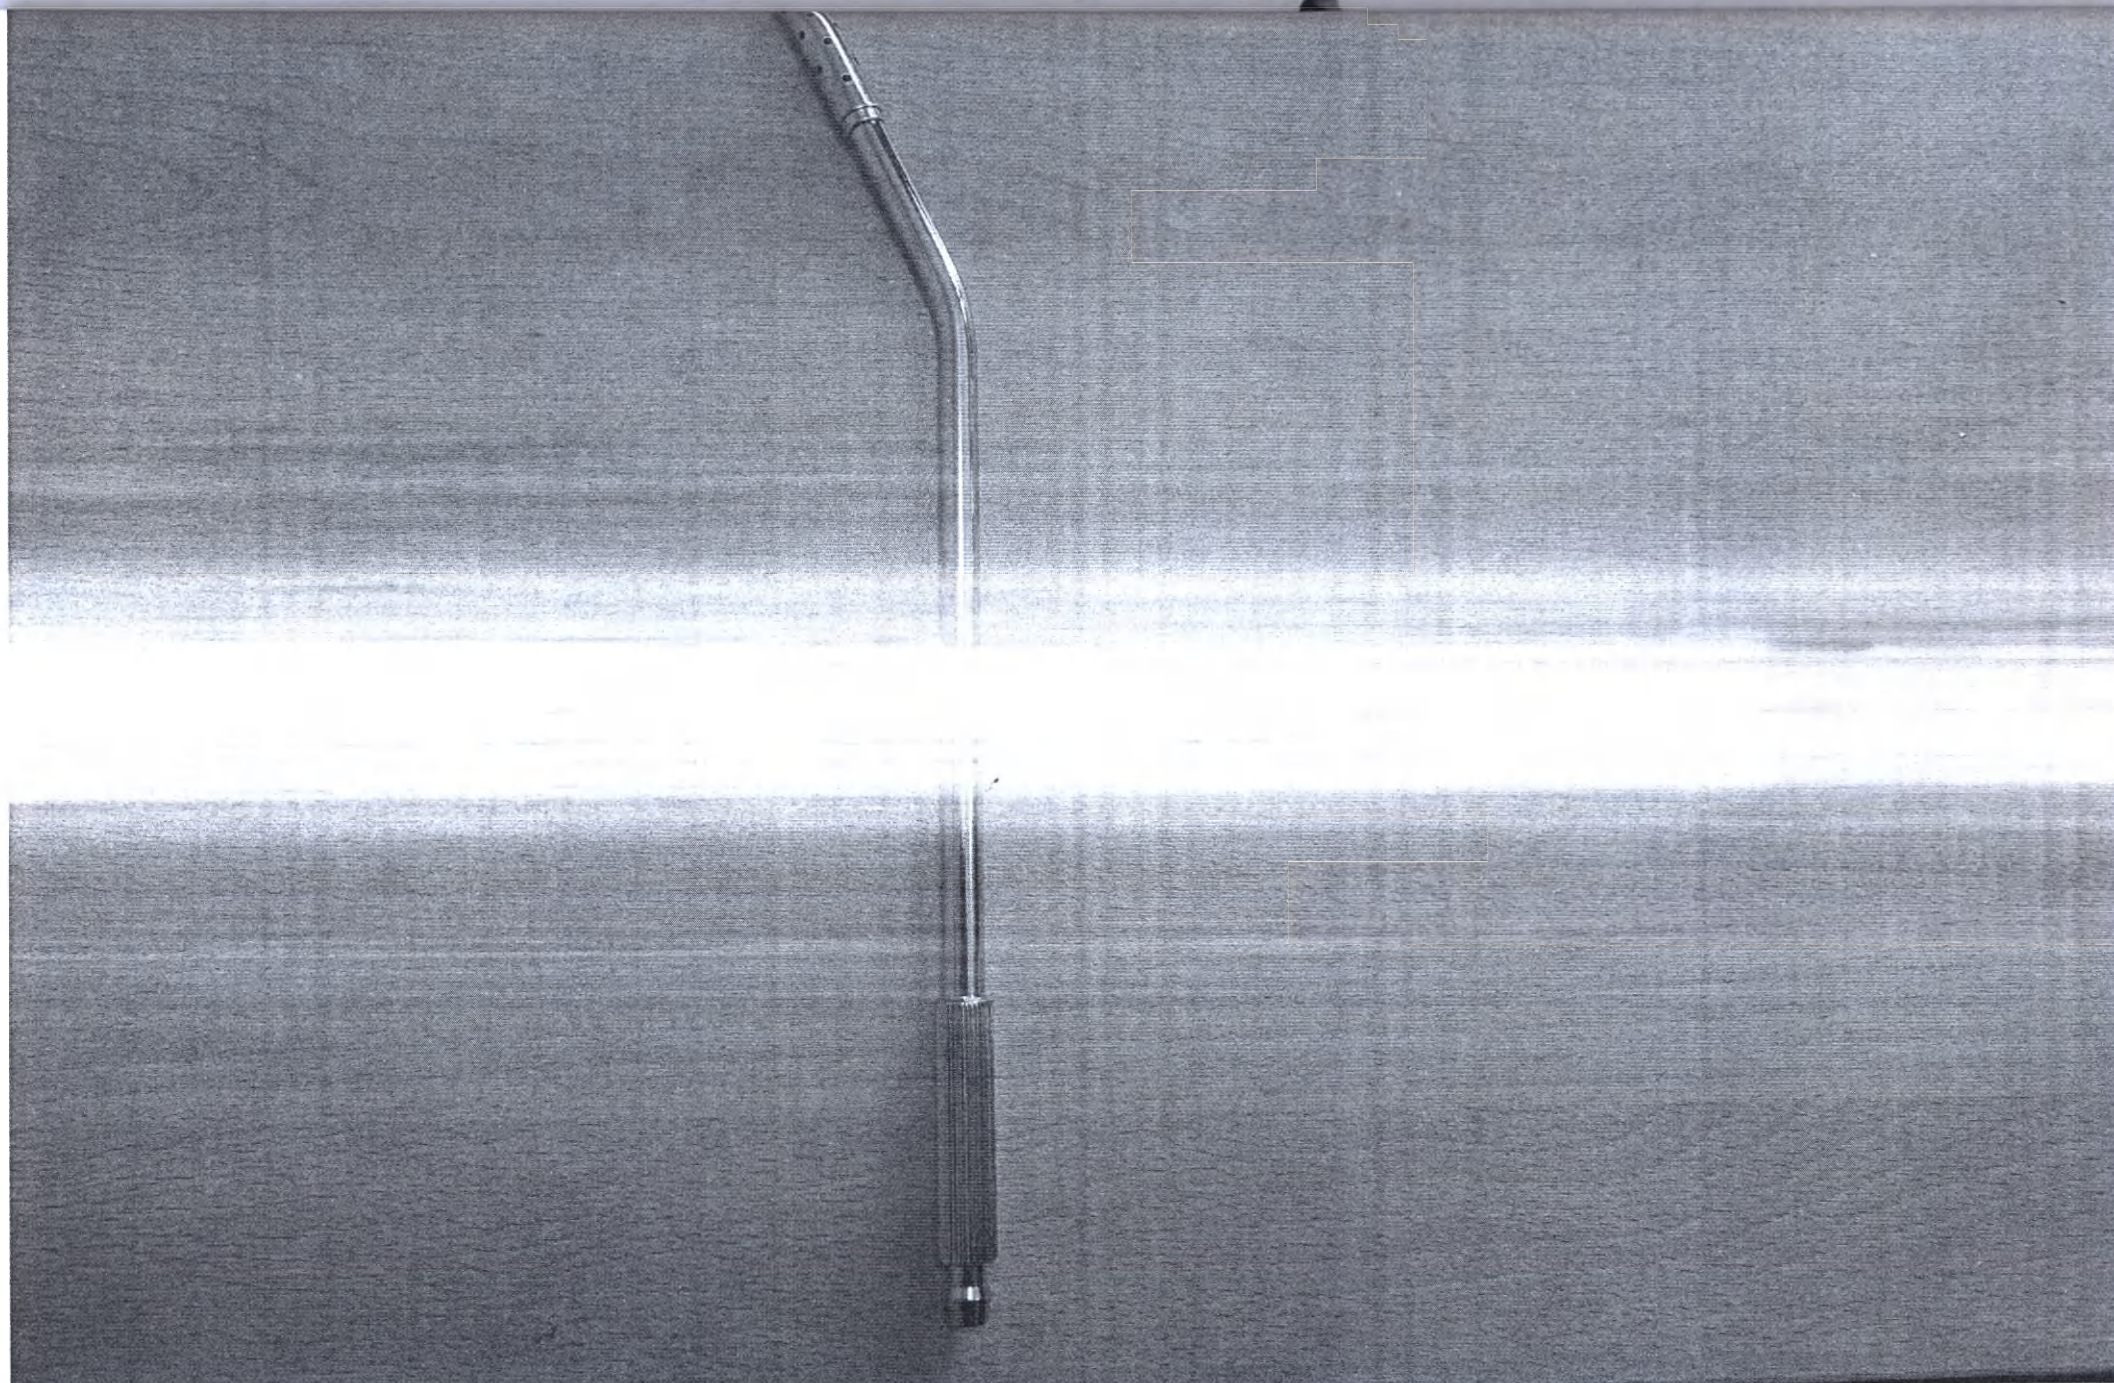


Рис. 66 – Наконечник для отсасывания

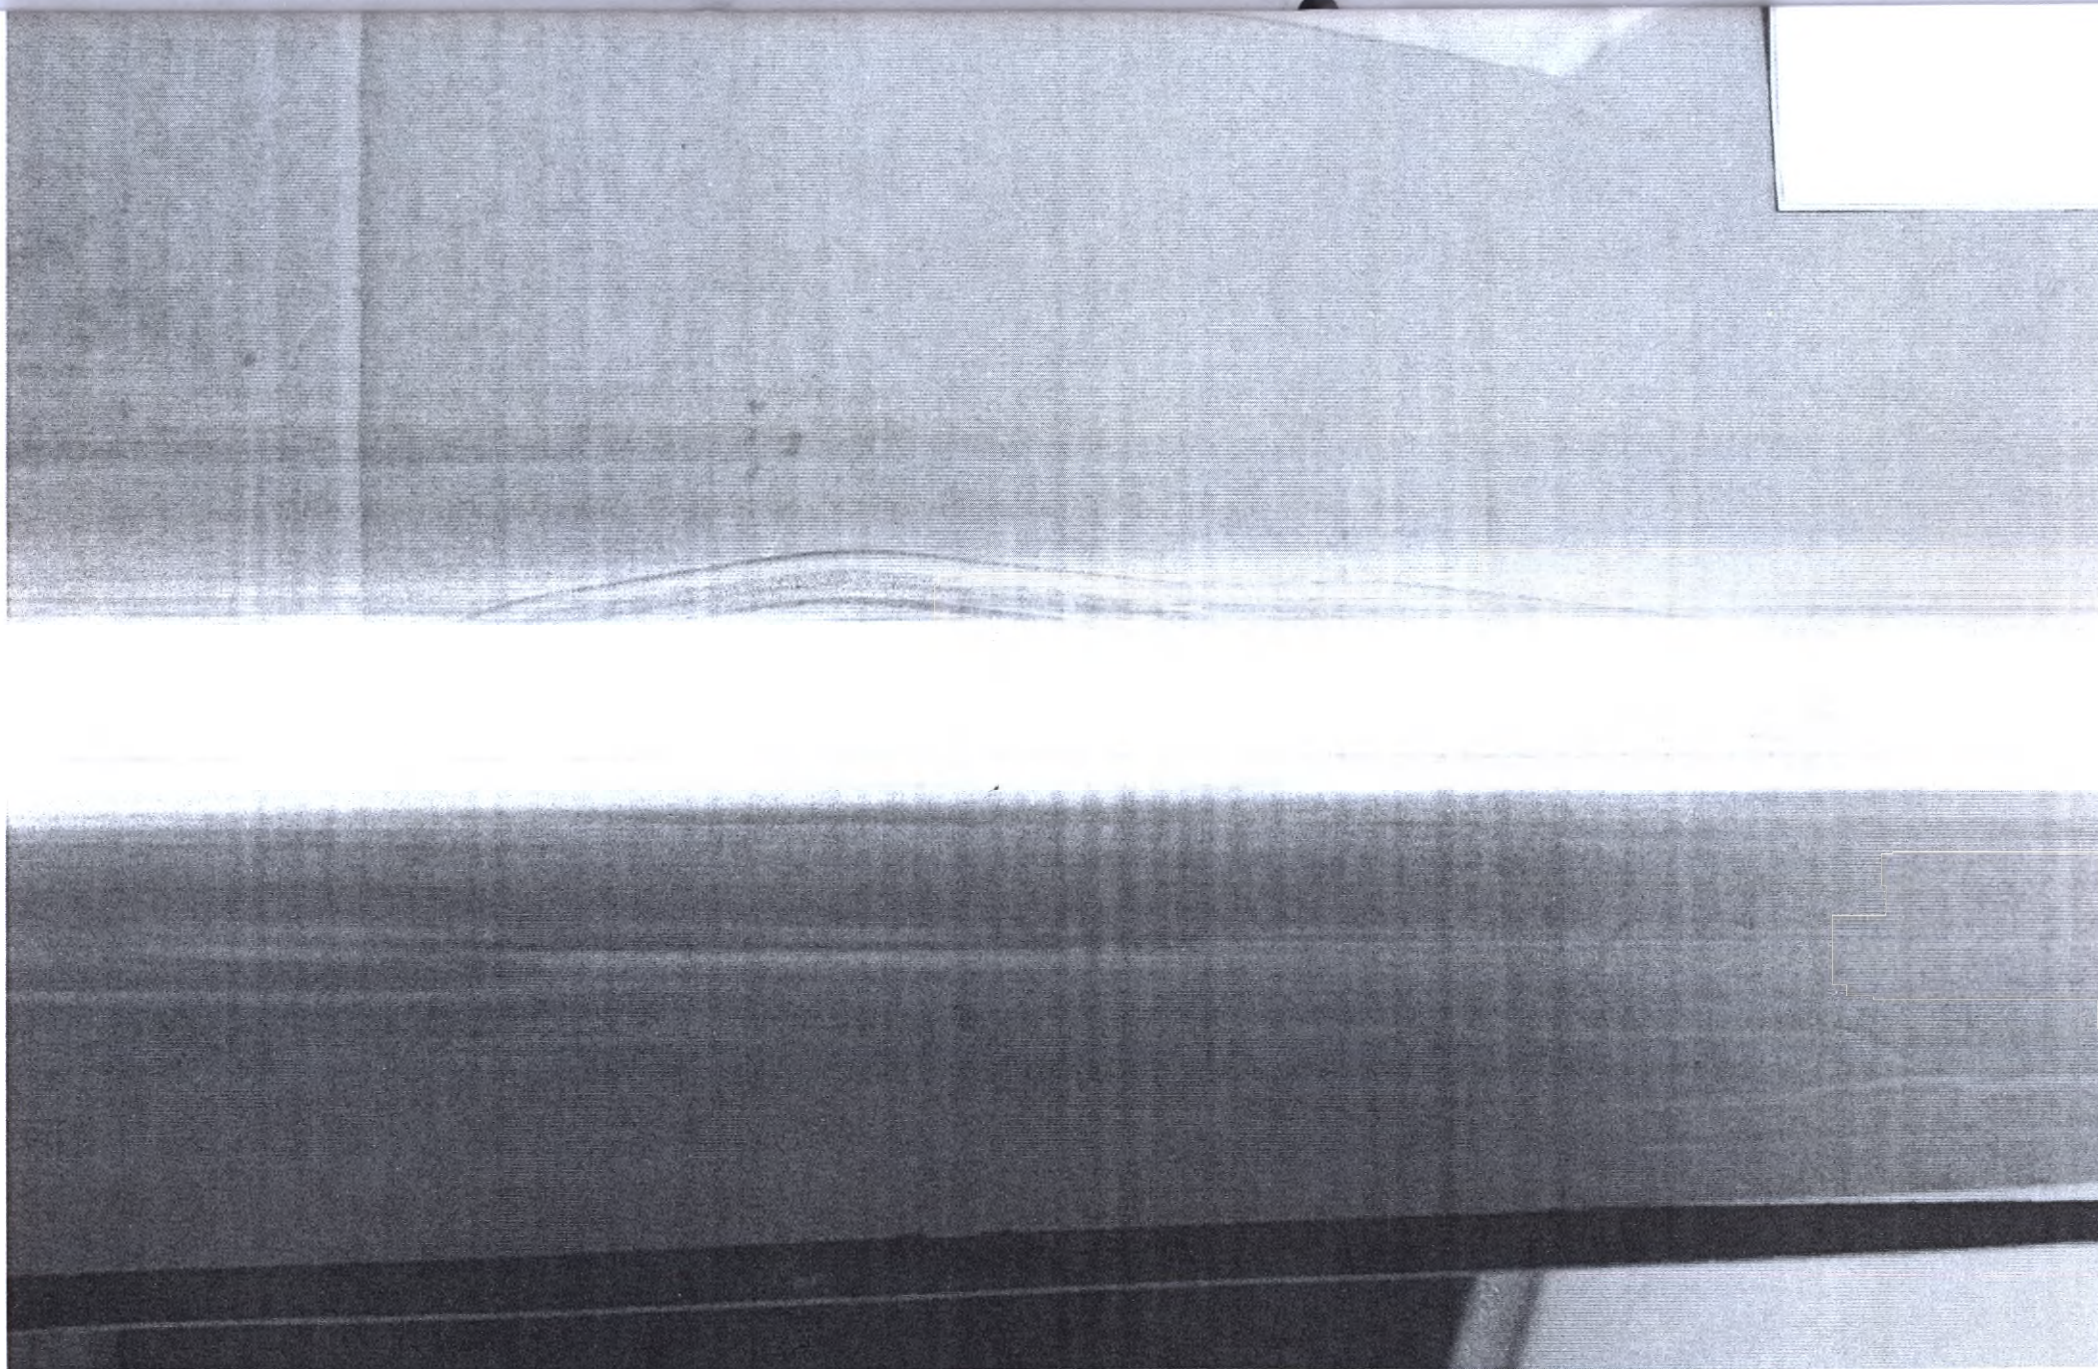


Рис. 67 – Трубка для отсасывания (по требованию)


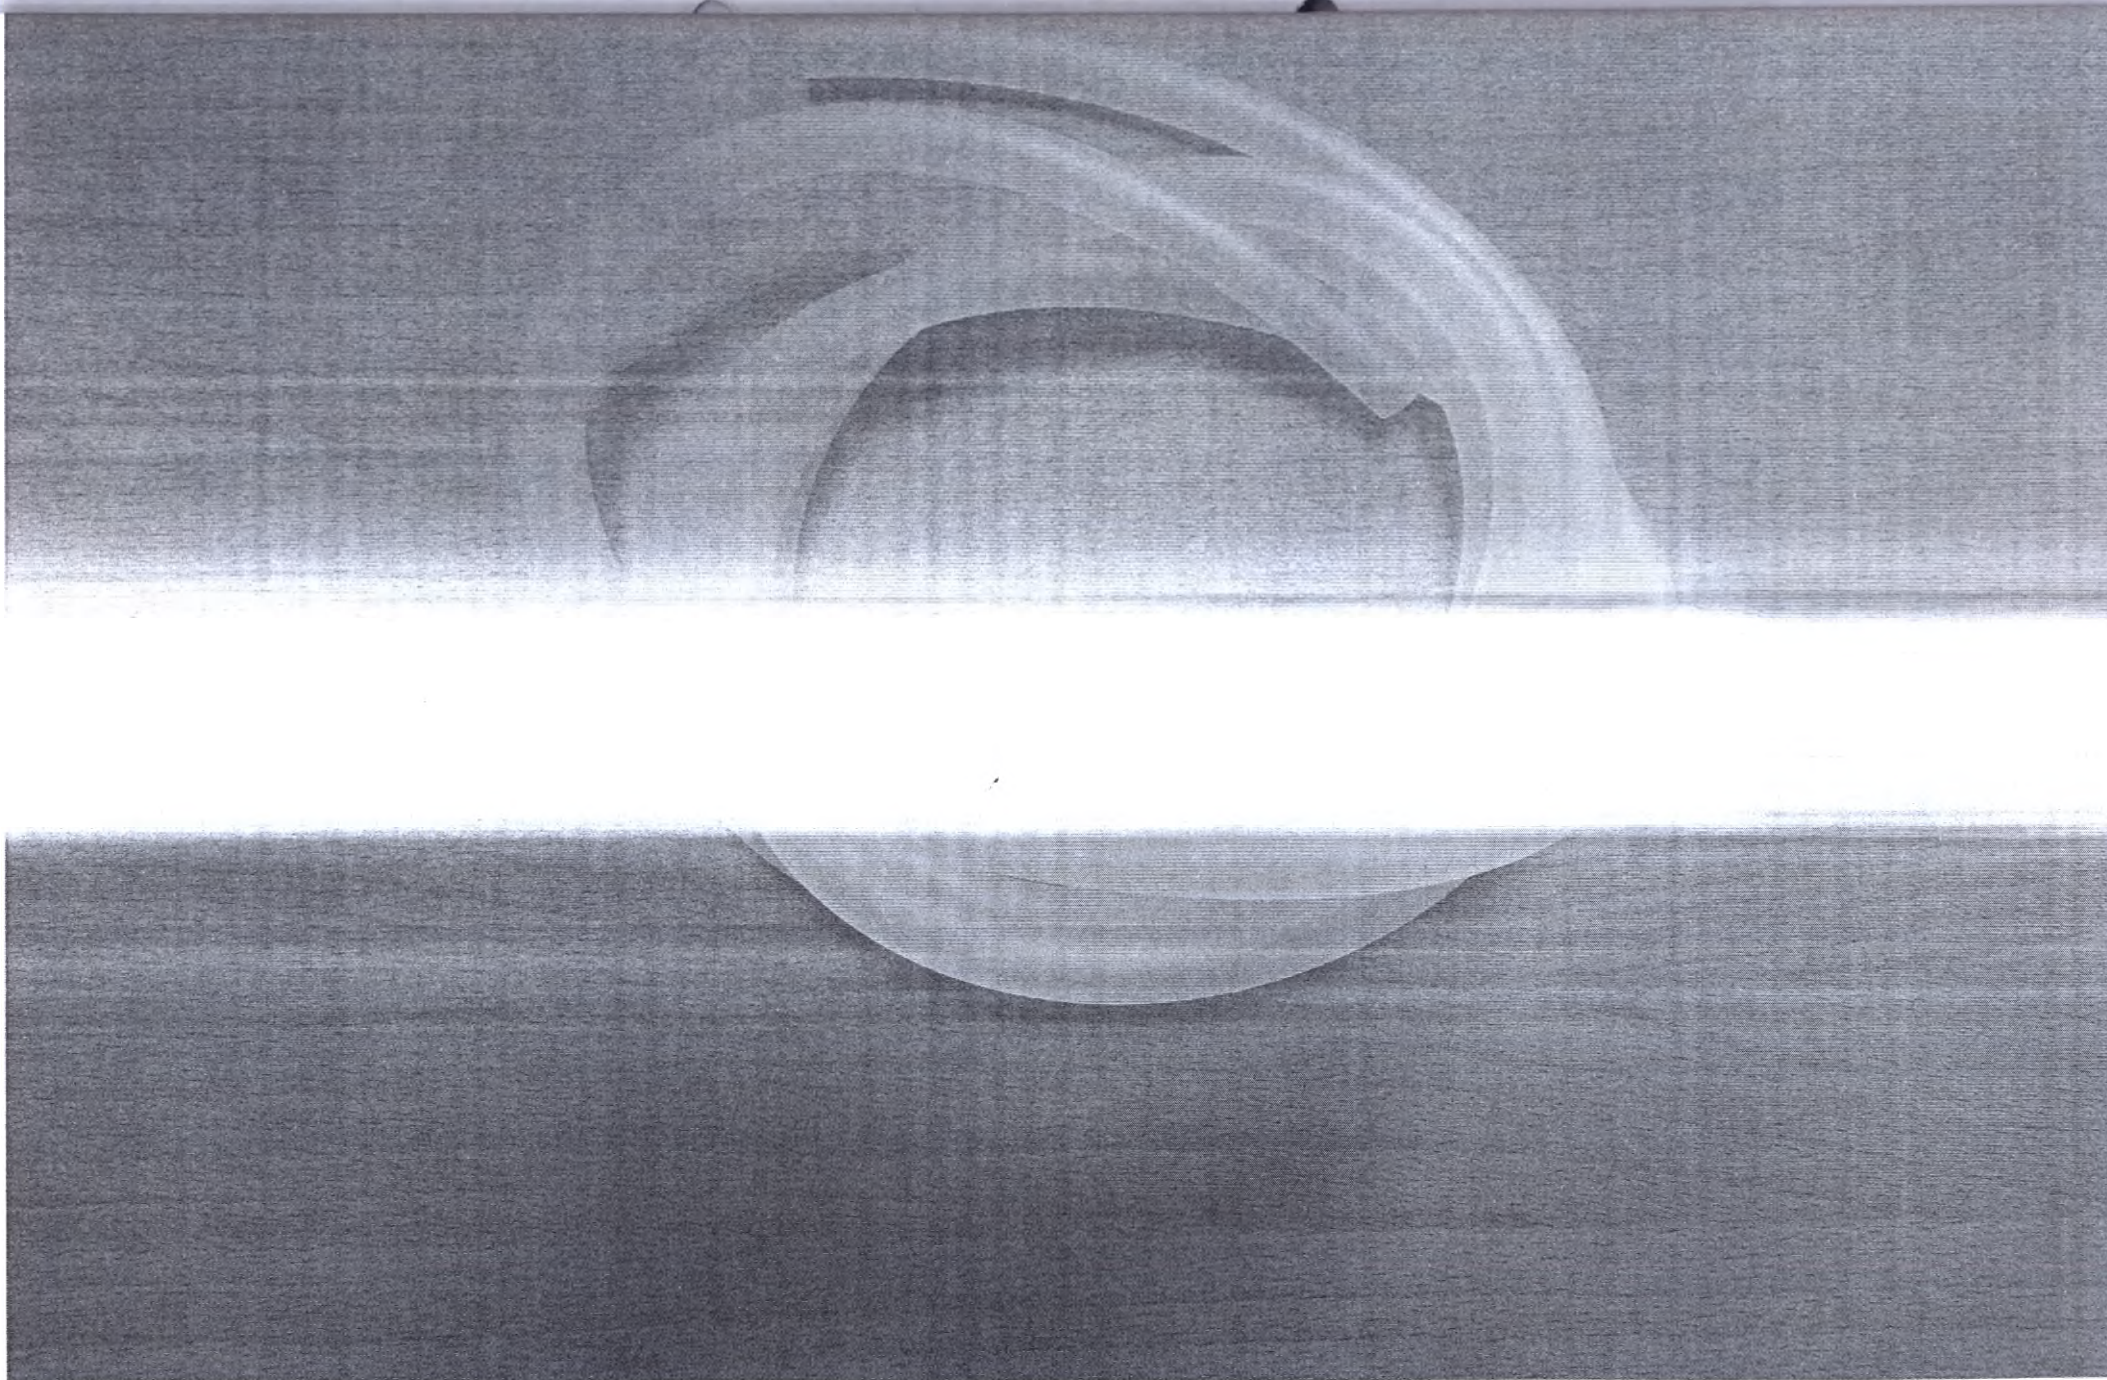


Рис. 68 – Трубка аспирационная

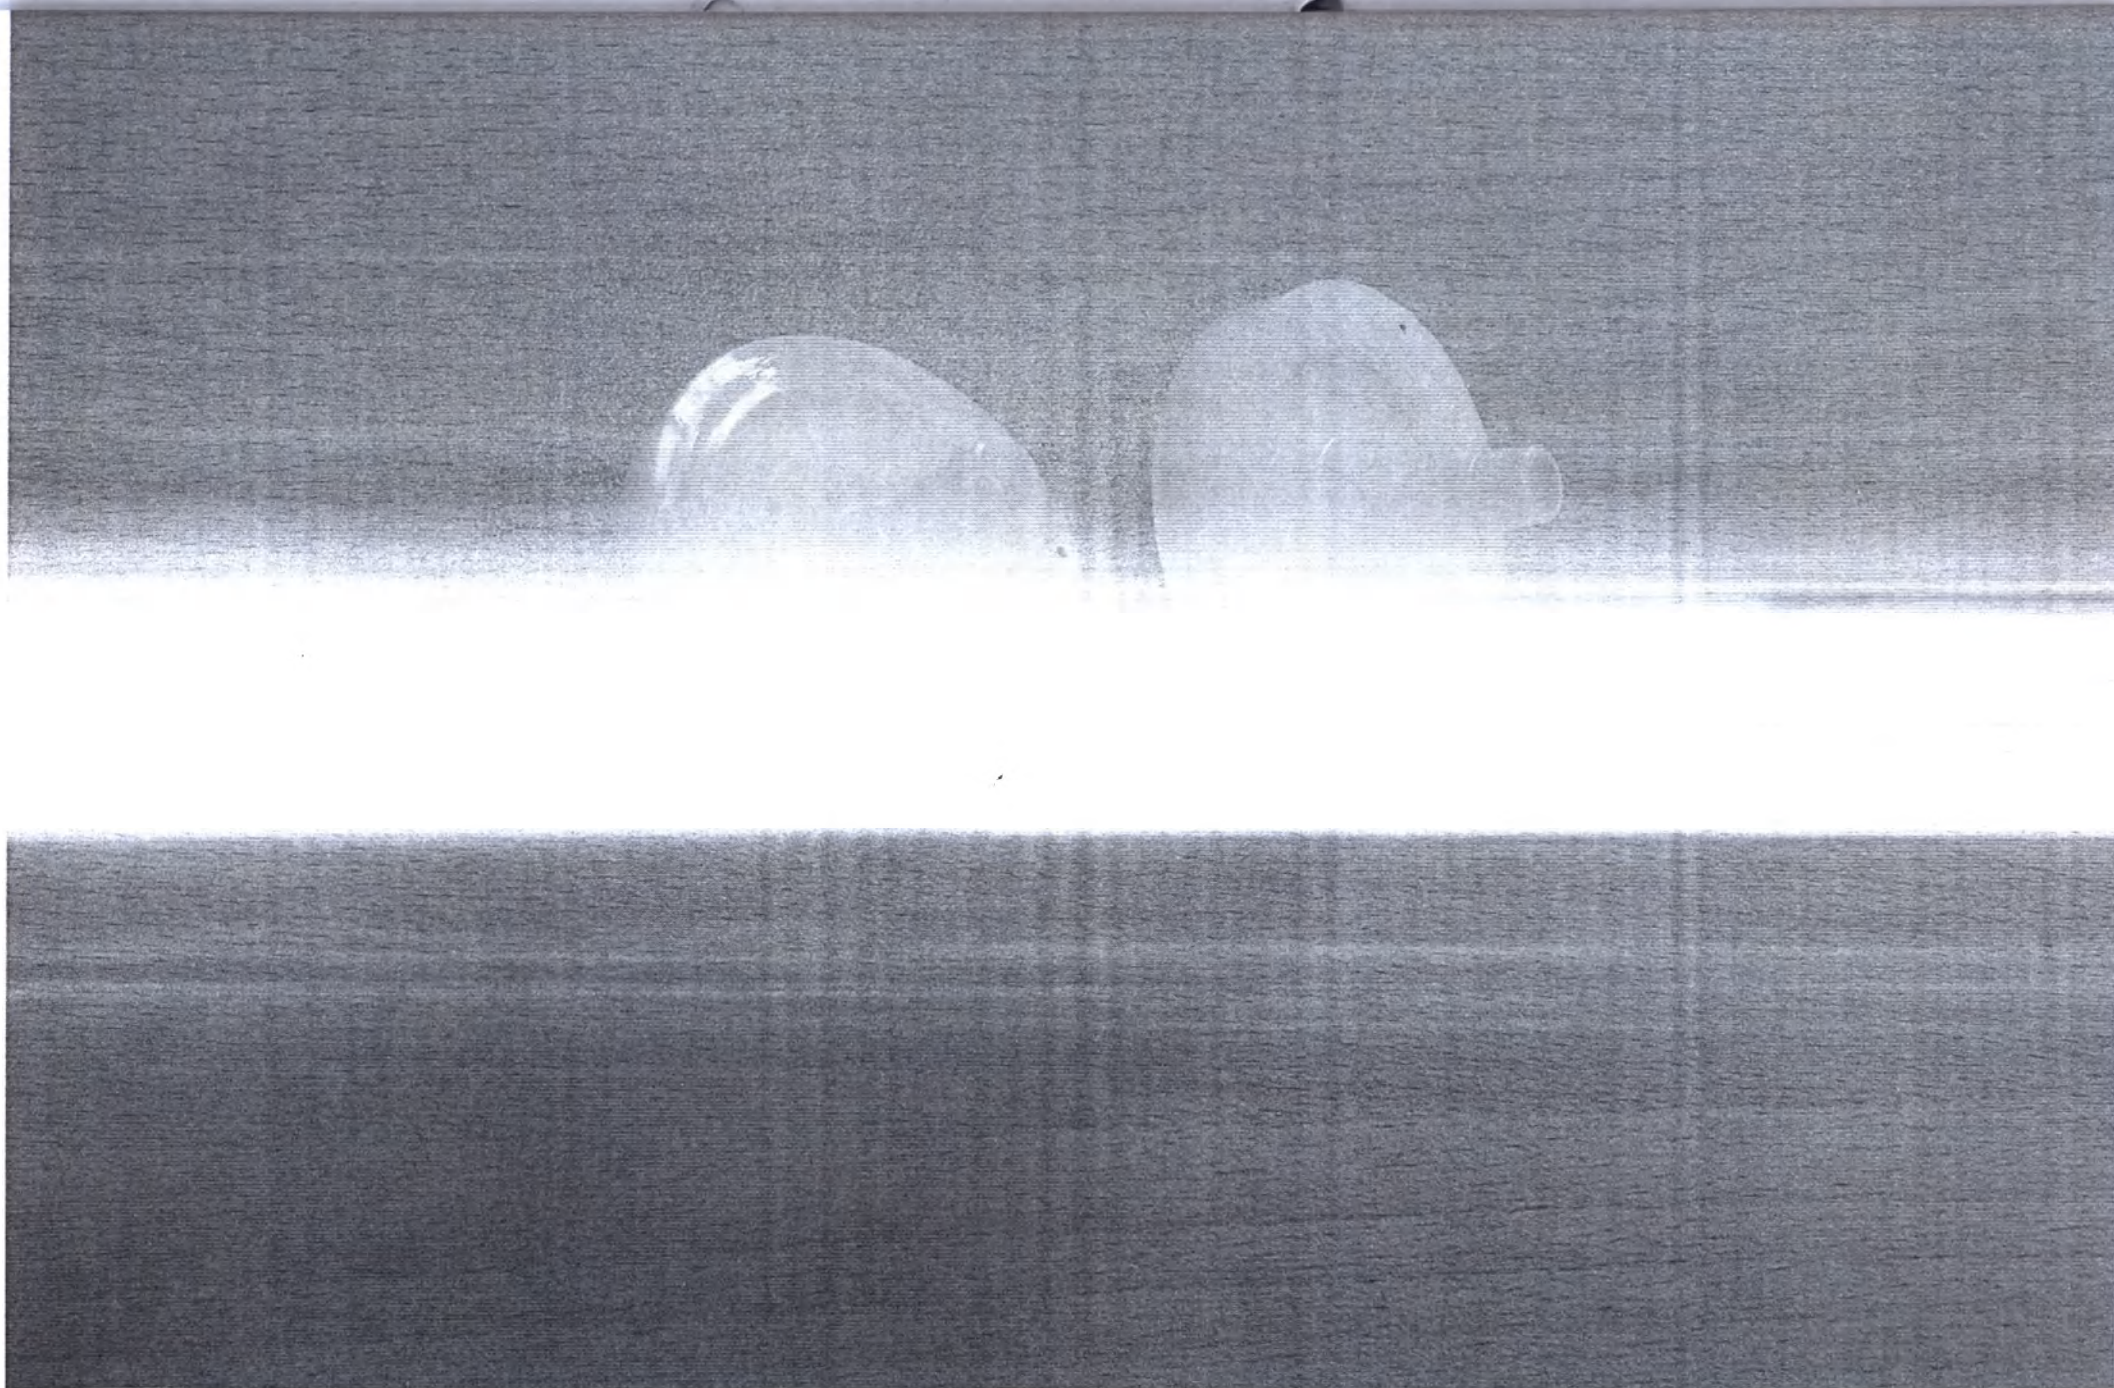

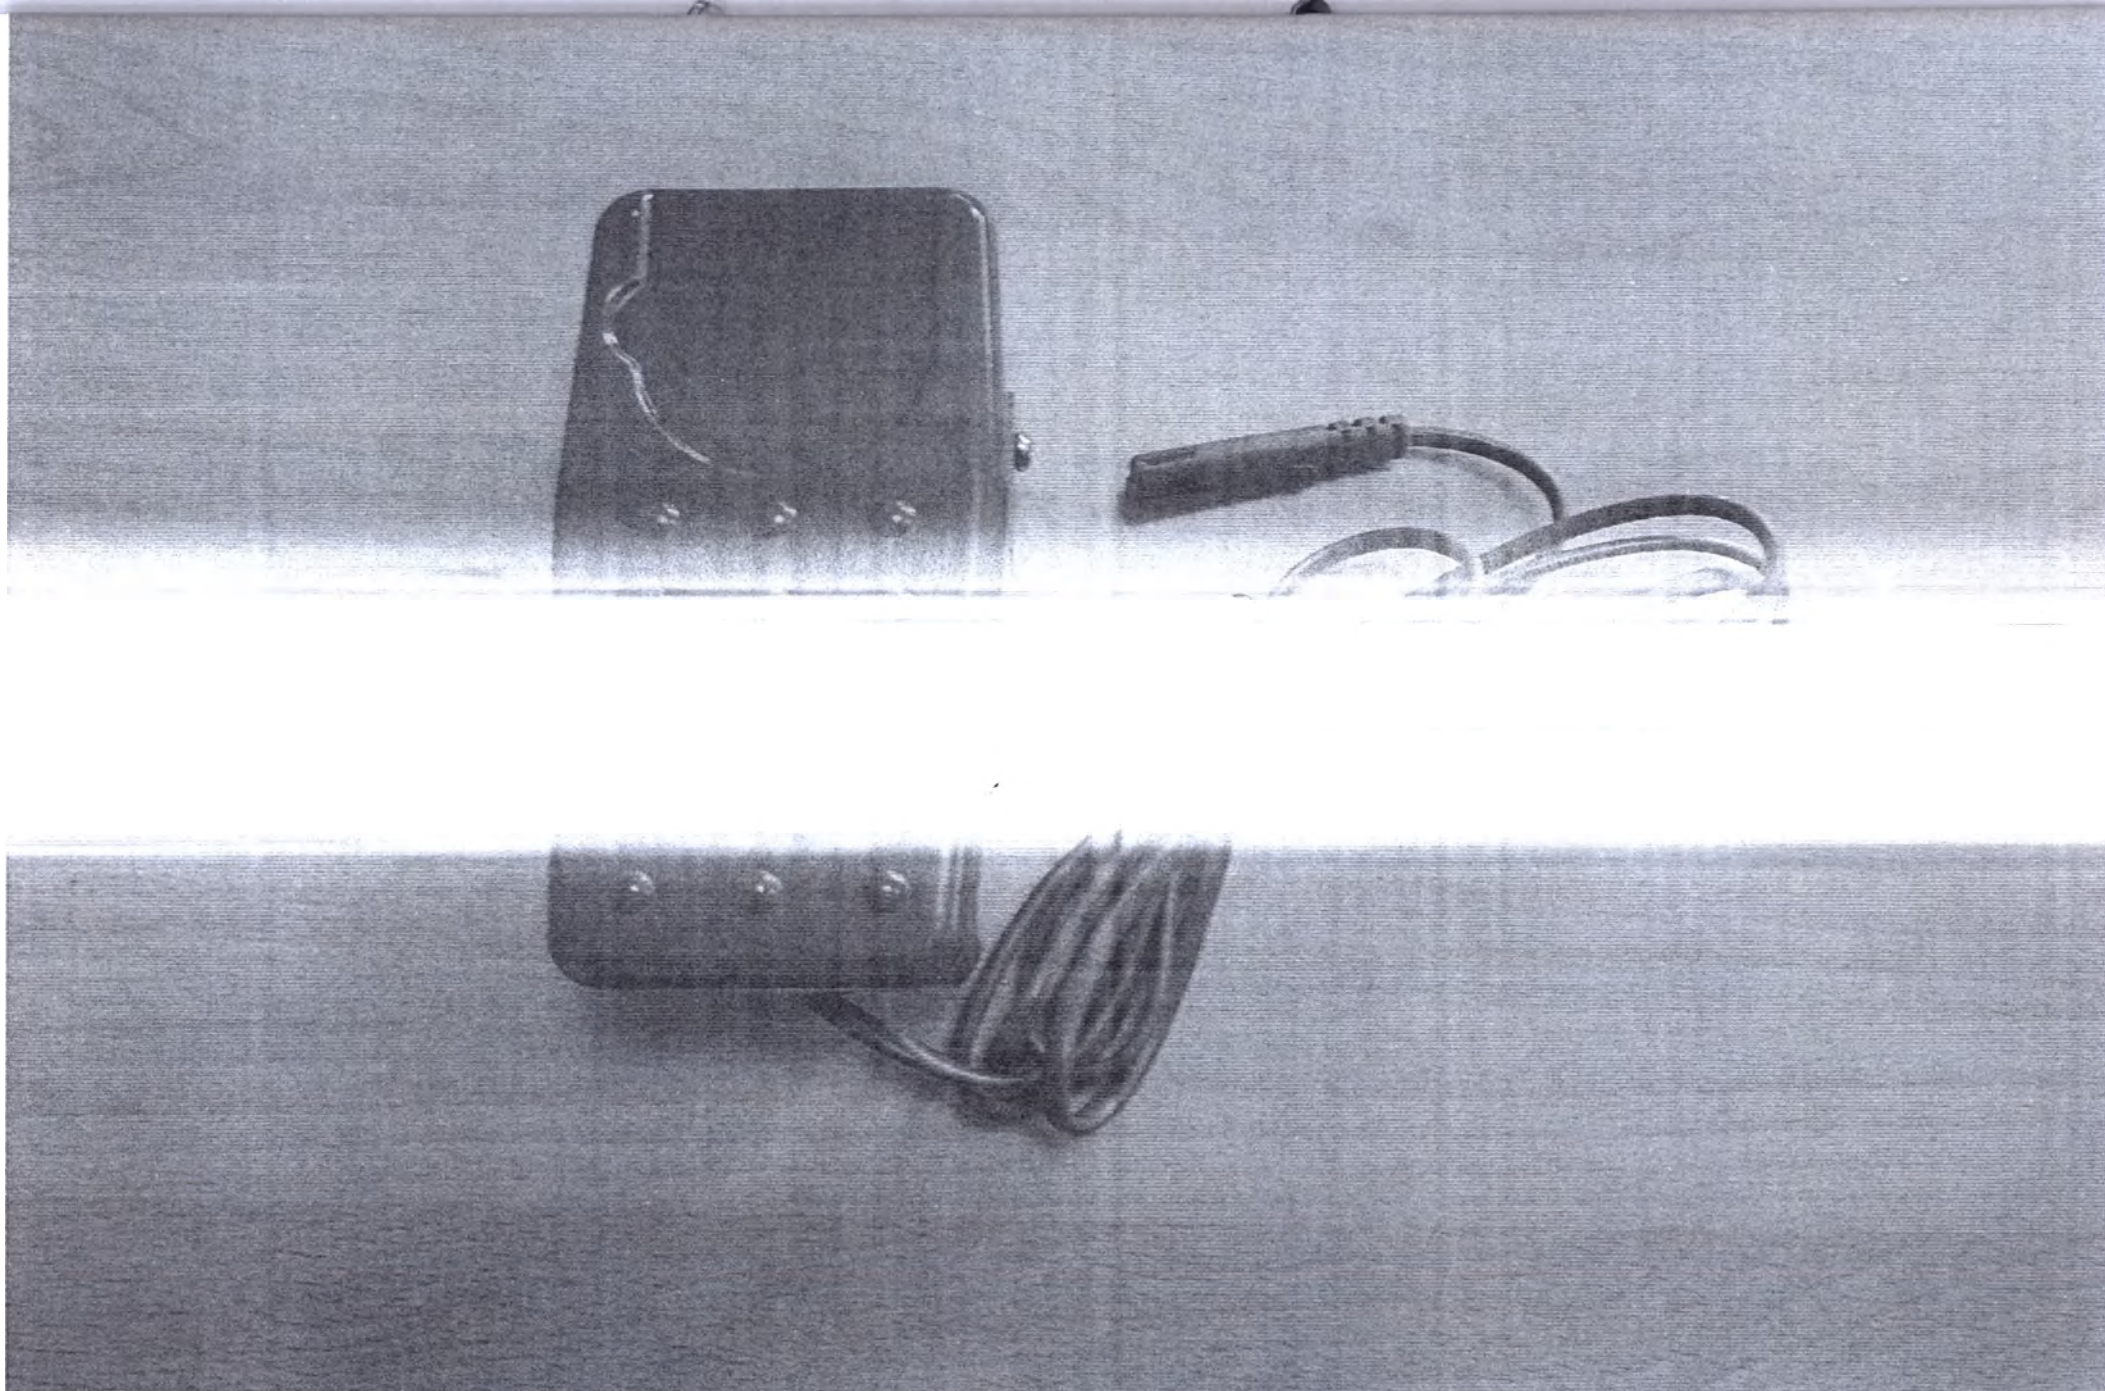


Рис. 70 – Педальный ножной выключатель

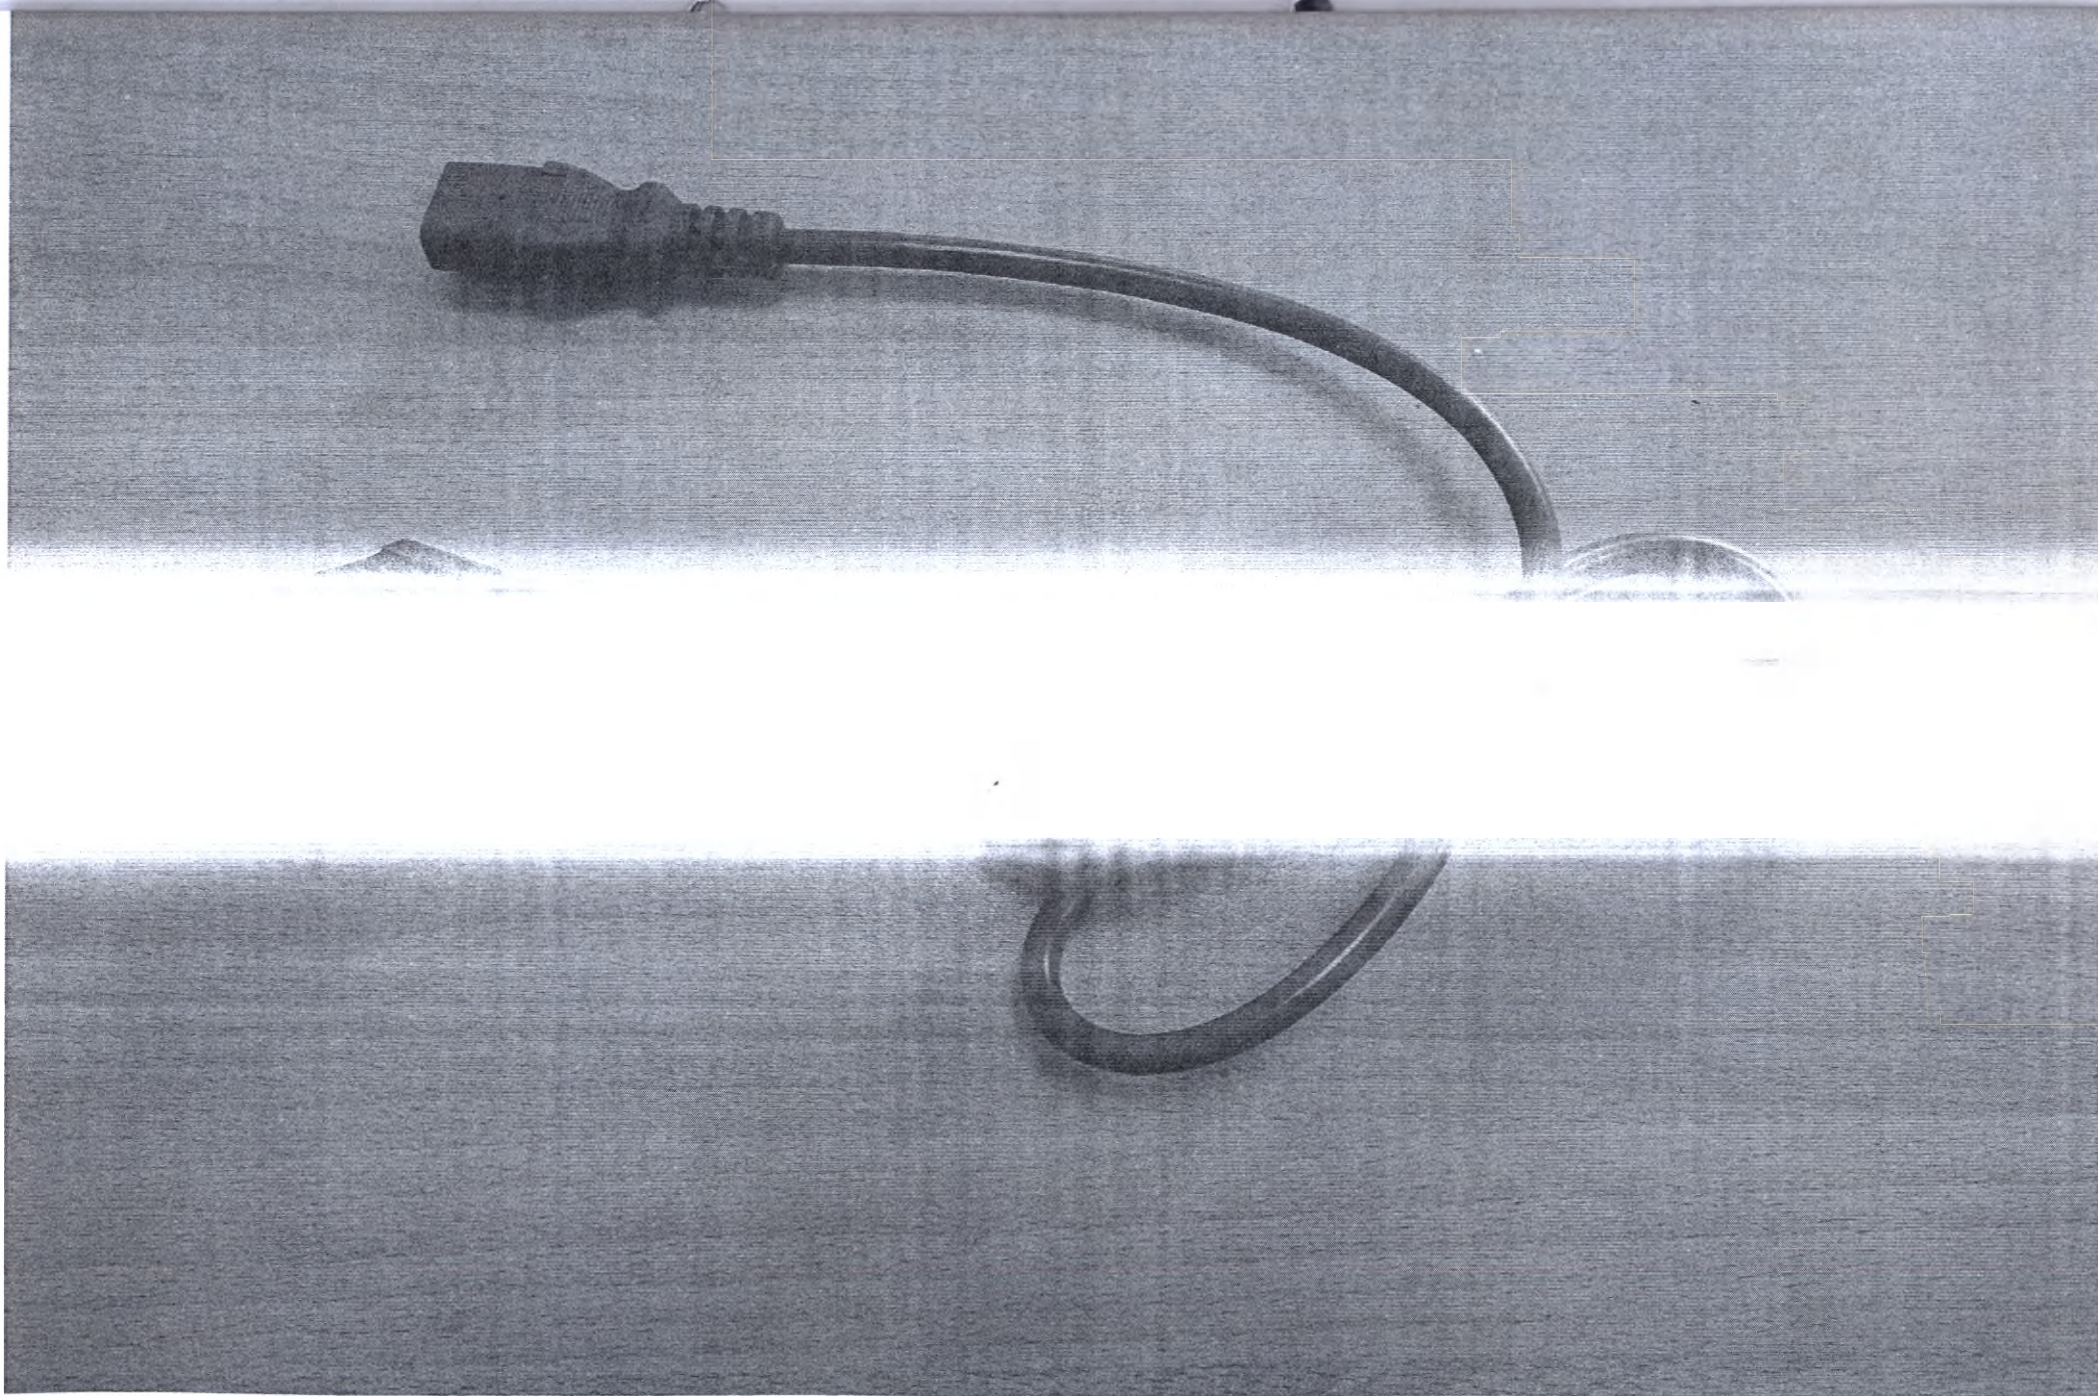


Рис. 71 – Шнур питания





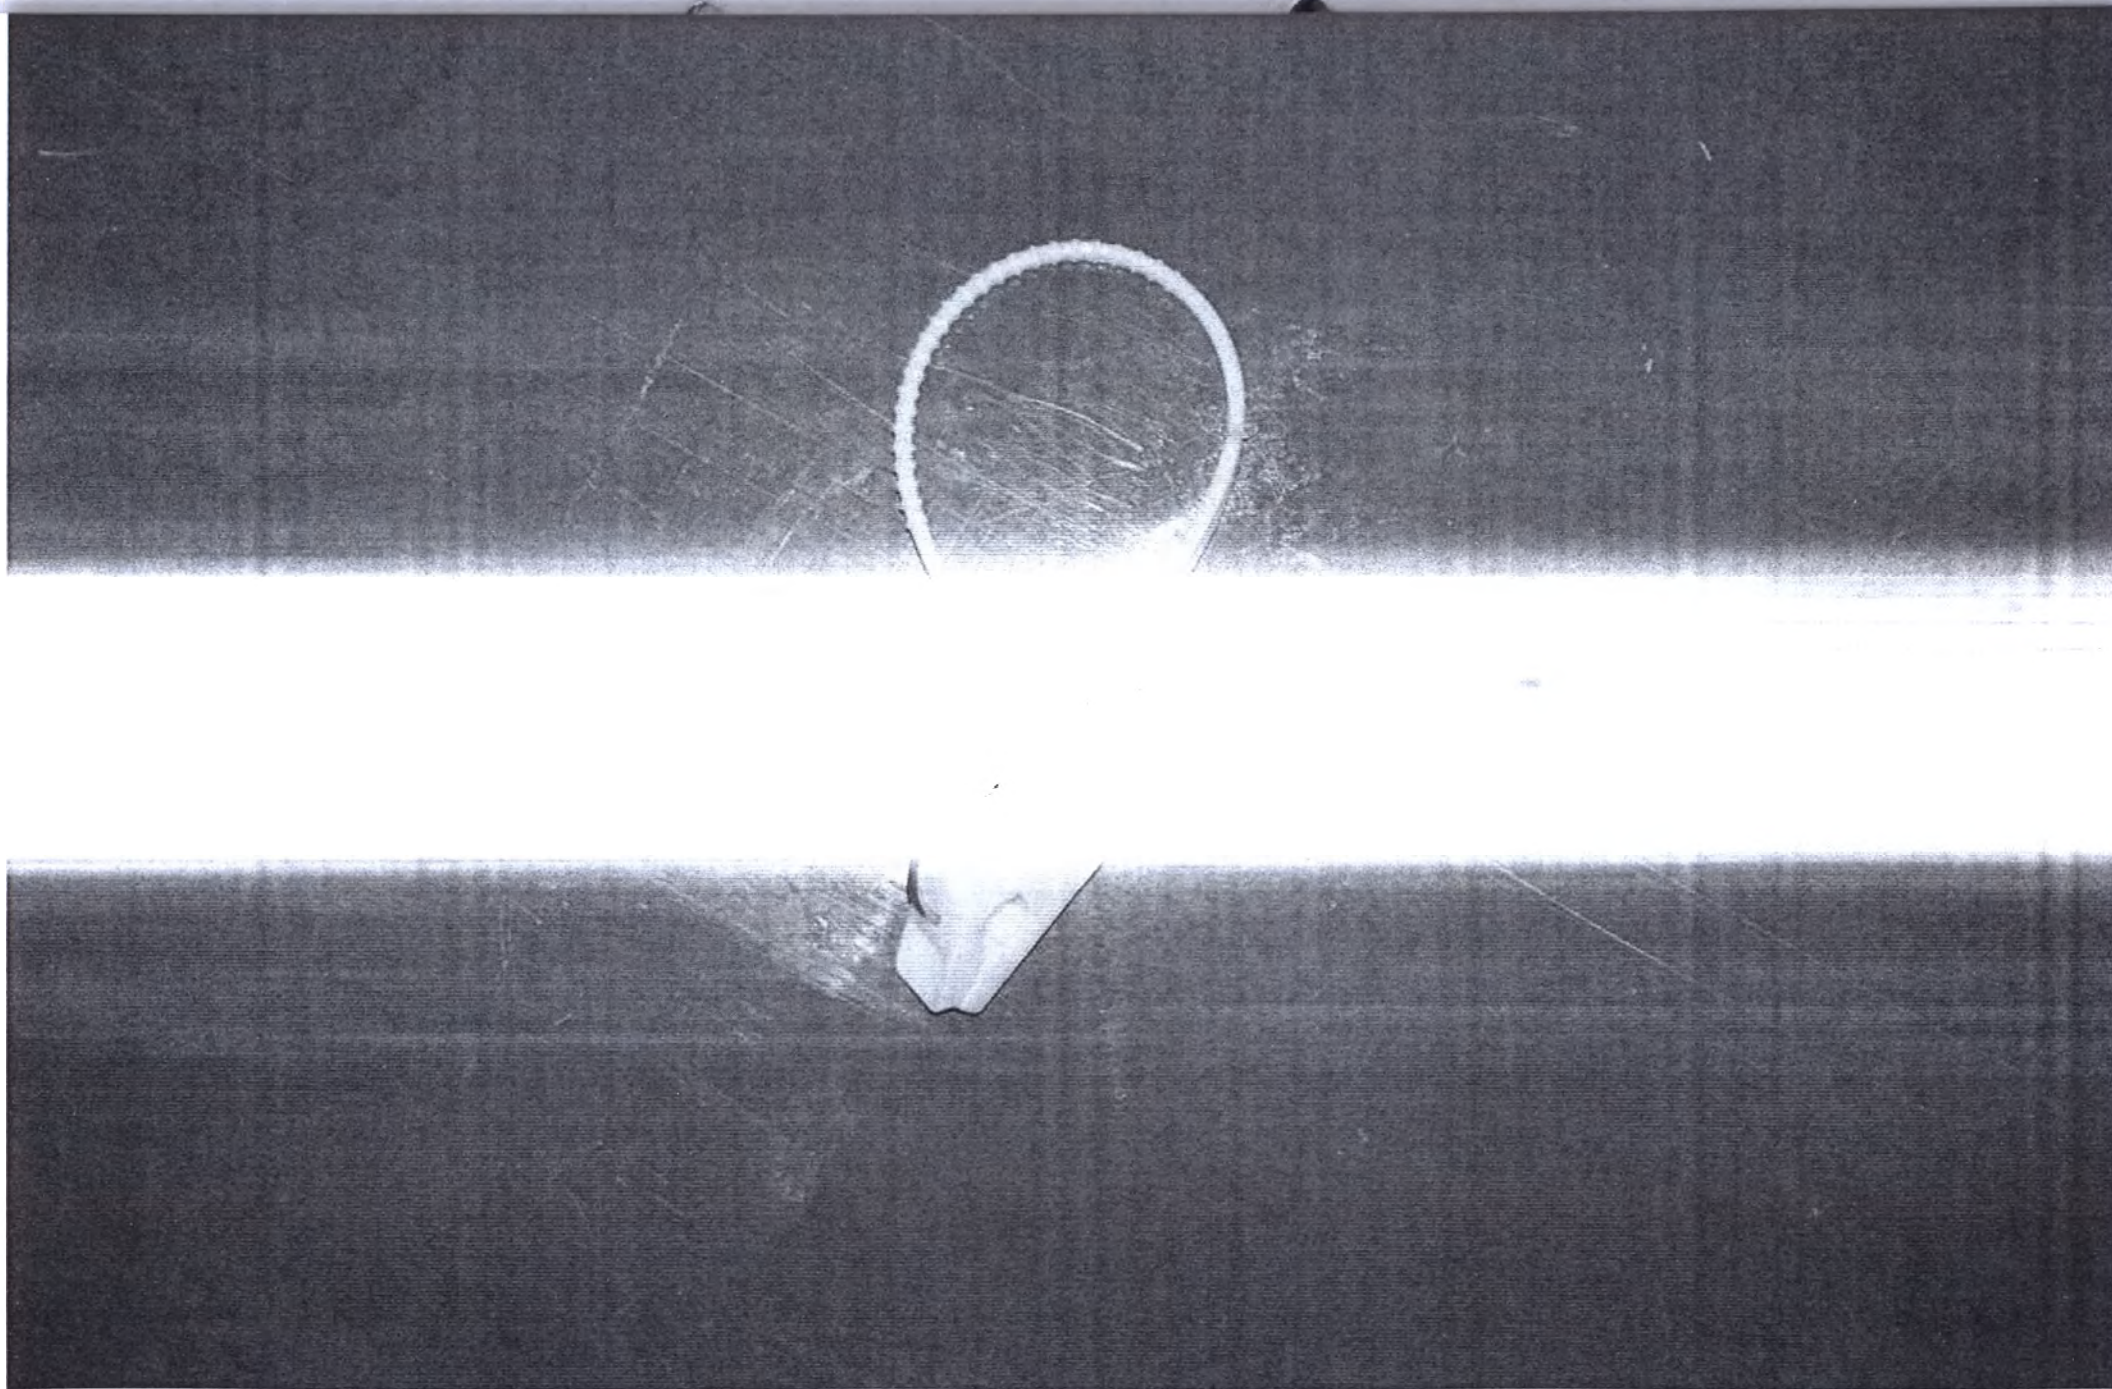
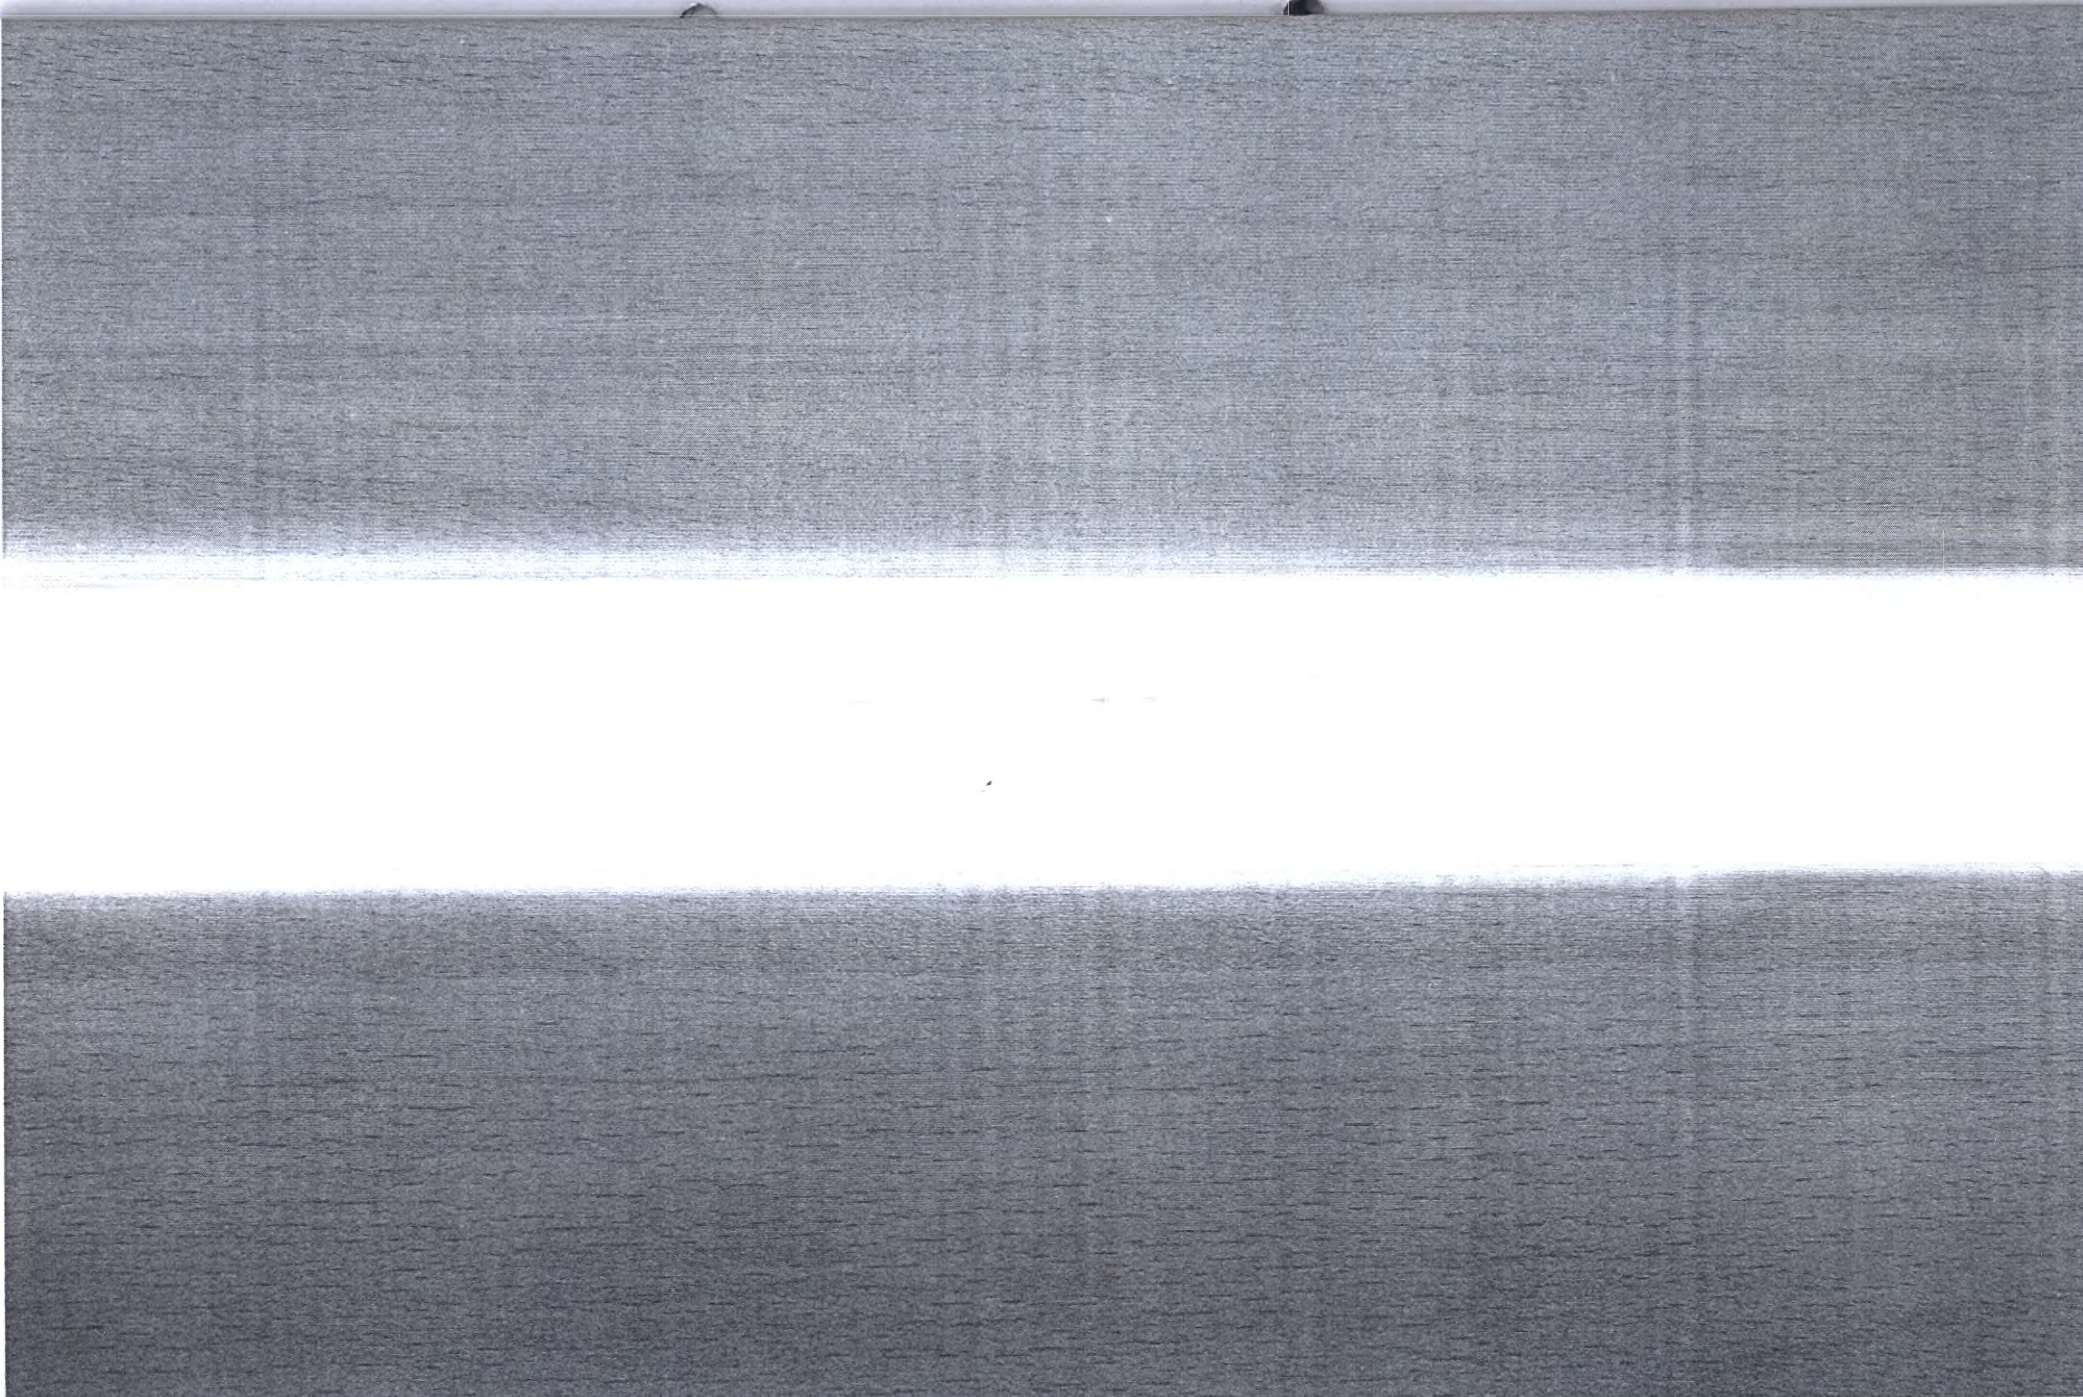


Рис. 72 – Зажим


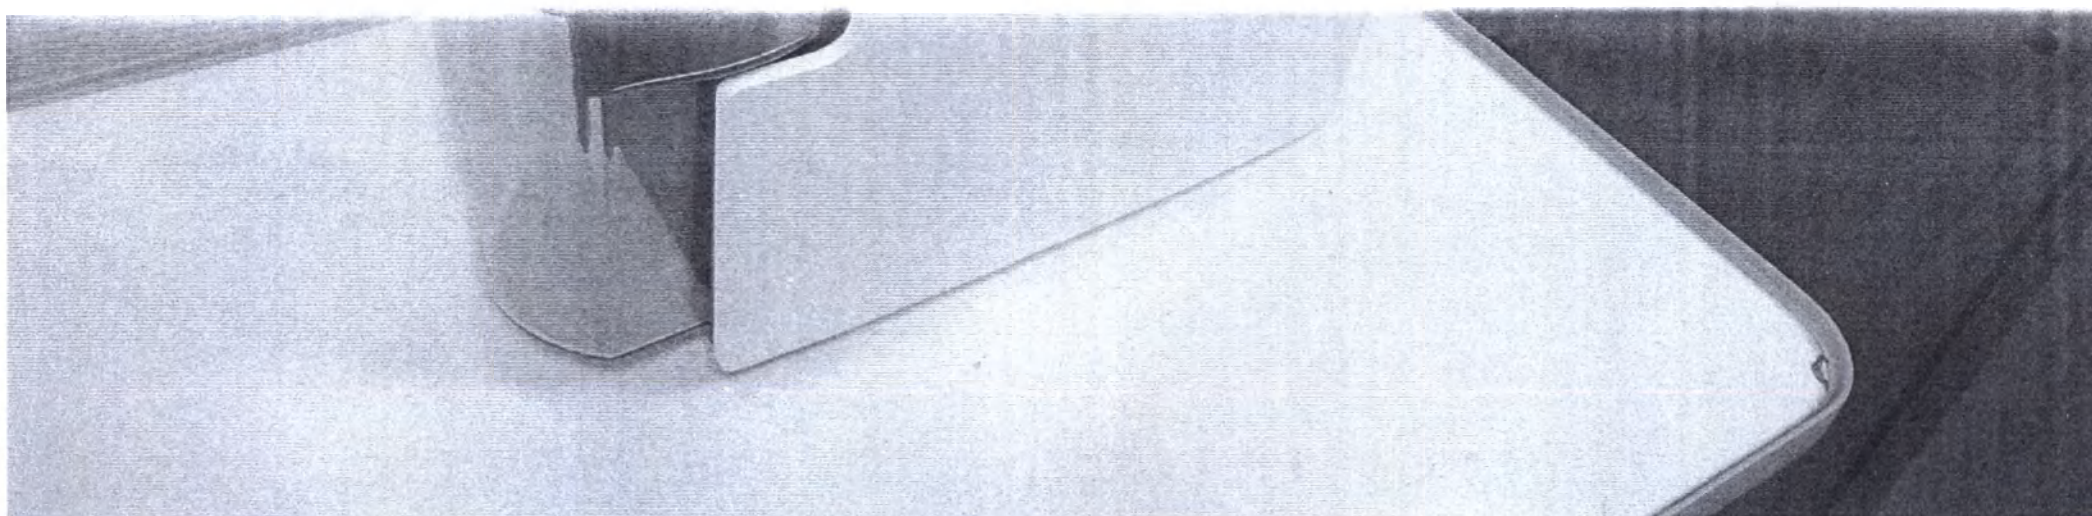



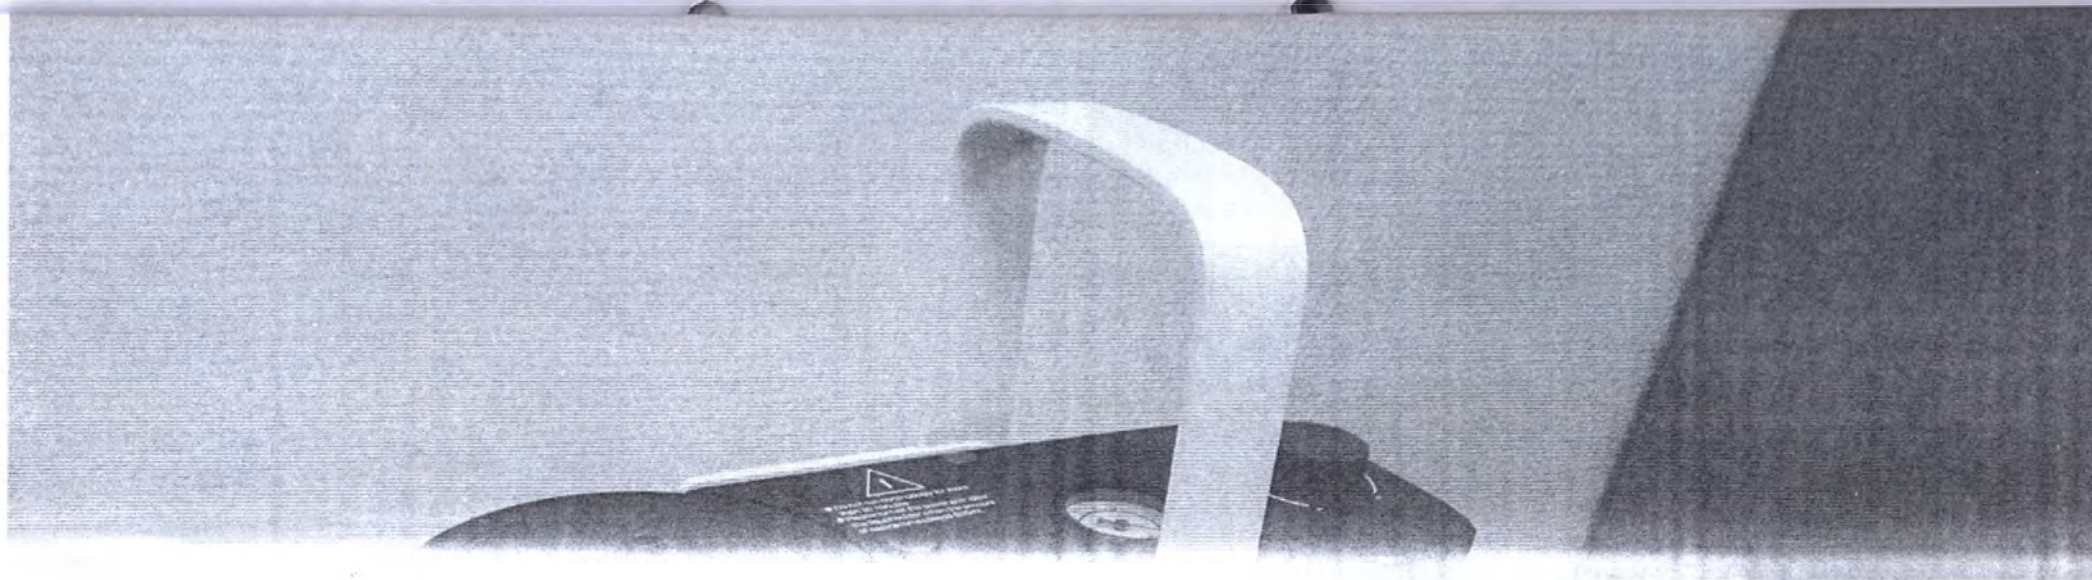


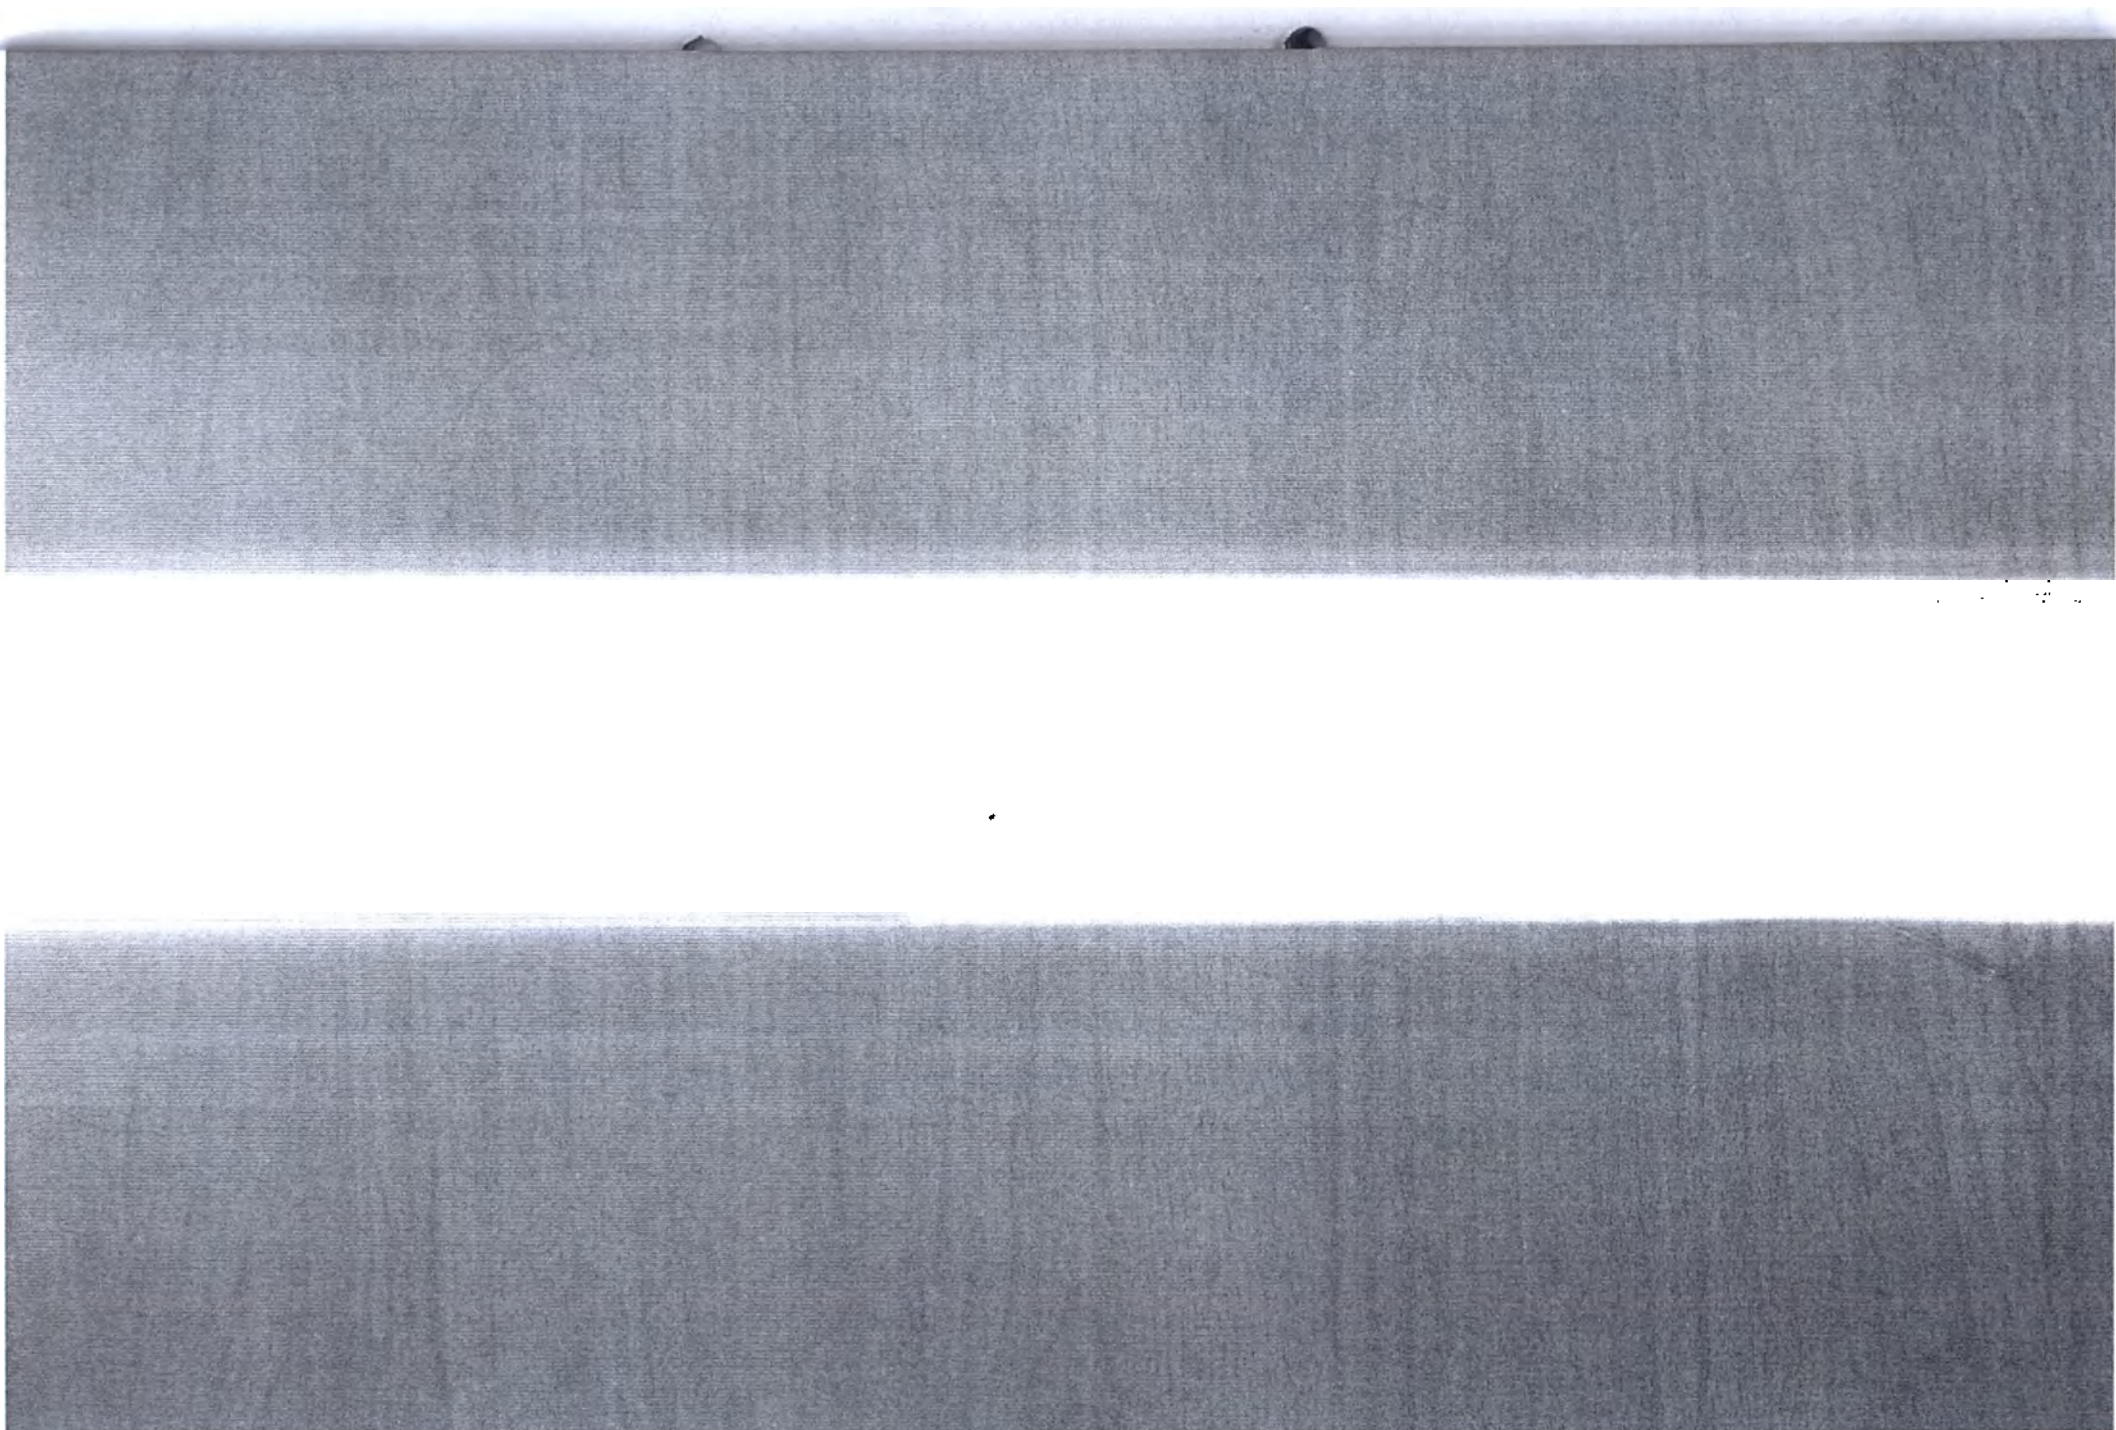

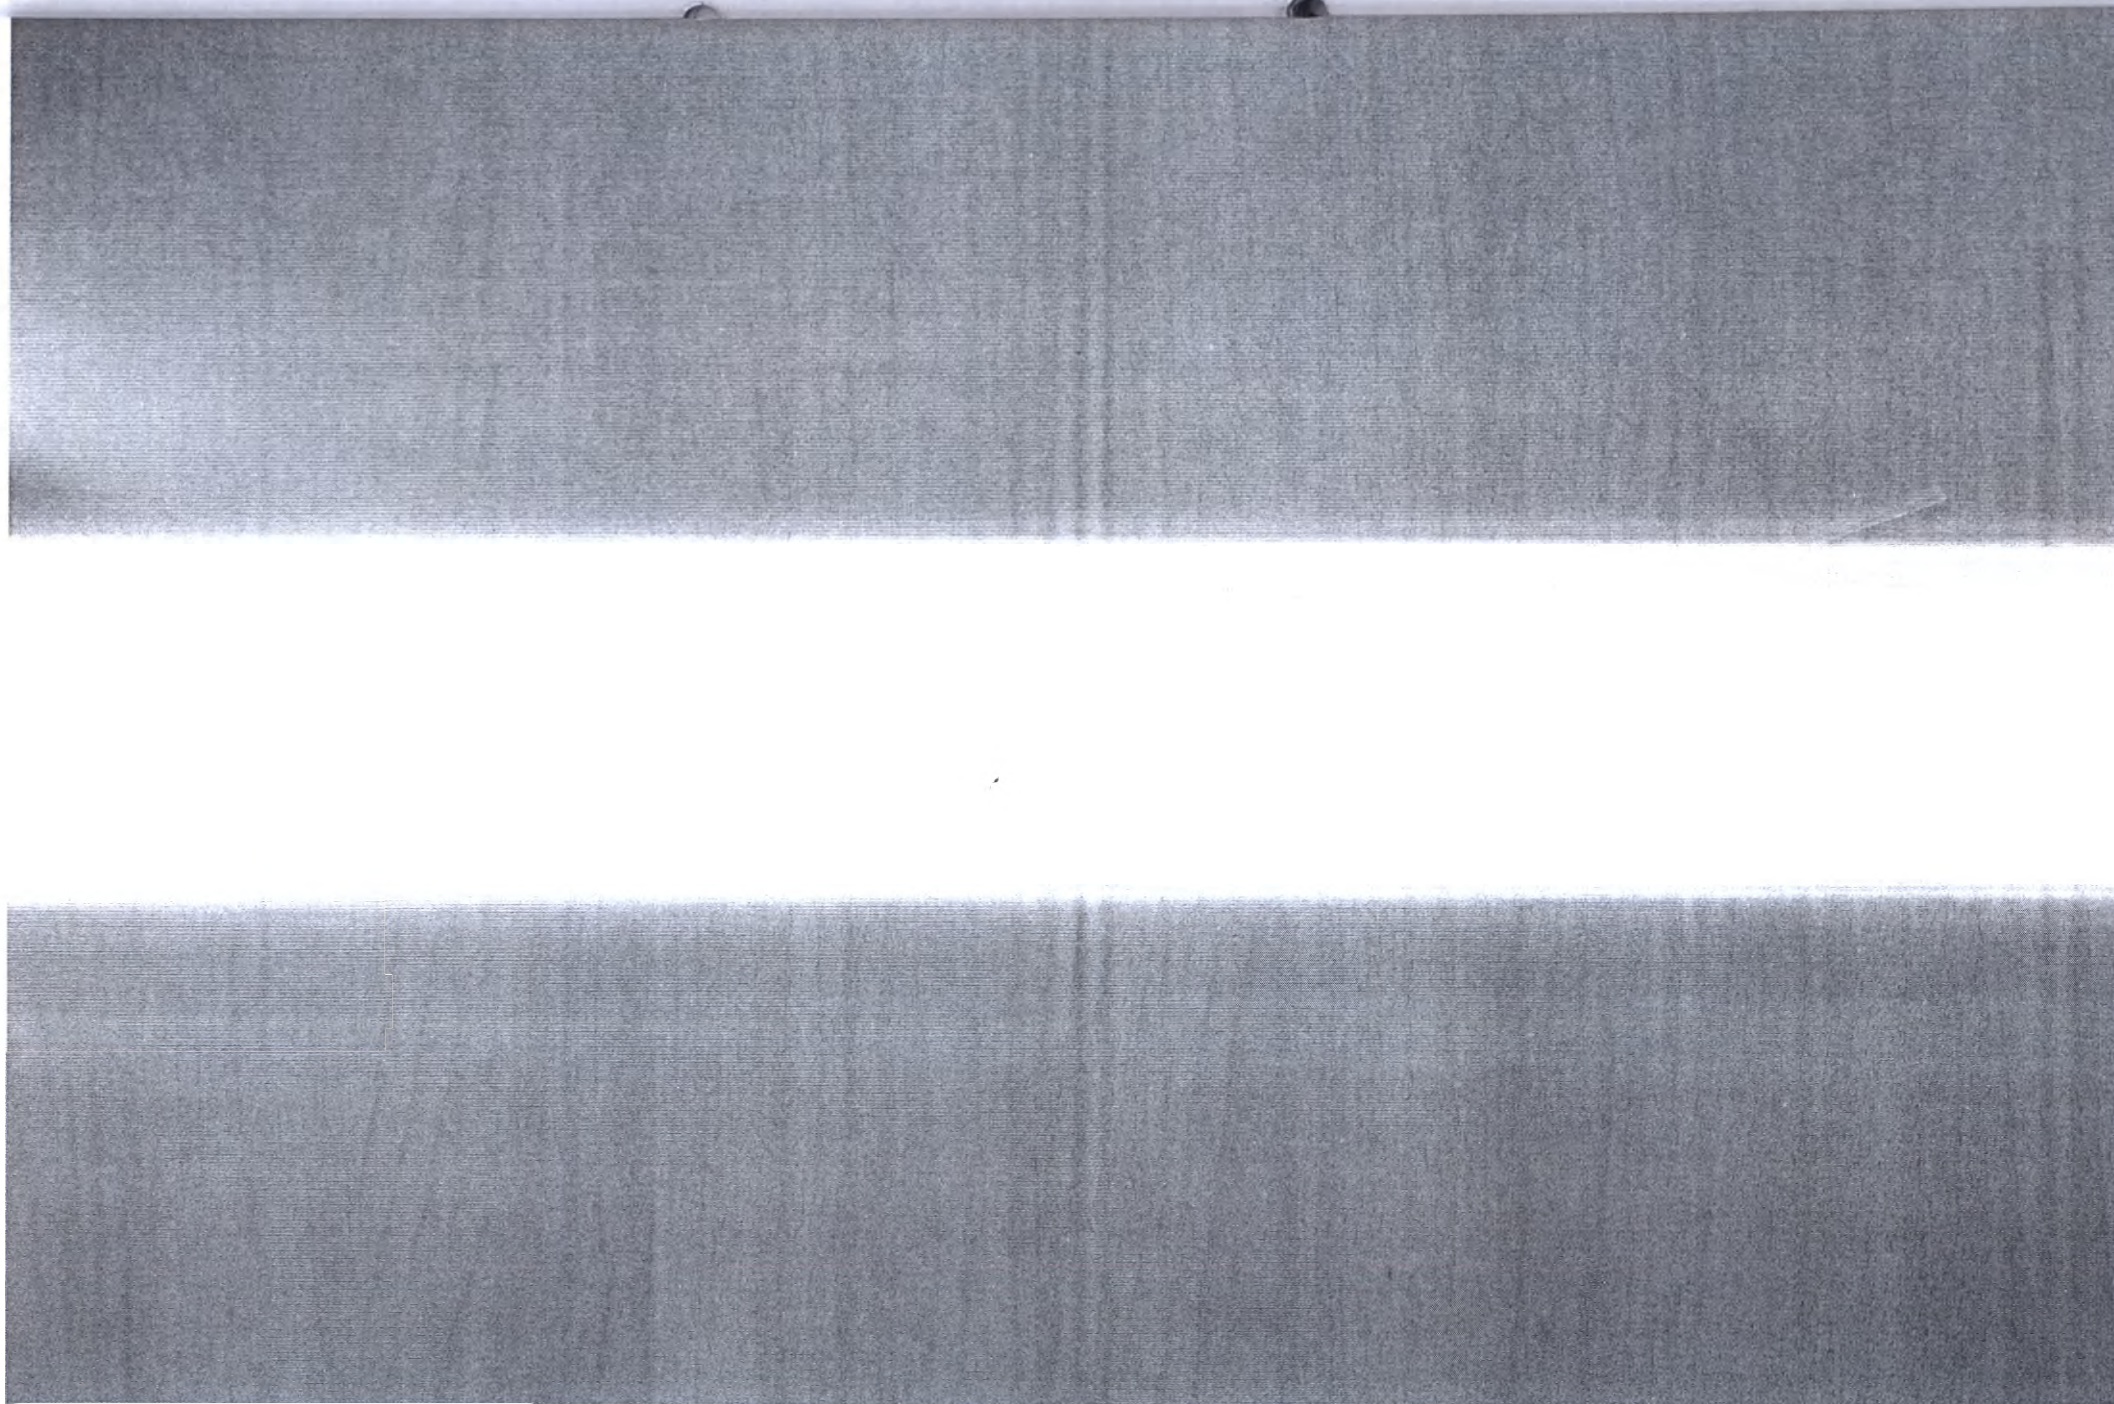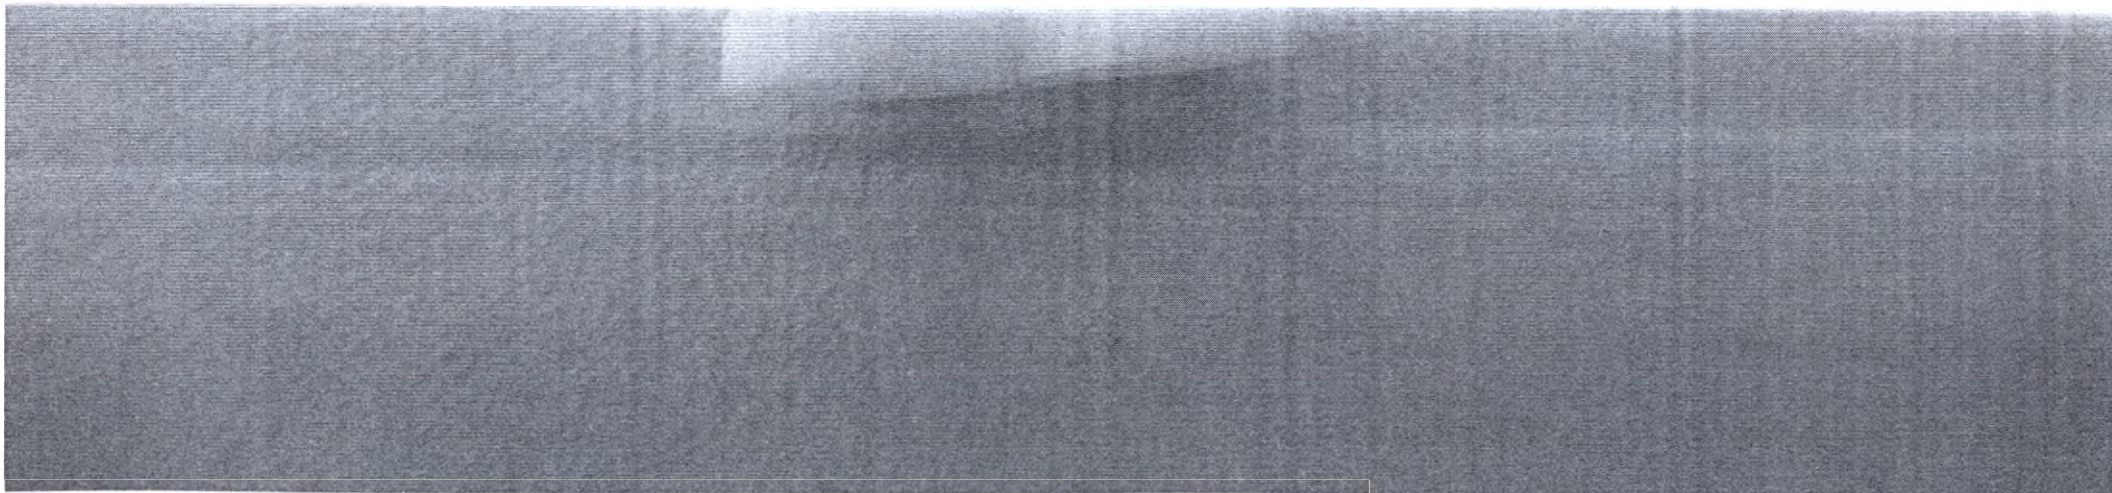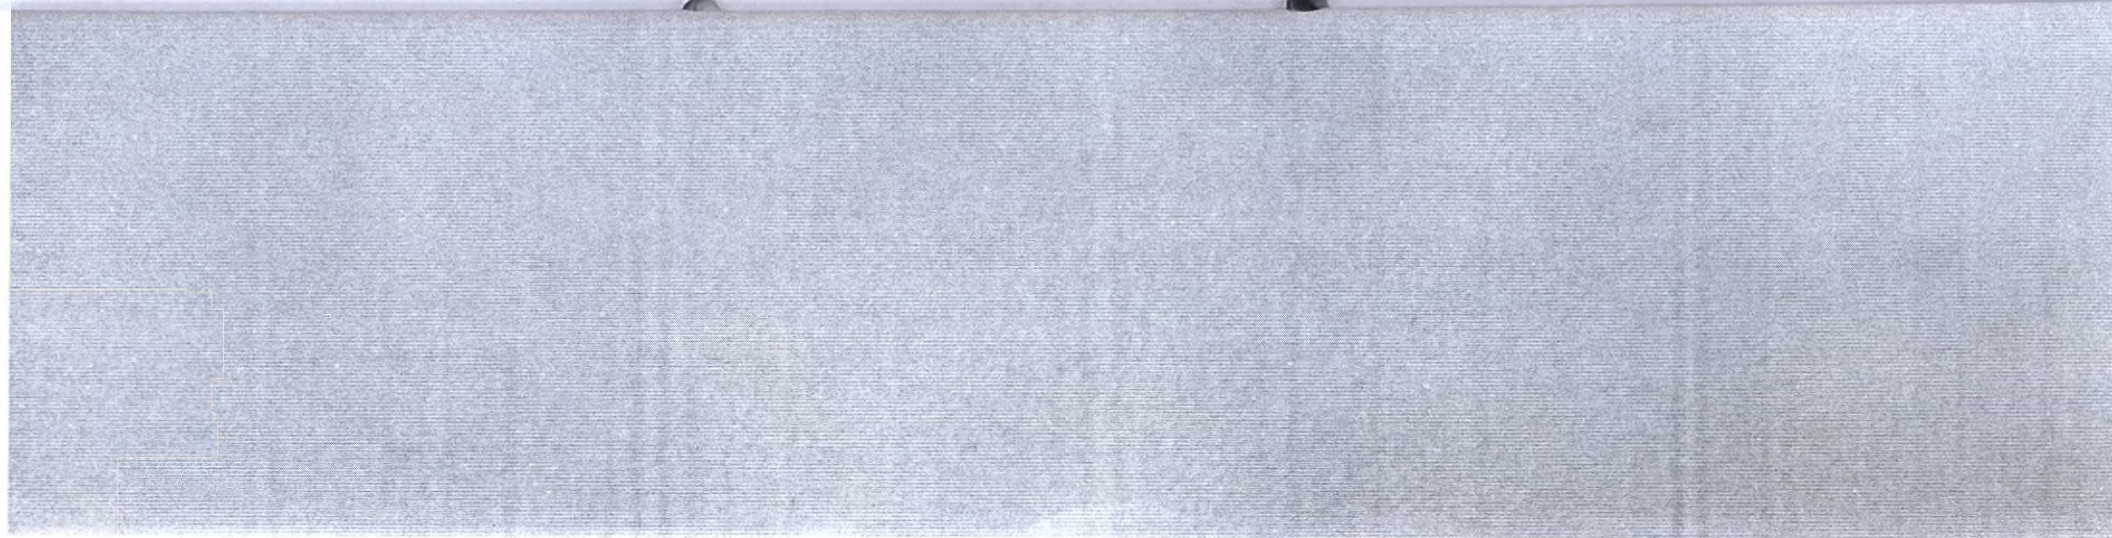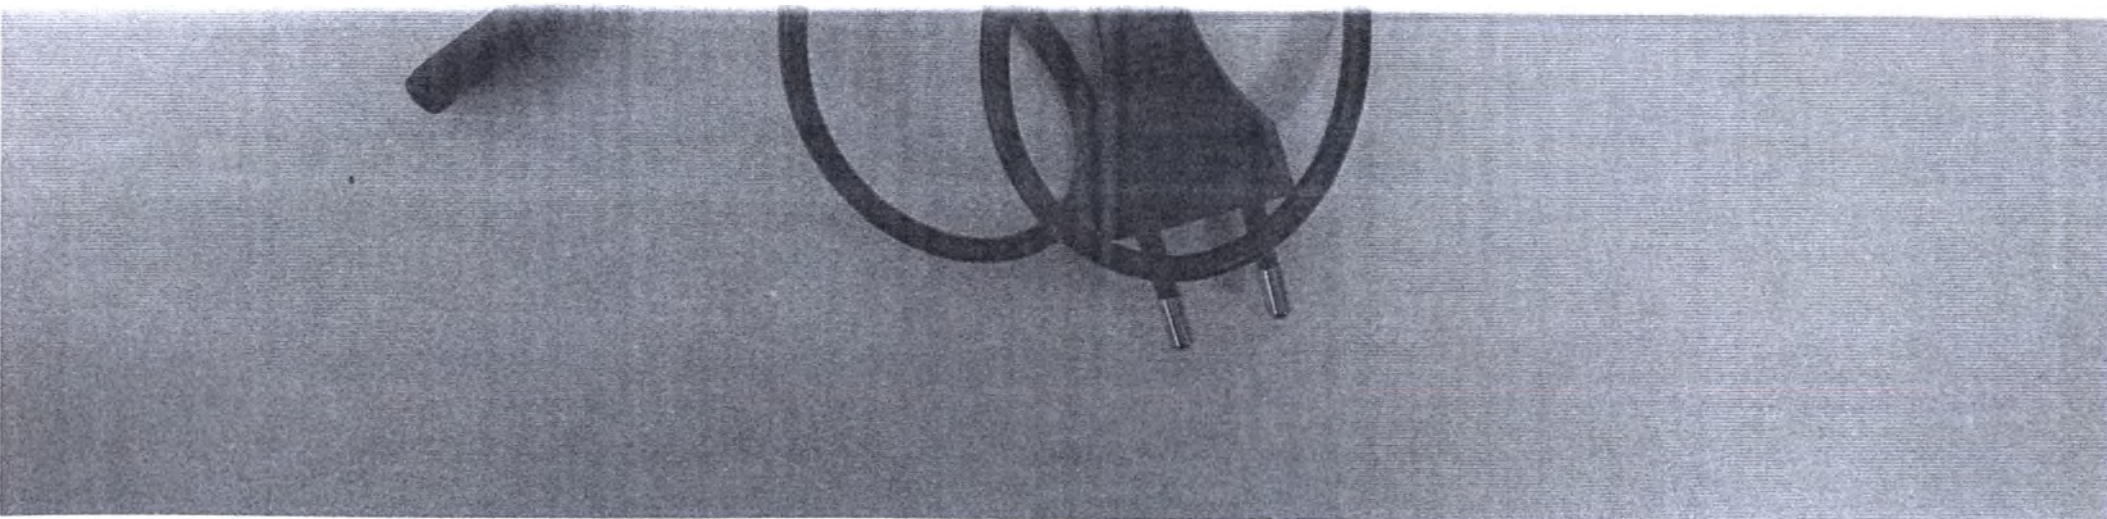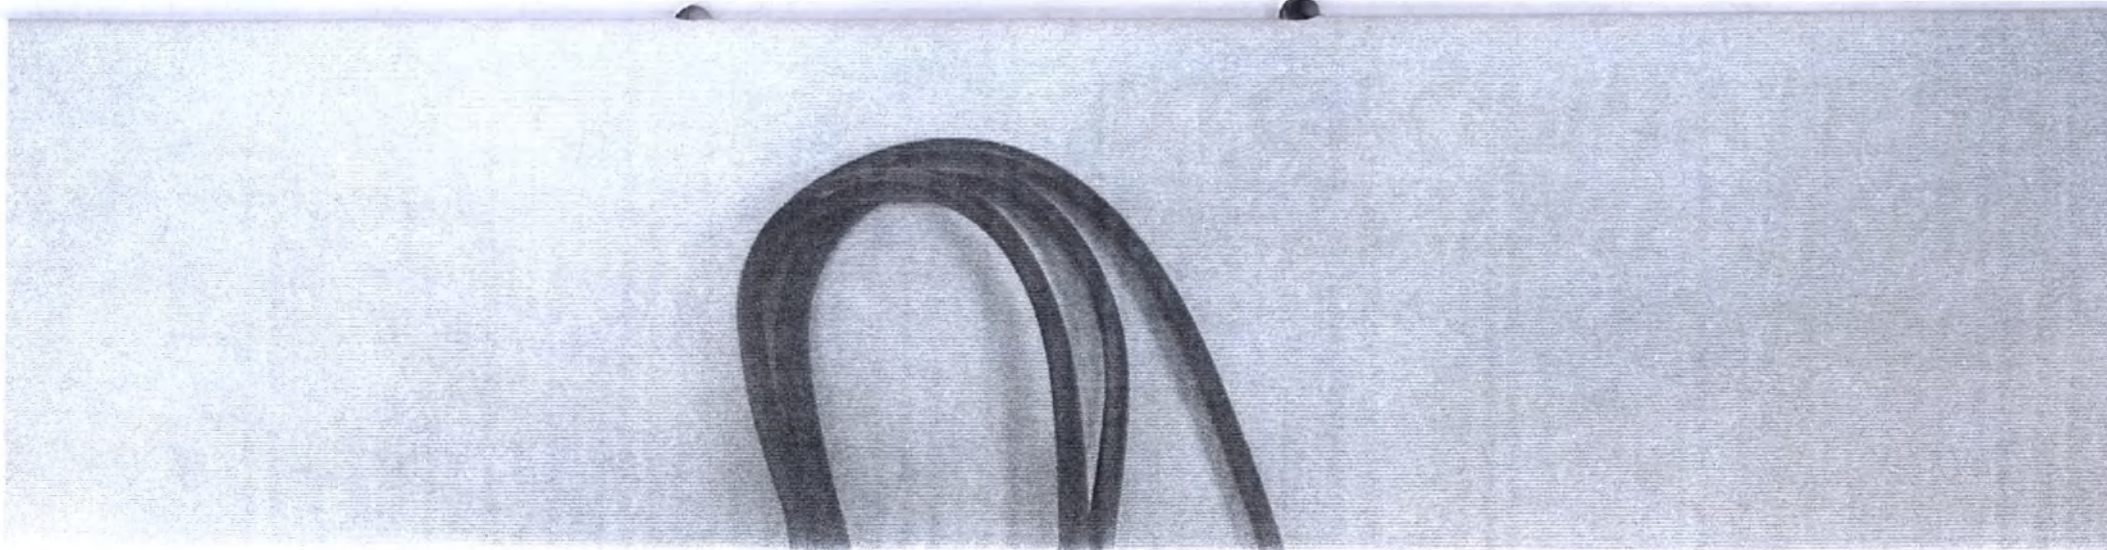








ОТСАСЫВАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ «Armed»

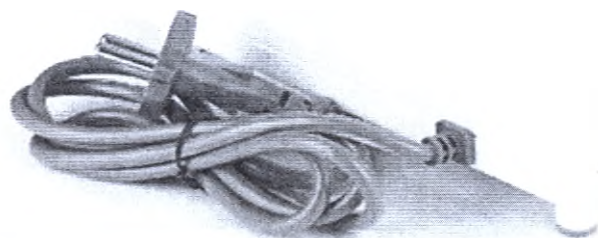



КОЛИЧЕСТВО: 1 шт.

www.armed.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12528 от 11 ноября 2020 г.
Отсасыватель предназначен для отсасывания крови, гноя и различных жидкостей, частиц тканей и газов из операционных ран и других полостей во время и после операций, для применения в перевязочных, хирургических, гинекологических и других отделениях лечебных учреждений.
Особенно необходим для оказания первой медицинской помощи в местах с отсутствием электрического источника питания.

ОТСАСЫВАТЕЛЬ
МЕДИЦИНСКИЙ «Armed

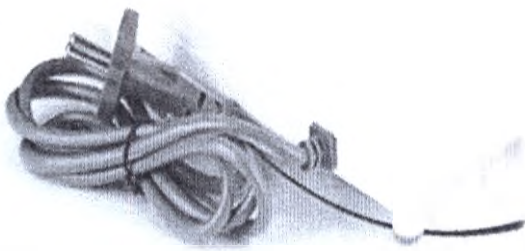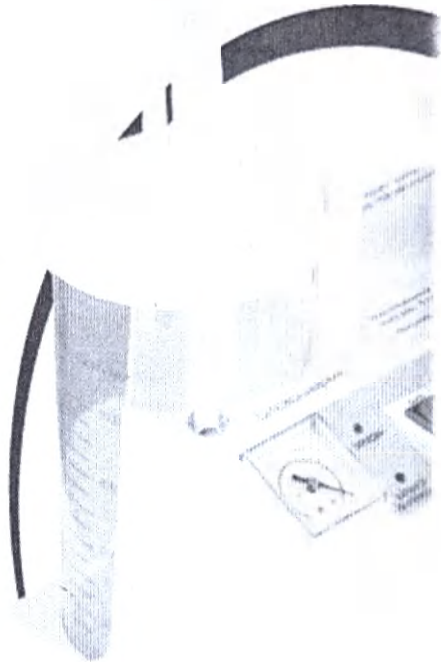7E-D



Срок службы: не менее 5 лет.
Срок гарантии: 12 месяцев
Дата выпуска:

Произведено
мент & Саппл
Yunyang Indus
Сити, Джангс
Импортер: ОО
630501, Ново

РЕГИСТРАЦИОННОЕ

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ
И ВНИМ



Легкость и удобство
управления



Низкий уровень
шума



Безмасляный
компрессор



Прозрачный резервуар
банка-сборника

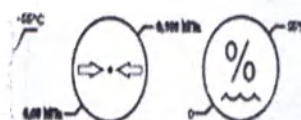


ment & Supply Co., Ltd, ("Джиангсу Юю Медикал Эквип-
Province, China 212310", (Юньян Индастриал парк, Данья

й р-н, р.п. Краснообск, д. 1/6, 2 этаж, пом. 227, 228

РЗН 2020/12528 от 11 ноября 2020 г.


ОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ
РУКОВОДСТВО.



4 680018 375794

Рис. 81 – Макет упаковки на примере исполнения 7E-D (вид справа)

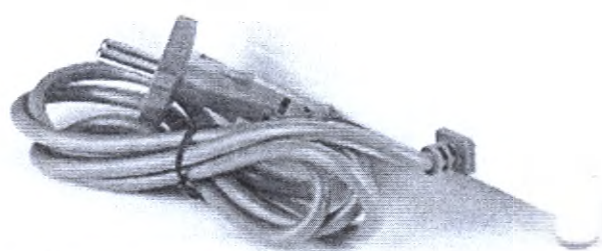ОТСАСЫВАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ «Armed»




КОЛИЧЕСТВО: 1 шт.

www.armed.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12528 от 11 ноября 2020 г.
Отсасыватель предназначен для отсасывания крови, гноя и различных жидкостей, частиц тканей и газов из операционных ран и других полостей во время и после операций, для применения в перевязочных, хирургических, гинекологических и других отделениях лечебных учреждений.
Особенно необходим для оказания первой медицинской помощи в местах с отсутствием электрического источника питания.

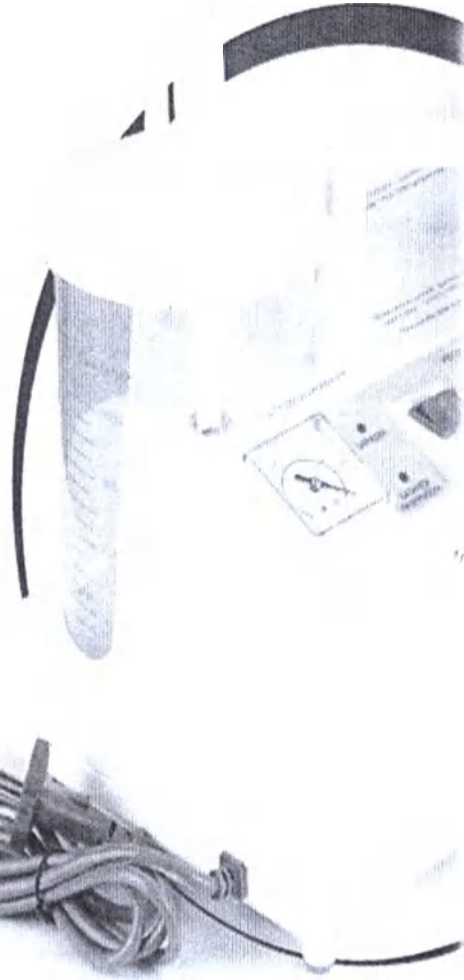7E-D



Срок службы: не менее 5 лет.
Срок гарантии: 12 месяцев
Дата выпуска:

Произведено: J
мент & Сапплай
Yunyang Industria
Сити, Джянсу
Импортер: ООО
630501, Новоси

РЕГИСТРАЦИОННОЕ У

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕ
И ВНИМА



Легкость и удобство
управления



Низкий уровень
шума



Безмасляный
компрессор



Прозрачный резервуар
банка-сборника

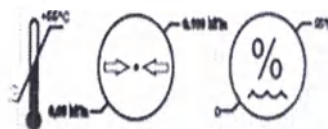


ipment & Supply Co., Ltd. ("Джянсу Юю Медикал Эквип-
и Province, China 212310 ", (Юньянг Индастриал парк, Данья

ский р-н, р.п. Краснообск, д. 1/6, 2 этаж, пом. 227, 228

№ РЗН 2020/12528 от 11 ноября 2020 г.

ОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ
В РУКОВОДСТВО.



Отсасыватель
Регистрационное
от

кий «Armed»: 7E-D
ение РЗН 2020/12528
2020 г.



Jiangsu Yuyue Medi
Медикал Эквипмент
Yunyang Industrial p
(Юньянг Индастриа
212310).

& Supply Co., Ltd. («Джиангсу Юк
, Лтд.»),
City, Jiangsu Province, China 212310
янг Сити, Джиангсу Провинс, Китай

Импортёр: ООО «Медимпорт»
630501, Новосибирская обл., Нов
227, 228

н, р.п. Краснообск, д. 1/6, 2 этаж, пом.

Напряжение питания:
1. Сеть переменного тока: ~
Частота сети: 50 Гц ± 2%
2. Сеть постоянного тока: ==
Потребляемая мощность не
Максимальное отрицательное
Время цикла: 30 мин. работ

%

3*А

е: 75 кПа

В перерыв

⊖ ⊕ в прикуриват
высокий вакуум / низкий рас

 IPX1





Дата выпуска

Заводской номер

Катетер F8

Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd., Yunyang Industrial park, Danyang City, Jiangsu Province
China 212310

«Джиангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд.», Юньянг Индастриал парк, Даньянг Сити
Джиангсу Провинс, Китай 212310

211009

Катетер F12
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd. Yunyang Industrial park, Dongying City, Shandong Province, China

длина основной части катетера 500 мм

LOT 181010



211009

STERILE EO

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью *87*
восемьдесят лист *ов*
семь

Генеральный директор
ООО «МЕДИМПОРТ»
Леонтьев А.М.



Фотографии медицинского изделия
«Отсасыватель медицинский «Armed»,
производство: Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd., Китай

- I. Отсасыватель медицинский «Armed», вариант исполнения 7E-A, в составе (рис. 1-8);
- II. Отсасыватель медицинский «Armed», вариант исполнения 7E-B, в составе (рис. 9-15);
- III. Отсасыватель медицинский «Armed», вариант исполнения 7E-C, в составе (рис. 16-24);
- IV. Отсасыватель медицинский «Armed», вариант исполнения 7E-D, в составе (рис. 25-35);
- V. Отсасыватель медицинский «Armed», вариант исполнения 7E-G, в составе (рис. 36-46);
- VI. Отсасыватель медицинский «Armed», вариант исполнения 7A-23B, в составе (рис. 47-55);
- VII. Отсасыватель медицинский «Armed», вариант исполнения 7A-23B-1, в составе (рис. 56-64);
- VIII. Отсасыватель медицинский «Armed», вариант исполнения 7A-23D, в составе (рис. 65-73);
- IX. Отсасыватель медицинский «Armed», вариант исполнения 7E-B5, в составе (рис. 74-79);
- X. Упаковка медицинского изделия (рис. 80-83);
- XI. Маркировка медицинского изделия (рис. 84-86).

Генеральный директор
(должность)

(подпись и печать)

(А.М. Леонтьев)
(И.О. Фамилия)

от имени Общества с ограниченной ответственностью «МЕДИМПОРТ» (ООО «МЕДИМПОРТ»)

(наименование организации-заявителя)

Приложение

I. Отсасыватель медицинский «Agmed», вариант исполнения 7E-A, в составе:



Рис. 1 – Отсасыватель



Рис. 2 – Катетер F8



Рис. 3 – Катетер F12

27218
19.04.2021



Рис. 4 – Трубка аспирационная

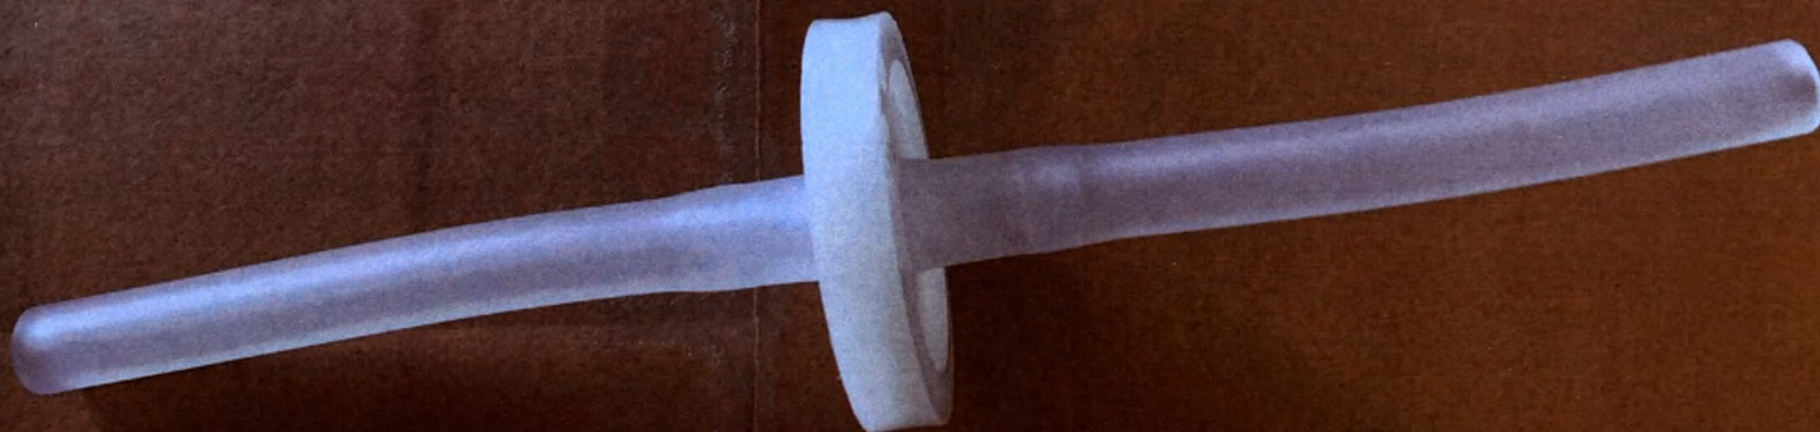


Рис. 5 – Трубки соединительные с фильтром в сборе



Рис. 6 – Фильтр воздушный (2 шт.)



Рис. 7 – Зажим



Рис. 8 – Предохранитель плавкий 1,5А (2 шт.)



Рис. 9 – Отсасыватель

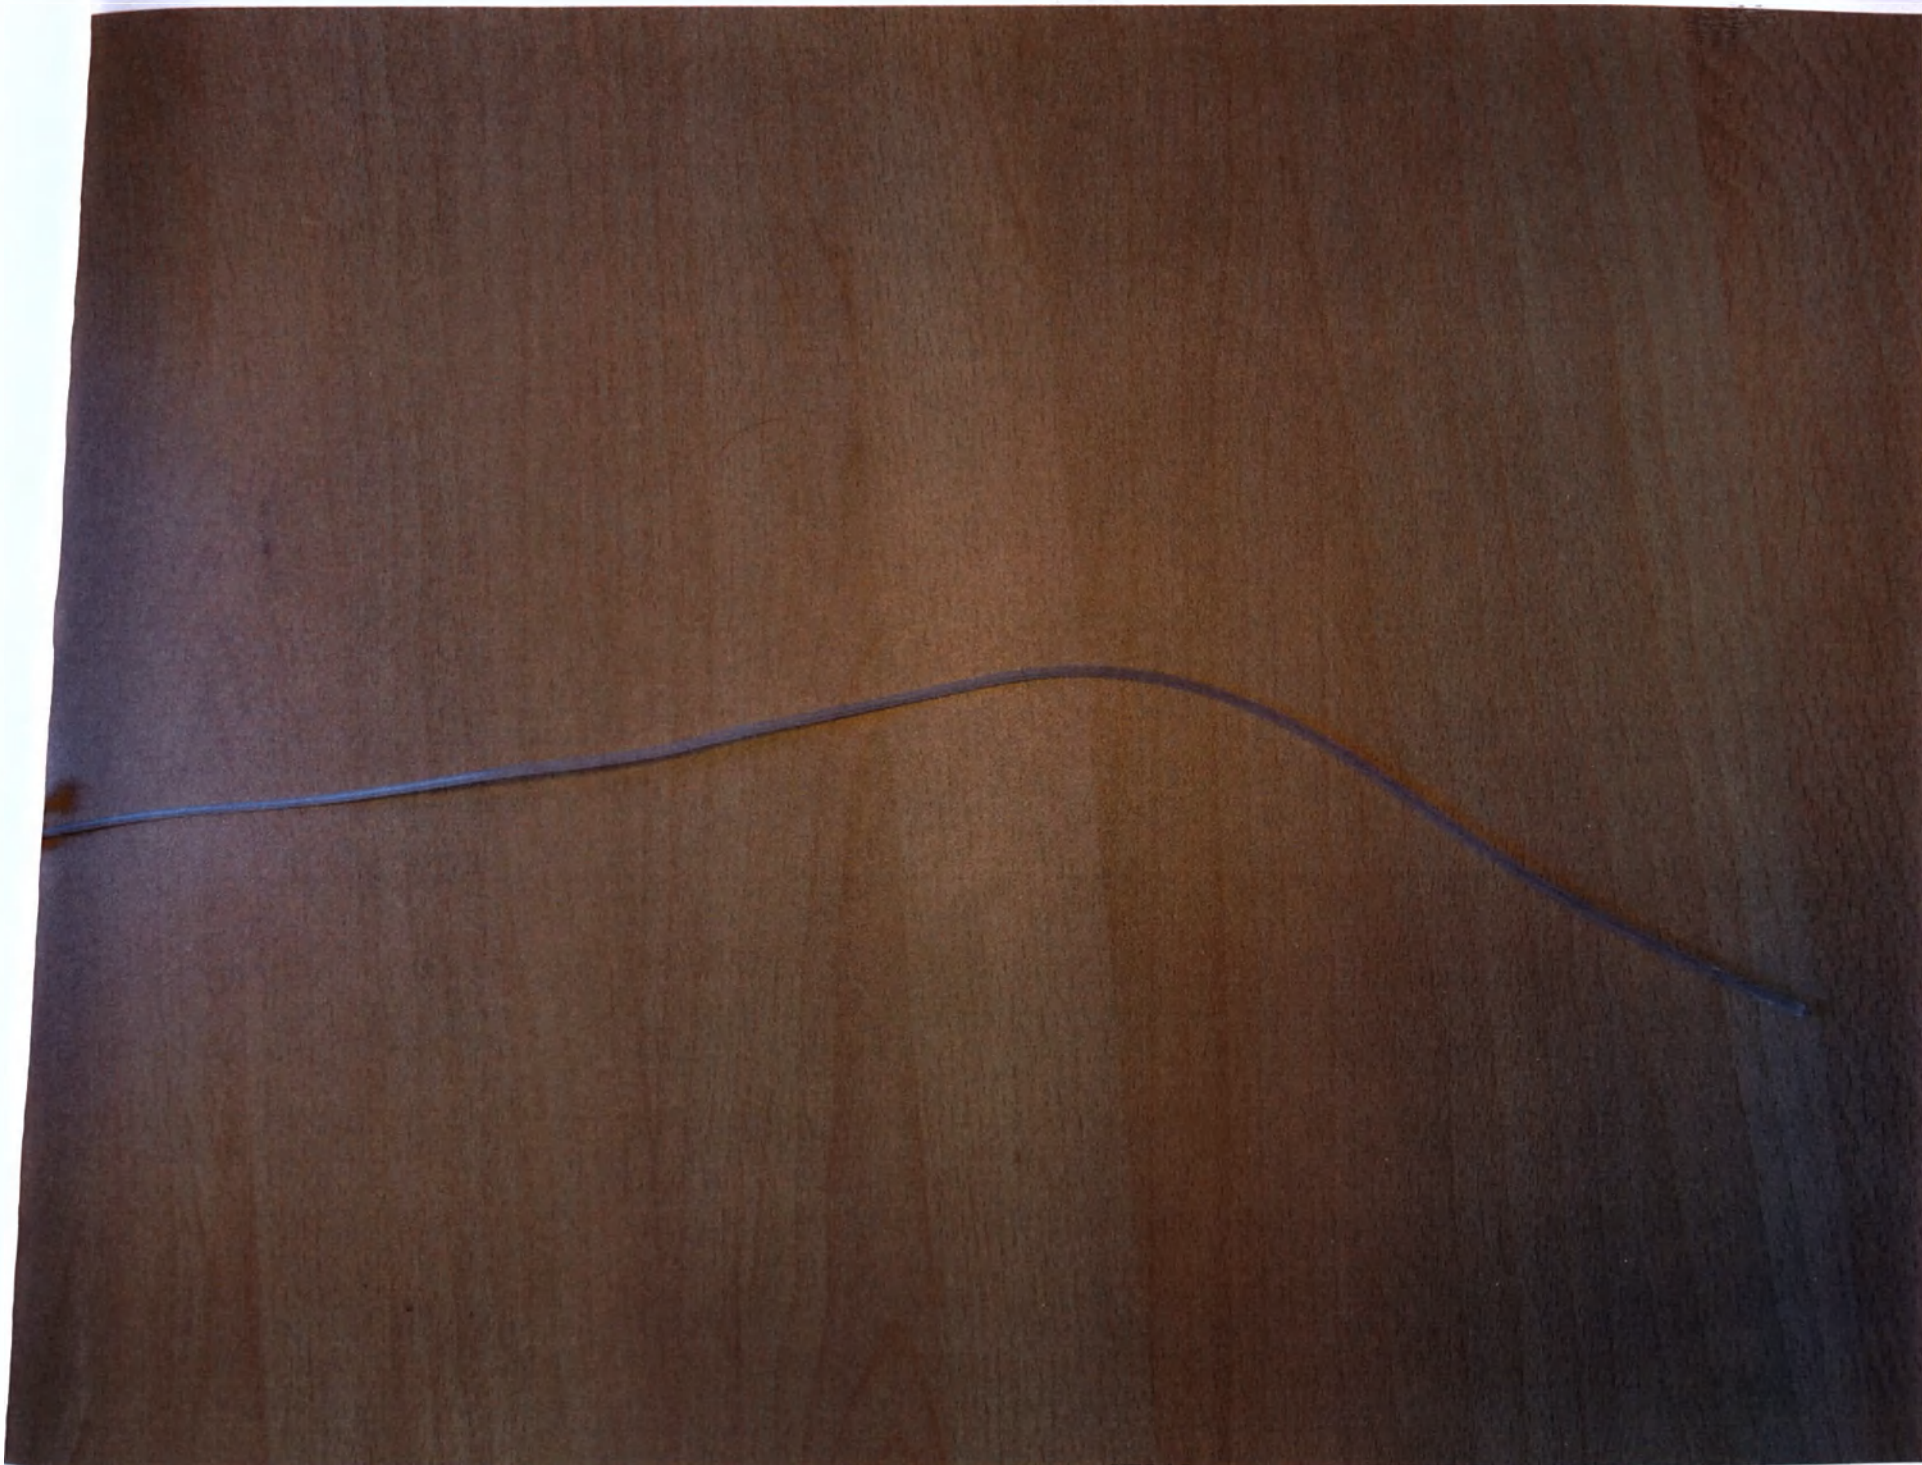


Рис. 10 – Катетер F8

27218
19.04.2021



Рис. 11 – Трубка аспирационная

27218
19.04.2021

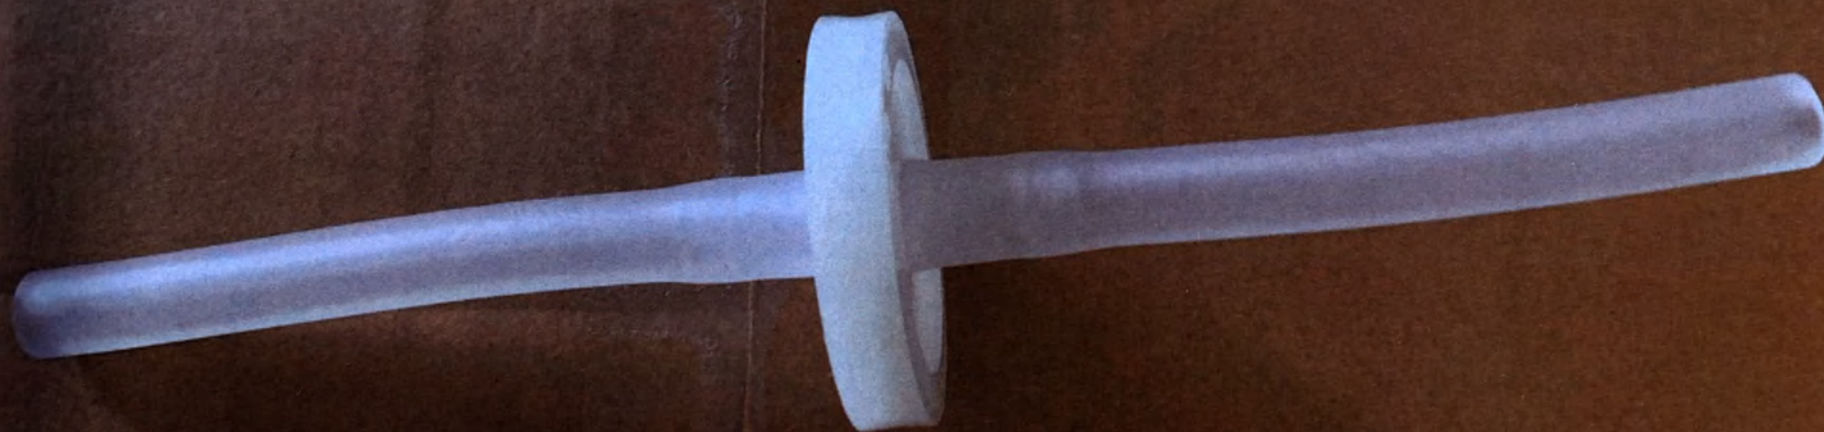


Рис. 12 – Трубки соединительные с фильтром в сборе

19.04.2021



Рис. 13 – Фильтр воздушный (2 шт.)



Рис. 14 - Зажим



Рис. 15 – Предохранитель плавкий 1,5А (2 шт.)

III. Отсасыватель медицинский «Armed», вариант исполнения 7Е-С, в составе:



Рис. 16 – Отсасыватель

27218
19.04.2021

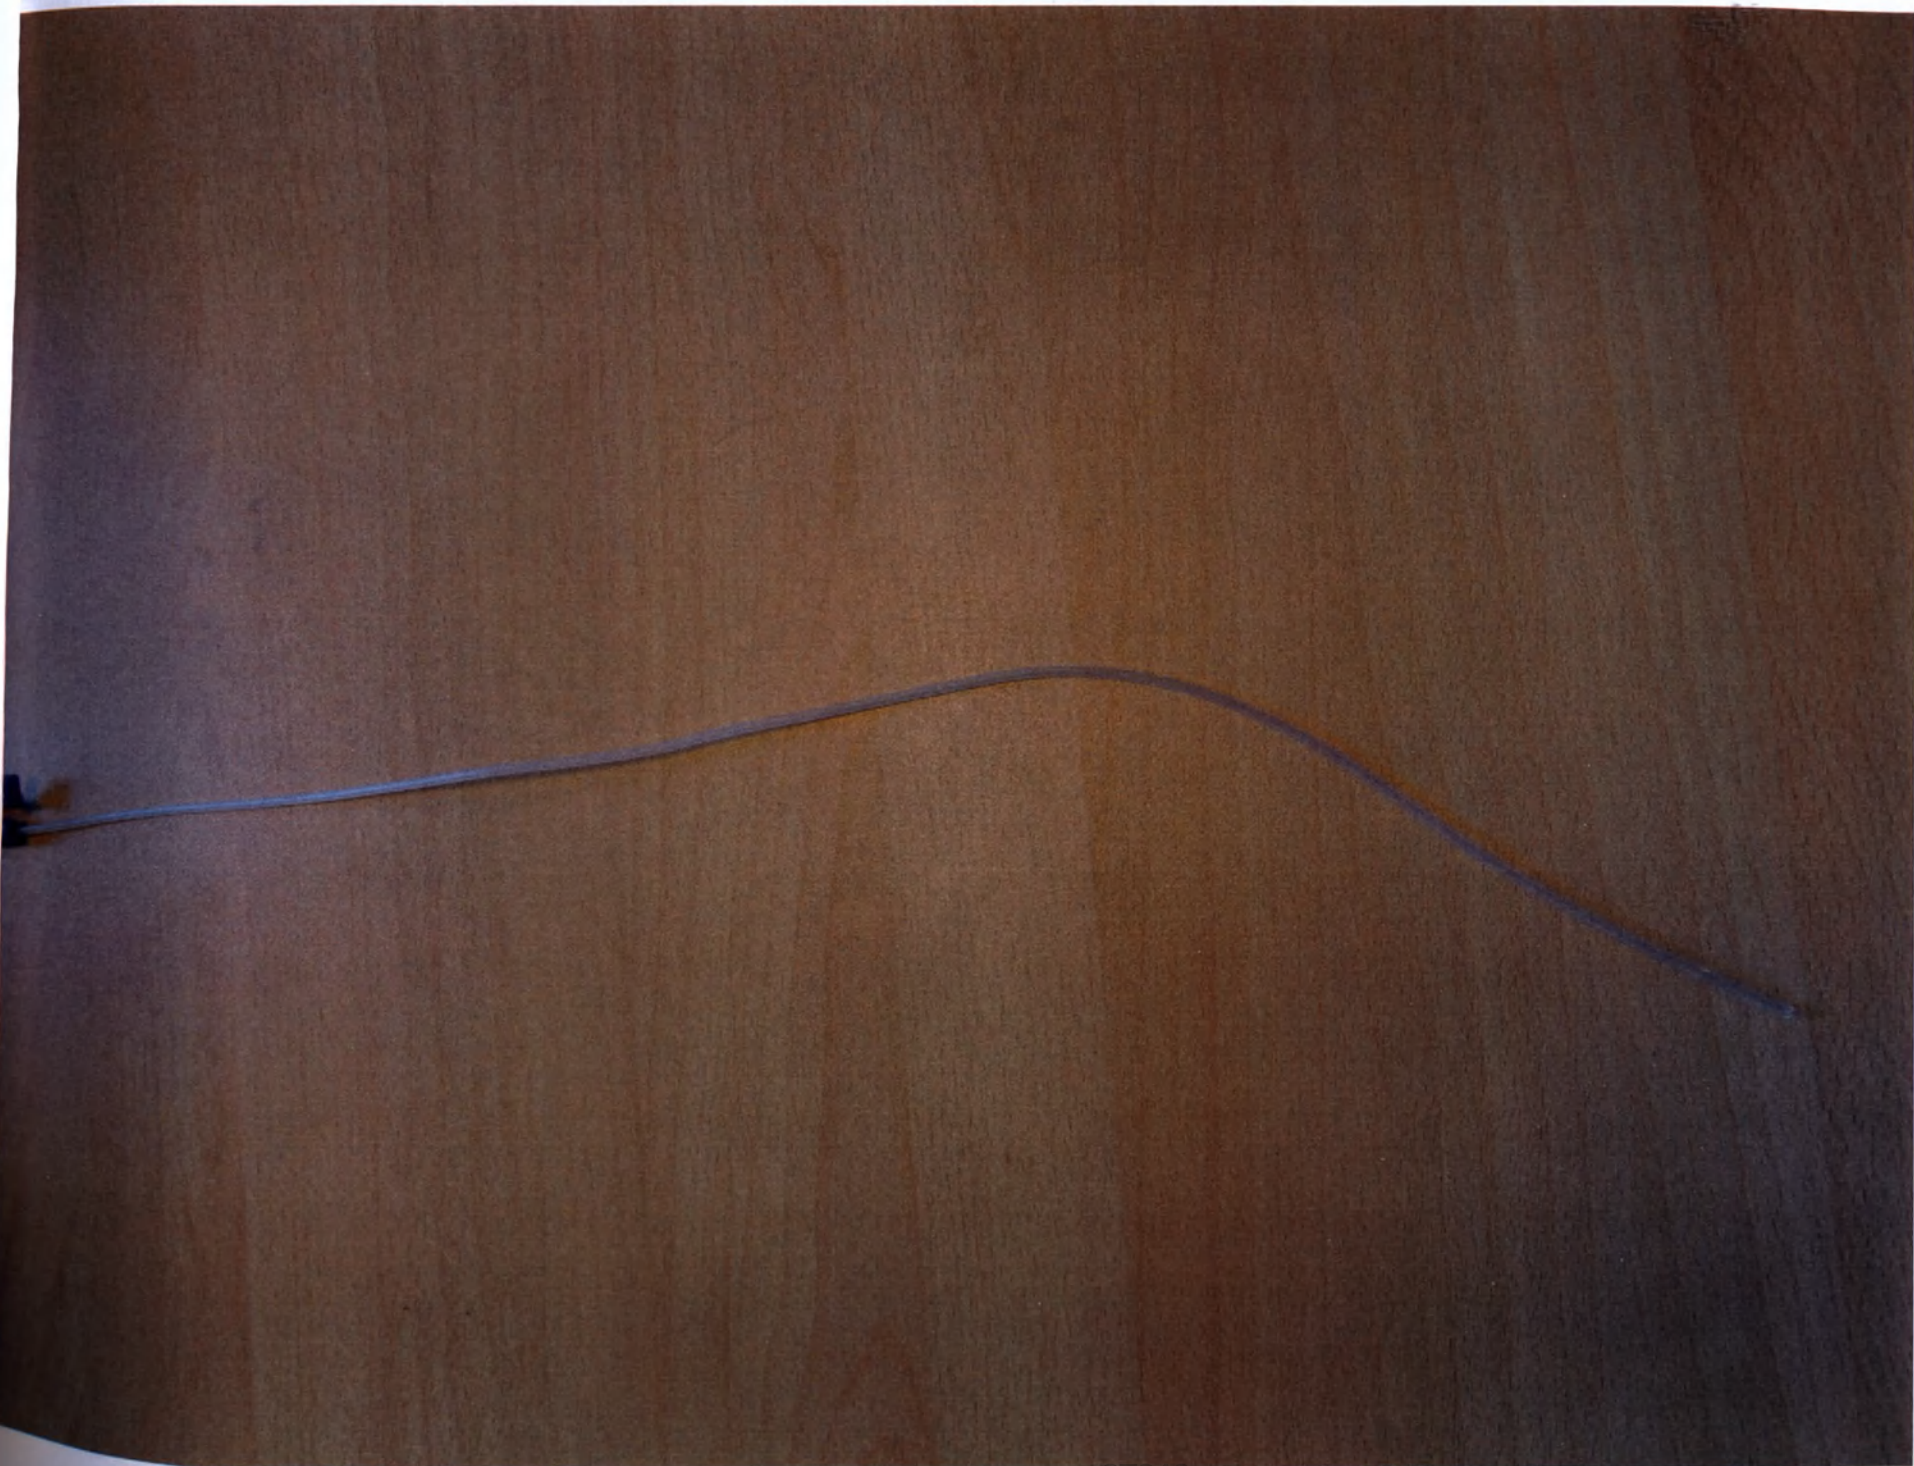


Рис. 17 – Катетер F8

27218
19.04.2021

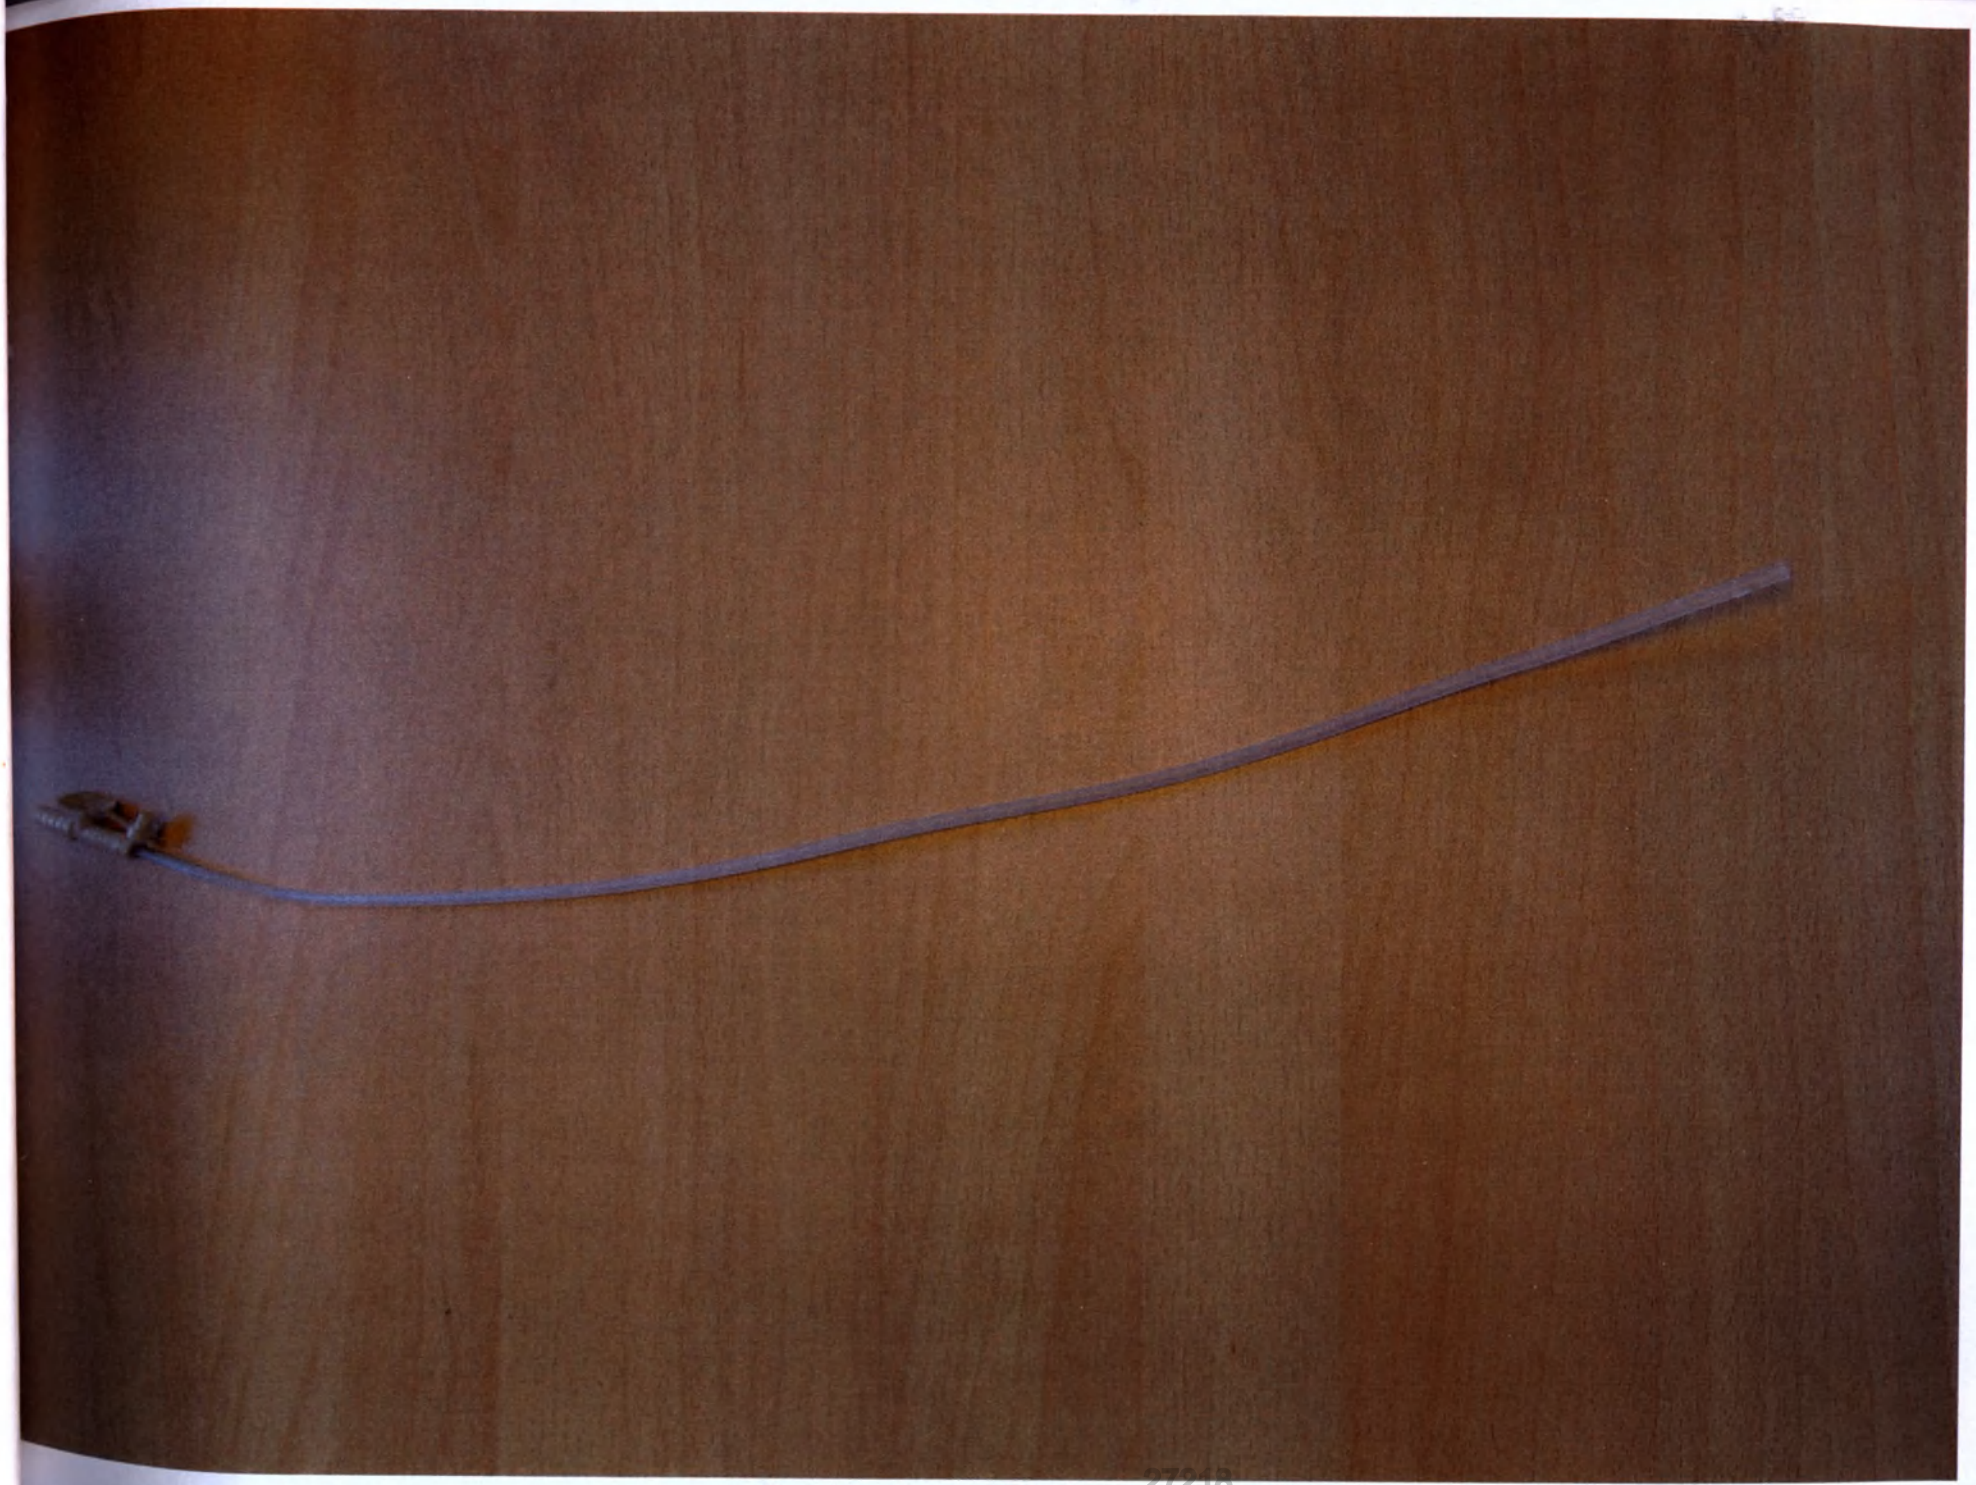


Рис. 18 – Катетер F12

27218
19.04.2021



Рис. 19 – Трубка аспирационная 27218
19.04.2021

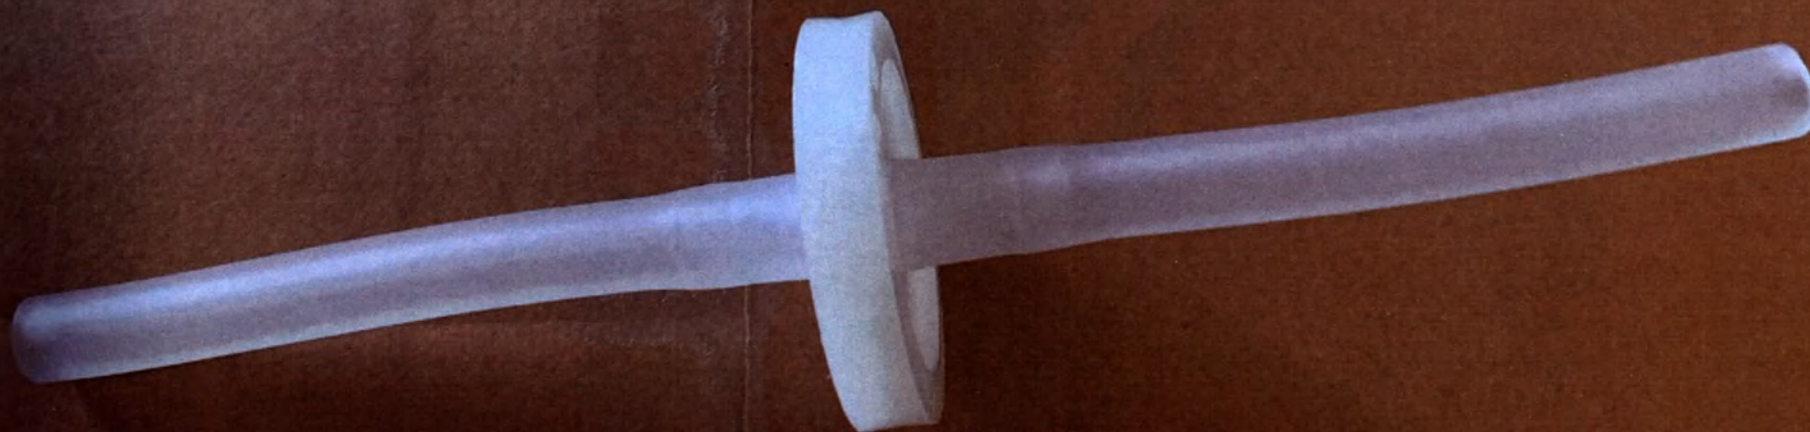


Рис. 20 – Трубки соединительные с фильтром в сборе



Рис. 21 – Фильтр воздушный (2 шт.)



Рис. 22 – Шнур питания

27218
19.04.2021



Рис. 23 – Зажим

27/218
19.04.2021



Рис. 24 – Предохранитель плавкий 1,5А (2 шт.)

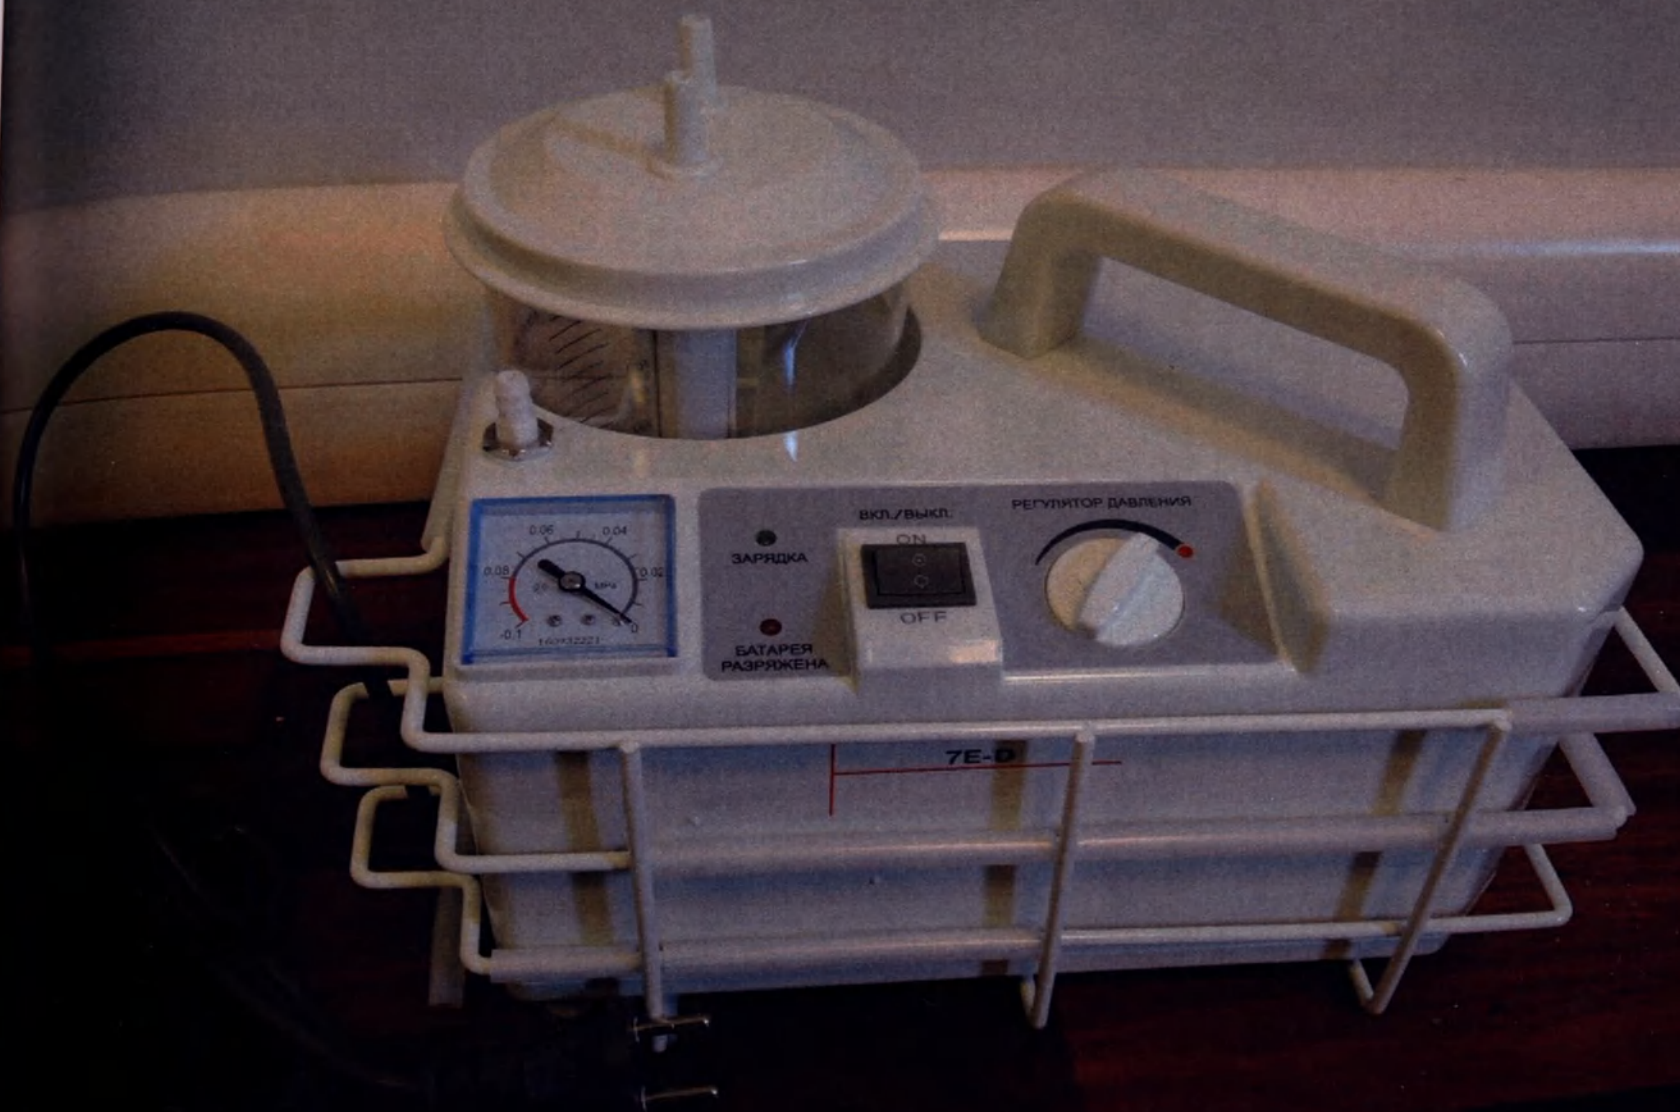


Рис. 25 – Отсасыватель

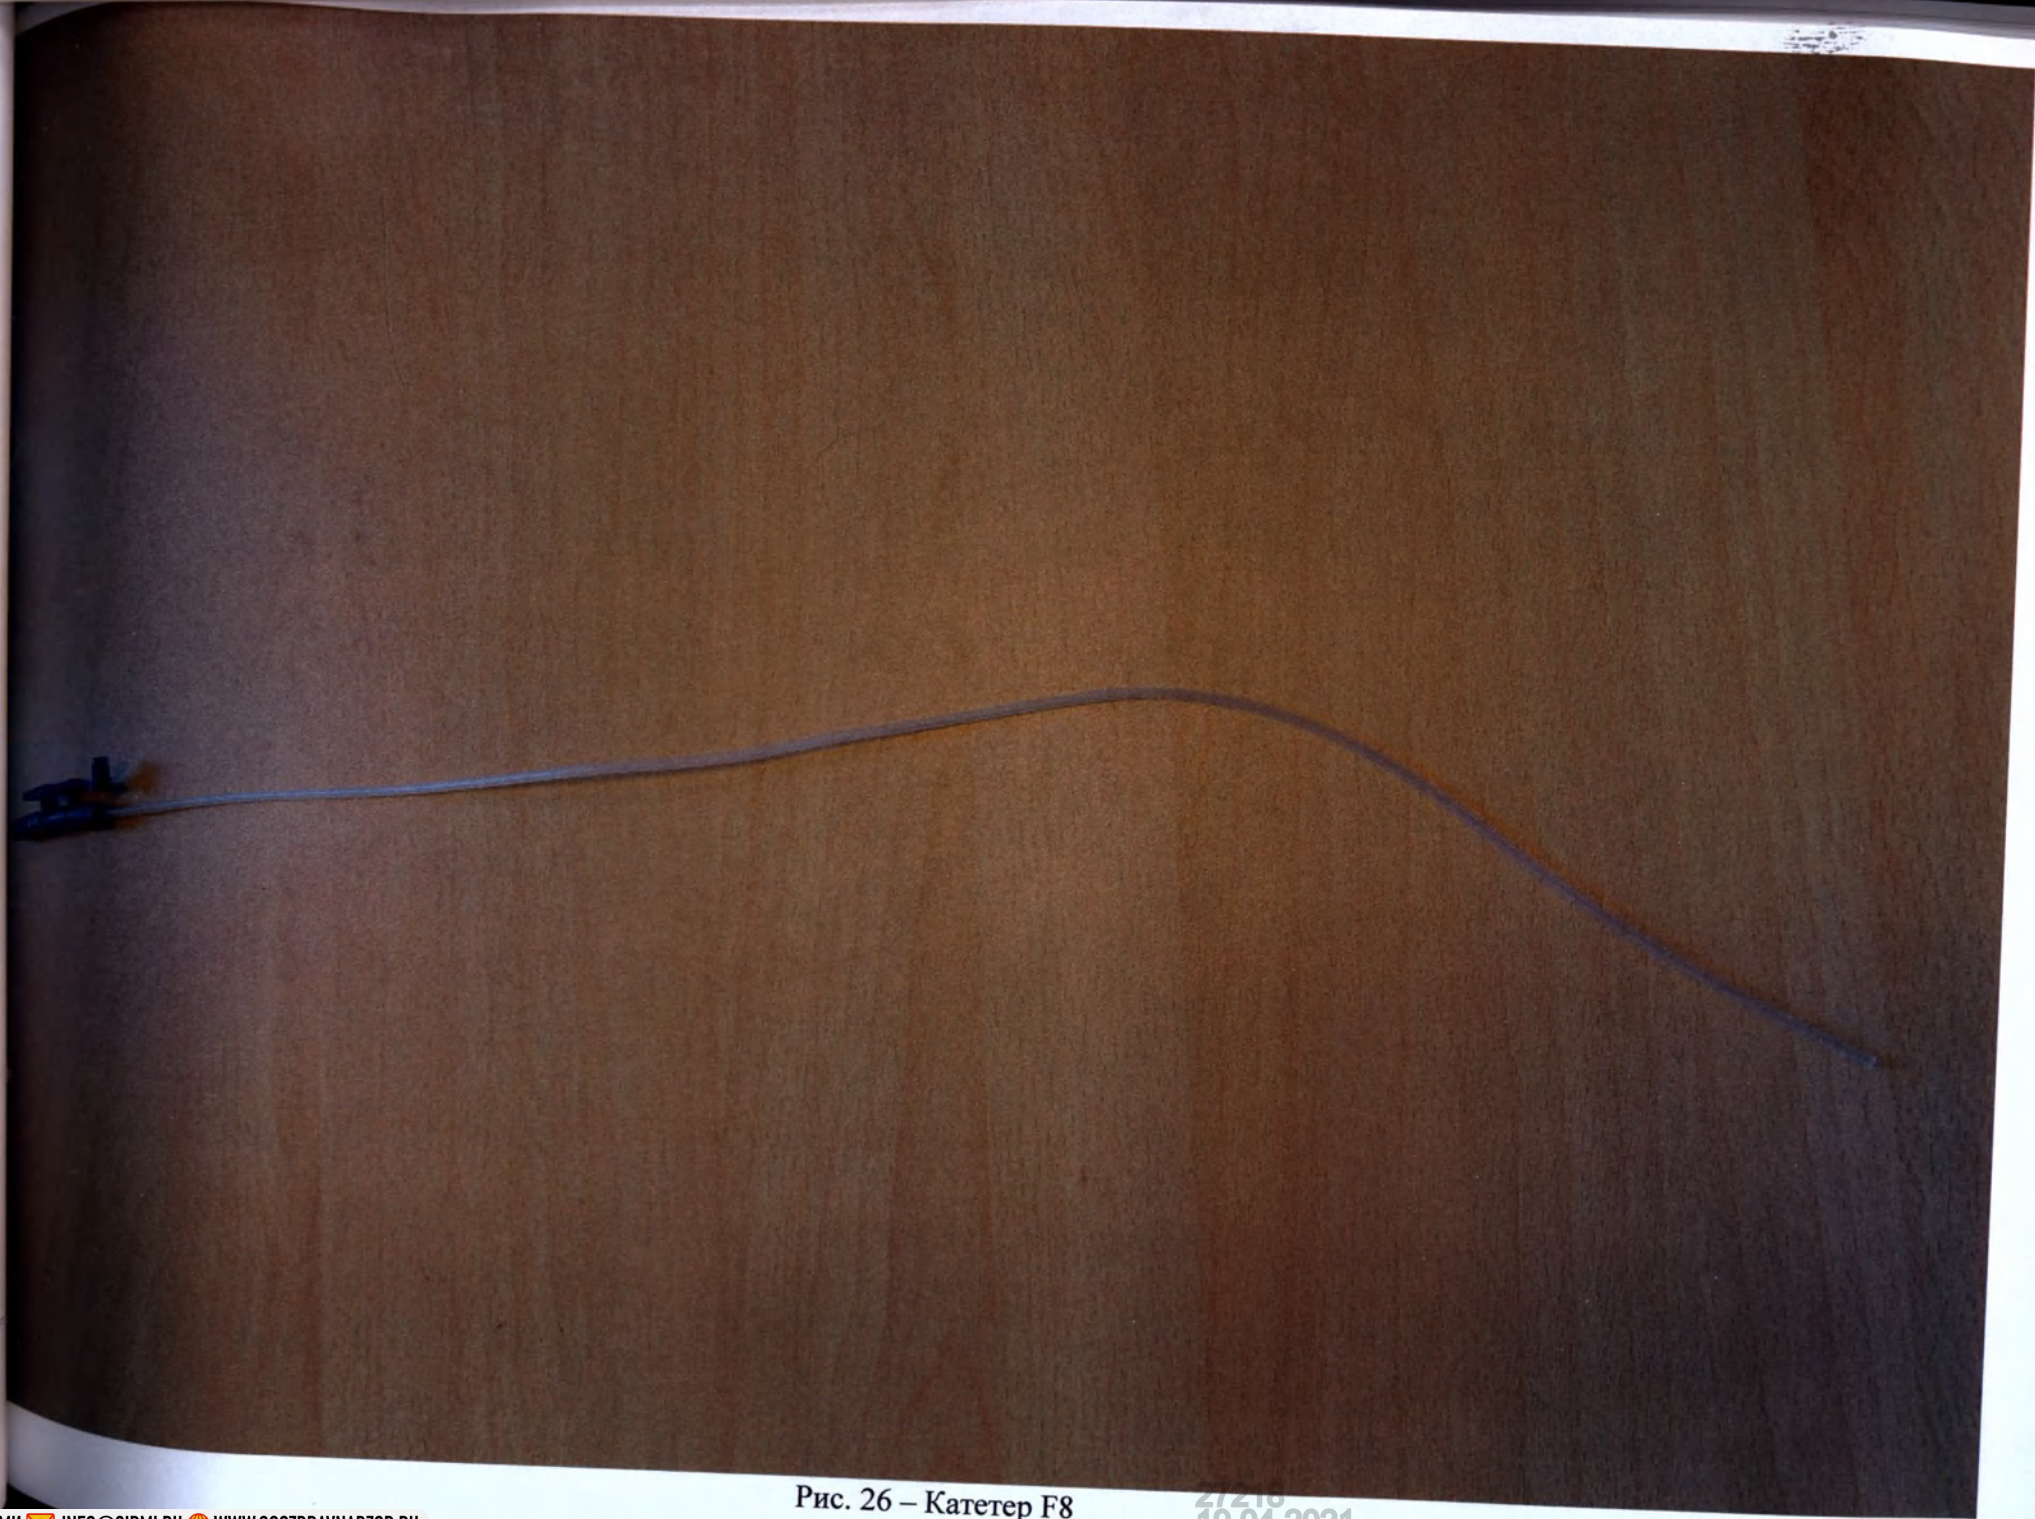


Рис. 26 – Катетер F8

27218
19.04.2021

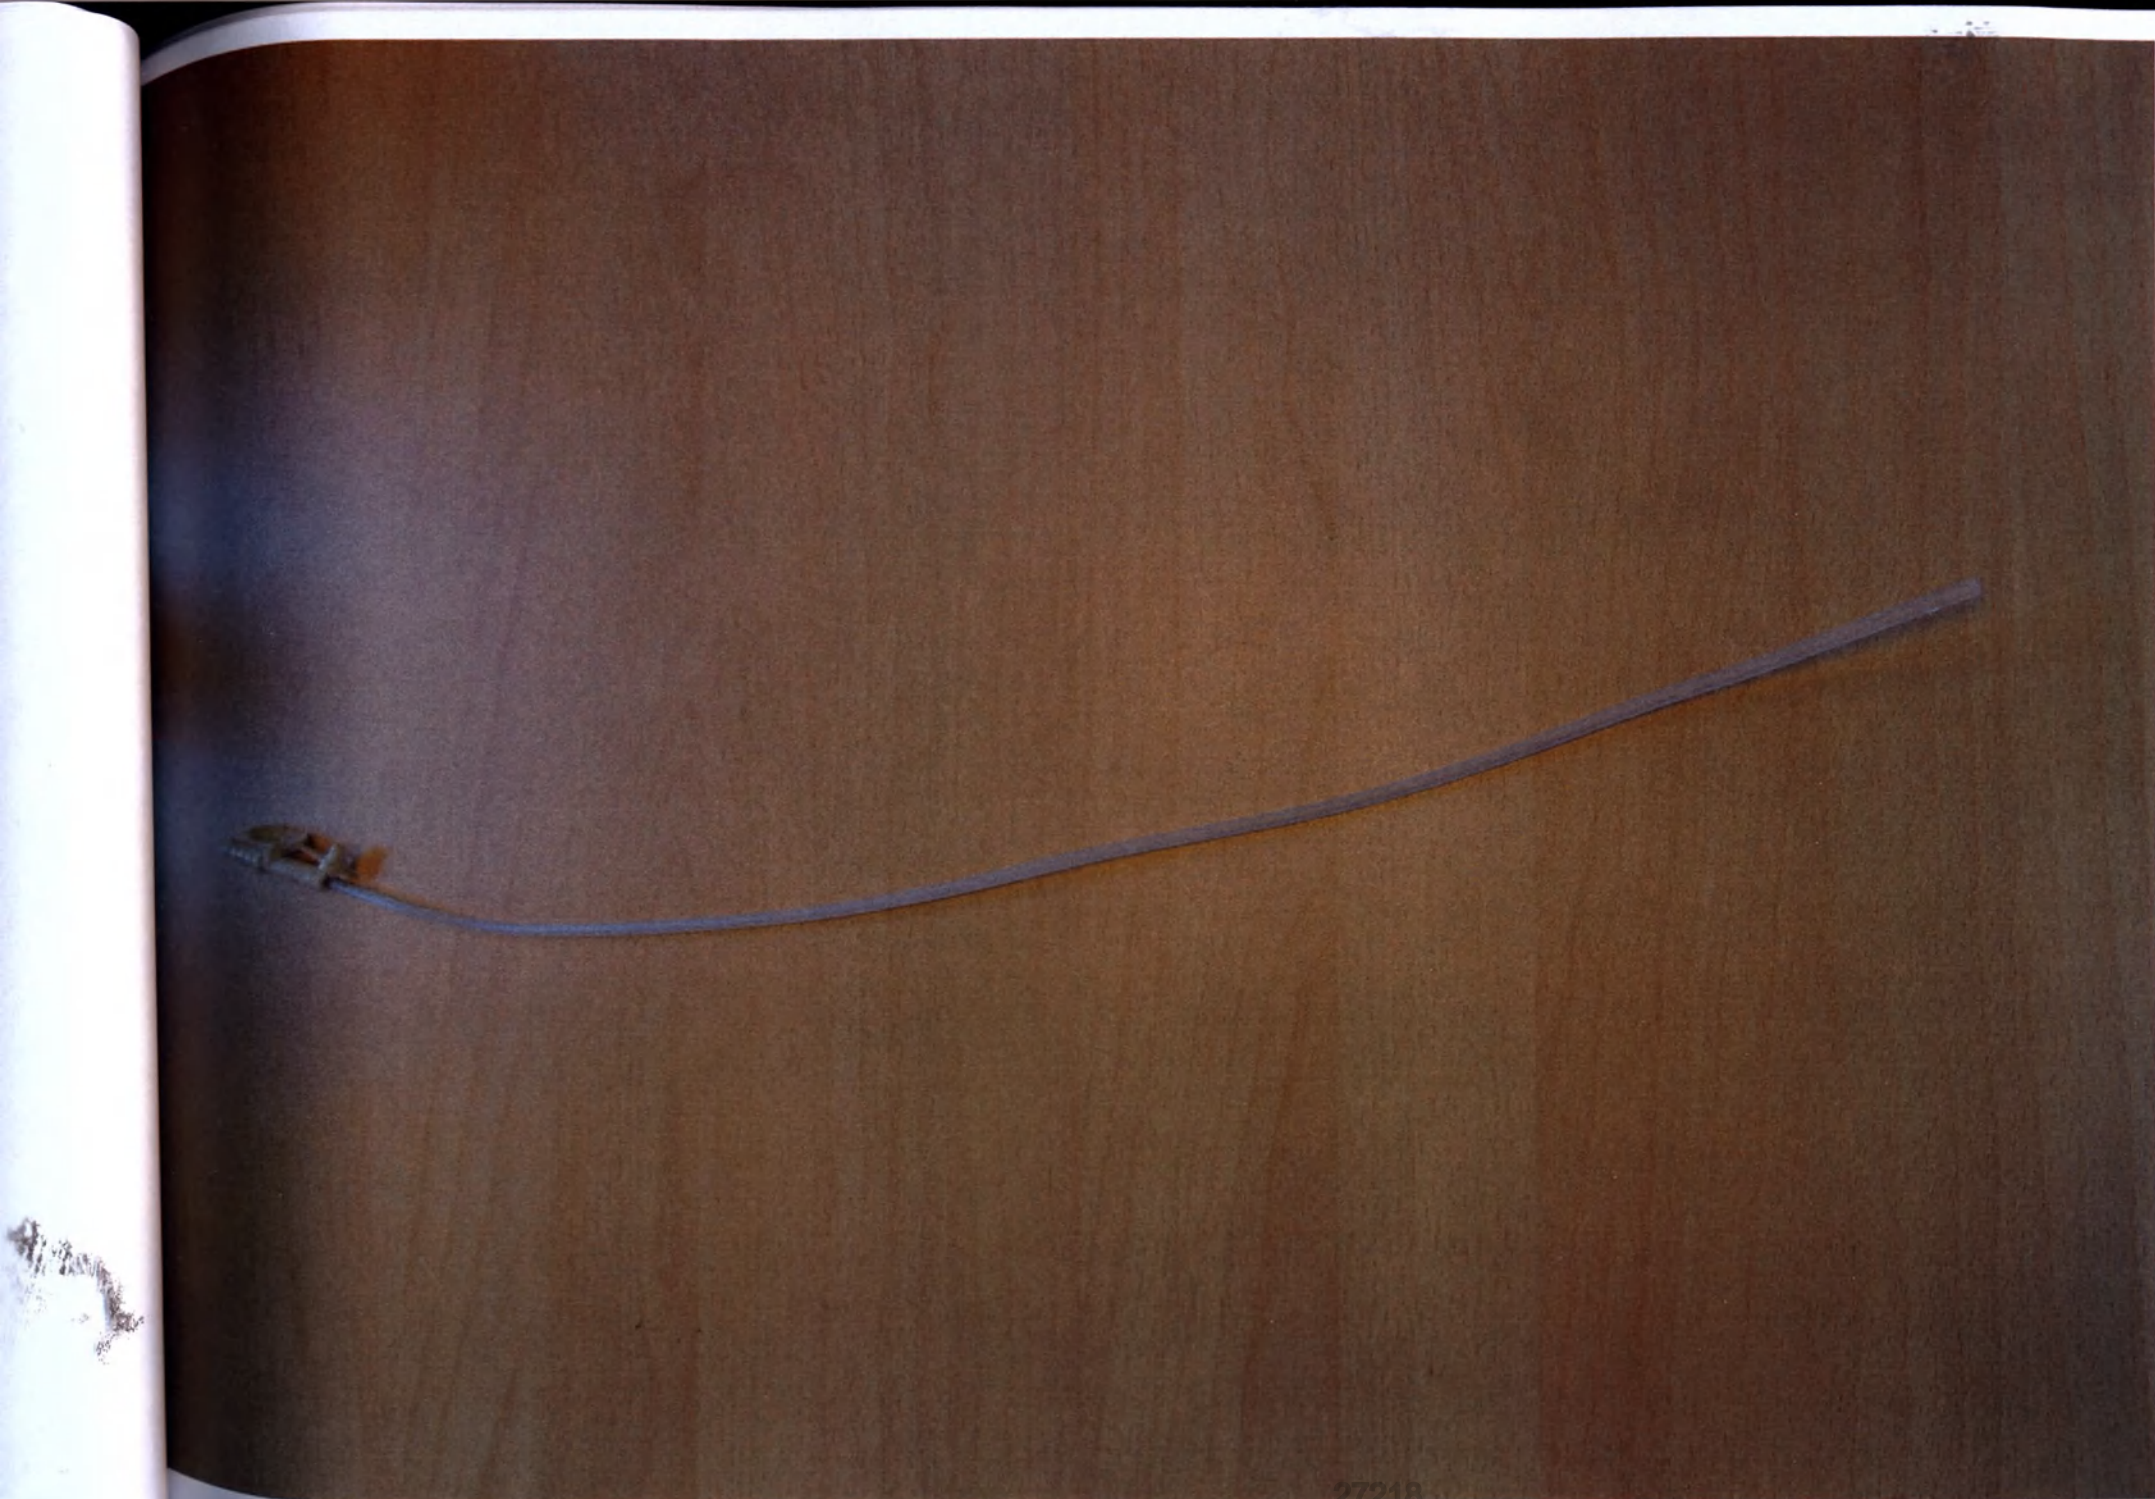


Рис. 27 – Катетер F12

27240
19.04.2021



Рис. 28 – Трубка аспирационная

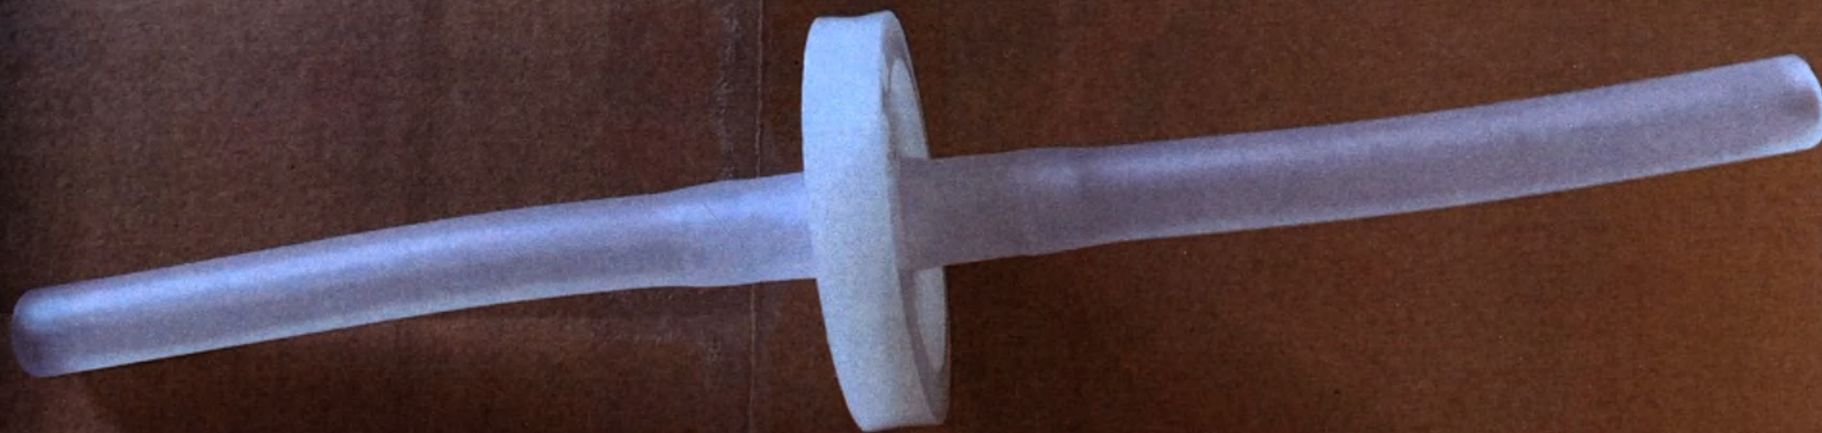


Рис. 29 – Трубки соединительные с фильтром в сборе



Рис. 30 – Фильтр воздушный (2 шт.)

27218
19.04.2021



Рис. 31 – Зажим

47218
19.04.2021

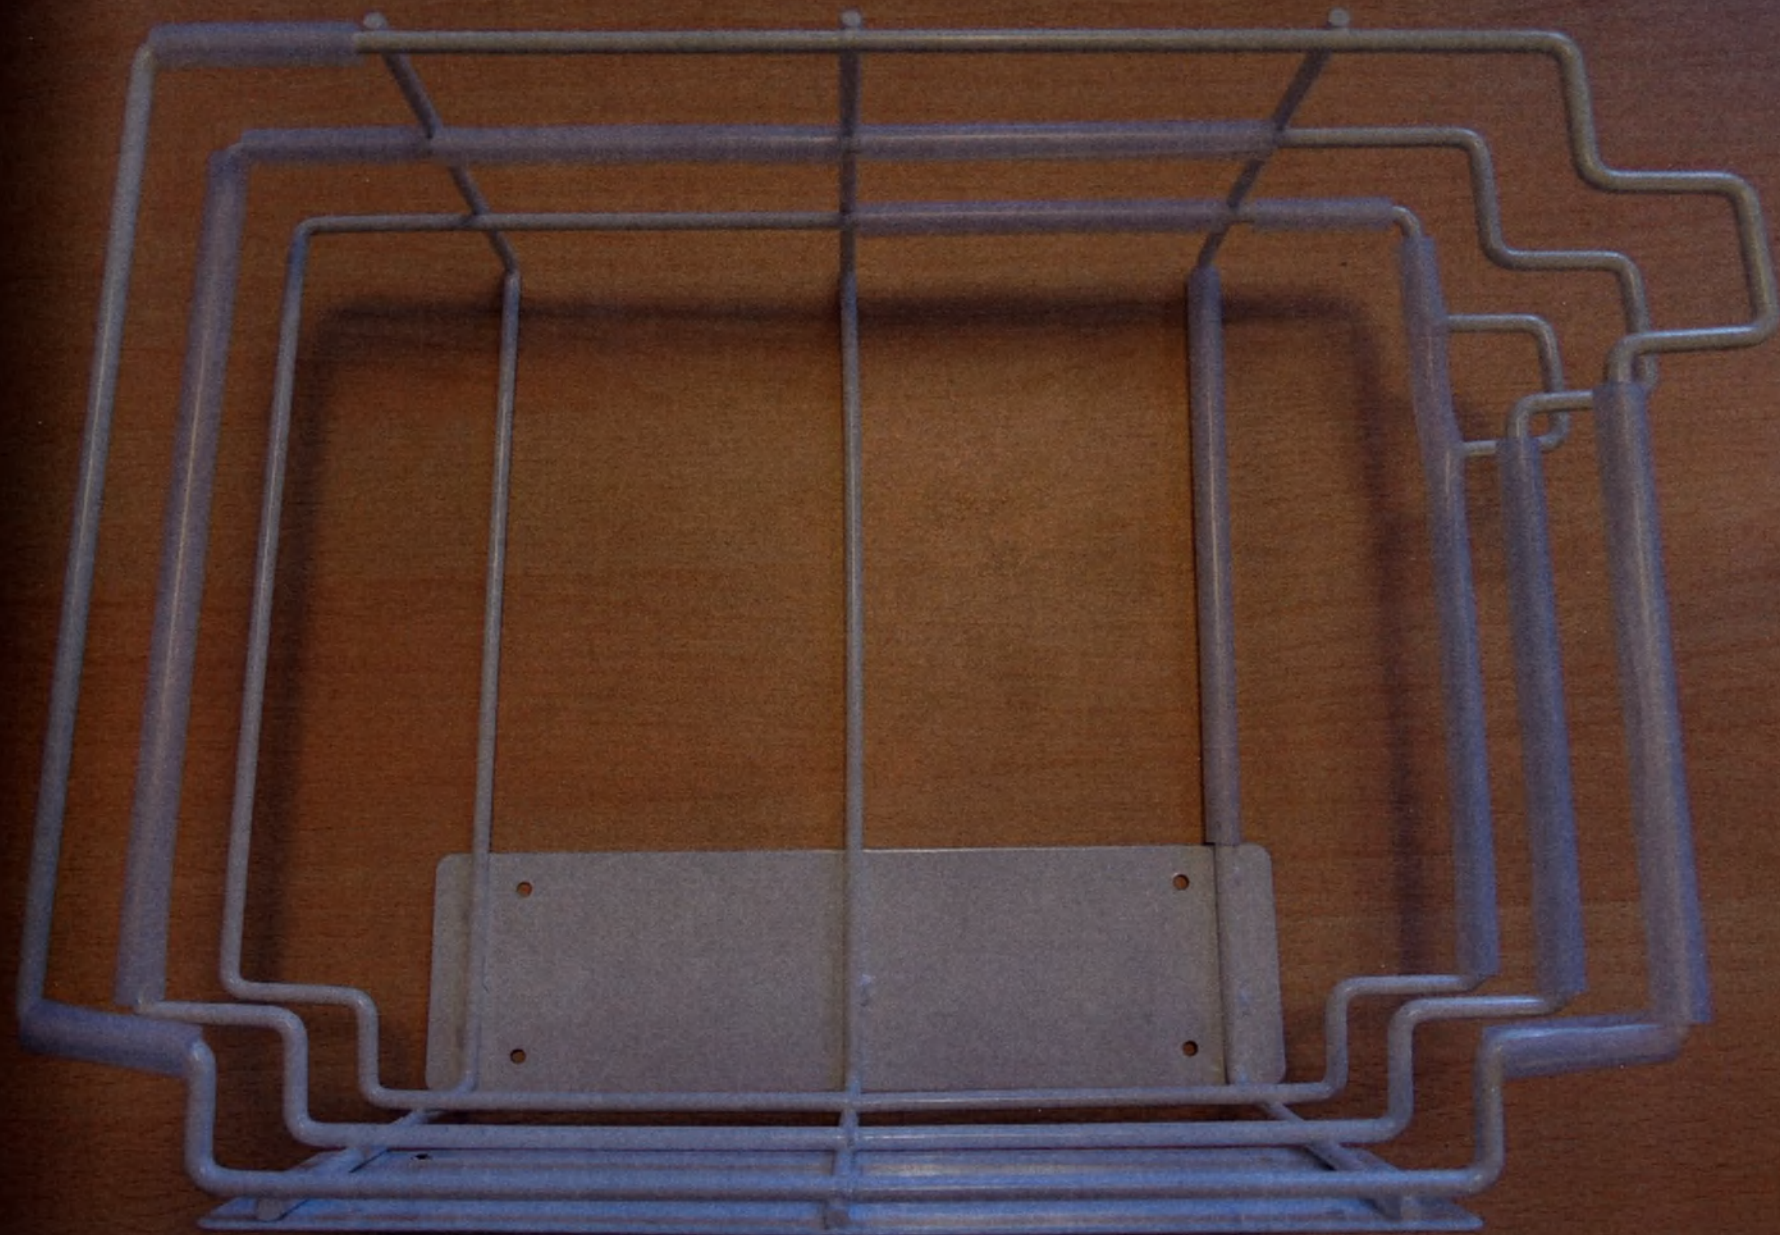


Рис. 32 – Кронштейн установочный



Рис. 33 – Кабель питания от бортсети автомобиля 12 В



Рис. 34 – Предохранитель плавкий 1,5А (2 шт.) 2021



Рис. 35 – Предохранитель плавкий 3А (3 шт.)





Рис. 37 – Катетер F8

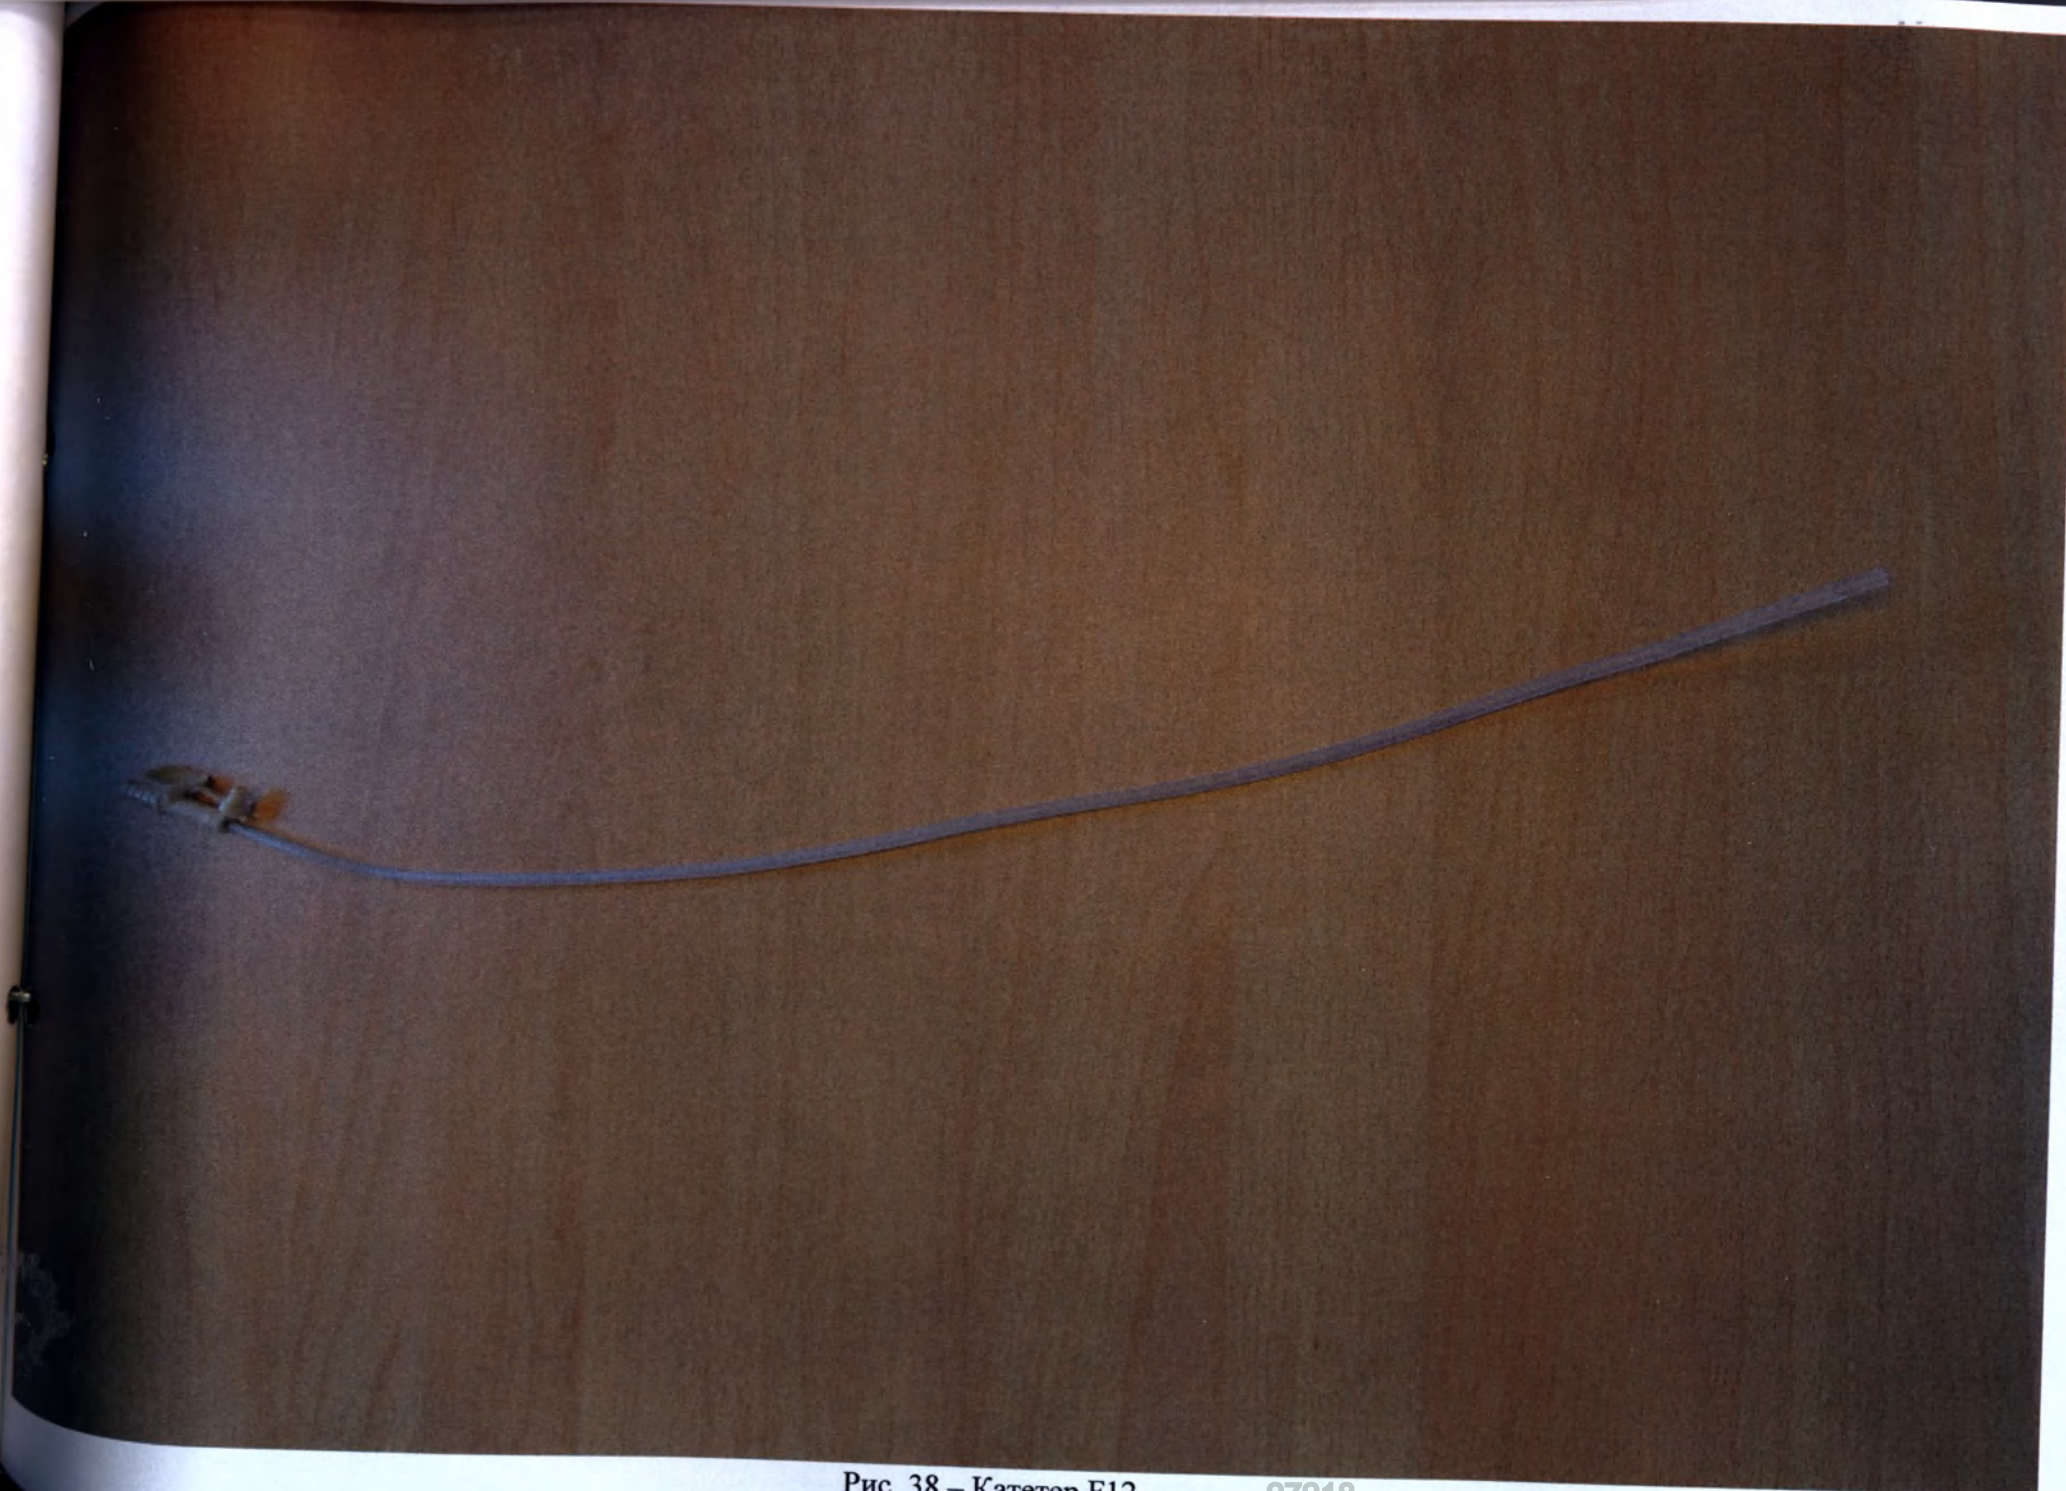


Рис. 38 – Катетер F12

27218
19.04.2021



Рис. 39 – Трубка аспирационная

27218
19.04.2021

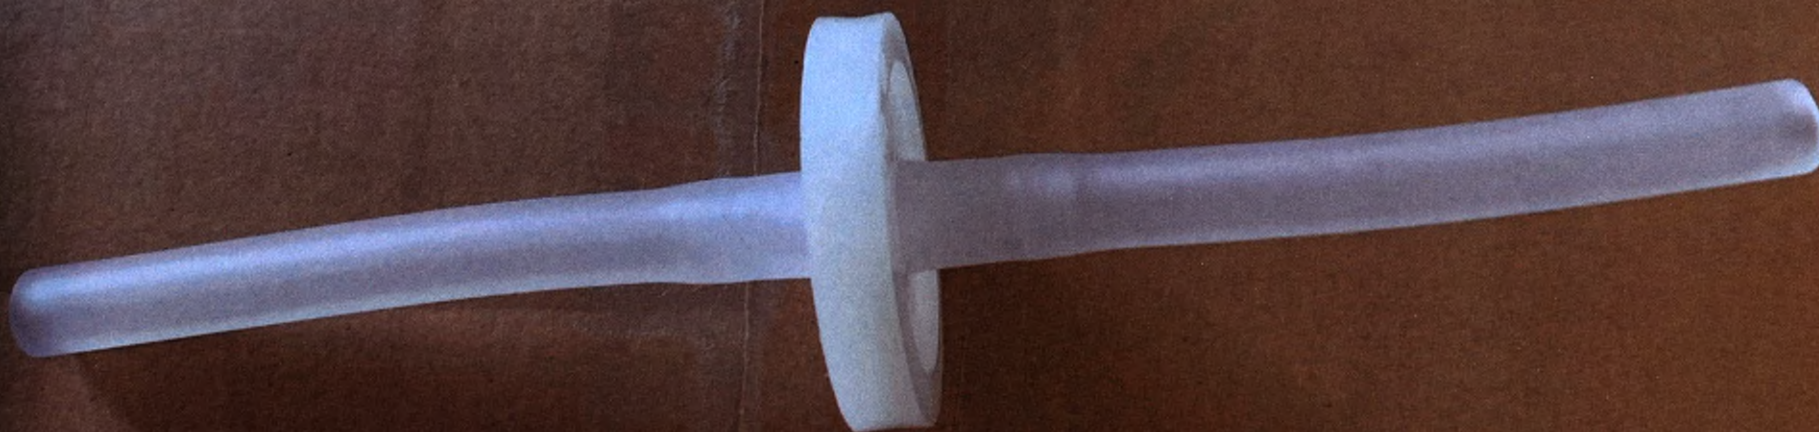


Рис. 40 – Трубки соединительные с фильтром в сборе



Рис. 41 – Фильтр воздушный (2 шт.) 19.04.2021



Рис. 43 – Зажим



Рис. 44 – Кабель питания от бортсети автомобиля 12 В



Рис. 45 – Предохранитель плавкий 1,5А (2 шт.)



Рис. 46 – Предохранитель плавкий 4А (3 шт.)



Рис. 47 – Отсасыватель

19.04.2021



Рис. 48 – Наконечник для отсасывания



Рис. 49 – Трубка для отсасывания (по требованию)



Рис. 50 – Трубка аспирационная



Рис. 51 – Фильтр воздушный (2 шт.)



Рис. 52 – Педальный ножной выключатель



Рис. 53 – Шнур питания



Рис. 54 – Зажим

19.04.2021



VII. Отсасыватель медицинский «Armed», вариант исполнения 7А-23В-1, в составе:



Рис. 56 – Отсасыватель



Рис. 57 – Наконечник для отсасывания



Рис. 58 – Трубка для отсасывания (по требованию)



Рис. 59 – Трубка аспирационная

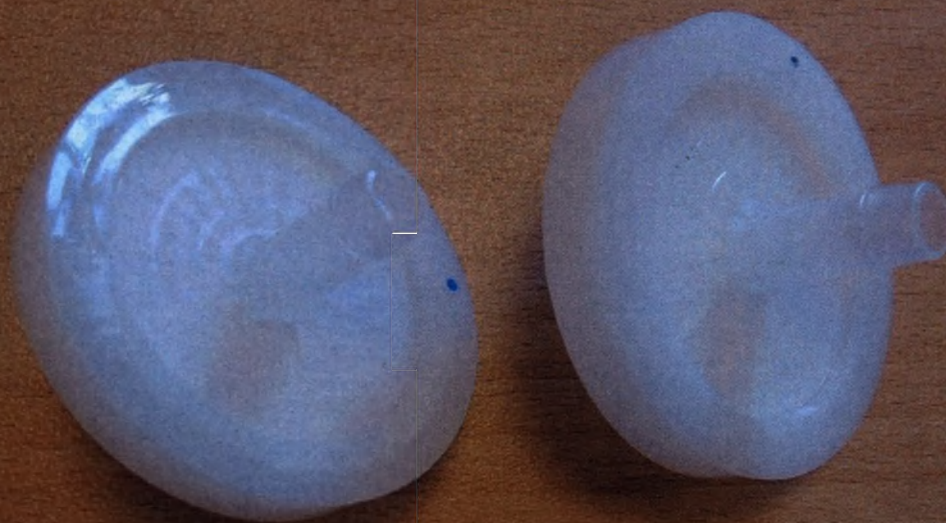


Рис. 60 – Фильтр воздушный (2 шт.) 9.04.2021



Рис. 61 – Педальный ножной выключатель



Рис. 62 – Шнур питания

19.04.2021



Рис. 63 – Зажим



VIII. Отсасыватель медицинский «Armed», вариант исполнения 7A-23D, в составе:

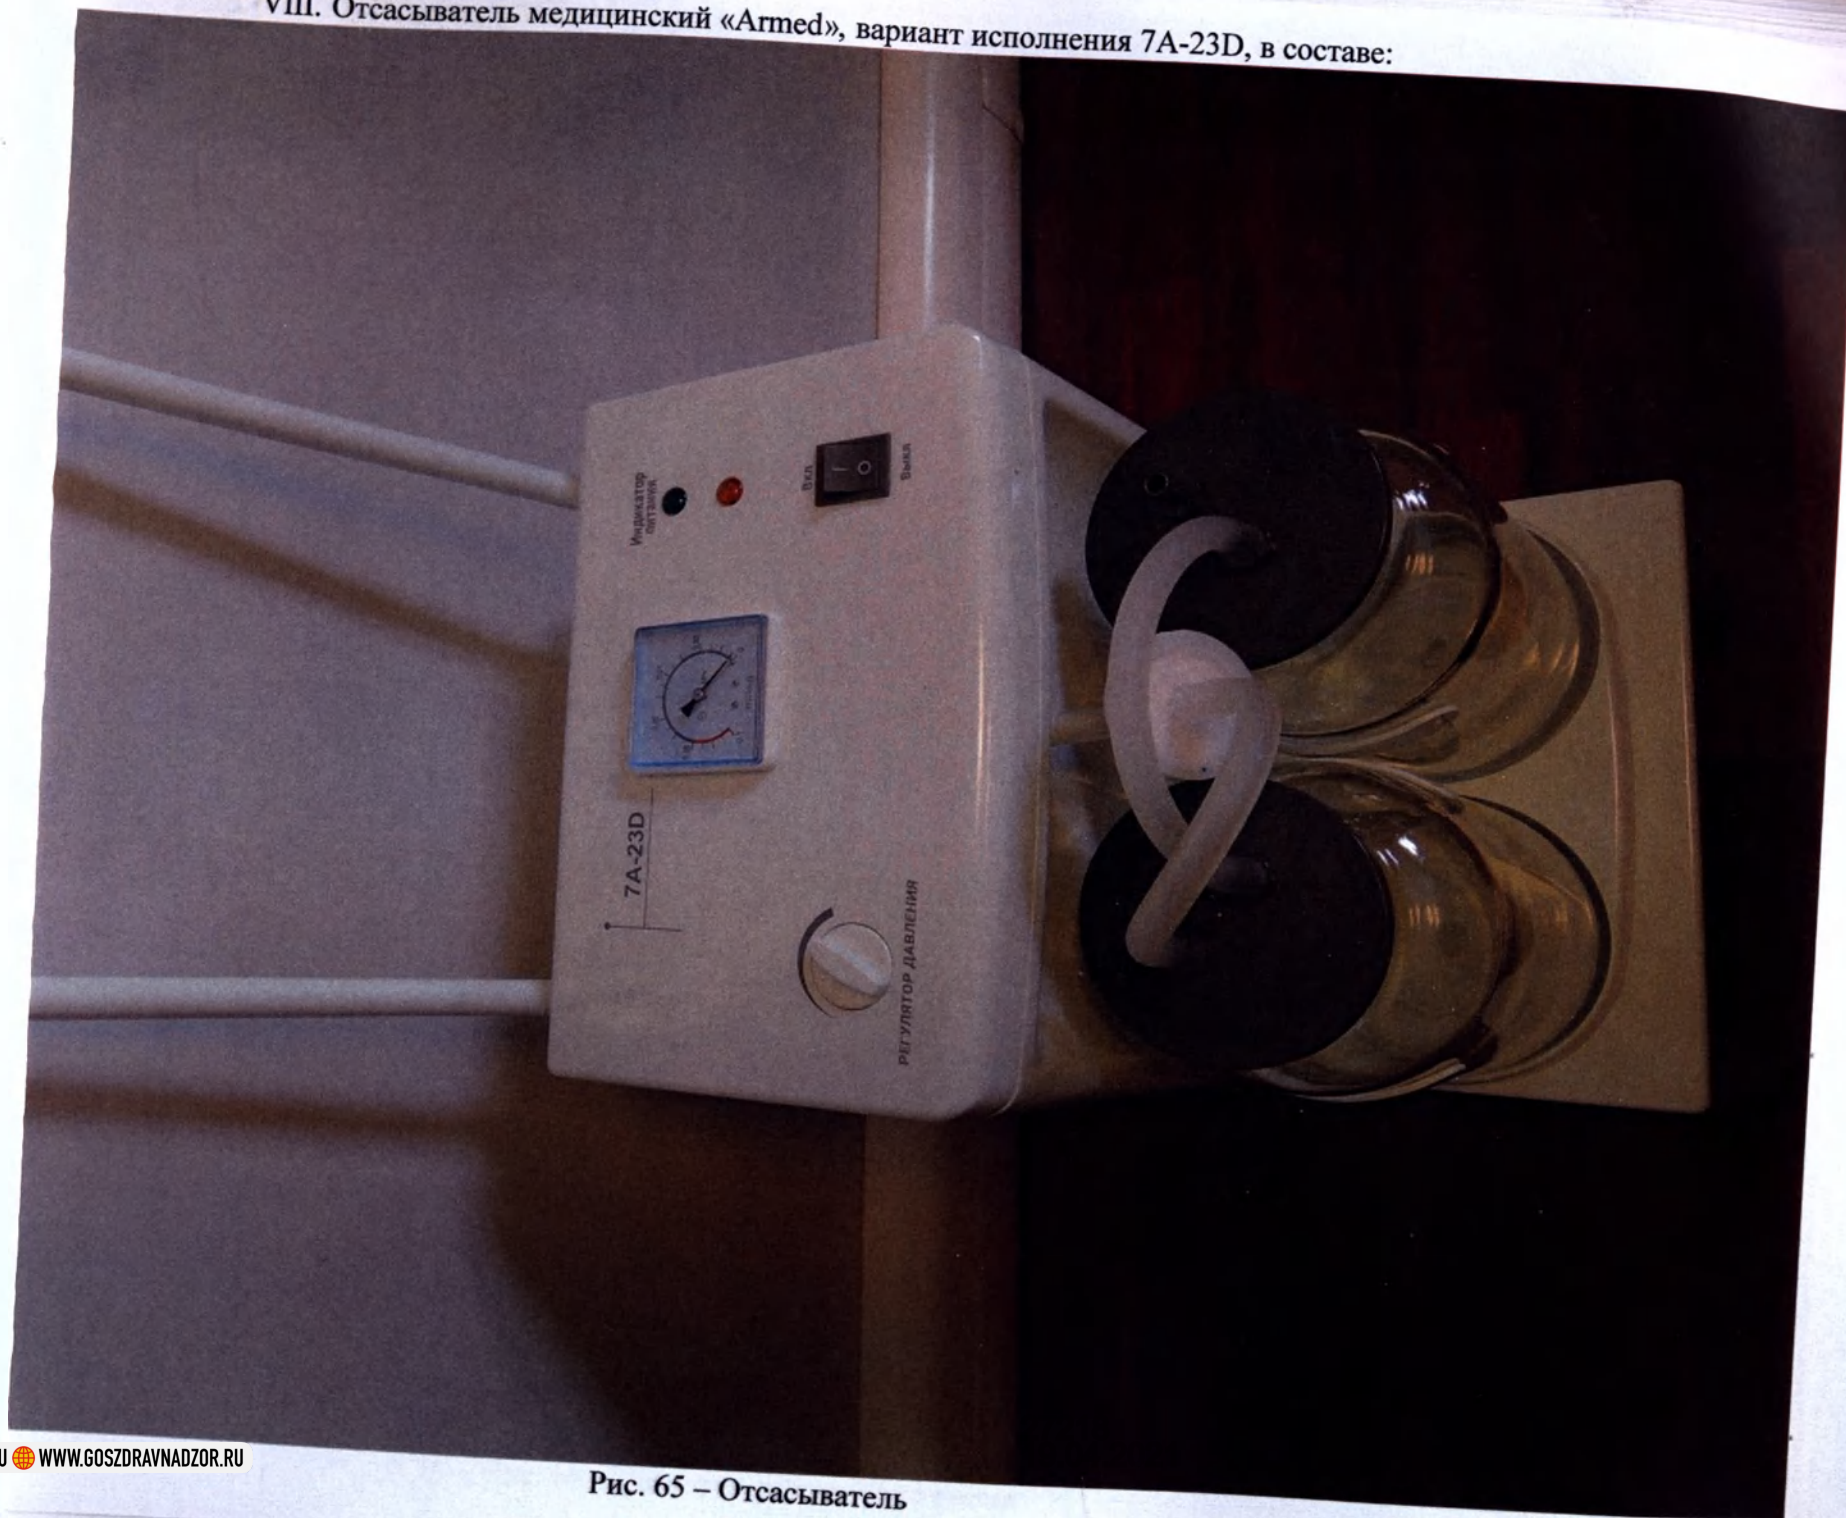


Рис. 65 – Отсасыватель





Рис. 67 – Трубка для отсасывания (по требованию).



Рис. 68 – Трубка аспирационная



Рис. 69 – Фильтр воздушный (2 шт.)



Рис. 70 – Педальный ножной выключатель



Рис. 71 – Шнур питания

19.04.2021



Рис. 72 – Зажим

19.04.2021



IX. Отсасыватель медицинский «Armed», вариант исполнения 7E-B5, в составе:



Рис. 74 – Отсасыватель

27218
19.04.2021





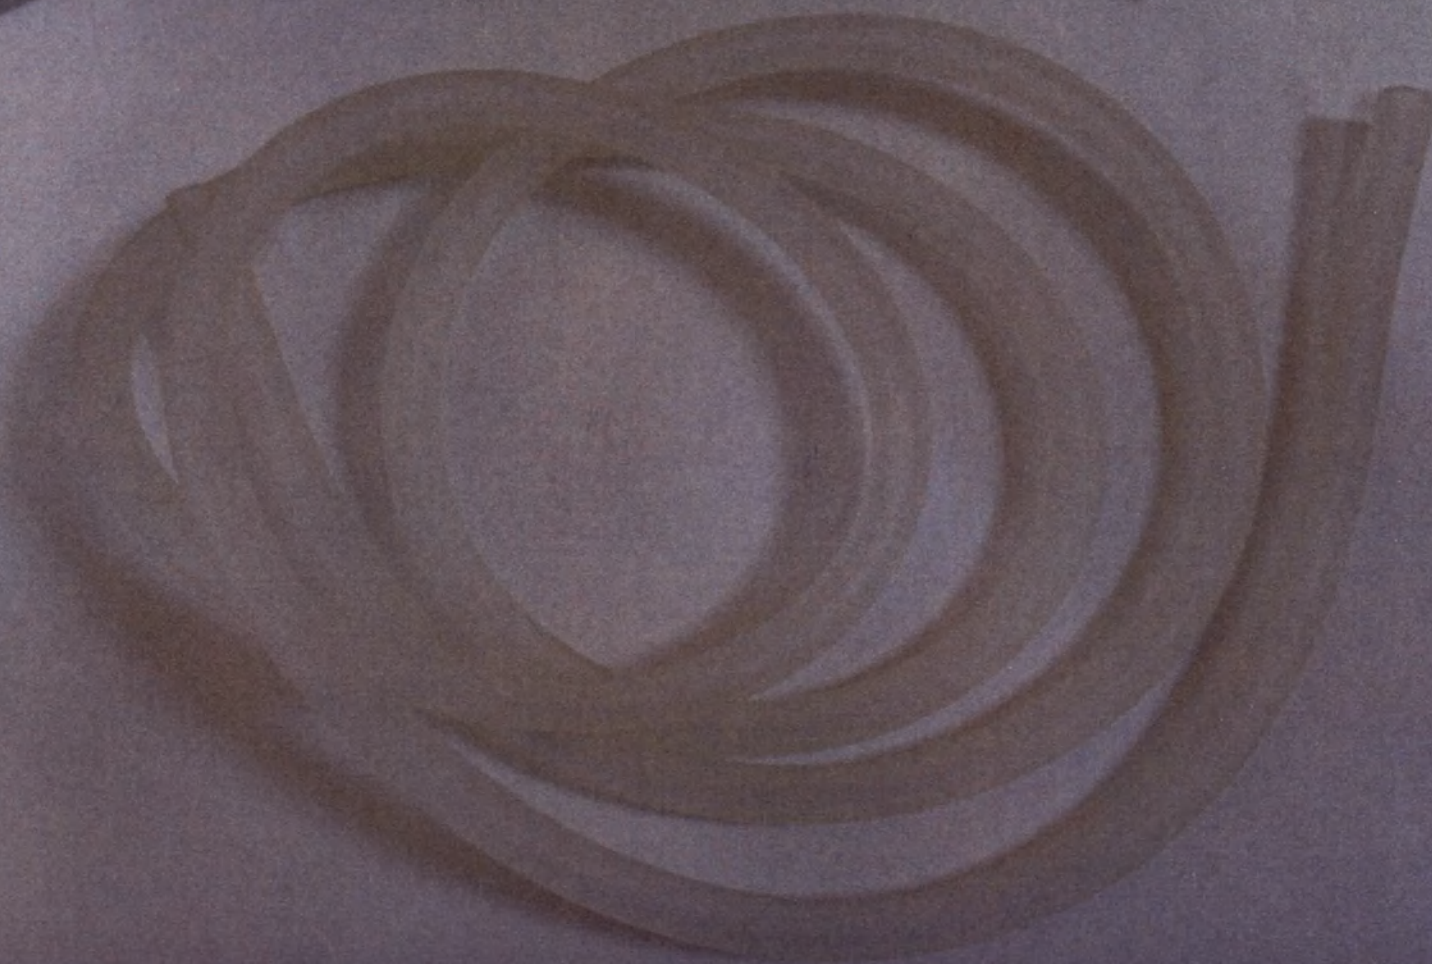


Рис. 77 – Трубка аспирационная



Рис. 78 – Фильтр воздушный (2 шт.)



Рис. 79 – Шнур питания

Х. Упаковка медицинского изделия:

ОТСАСЫВАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ «Armed»

7E-D

КОЛИЧЕСТВО: 1 шт.

www.armed.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12528 от 11 ноября 2020 г.
Отсасыватель предназначен для отсасывания крови, гноя и различных жидкостей, частиц тканей и газов из операционных ран и других полостей во время и после операций, для применения в перевязочных, хирургических, гинекологических и других отделениях лечебных учреждений.
Особенно необходим для оказания первой медицинской помощи в местах с отсутствием электрического источника питания.



ОТСАСЫВАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ «Armed»

7E-D

КОЛИЧЕСТВО: 1 шт.

www.armed.ru

Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12528 от 11 ноября 2020 г.
Отсасыватель предназначен для отсасывания крови, гноя и различных жидкостей, частиц тканей и газов из операционных ран и других полостей во время и после операций, для применения в перевязочных, хирургических, гинекологических и других отделениях лечебных учреждений.
Особенно необходим для оказания первой медицинской помощи в местах с отсутствием электрического источника питания.



Срок службы: не менее 5 лет.
Срок гарантии: 12 месяцев
Дата выпуска:

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ № РЗН 2020/12528 от 11 ноября 2020 г.



Рис. 83 – Макет упаковки на примере исполнения 7Е-D (вид слева)

Регистрационное удостоверение РЗН 2020/12528
от 11 ноября 2020 г.



Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd. («Джиангсу Юю
Медикал Эквипмент & Салплай Ко., Лтд.»),

Yunyang Industrial park, Danyang City, Jiangsu Province, China 212310
(Юньян Индастриал парк, Даньянг Сити, Джиангсу Провинс, Китай
212310).

Импортёр: ООО «Медимпорт»

630501, Новосибирская обл., Новосибирский рн, р.п. Краснообск, д. 1/6, 2 этаж, пом.
227, 228

Напряжение питания:

1. Сеть переменного тока: $\sim 220 \text{ В} \pm 10\%$

Частота сети: $50 \text{ Гц} \pm 2\%$

2. Сеть постоянного тока: $\text{---} 12 \text{ В}$.

Потребляемая мощность не более: $76 \text{ В} \cdot \text{А}$

Максимальное отрицательное давление: 75 кПа

Время цикла: $30 \text{ мин. работа} / 15 \text{ мин. перерыв}$

$\ominus \text{---} \oplus \text{---} \text{---}$ в прикуриватель 12 В .

высокий вакуум / низкий расход



Дата выпуска

Заводской номер

Х. Маркировка медицинского изделия:

Рис. 84 – Макет этикетки на примере исполнения 7Е-D

Катетер F12

Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd., Yunyang Industrial park, Danyang City, Jiangsu Province, China 212310

«Джиангсу Юю Медикал Эквипмент энд Сапплай Ко., Лтд.», Юньян Индастриал парк, Даньянг Сити, Джиангсу Провинс, Китай 212310

Номинальный наружный диаметр основной части катетера F12 / 4.0 мм

Номинальная длина основной части катетера 500 мм

LOT 181010



211009

STERILE EO

Рис. 86 – Этикетка на индивидуальной упаковке катетера F12

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью *87*
(*восемьдесят семь*) листов

Генеральный директор
ООО «МЕДИМПОРТ»
Леонтьев А.М.

