





И.о. директора
ООО «РоеСис»
Гальцев А.П.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ «РЕНТГЕНОВСКАЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА X TWIN» В СОСТАВЕ**

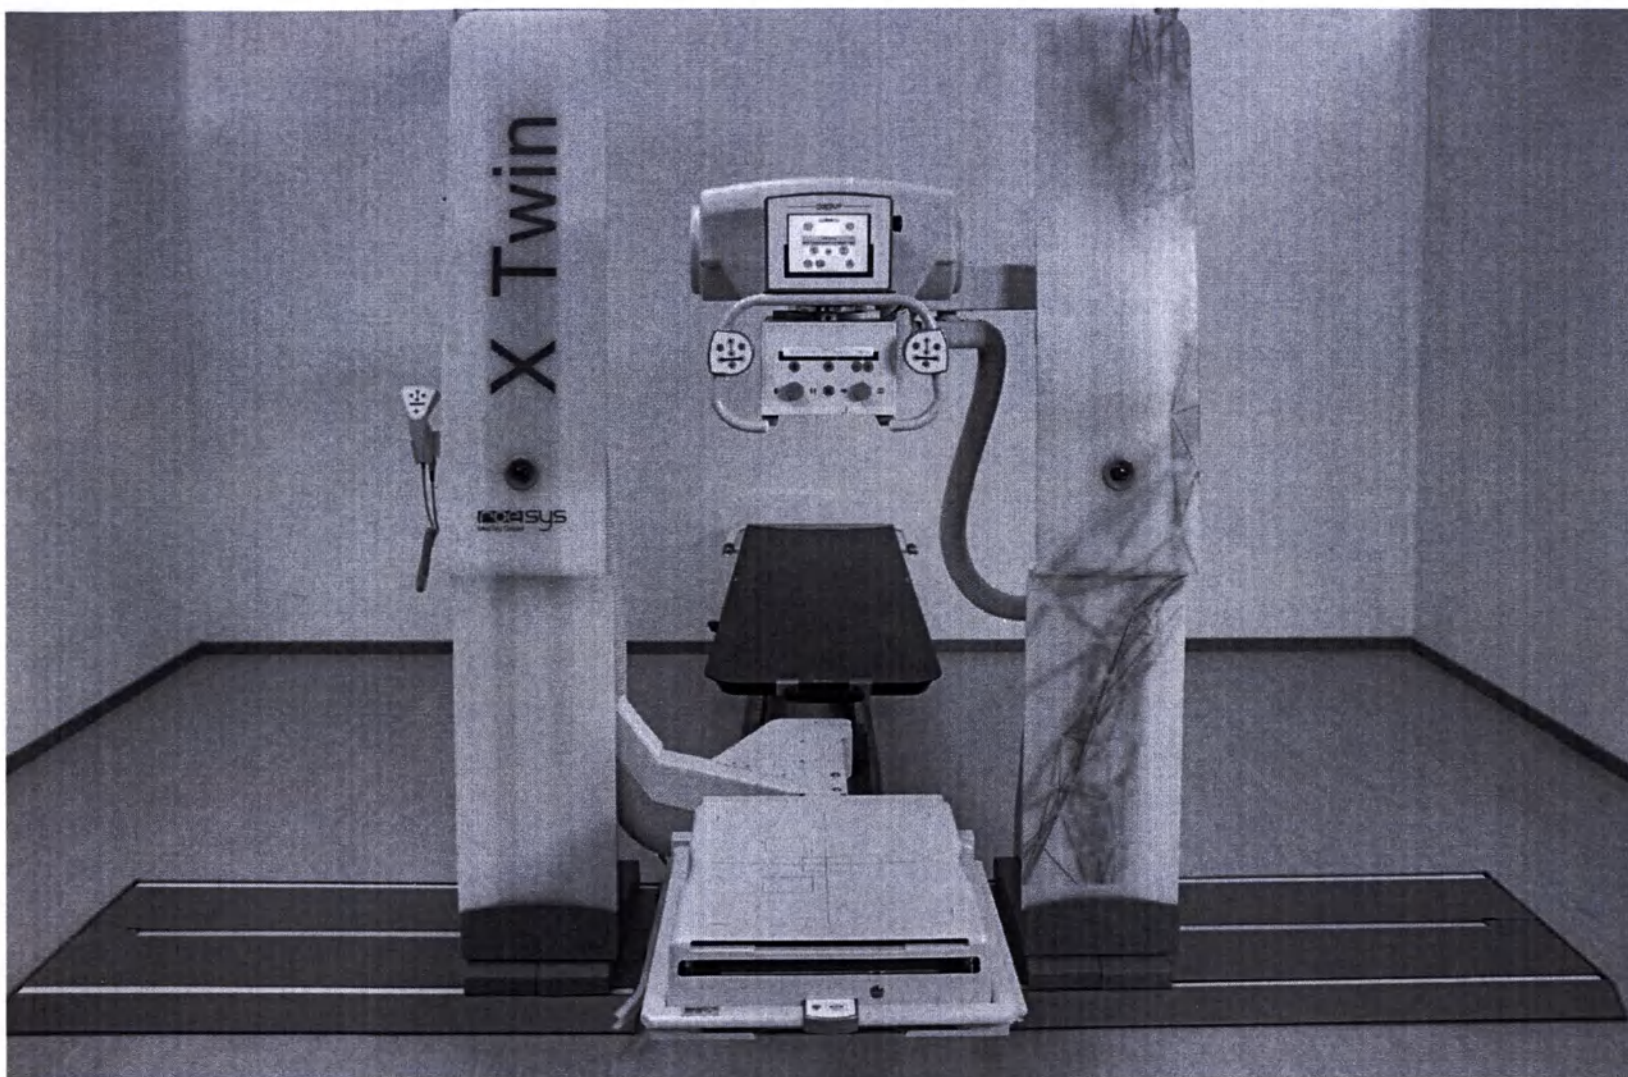

Колонна приемника изображения, основание колонны приемника изображения, колонна рентгеновского излучателя, основание колонны рентгеновского излучателя

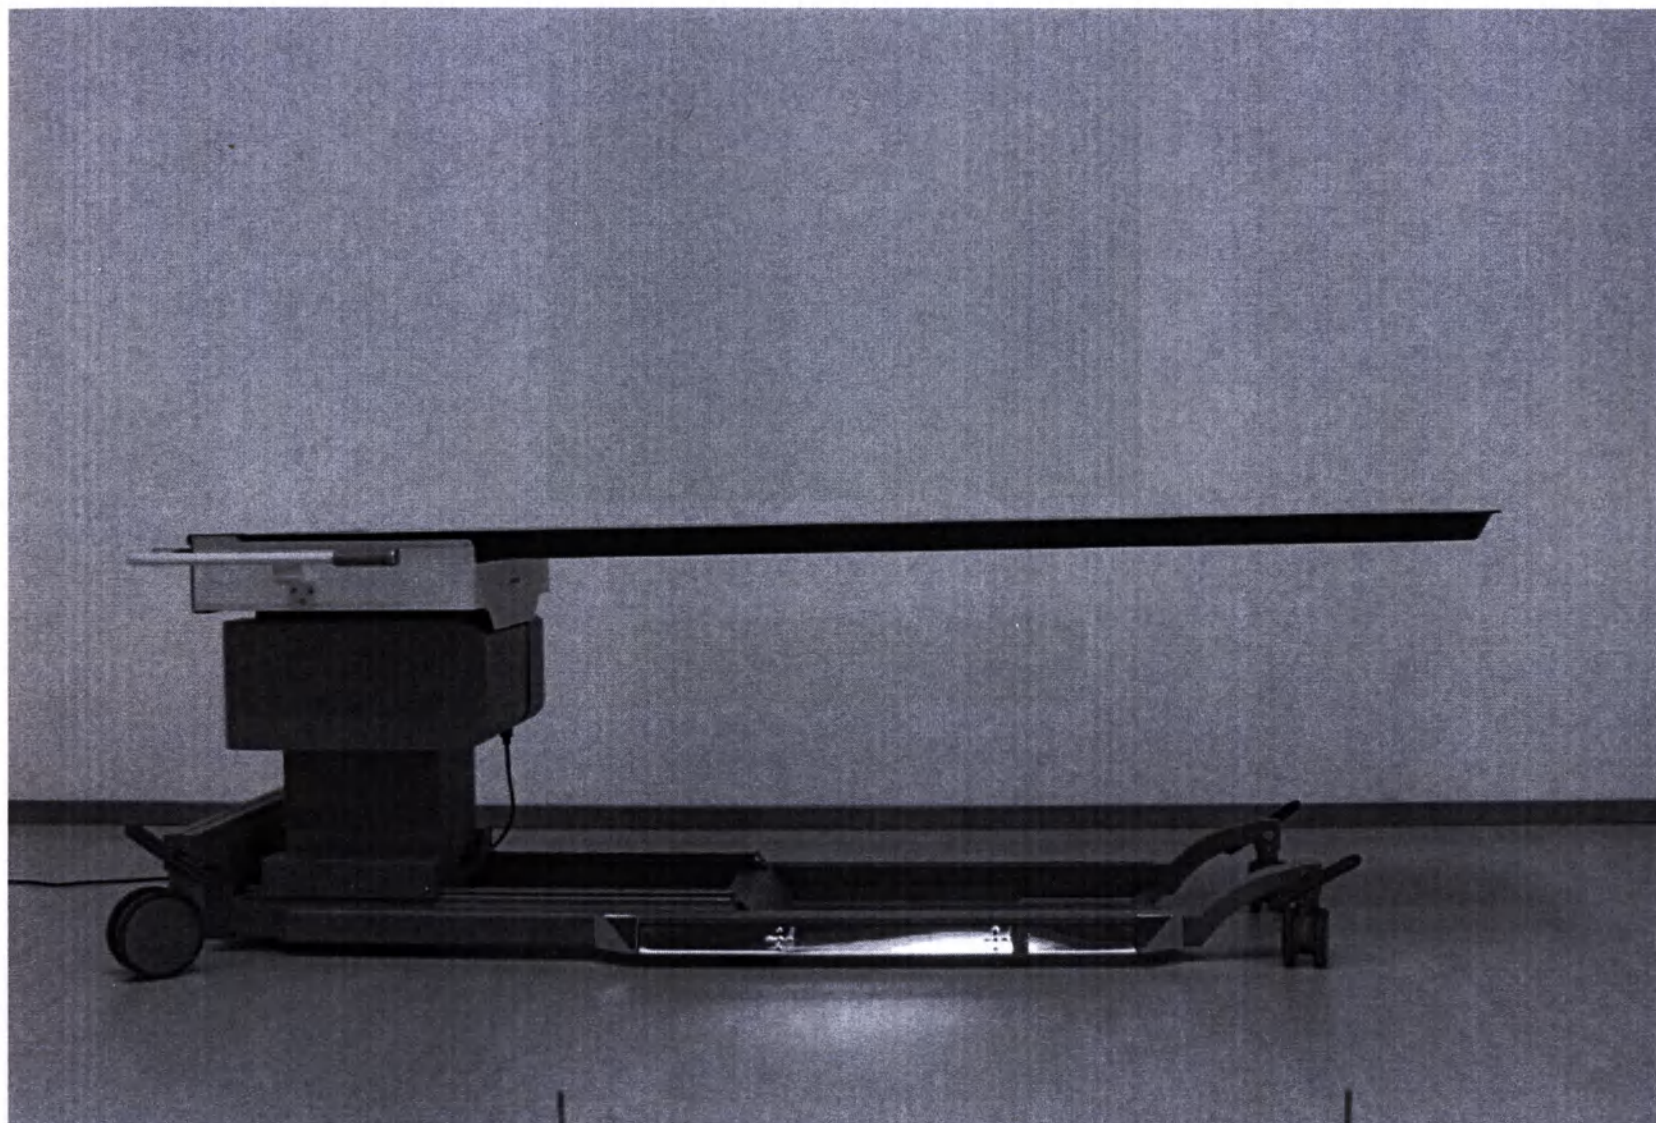

Передвижной рентгенопрозрачный стол X Mobil Serie

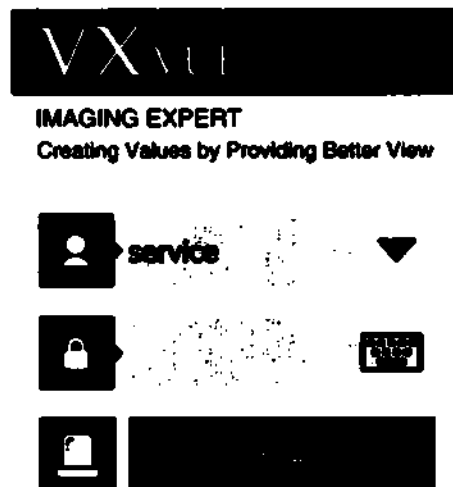

Программное обеспечение DXRS Serie, Vxvue




Рентгеновский генератор (снята крышка) и пульт управления




Кнопка включения снимка




Кронштейн крепления пульта управления

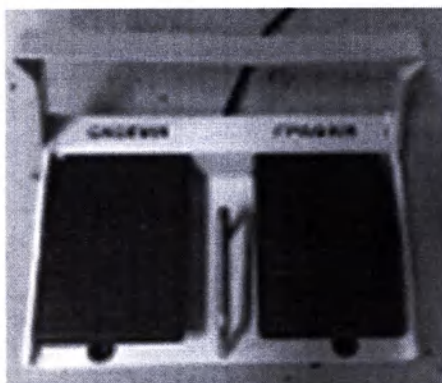


Педали включения снимка

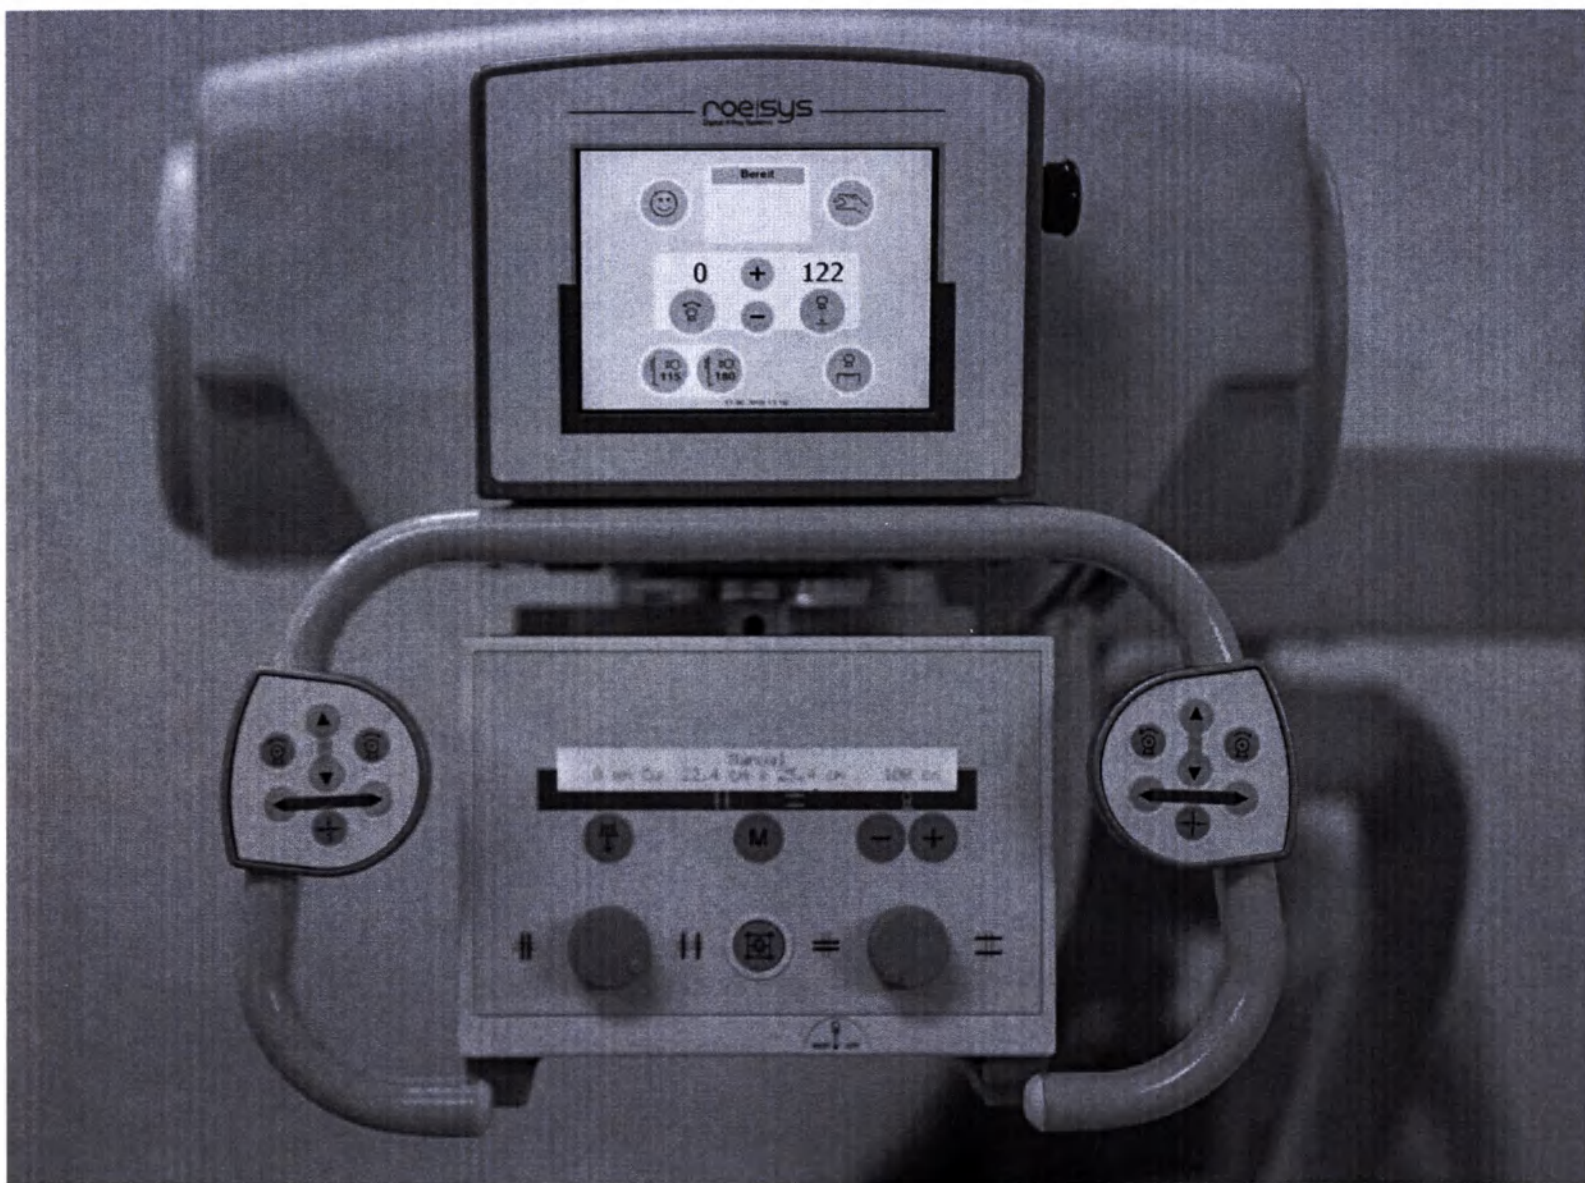

Рентгеновская трубка и рентгеновский коллиматор

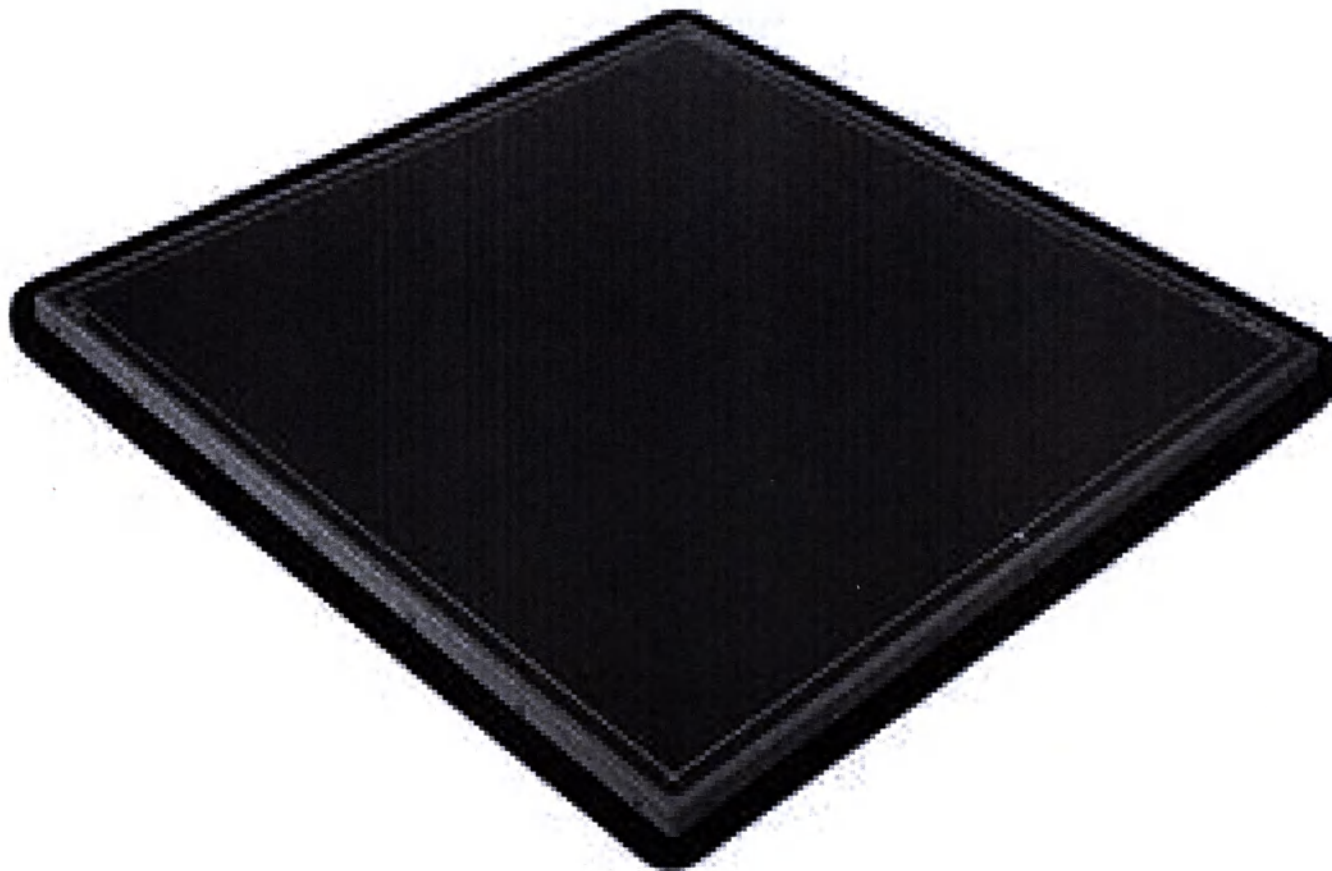


Плоскопанельный рентгеновский детектор

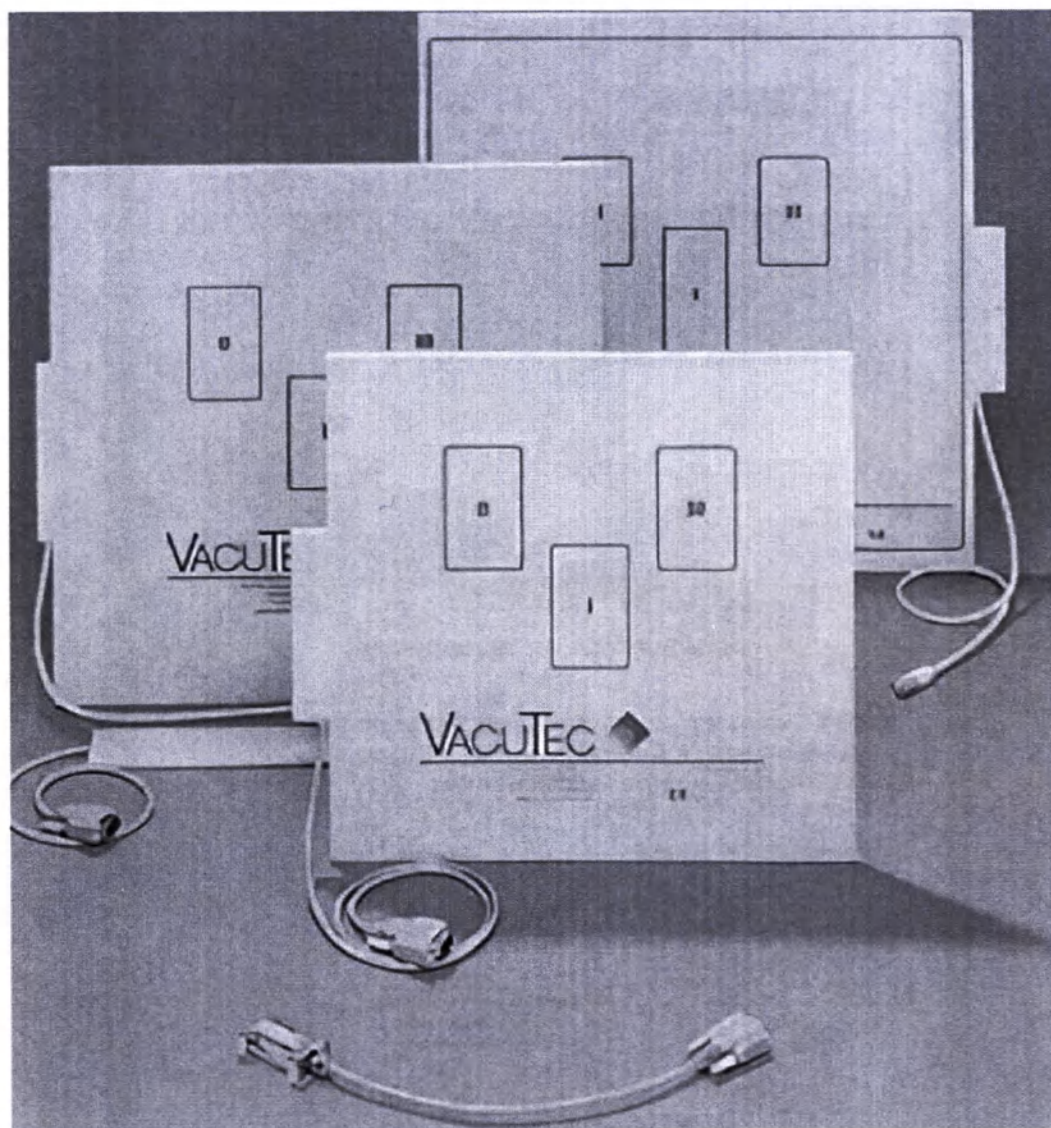

Система управления дозой АЕС

roesys
MedTec GmbH

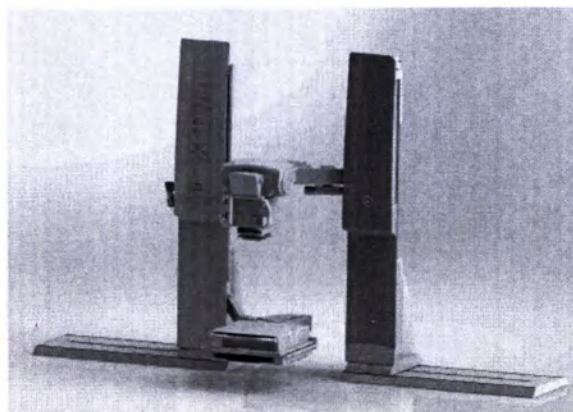


Руководство по эксплуатации

**Рентгеновская диагностическая система X Twin
с рентгеновским штативом и передвижным
рентгеновским столом X Mobil Serie**

Номер модели X Twin 0105 7700
Артикул 0105 7700-RU

Умберто Пистори Джизетти
Управляющий директор
«Roesys MedTec GmbH»


Руководство по эксплуатации

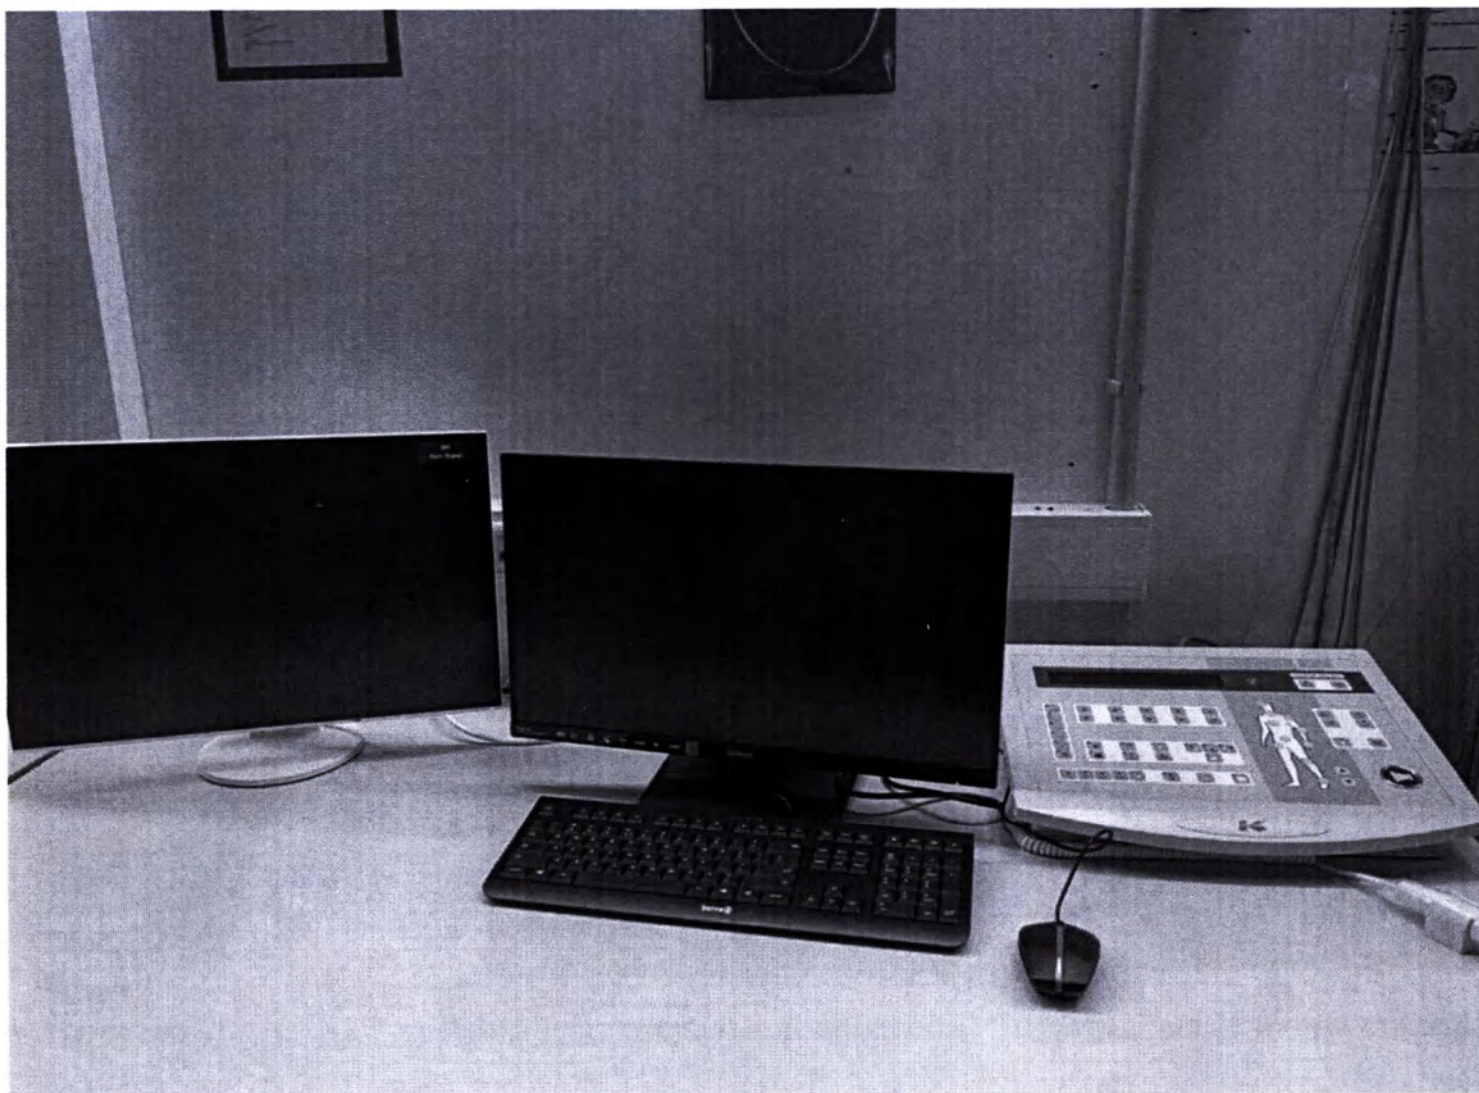

Рабочая станция лаборанта




Переговорное устройство

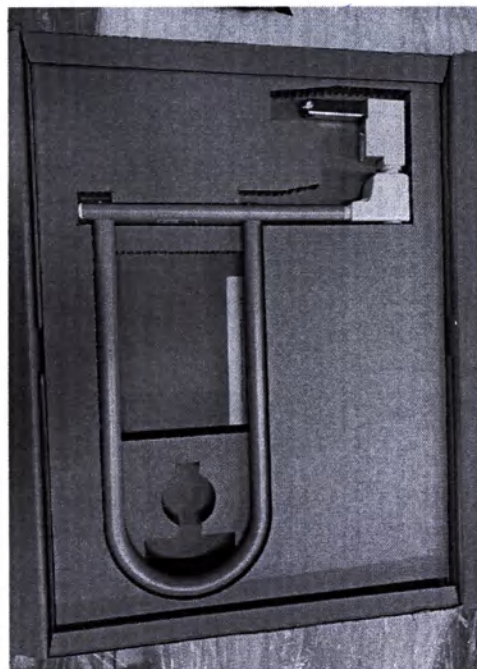

Ручка для латеральной проекции




Штатив для функции сшивания с линейкой

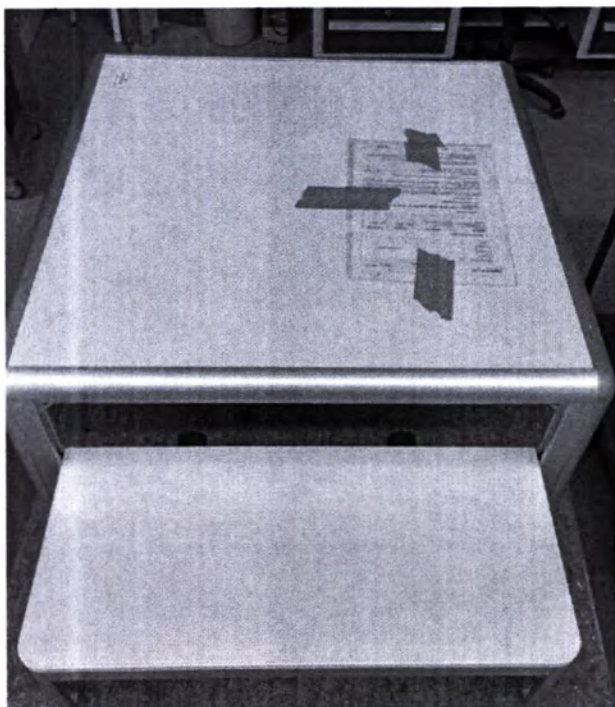


Подставка для ног




Блок файл-сервера

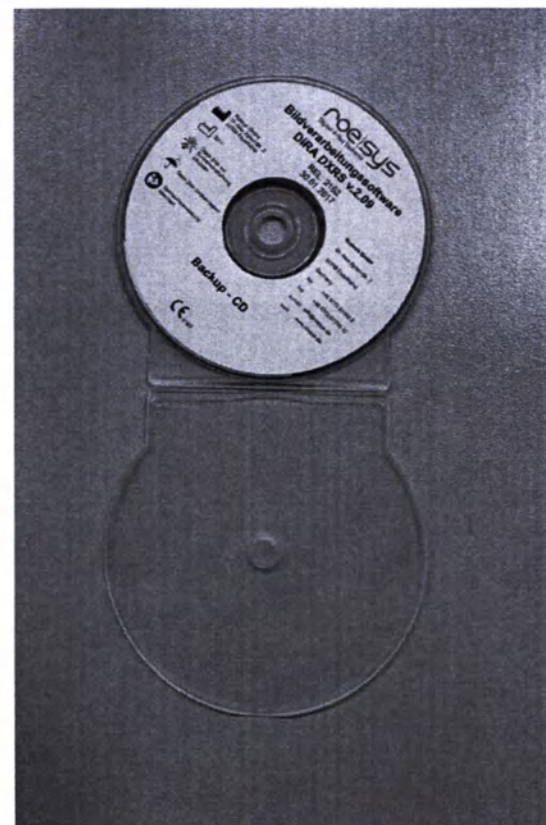


Набор CD/DVD дисков с инсталляторами

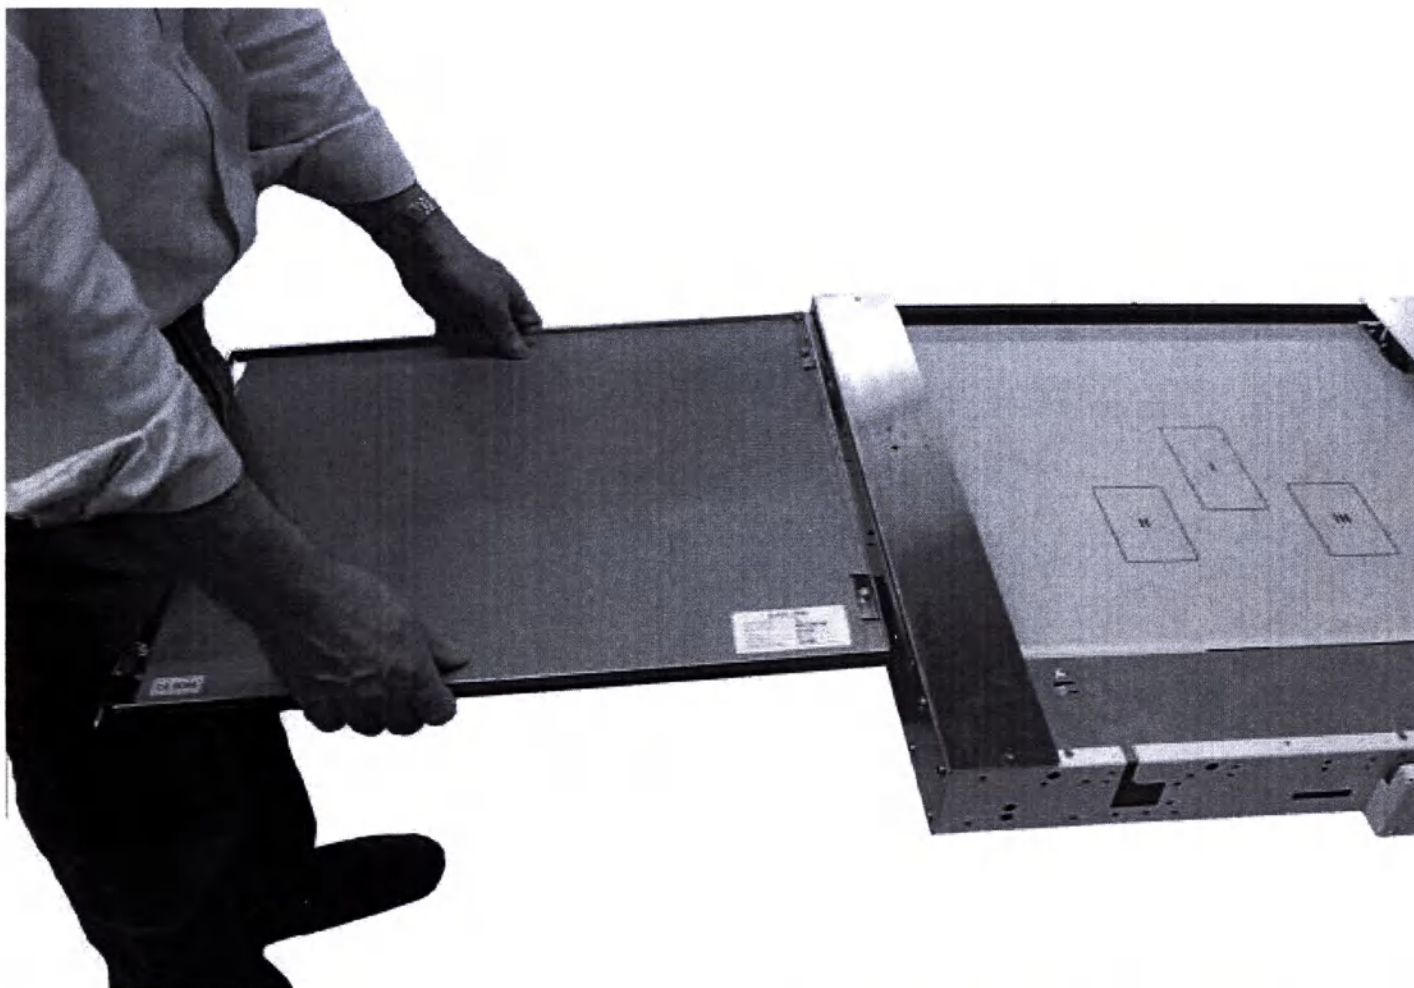

Отсеивающая фокусирующая решетка, система управления дозой АЕС, устройство букки

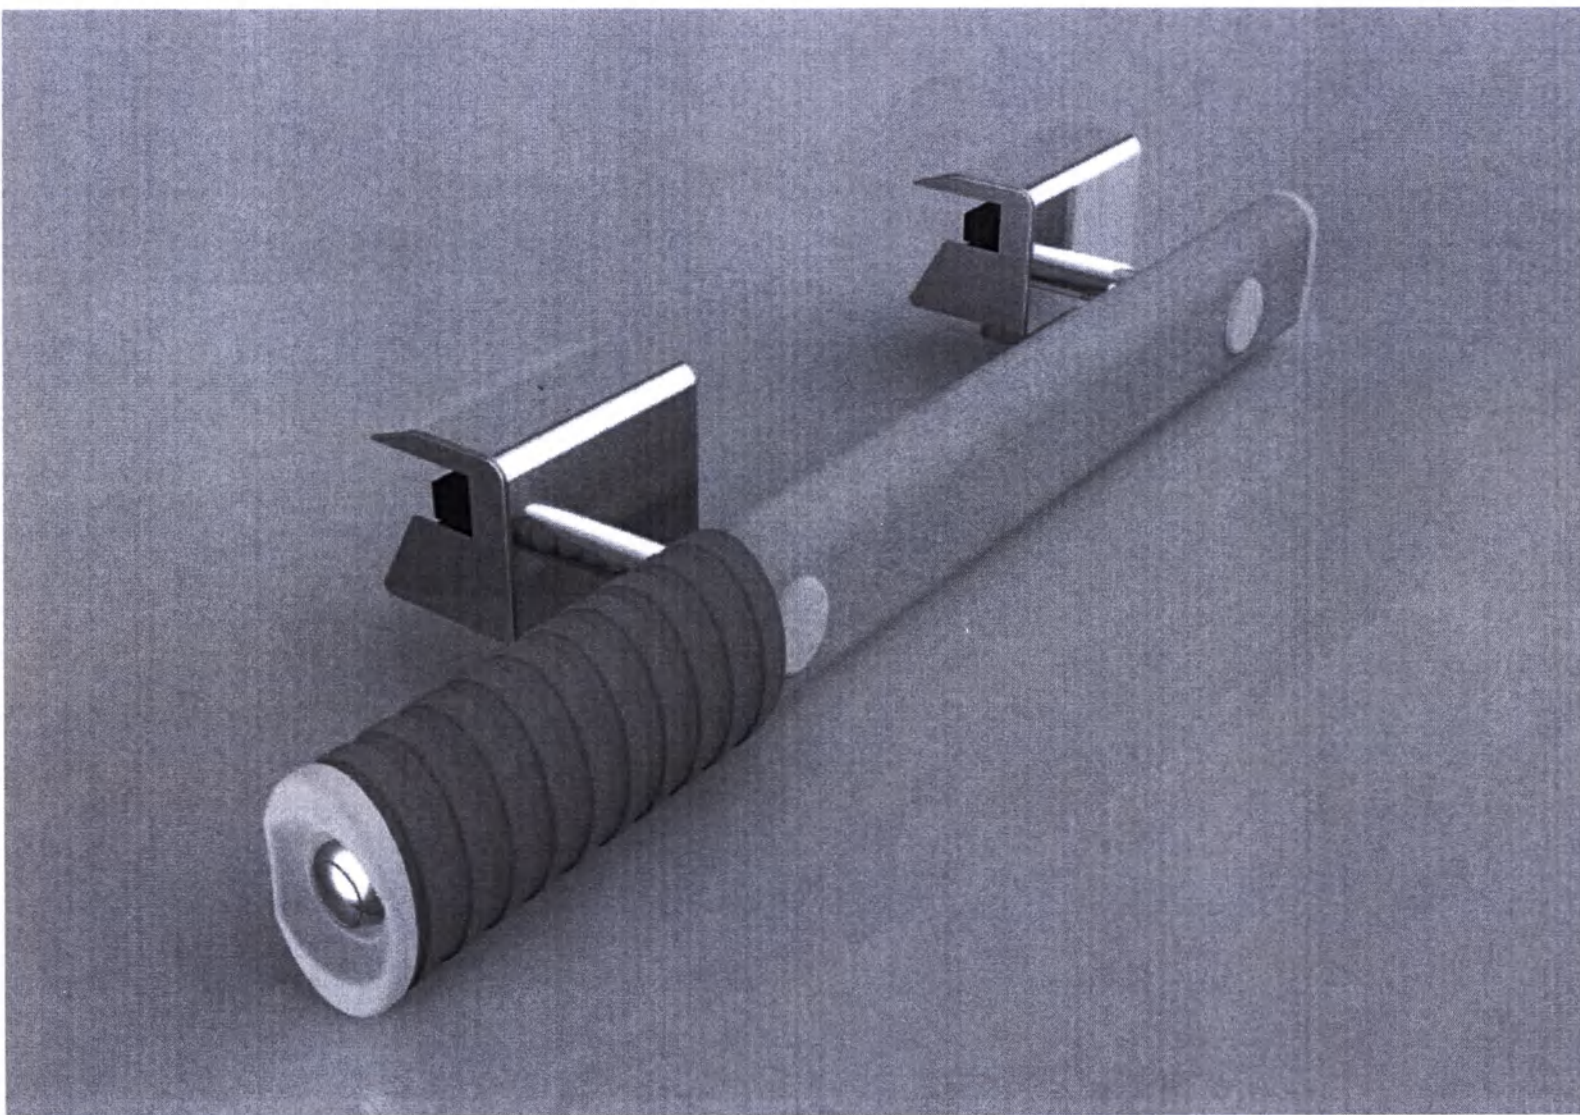


Ручка с кнопкой снятия блокировки стола

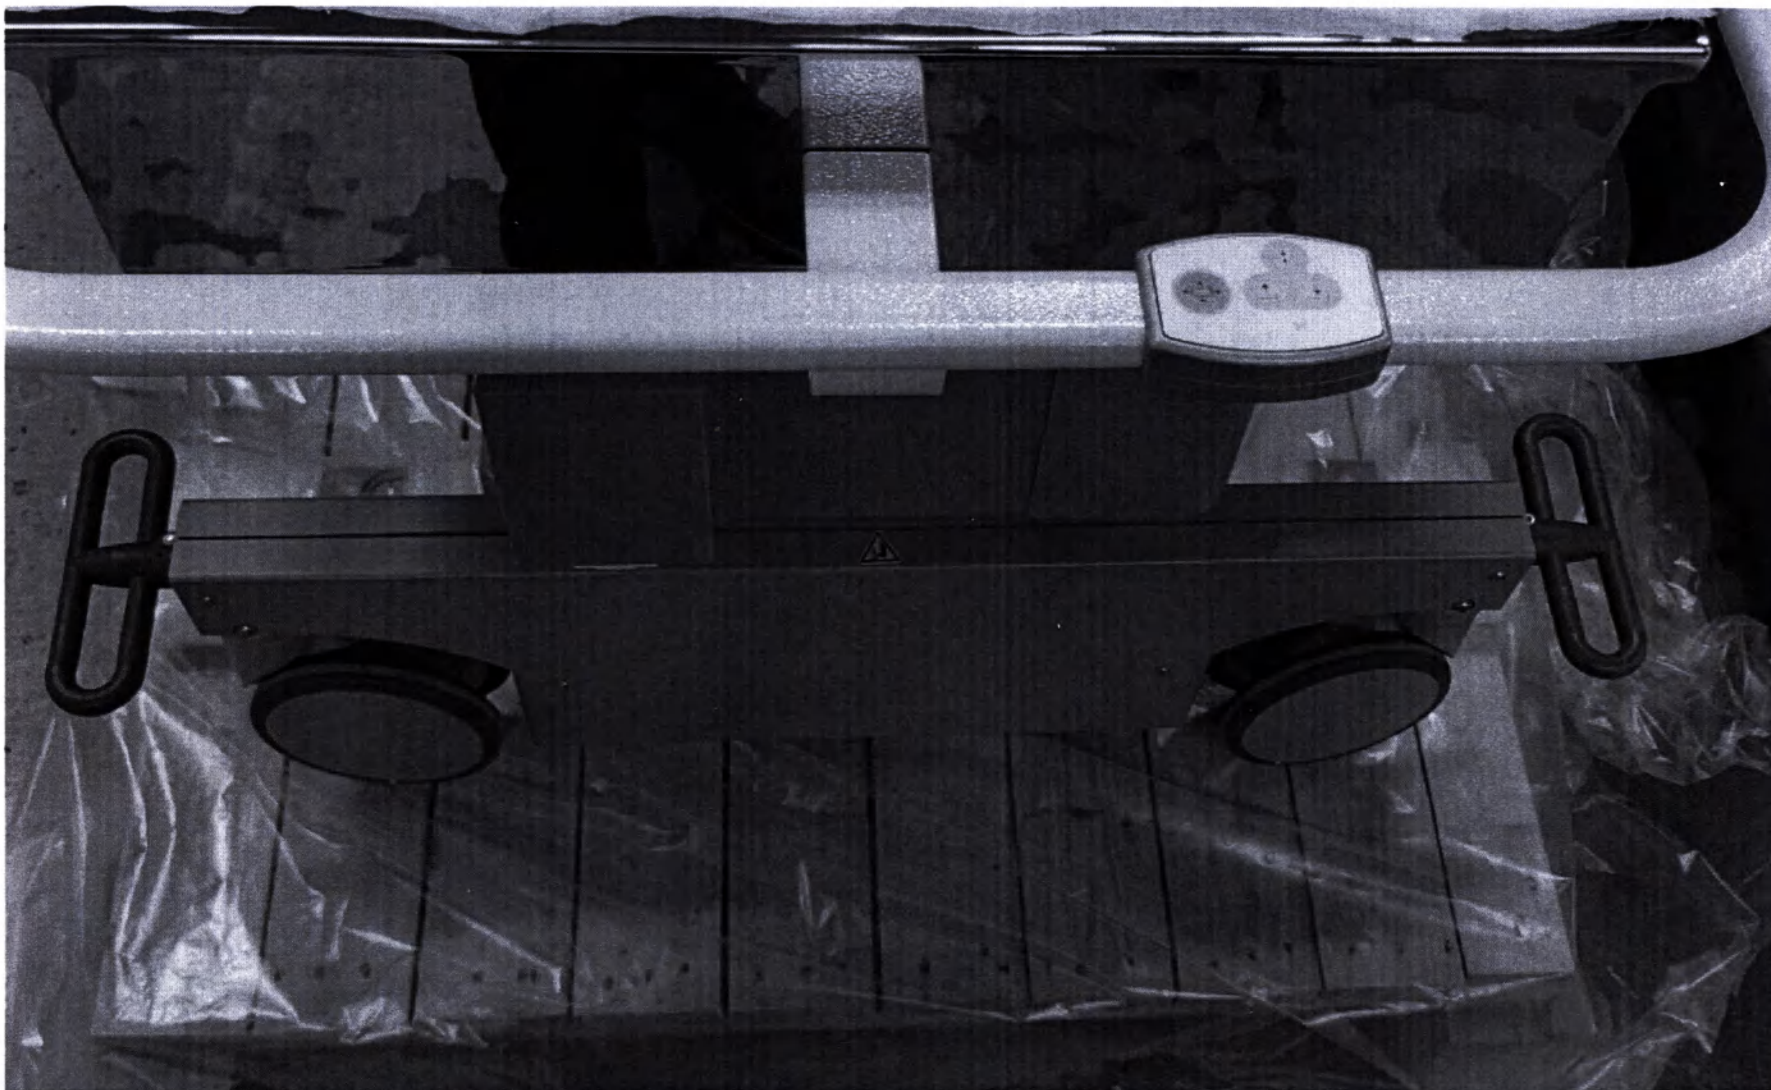


Педали тормоза с двух сторон


- / 7 -

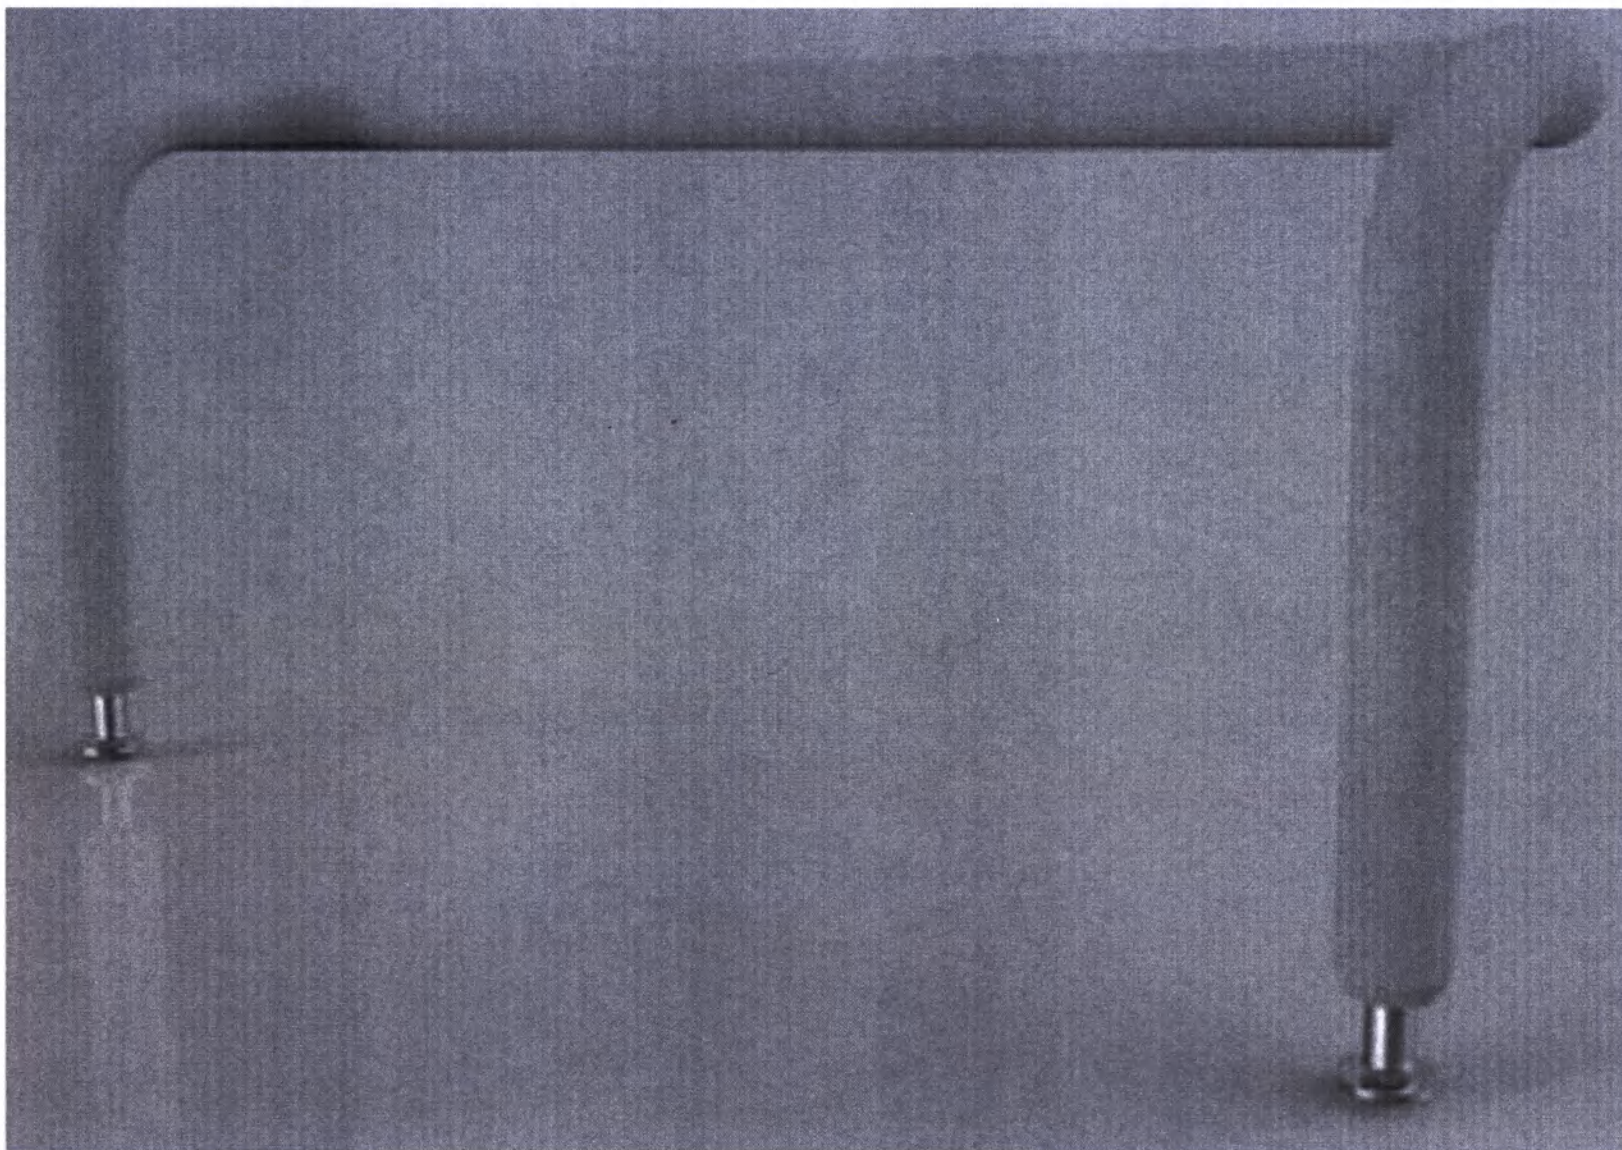


Ручка для перемещения стола

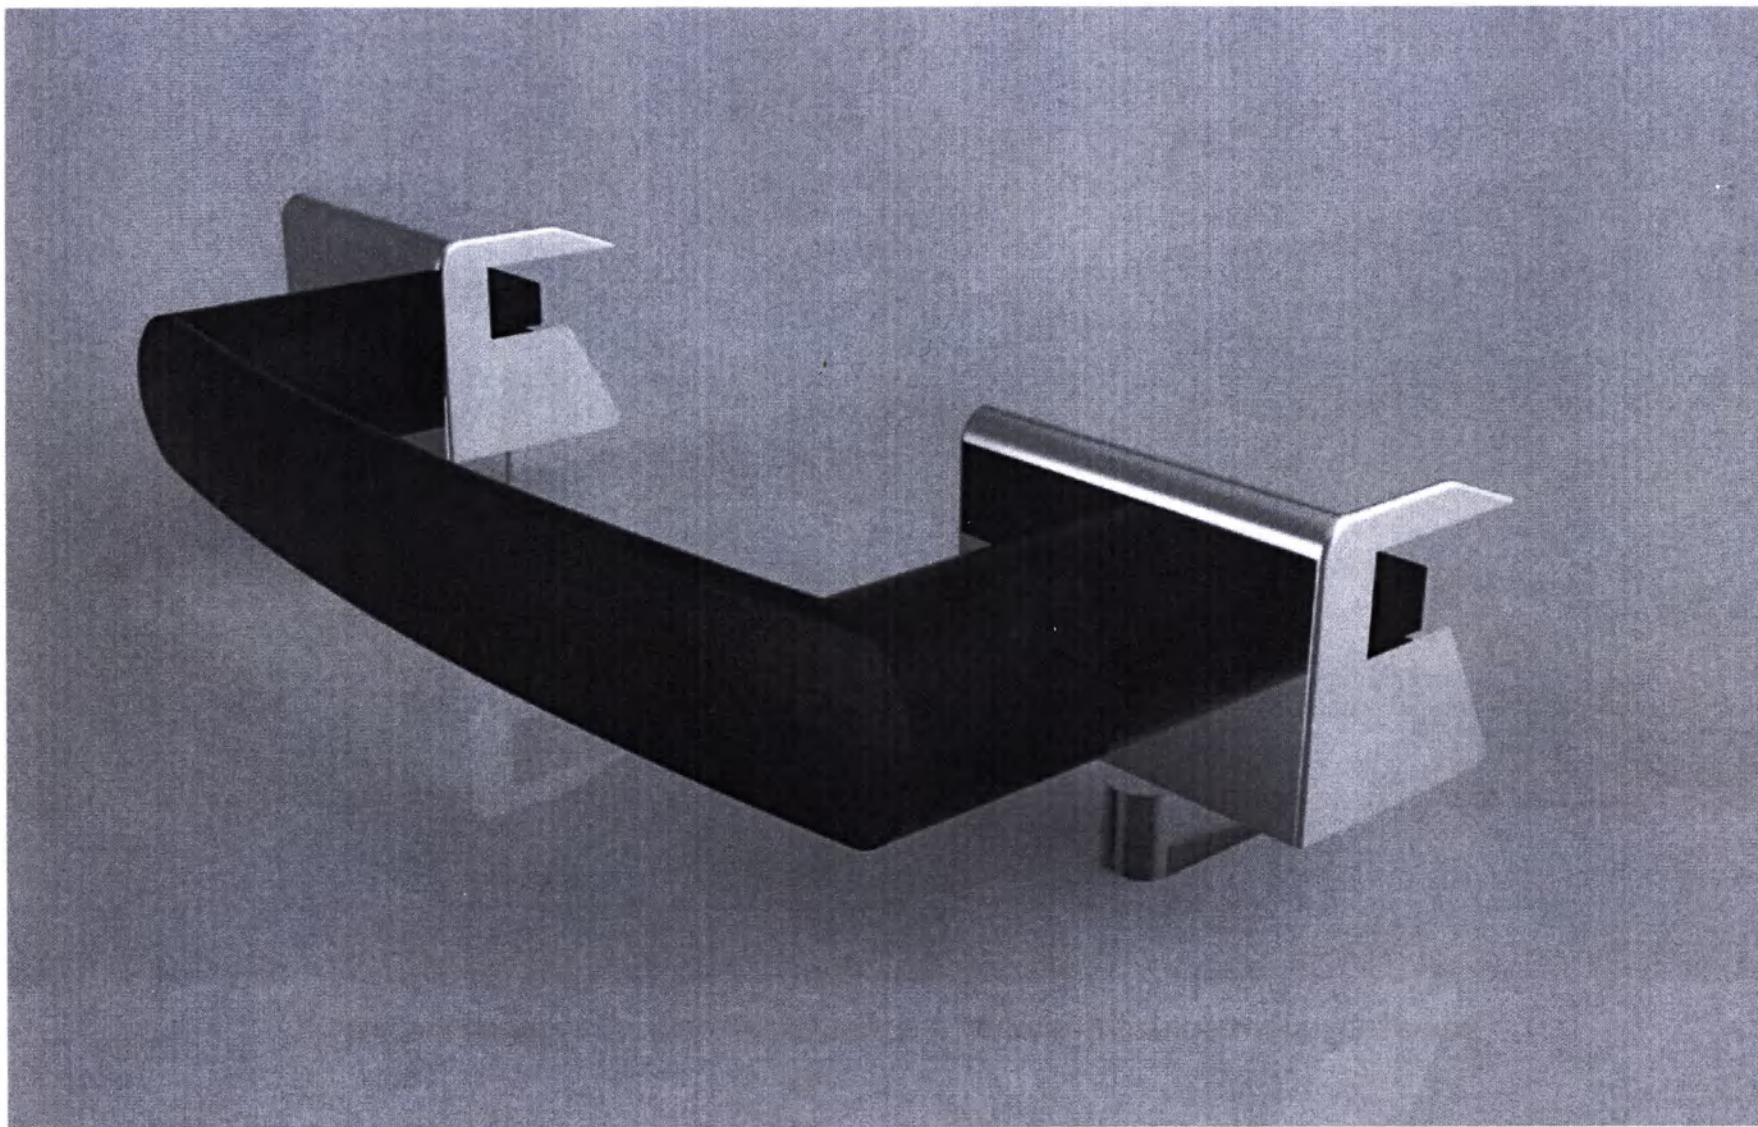


Мобильная ручка управления

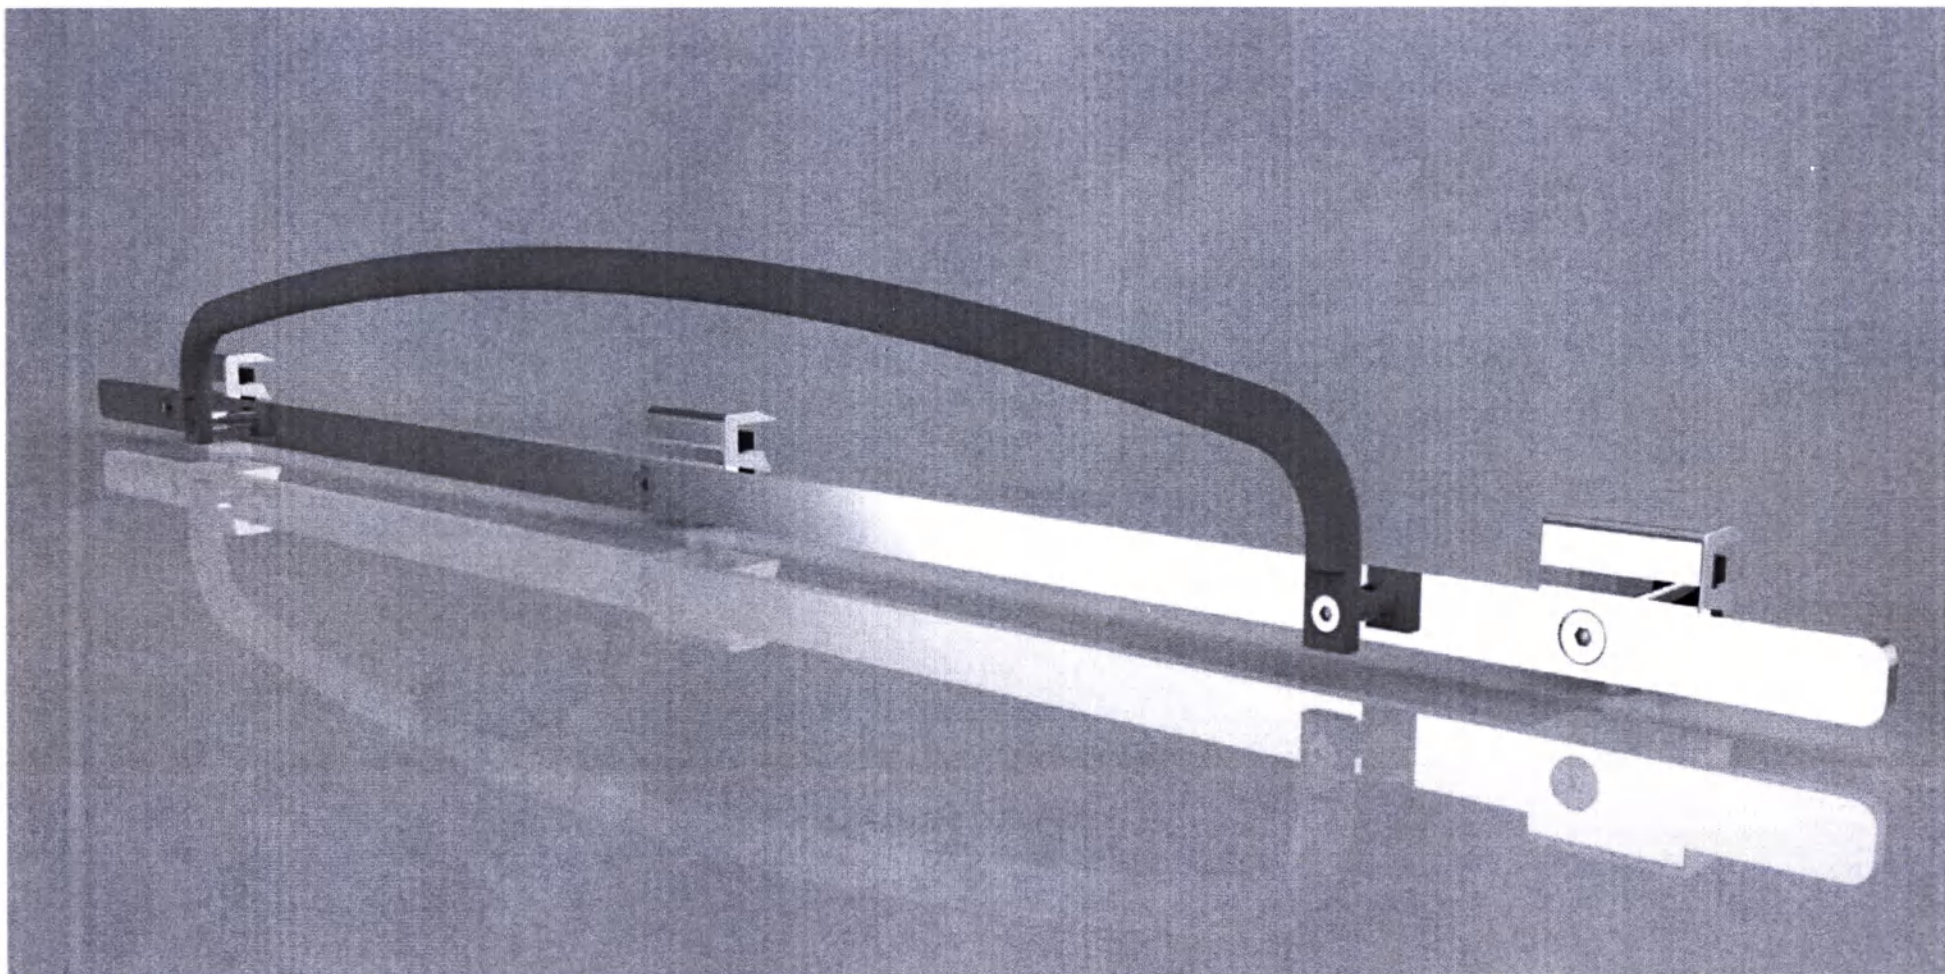

Ручка для пациента и направляющая для дополнительного оборудования

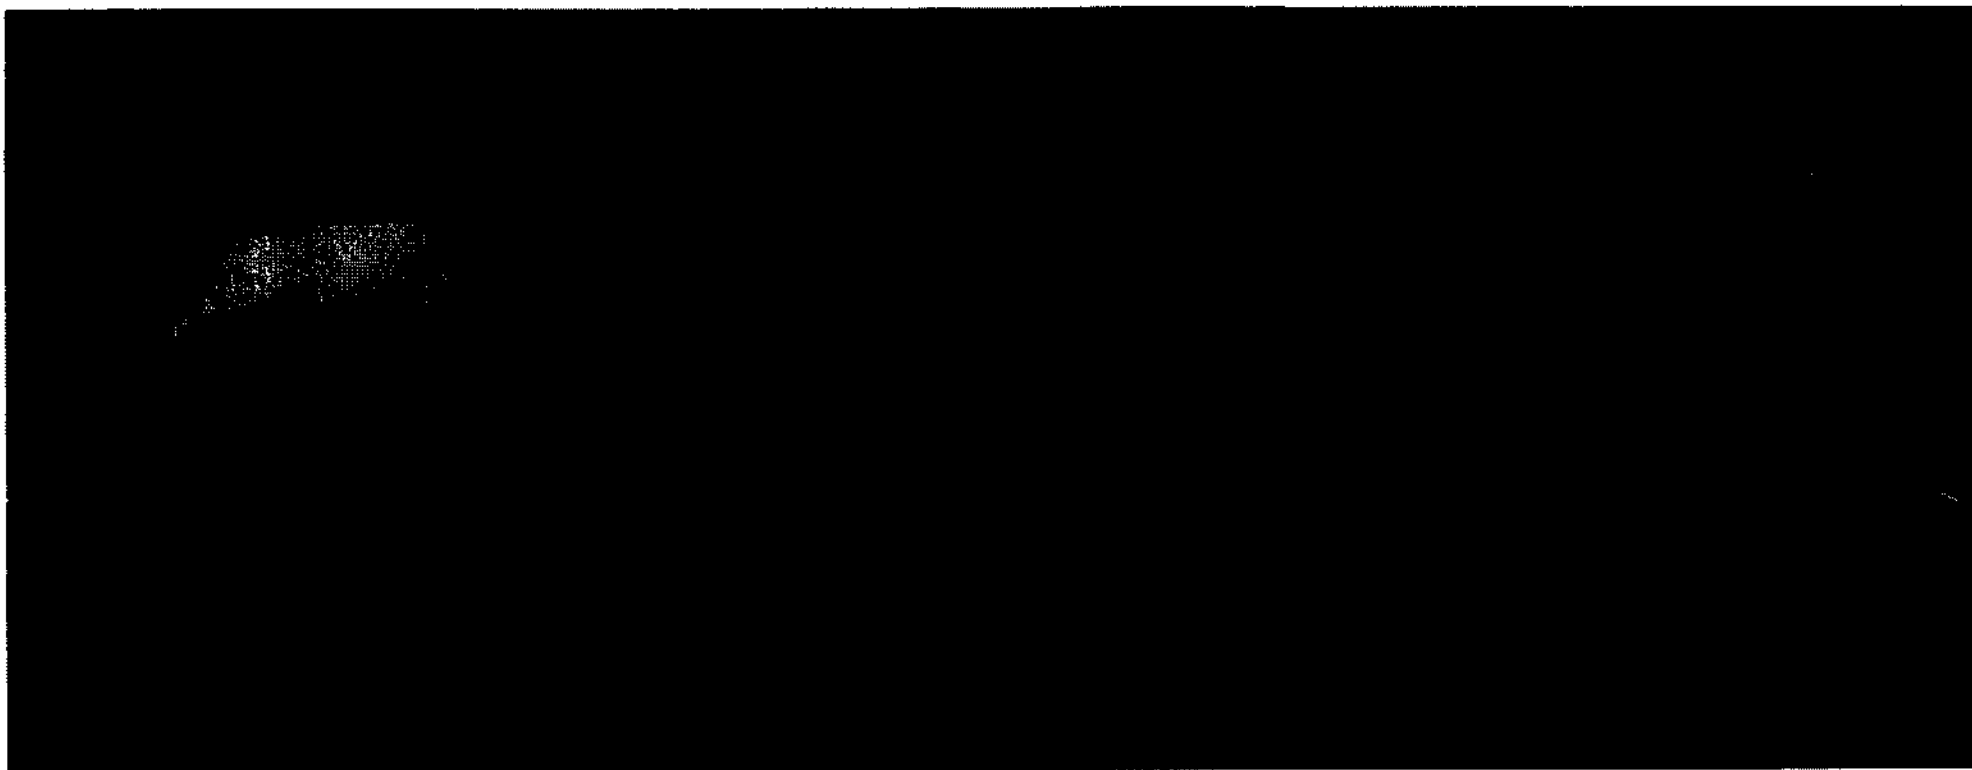

Матрас пациента

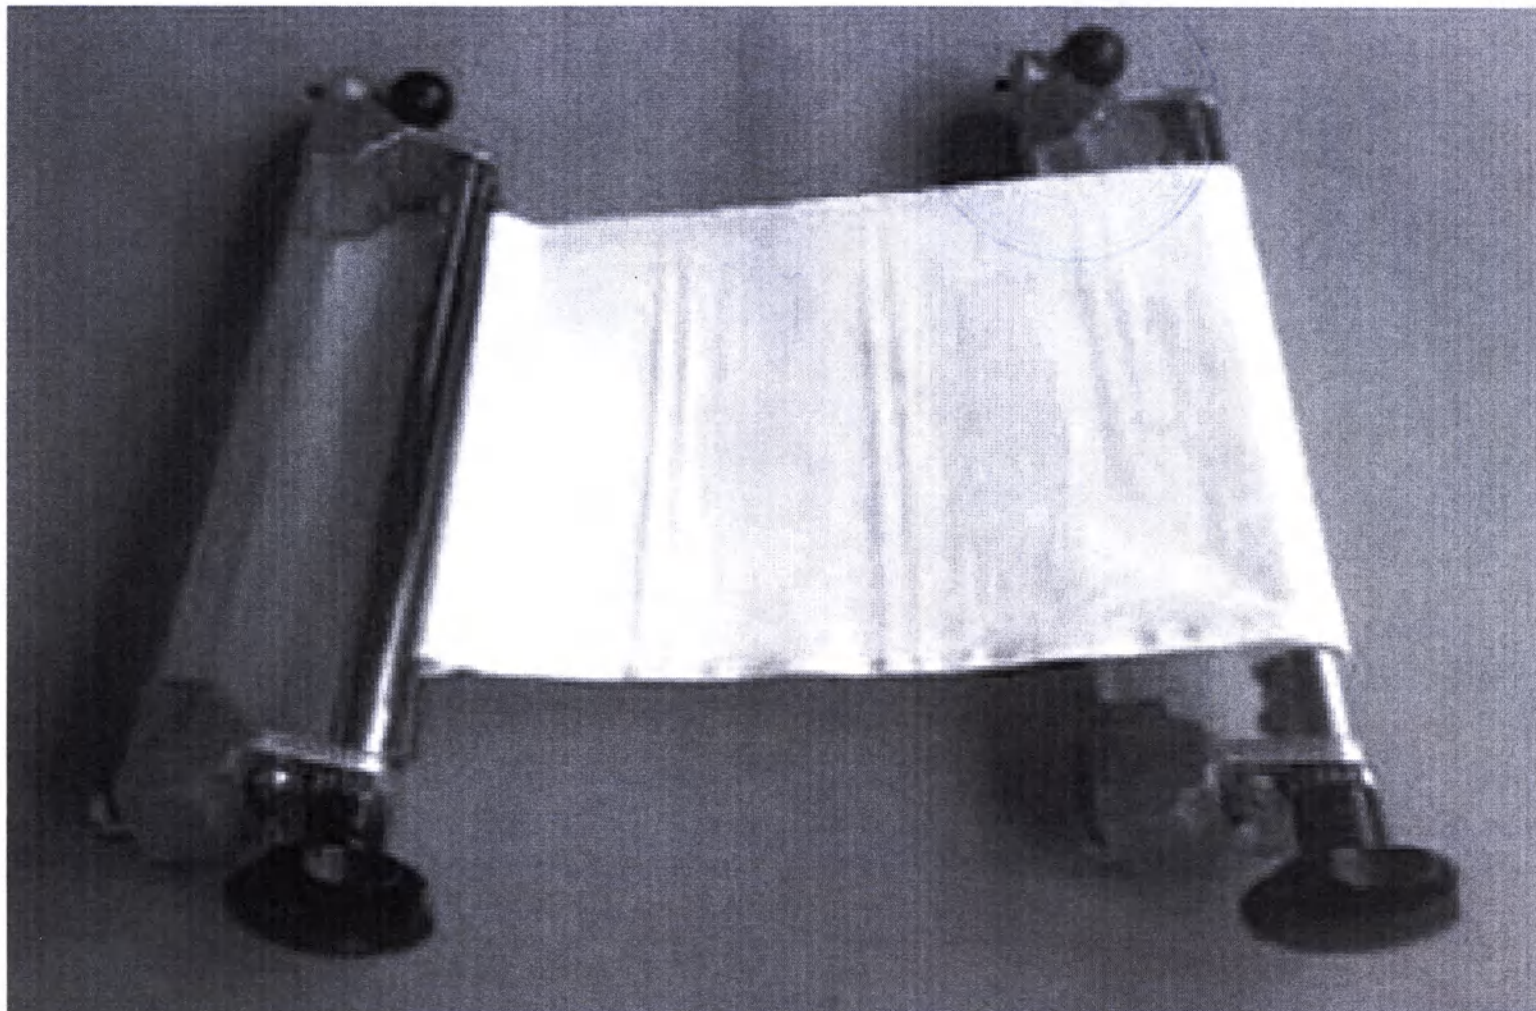

Компрессионное устройство

Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью



22 (двадцать два) листов

Гальцев А.П.