



Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности качественного определения антител класса IgG к
ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр-1
иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови
человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «EBV ядерный
антиген-1 (EBNA-1) антитела IgG Контрольные материалы (Alinity i
EBV EBNA-1 IgG Controls)»**

(размером не менее 18 x 24 сантиметра)



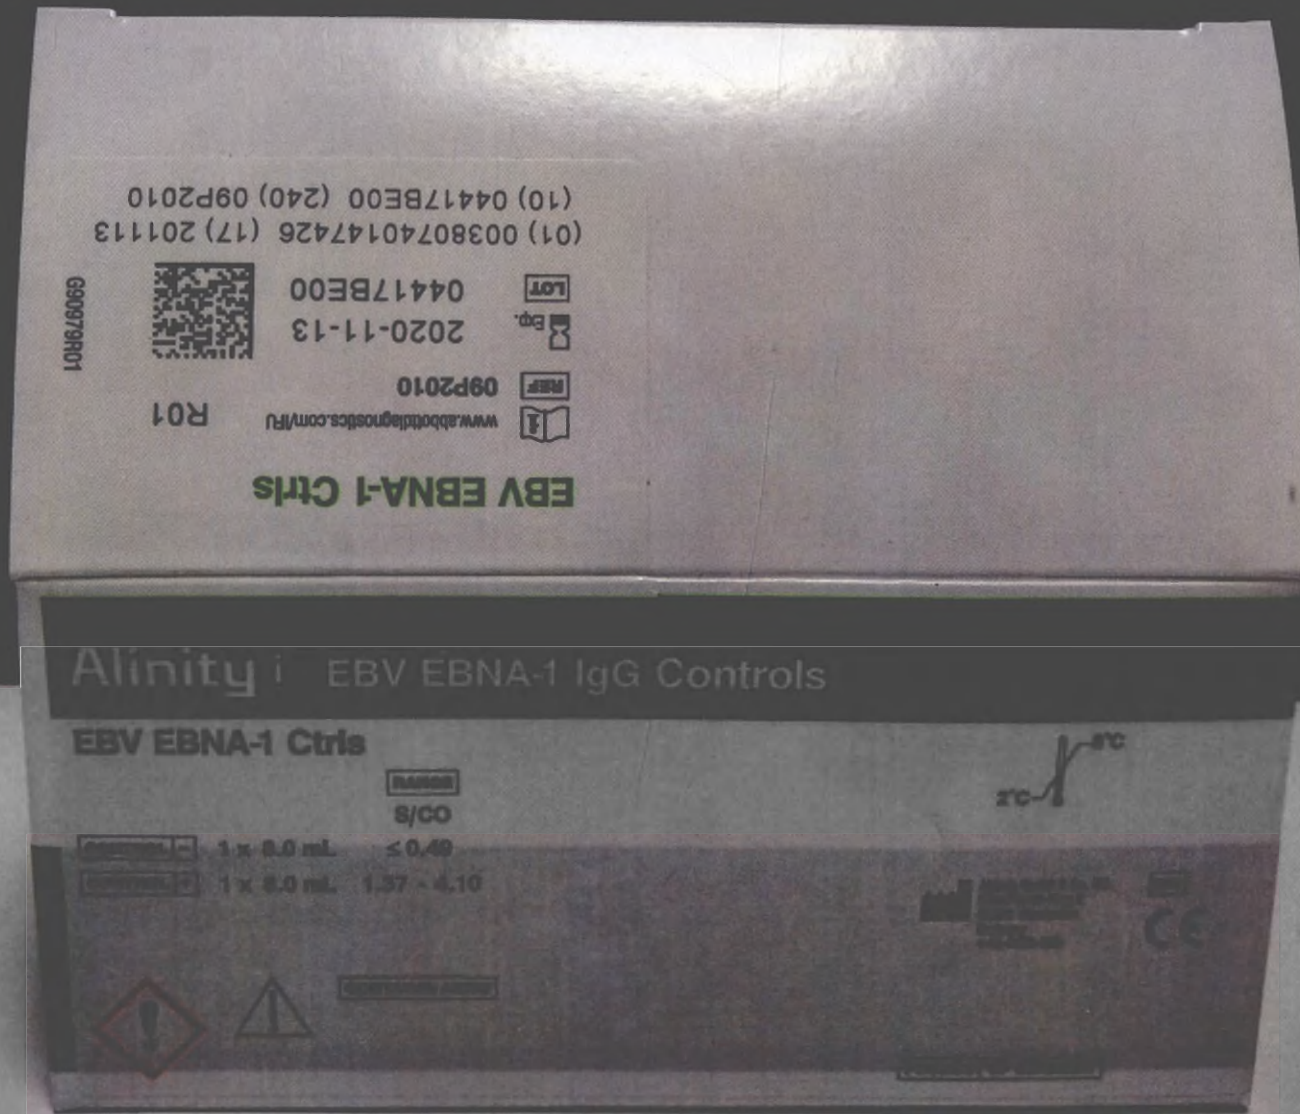

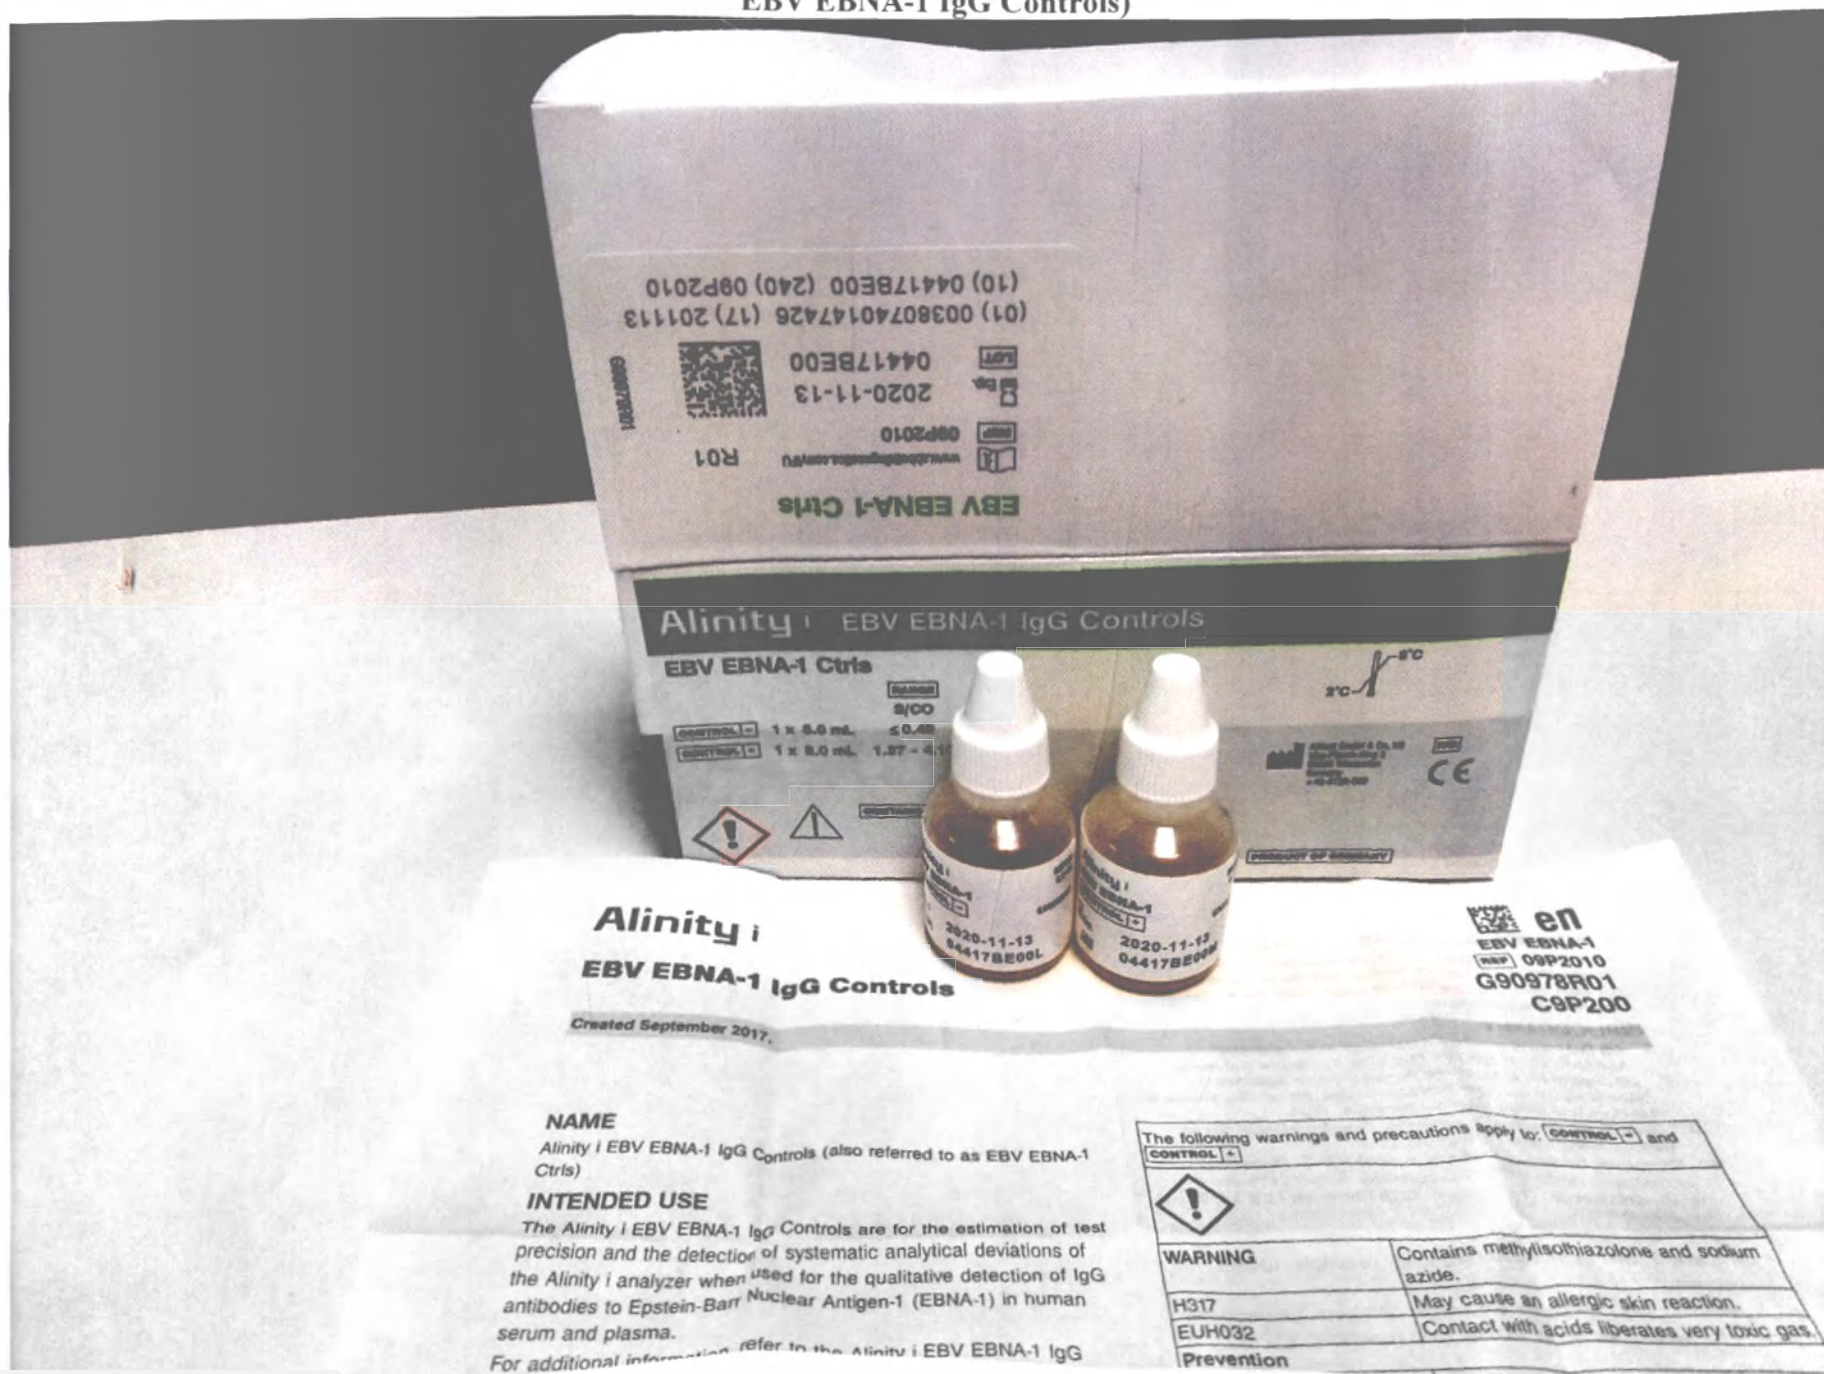

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 (четыре) листов

Подпись



Макет маркировки на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и
правильности качественного определения антител класса IgG к ядерному
антигену вируса Эпштейна-Барр-1 иммунохемилюминесцентным методом в
сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах
Alinity i «EBV ядерный антиген-1 (EBNA-1) антитела IgG Контрольные
материалы (Alinity i EBV EBNA-1 IgG Controls)»**

Макет русскоязычной маркировки

**REF** 09P20-10**IVD**

Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности качественного определения антител класса IgG к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр-1 иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «EBV ядерный антиген-1 (EBNA-1) антитела IgG Контрольные материалы (Alinity i EBV EBNA-1 IgG Controls)»

в составе:

- Контроль - (Alinity i EBV EBNA-1 IgG CONTROL-) - 1 флакон x 8,0 мл
 - Контроль + (Alinity i EBV EBNA-1 IgG CONTROL +) - 1 флакон x 8,0 мл
- Инструкция по применению

Производитель: Abbott GmbH & Co. KG, Max-Plank-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия)

Производственная площадка: Abbott GmbH & Co. KG, Max-Plank-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany (Германия)

Страна происхождения: Германия

/ РУ № _____ / _____ от _____.____ / Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Данный продукт содержит полученные от человека и/или потенциально инфекционные компоненты.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран СНГ:

Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,

Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)

EBV EBNA-1 Ctrls


REF 09P2010

www.abbottdiagnostics.com/FLU

Exp

LOT

Alinity i EBV EBNA-1 IgG Controls



EBV EBNA-1 Ctrls

		RANGE
CONTROL -	1 x 8.0 mL	S/CO ≤ 0.49
CONTROL +	1 x 8.0 mL	1.37 - 4.10



CONTAINS: AZIDE



EBV EBNA-1 Ctrls



Abbott GmbH
Max-Planck-Str. 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580



PRODUCT OF GERMANY



Макет маркировки блока компонентов медицинского изделия

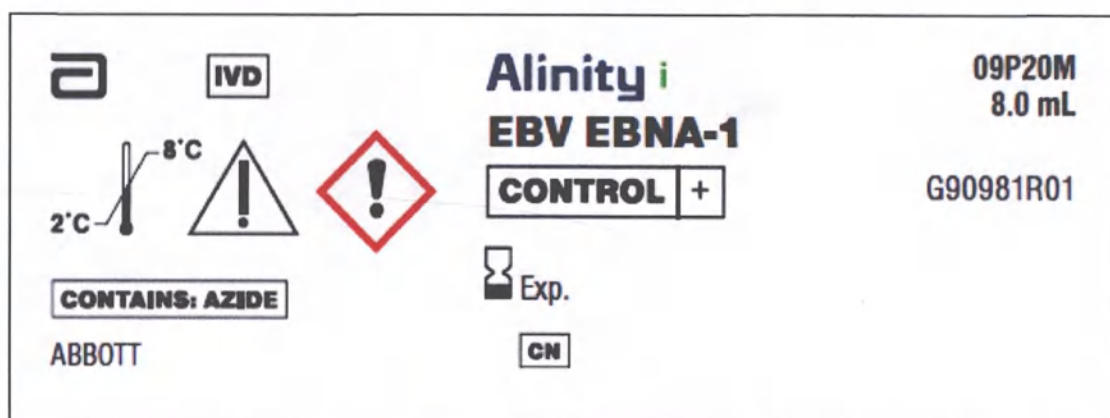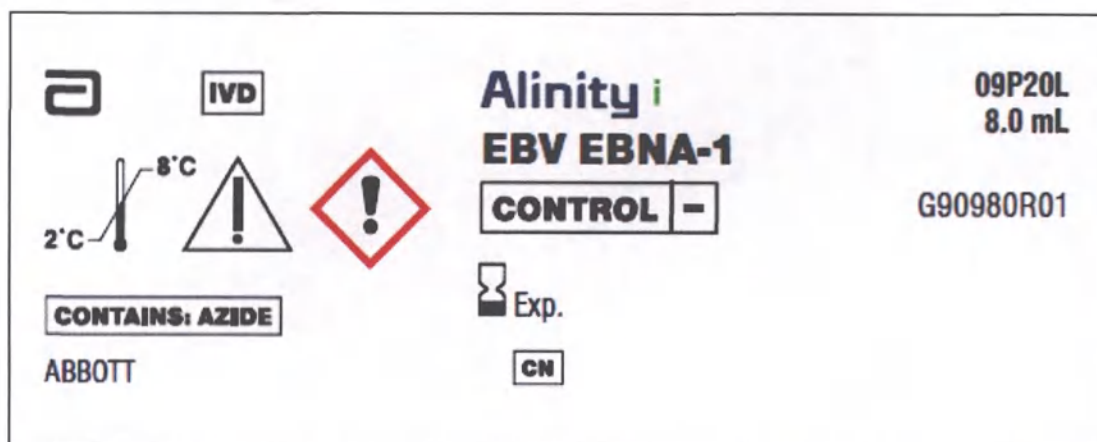

Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:

Стандарт	Наименование стандарта
ГОСТ Р ИСО 18113-1-2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования
ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка). Часть 2. Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования

Расшифровка символов представлена в инструкции.

Всего прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

4 (четыре) листов

Подпись

