

Фотографические изображения медицинского изделия

**Система диагностическая ультразвуковая, варианты исполнения:
XARIO 100G (модель CUS-X100G) и XARIO 200G (модель CUS-X200G) с
принадлежностями**

Производства:

Canon Medical Systems Corporation

(Канон Медикал Системз Корпорейшн)

1385 Shimoishigami, Otawara-shi, Tochigi, 324-8550, Japan

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Канон Медикал Системз»

А.В. Чабаненко




Система диагностическая ультразвуковая, вариант исполнения XARIO 100G (модель CUS-X100G), базовый состав:

1. Основной блок системы




3. Монитор цветной жидкокристаллический

4

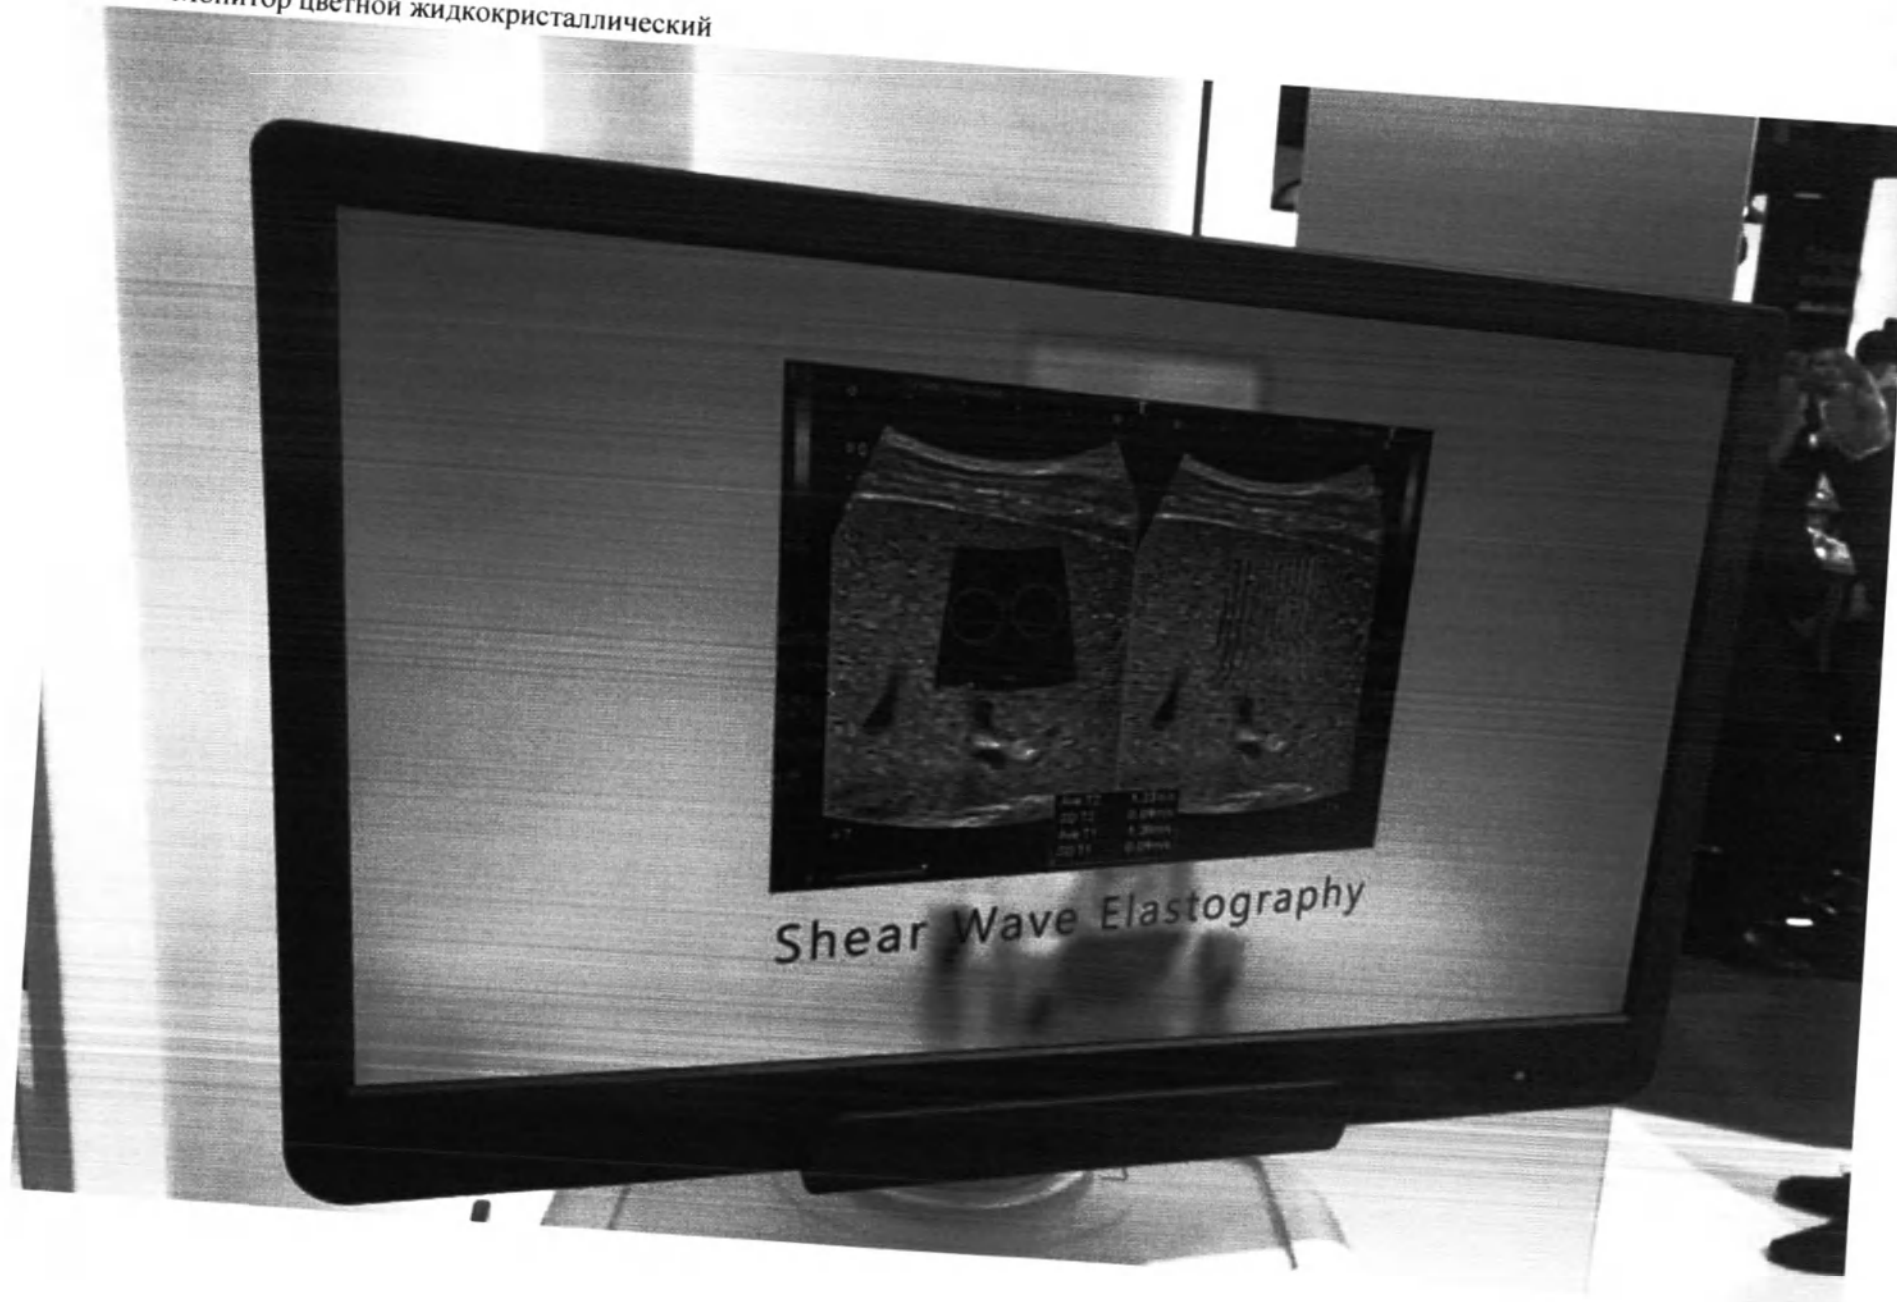


4. Датчик секторный, модель PSU-25BT, РУ №РЗН 2015/2361

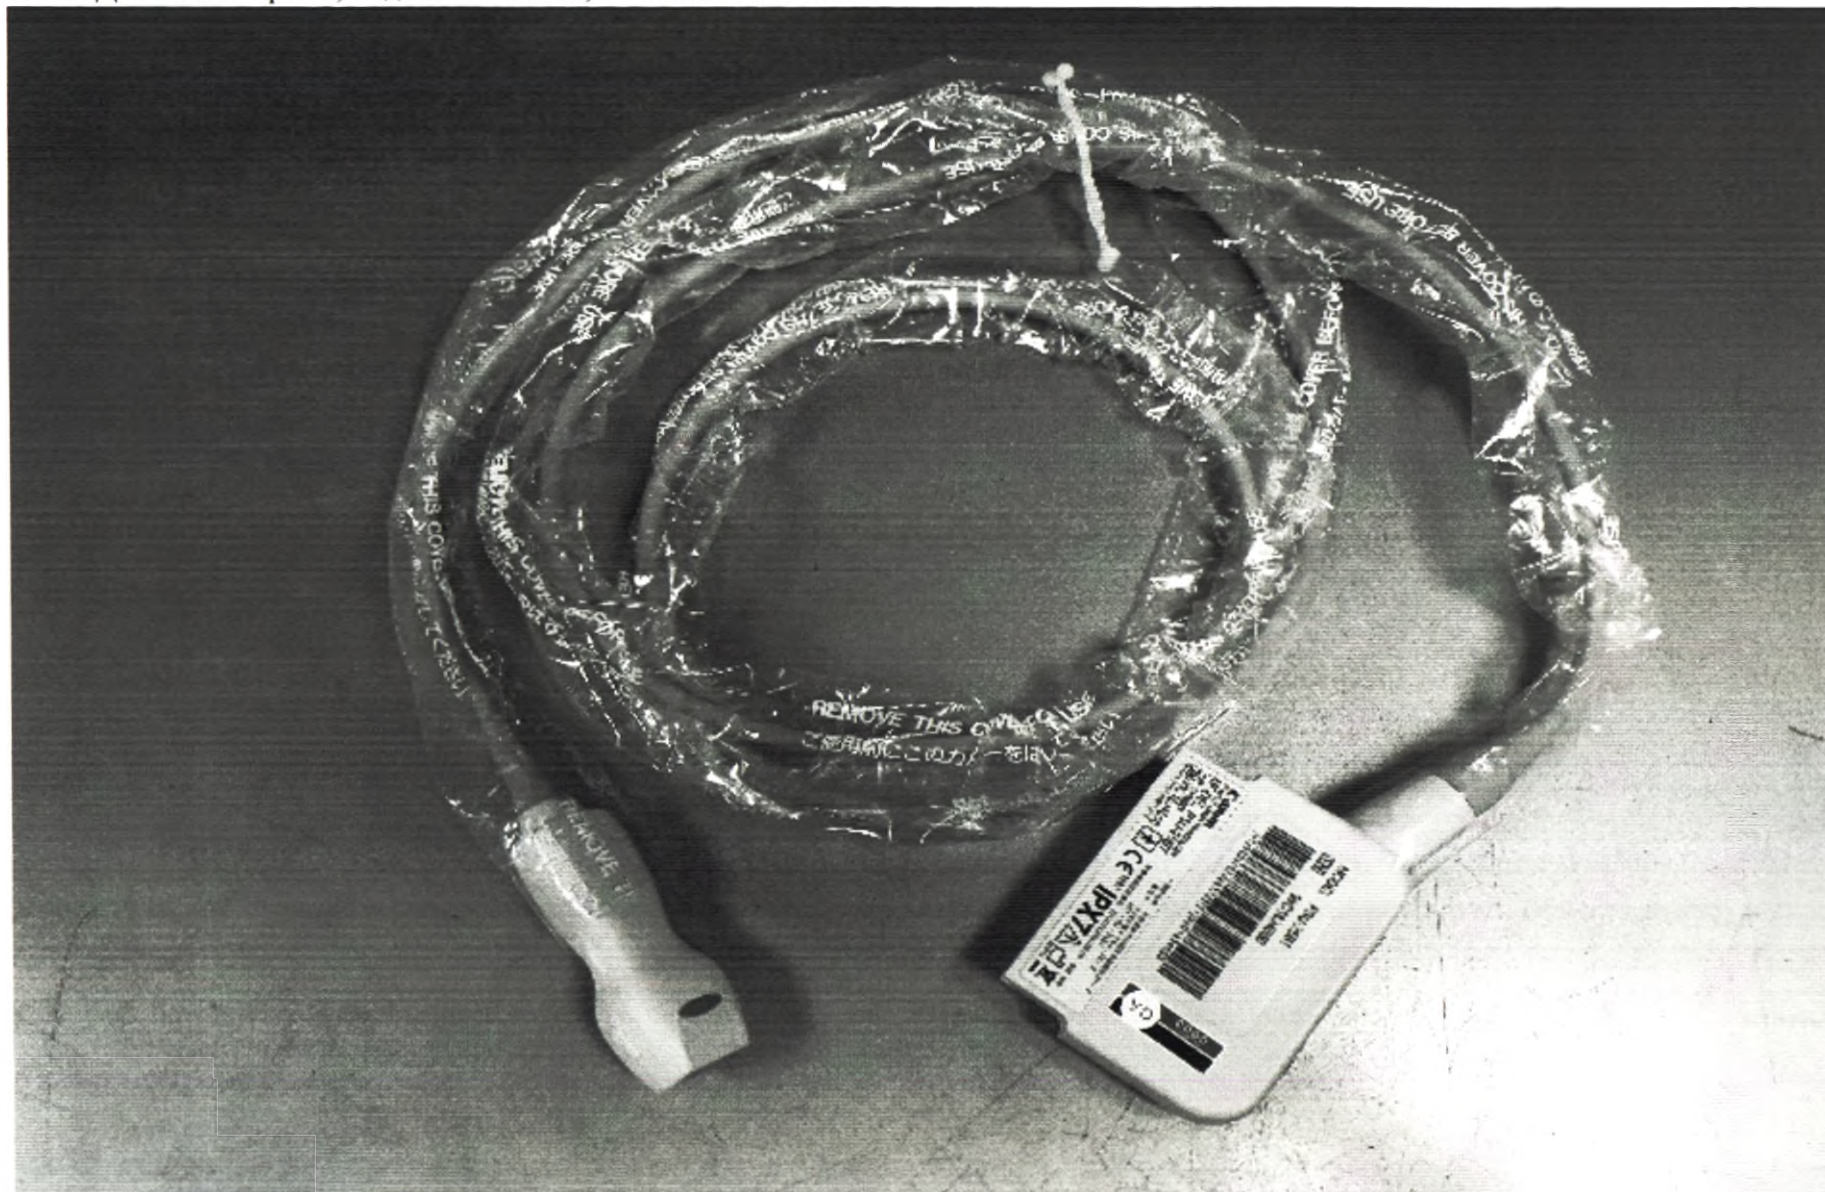

5. Датчик секторный, модель PSU-30BT, РУ №РЗН 2015/2361




6. Датчик секторный, модель PSU-50BT, РУ №РЗН 2015/2361

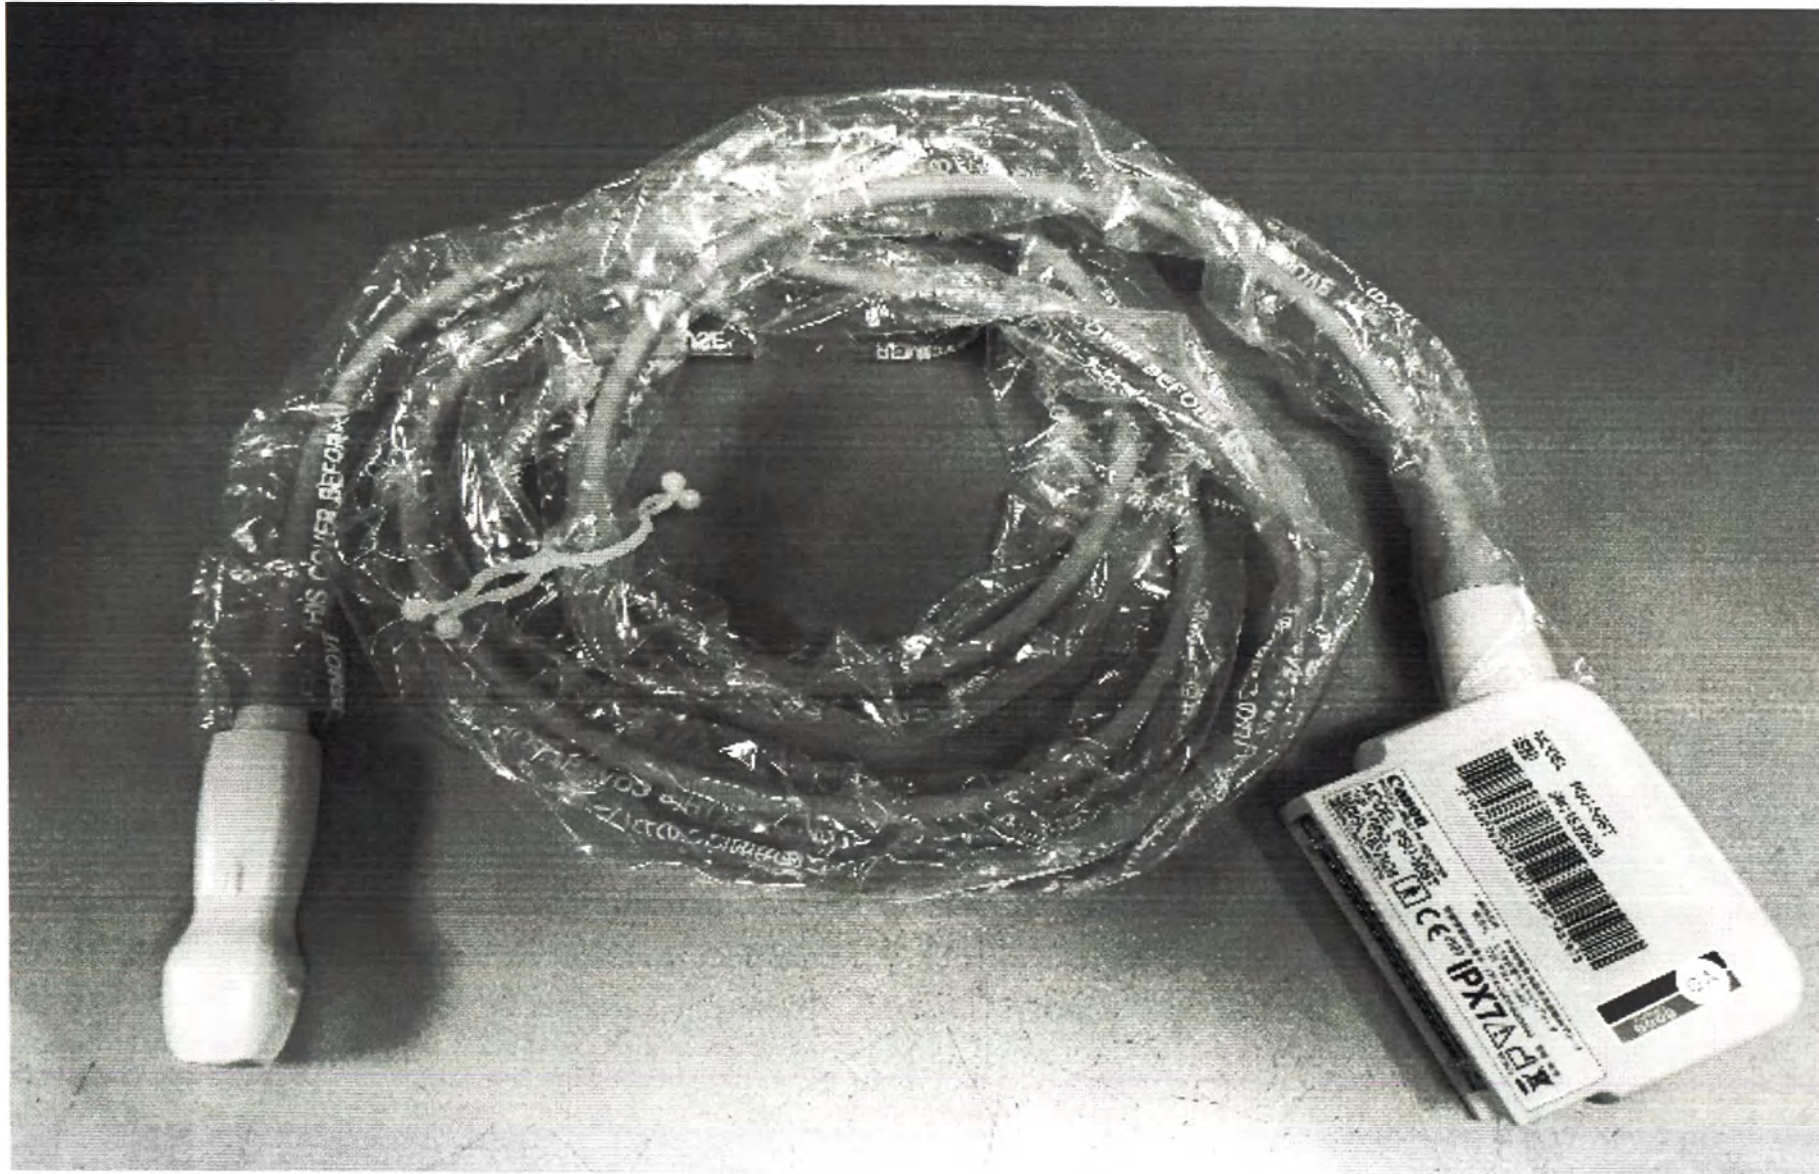

7. Датчик секторный, модель PSU-70BT, РУ №РЗН 2015/2361




8. Датчик конвексный, модель PVU-375BT, РУ №РЗН 2015/2361

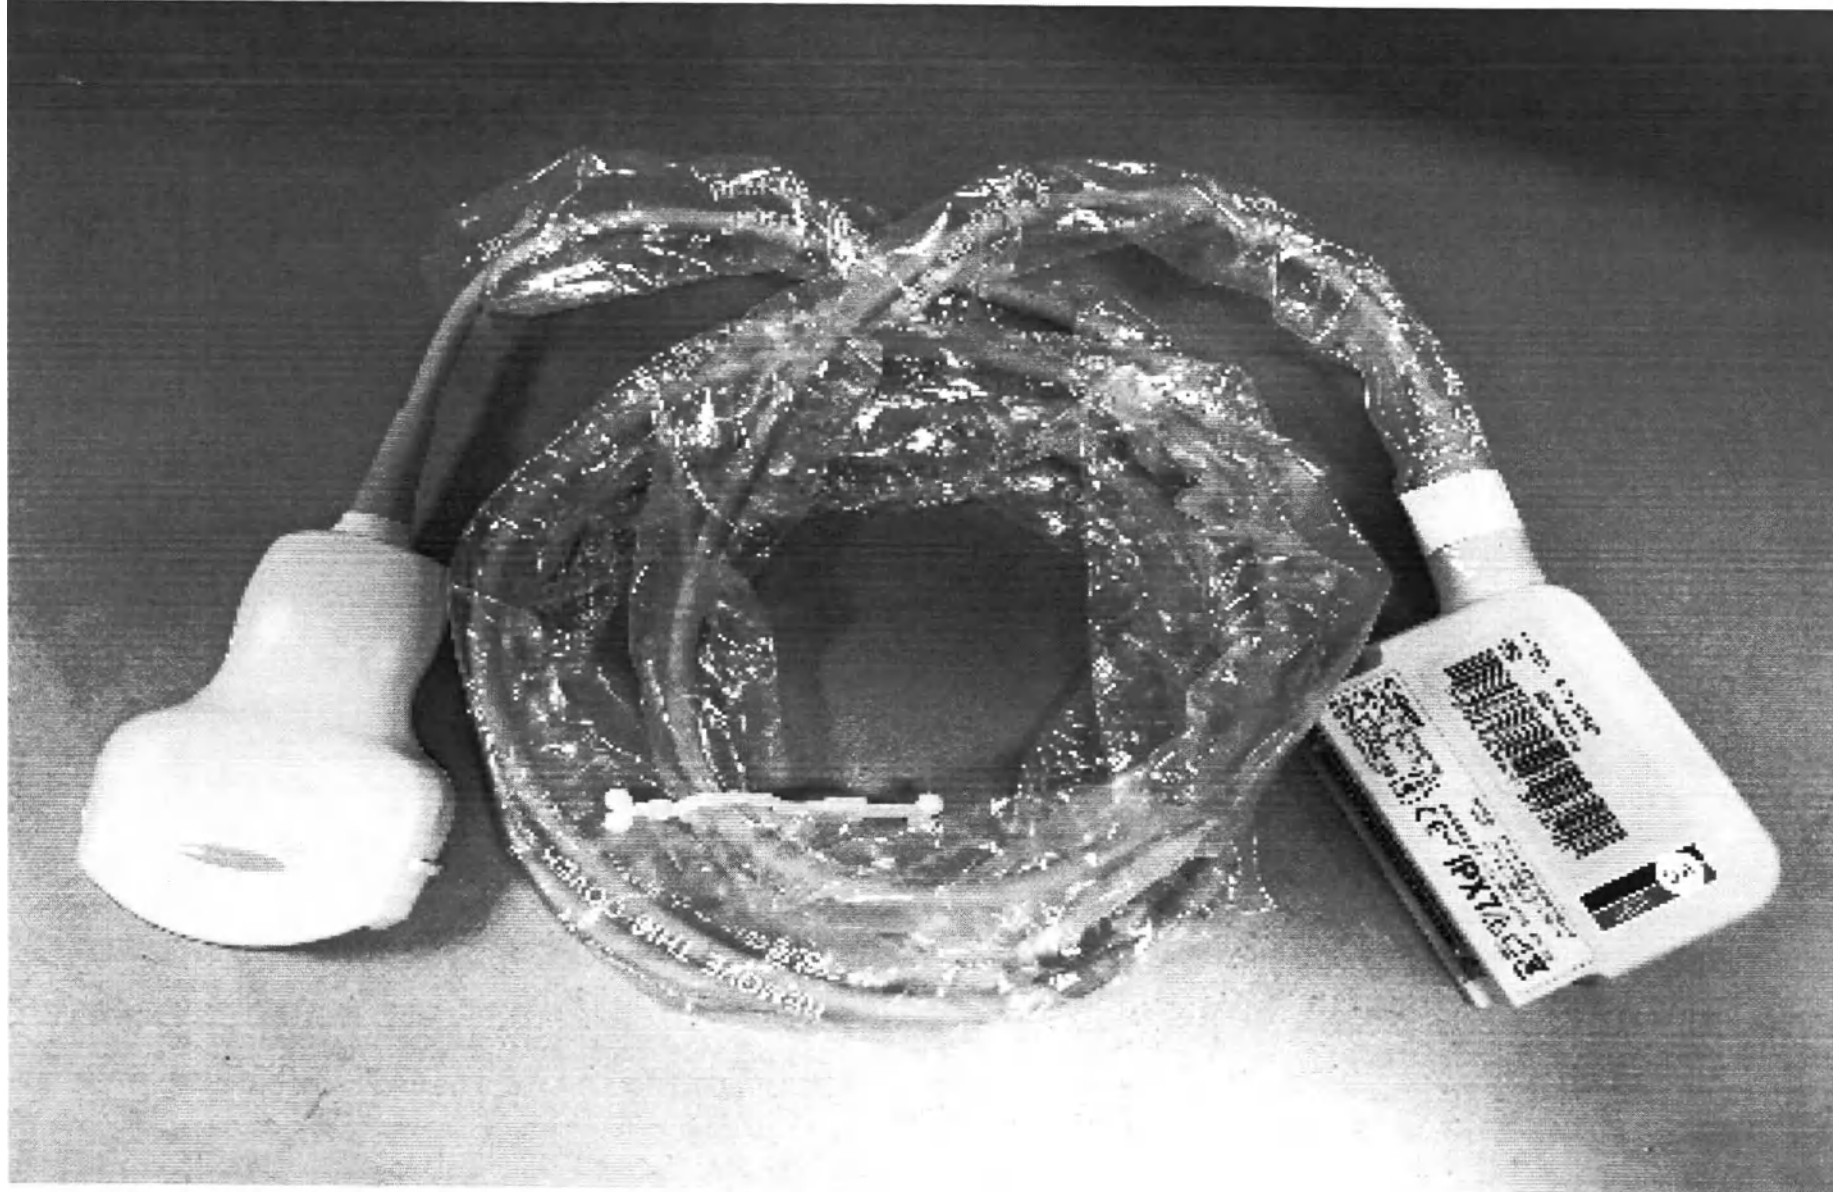

9. Датчик конвексный, модель PVU-674BT, РУ №РЗН 2015/2361



10. Датчик конвексный, модель PVU-674MV, РУ №РЗН 2015/2361

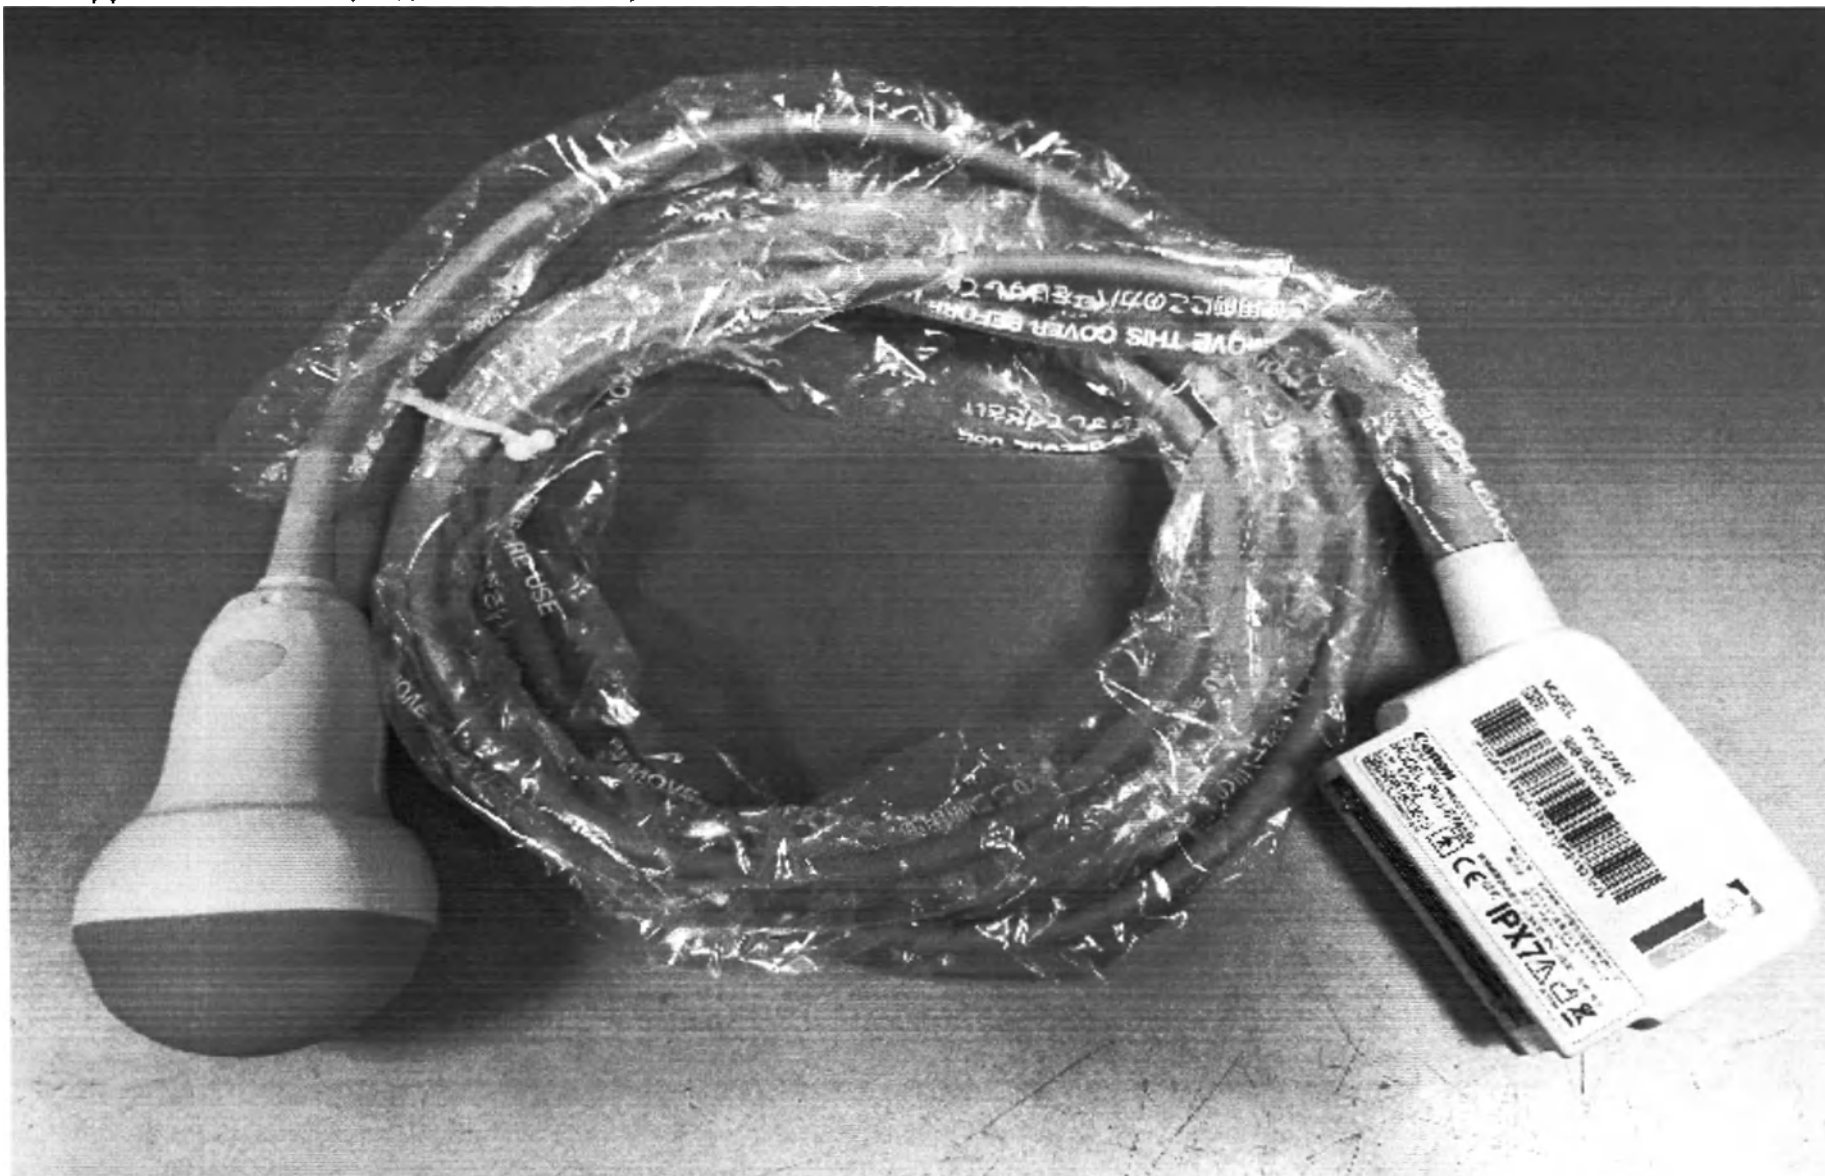

11. Датчик внутривидеостной, модель PVU-681MVL, РУ №РЗН 2015/2361




12. Датчик конвексный, модель PVU-712BT, РУ №РЗН 2015/2361




13. Датчик конвексный, модель PVU-745BTF, РУ №РЗН 2015/2361



14. Датчик конвексный, модель PVU-745BTH, РУ №РЗН 2015/2361

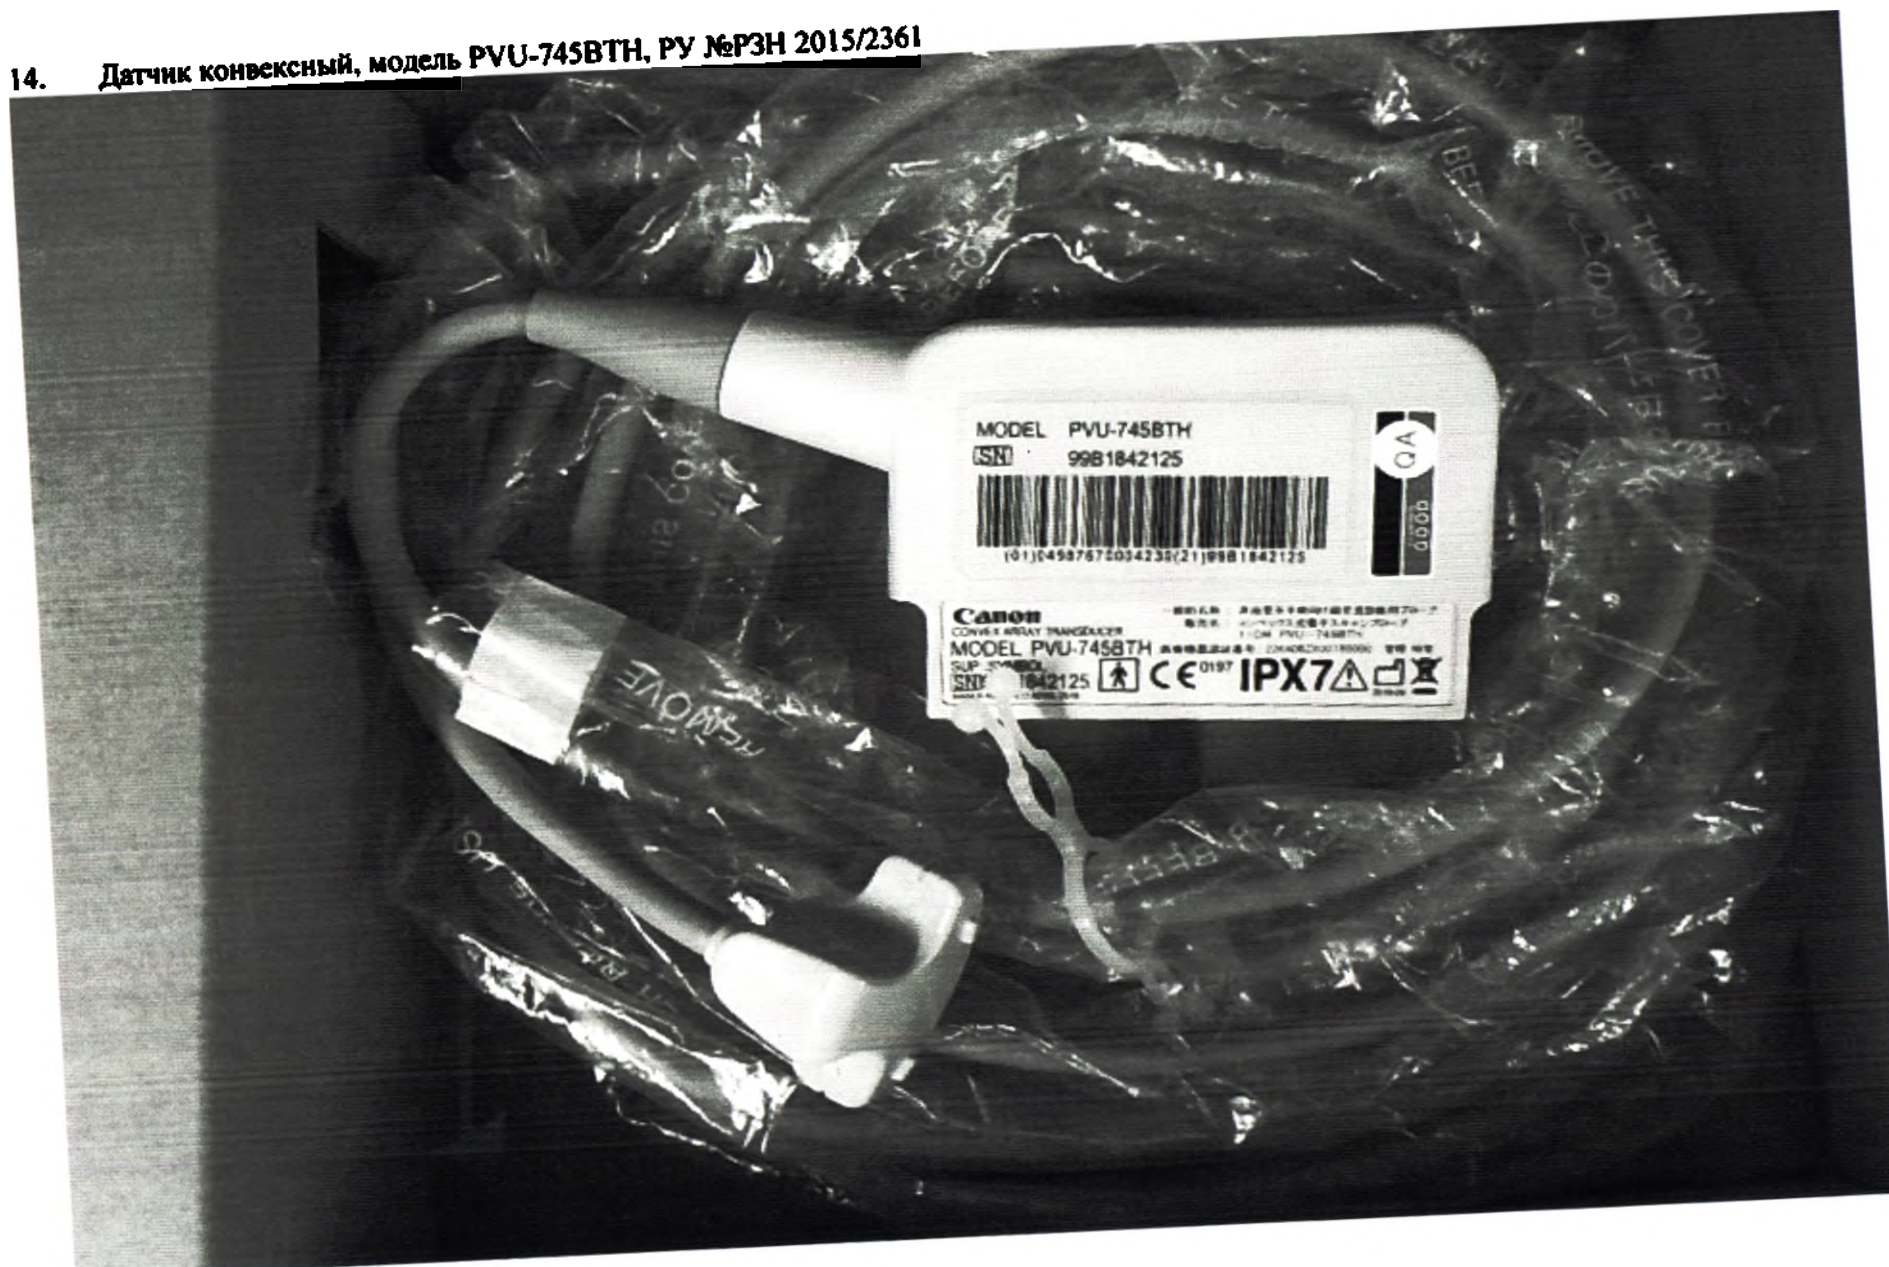

15. Датчик внутриполостной, модель PVU-770ST, РУ №РЗН 2015/2361

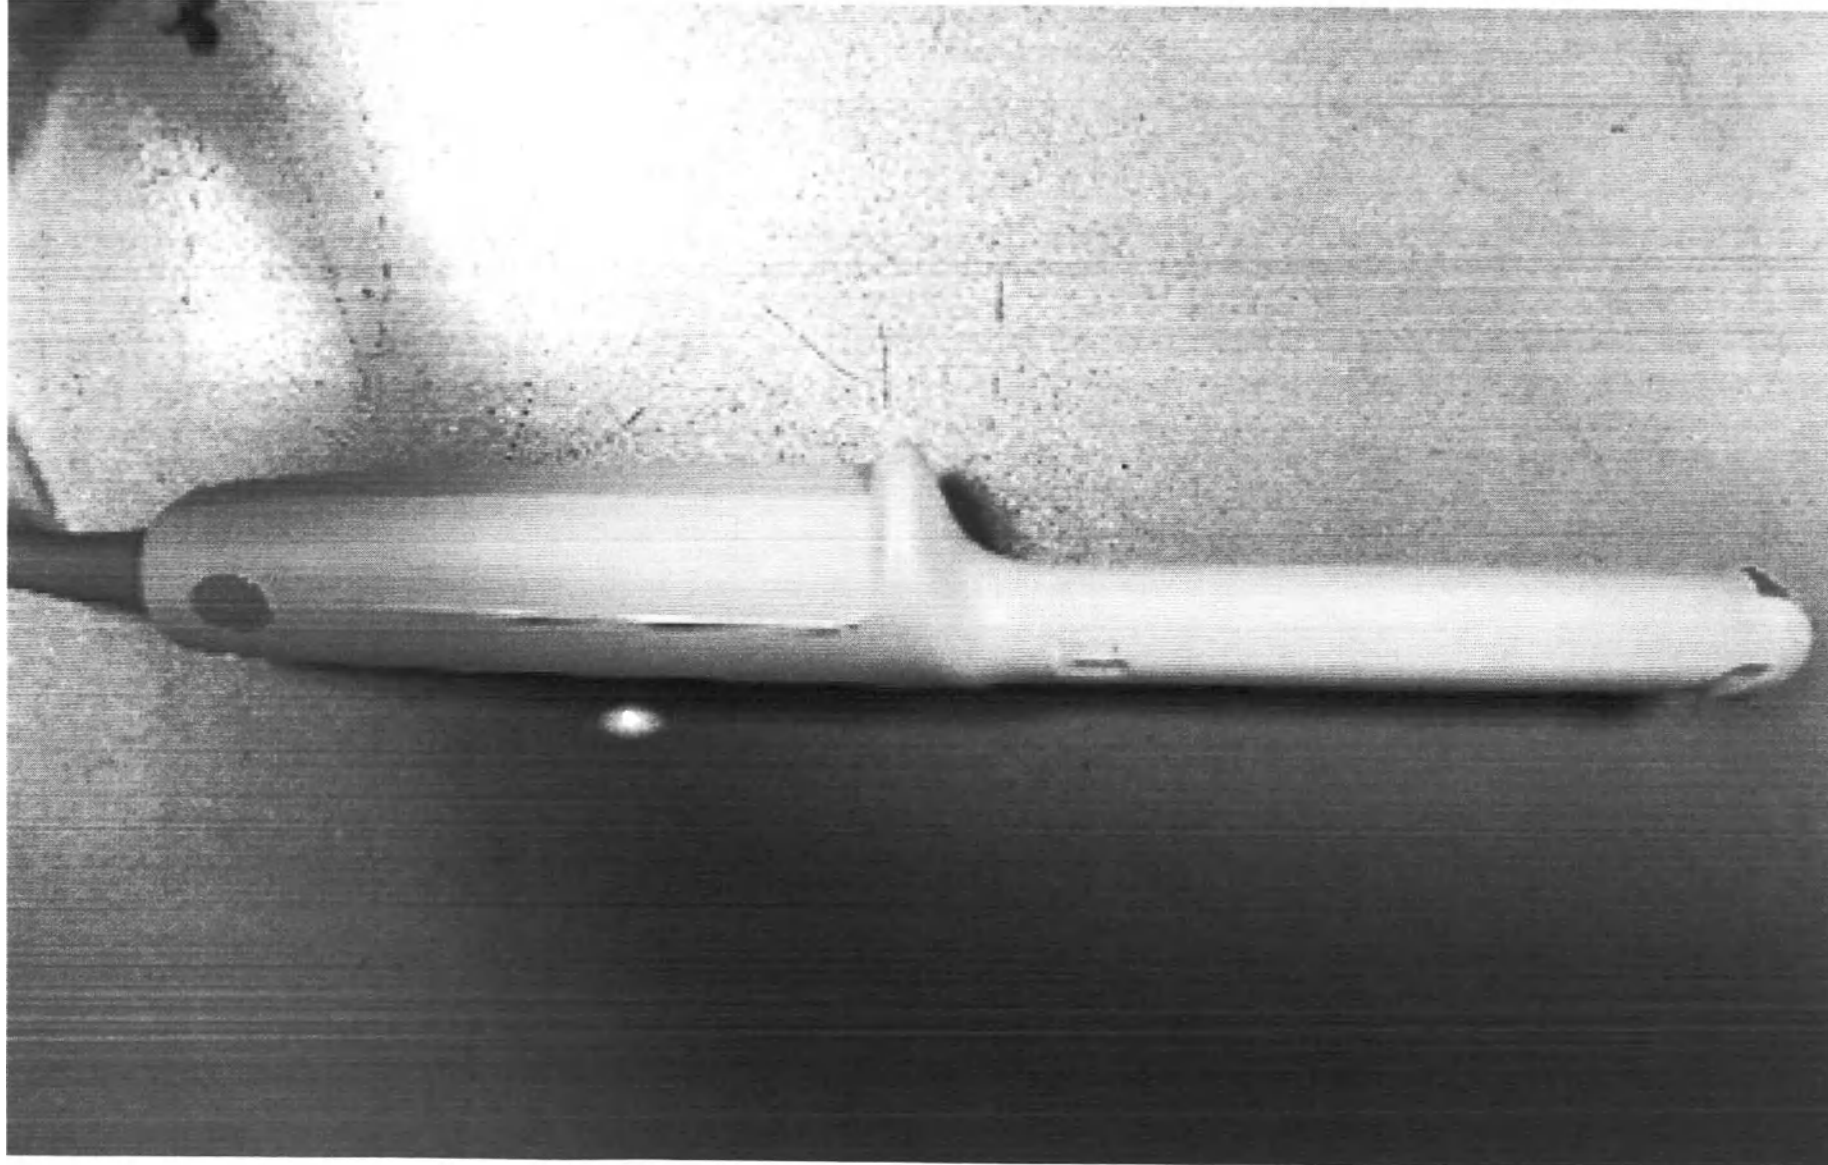


16. Датчик внутриполостной, модель PVU-781VT, РУ №РЗН 2015/2361



17. Датчик внутриполостной, модель PVU-781VTE, РУ №РЗН 2015/2361




18. Датчик внутрисполостной, модель PVL-715RS, РУ №РЗН 2015/2361

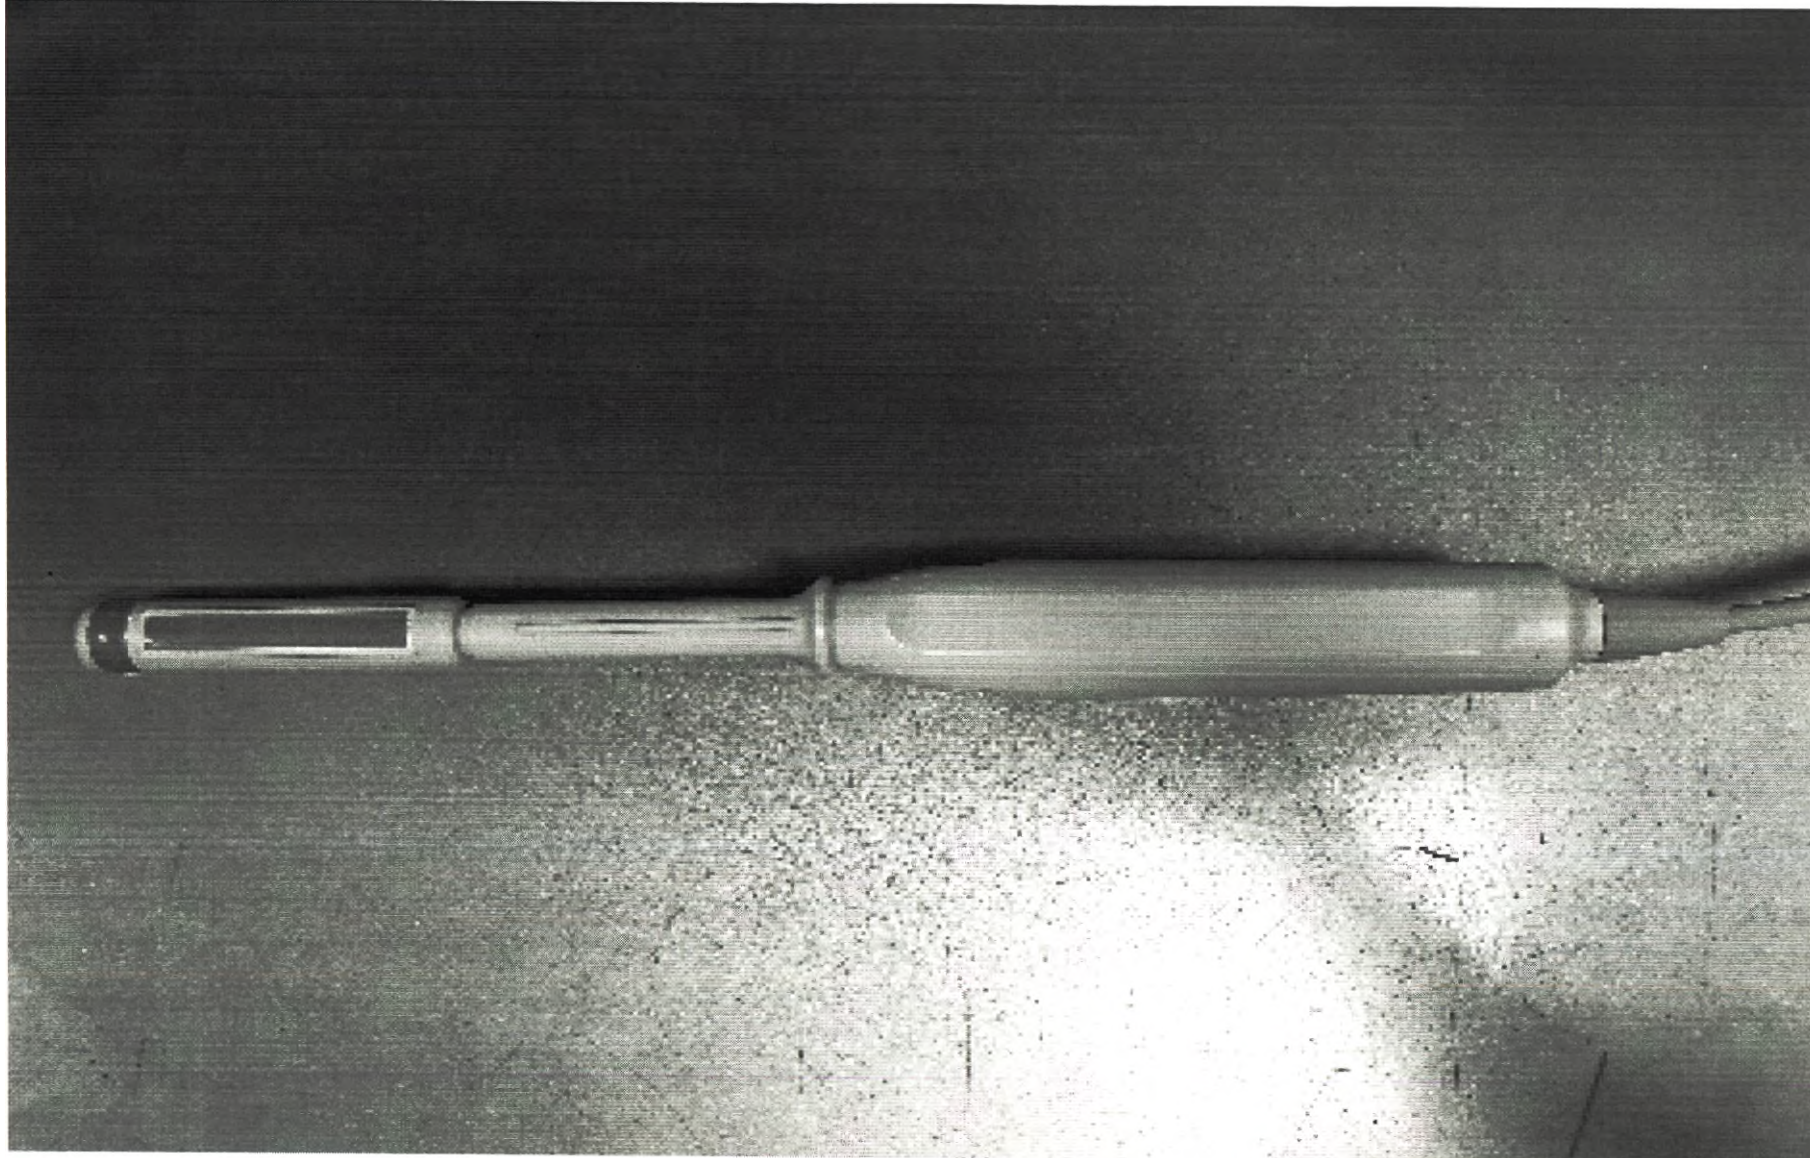


19. Датчик линейный биопсийный, модель PLU-308BTP, РУ №РЗН 2015/2361



20. Датчик линейный, модель PLU-704BT, РУ №РЗН 2015/2361

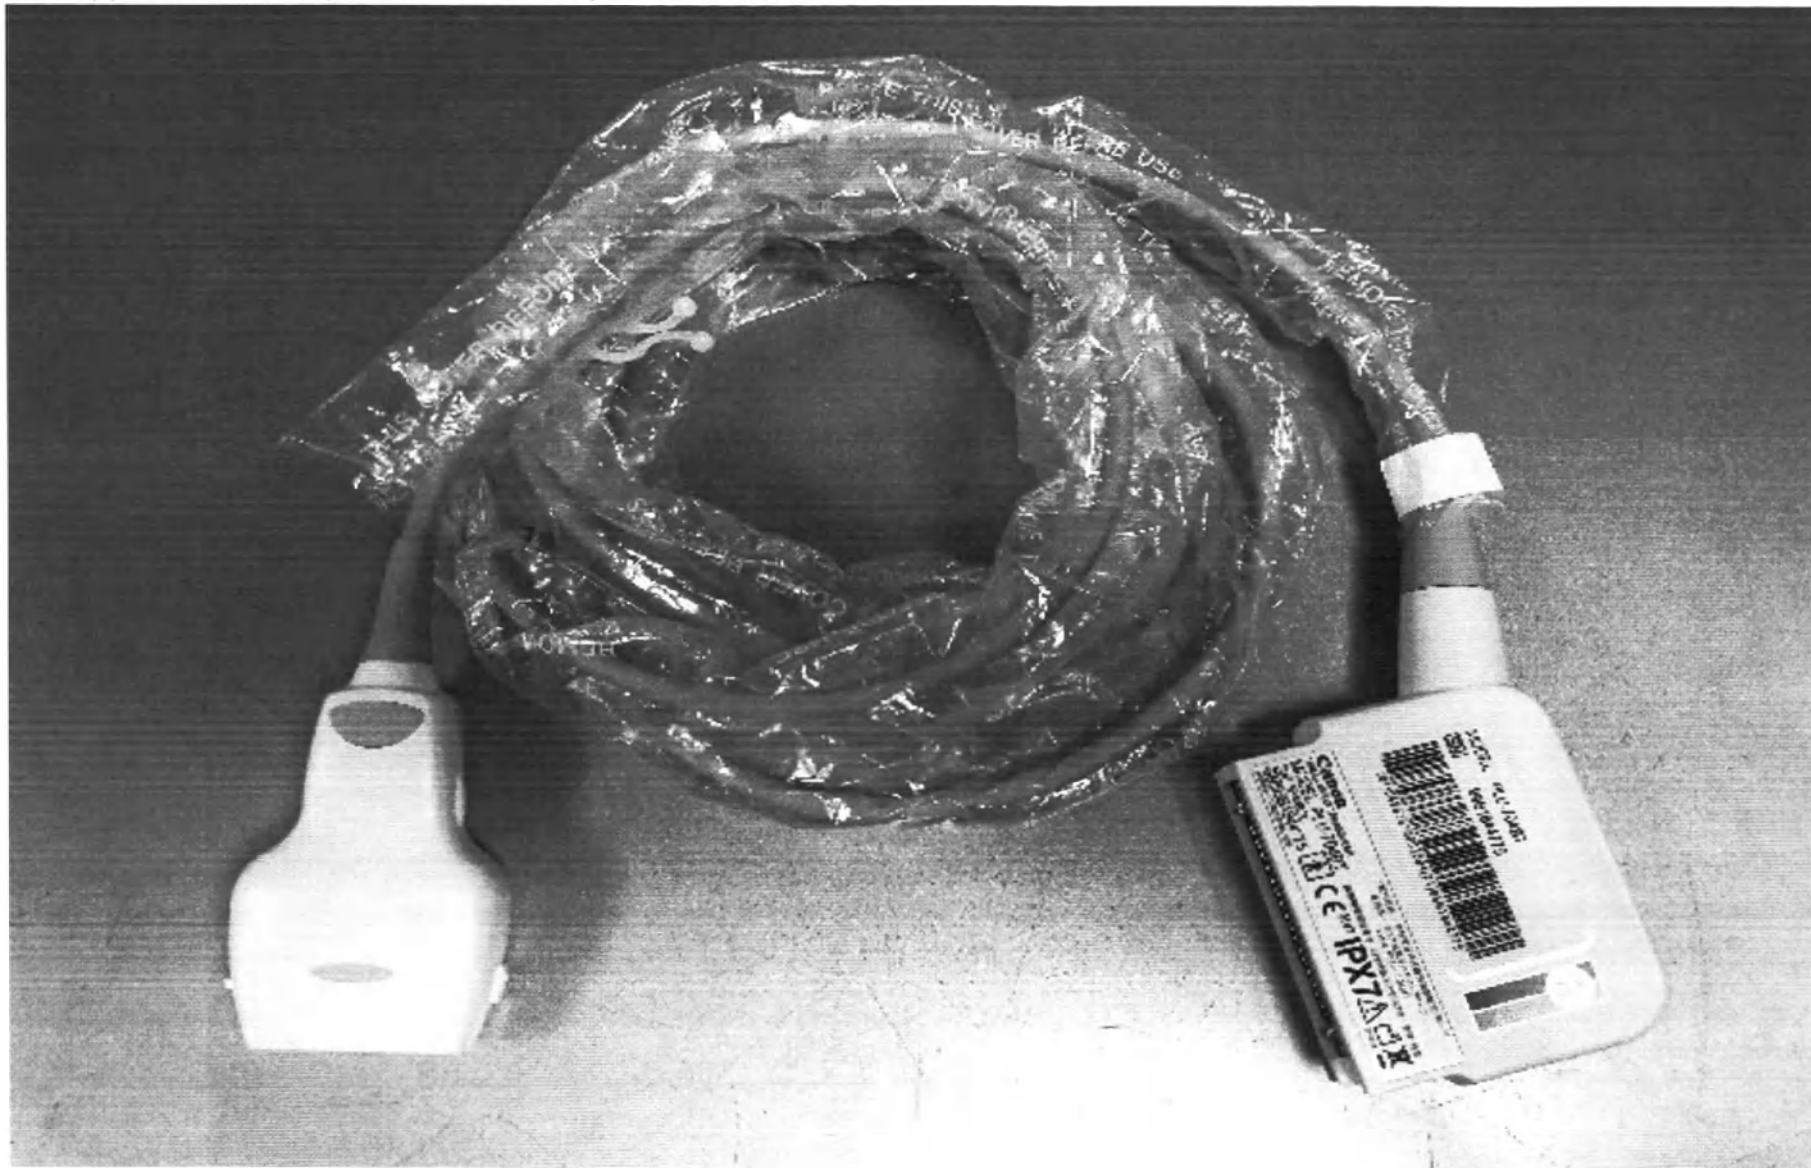


21. Датчик линейный, модель PLU-1005BT, РУ №РЗН 2015/2361

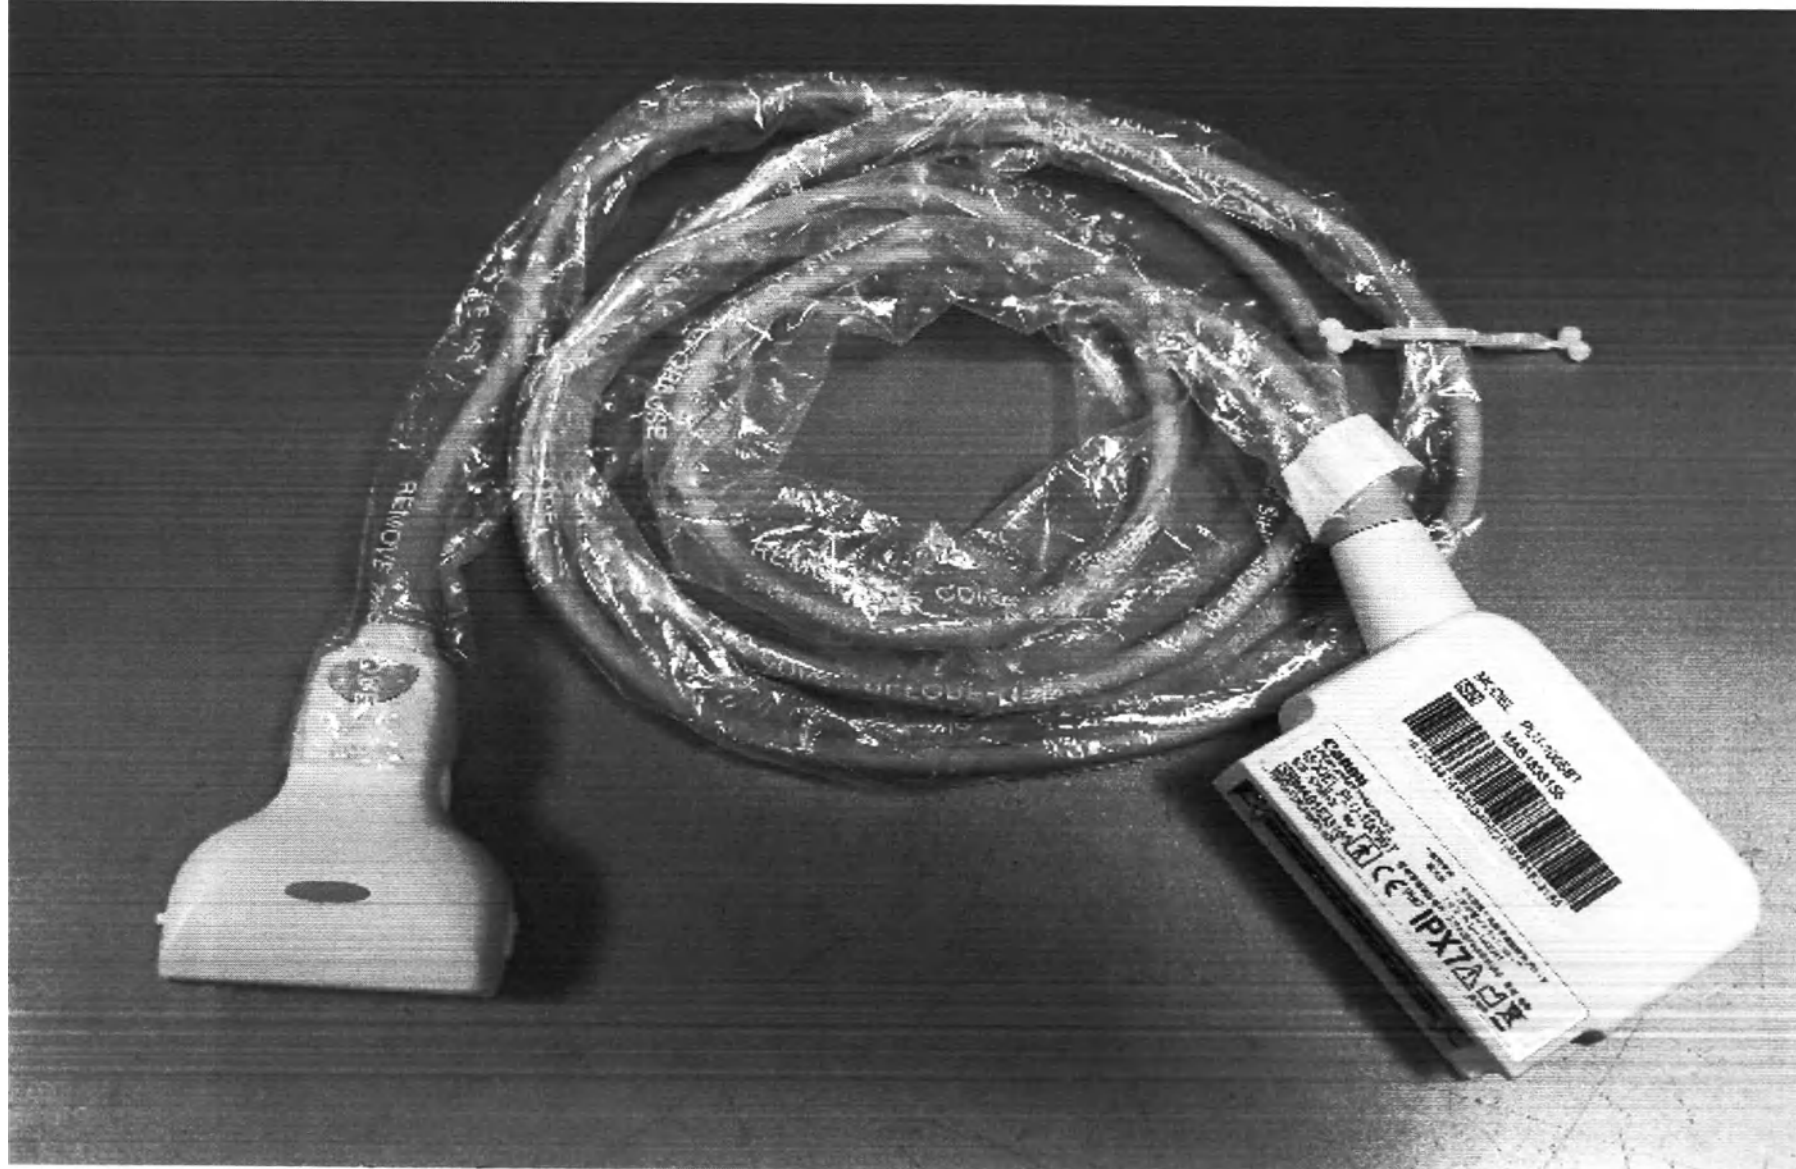


22. Датчик линейный, модель PLU-1202BT, РУ №РЗН 2015/2361




23. Датчик линейный, модель PLU-1204BT, РУ №РЗН 2015/2361

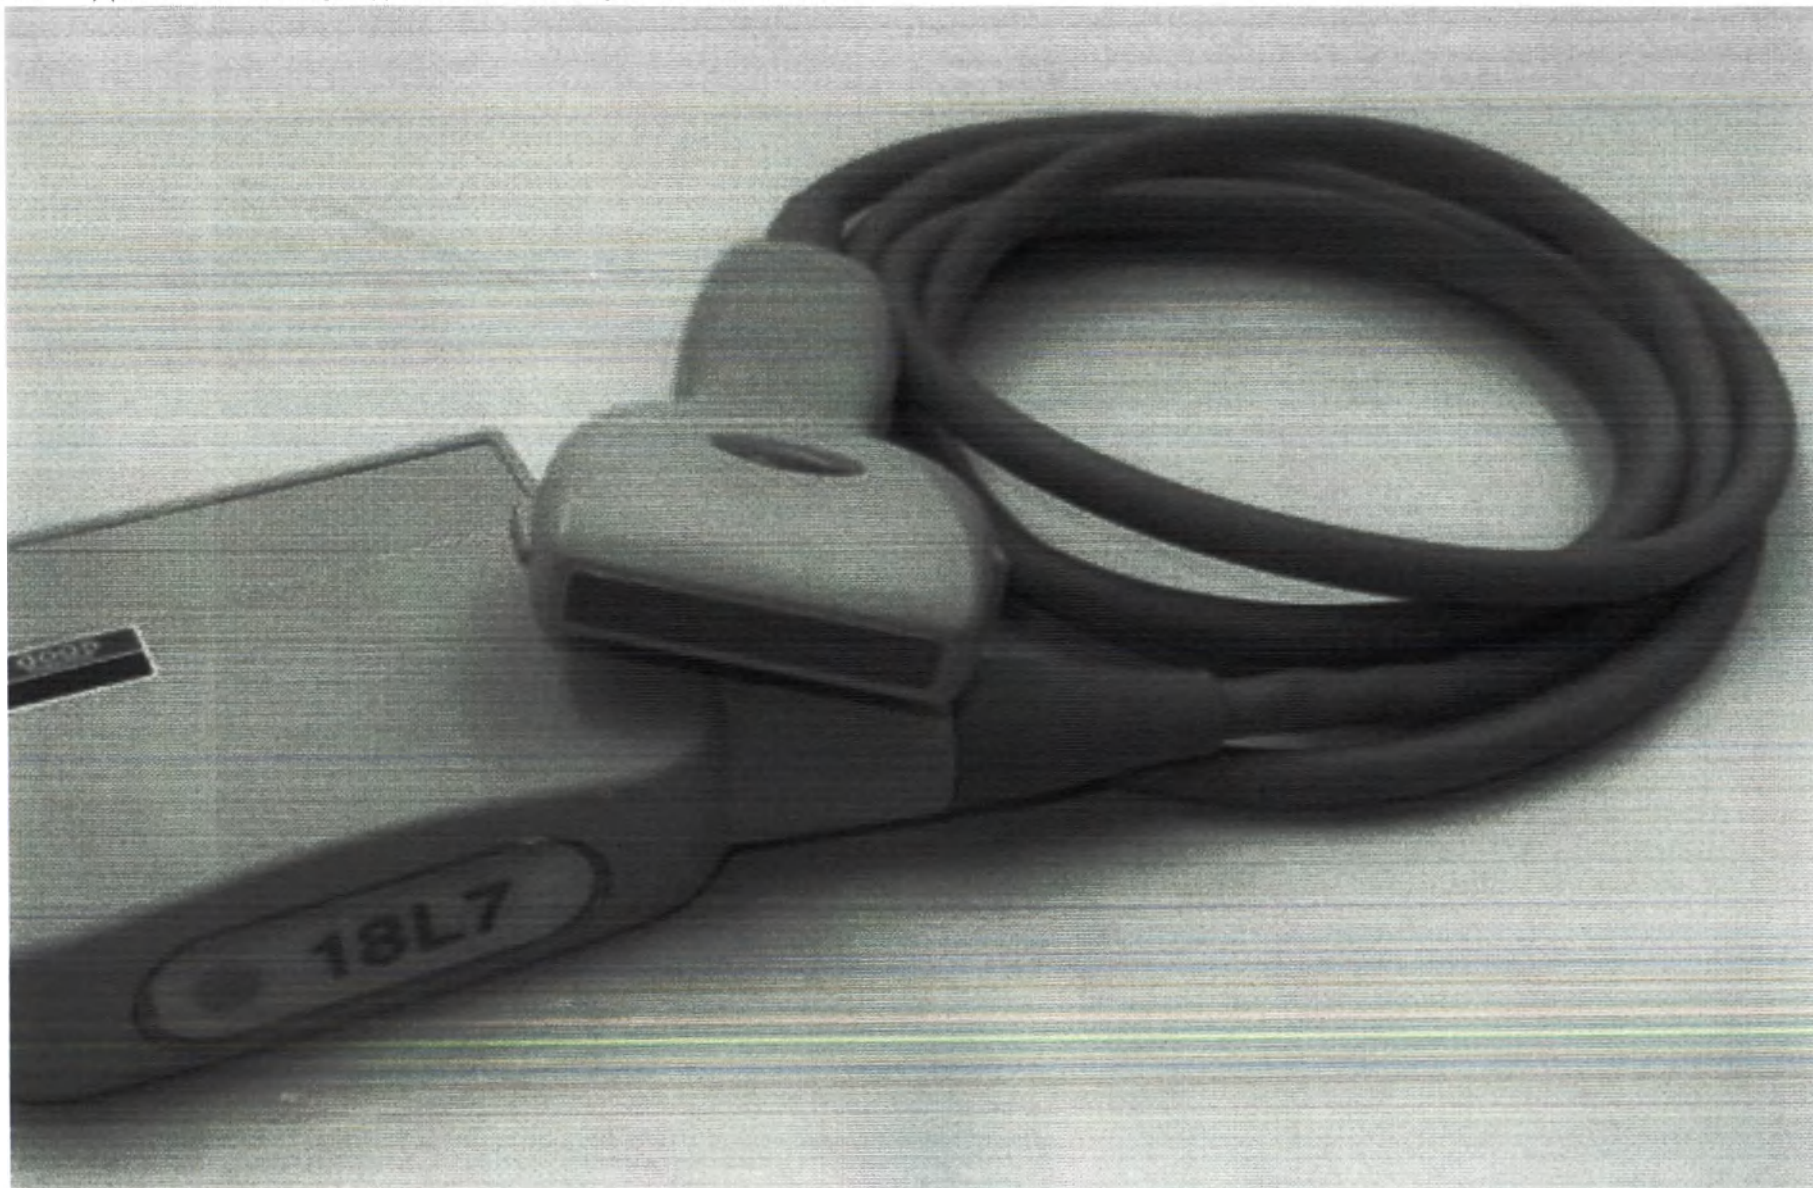

24. Датчик транспищеводный мультиплановый, модель РЕТ-512MD, РУ №РЗН 2015/2361

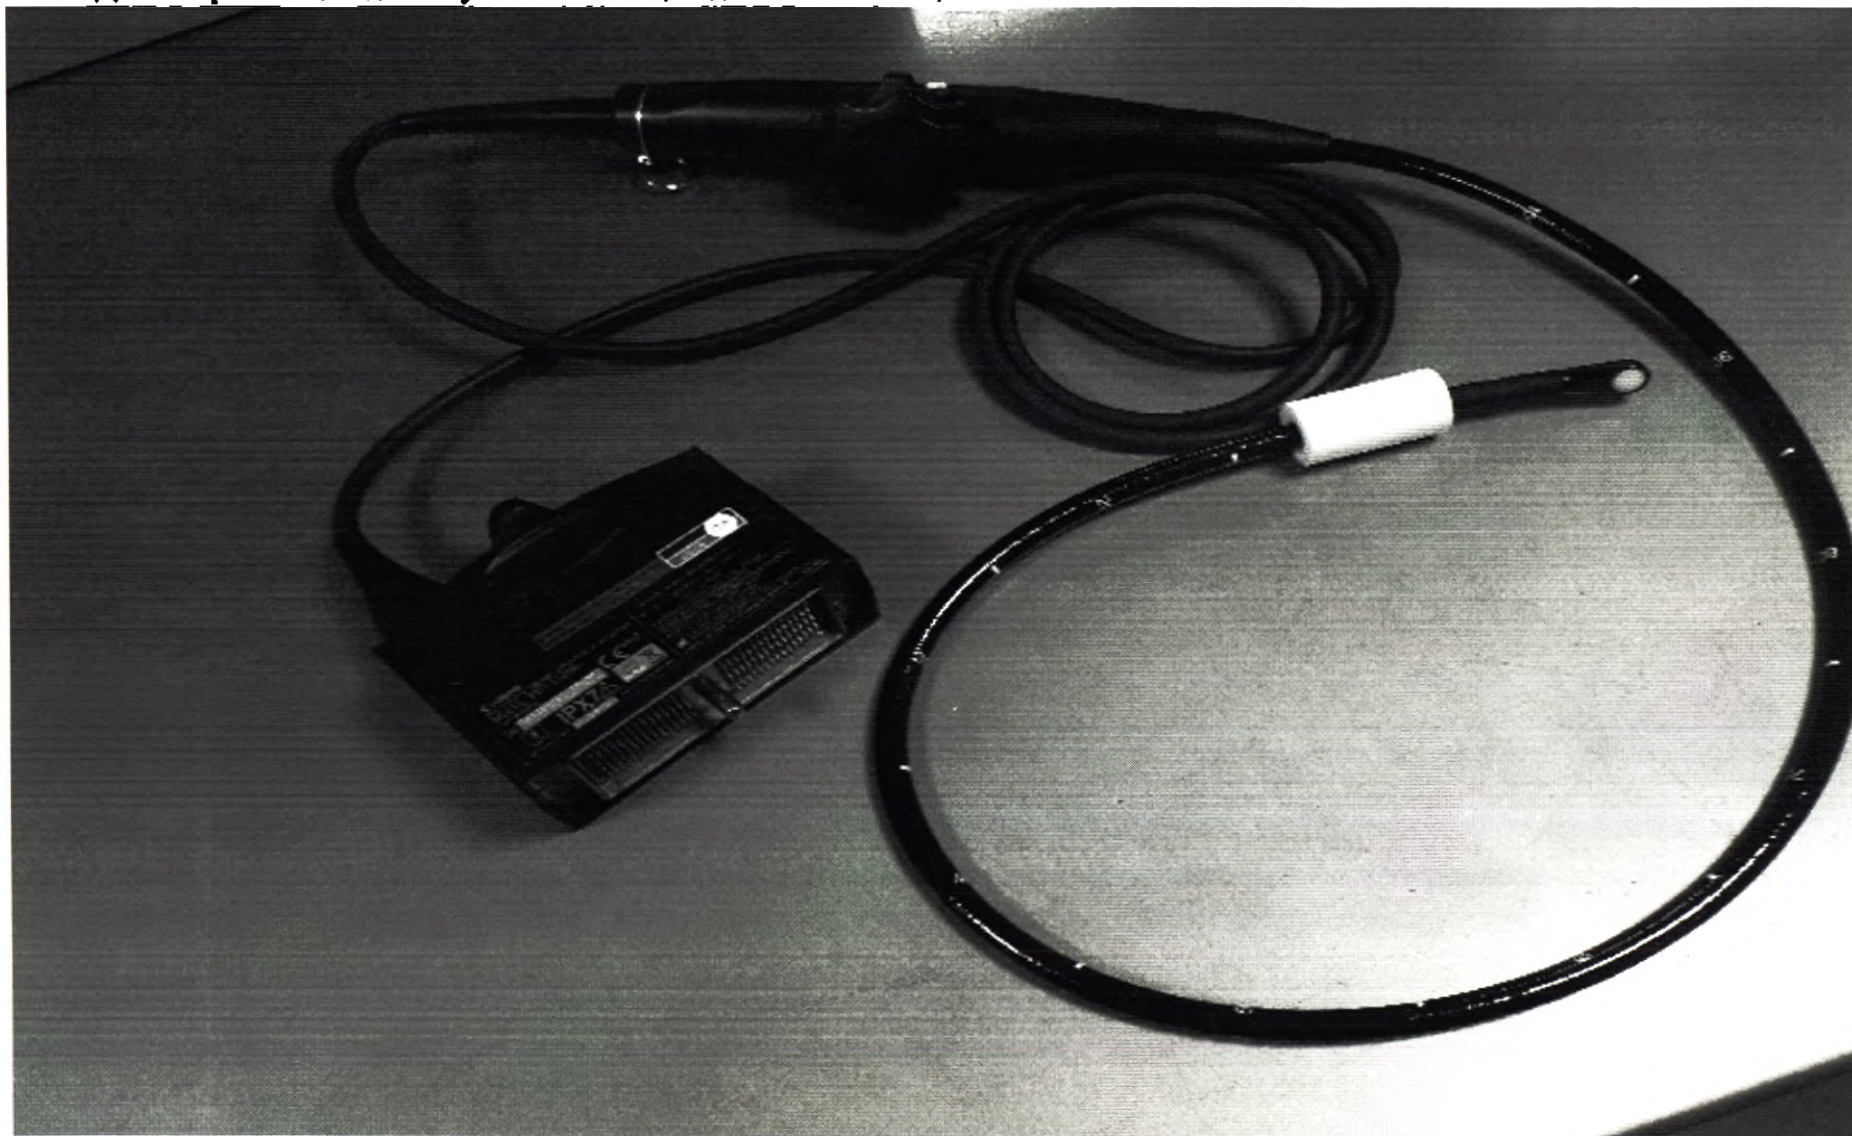

25. Датчик линейный, модель РЕТ-805LA, РУ №РЗН 2015/2361

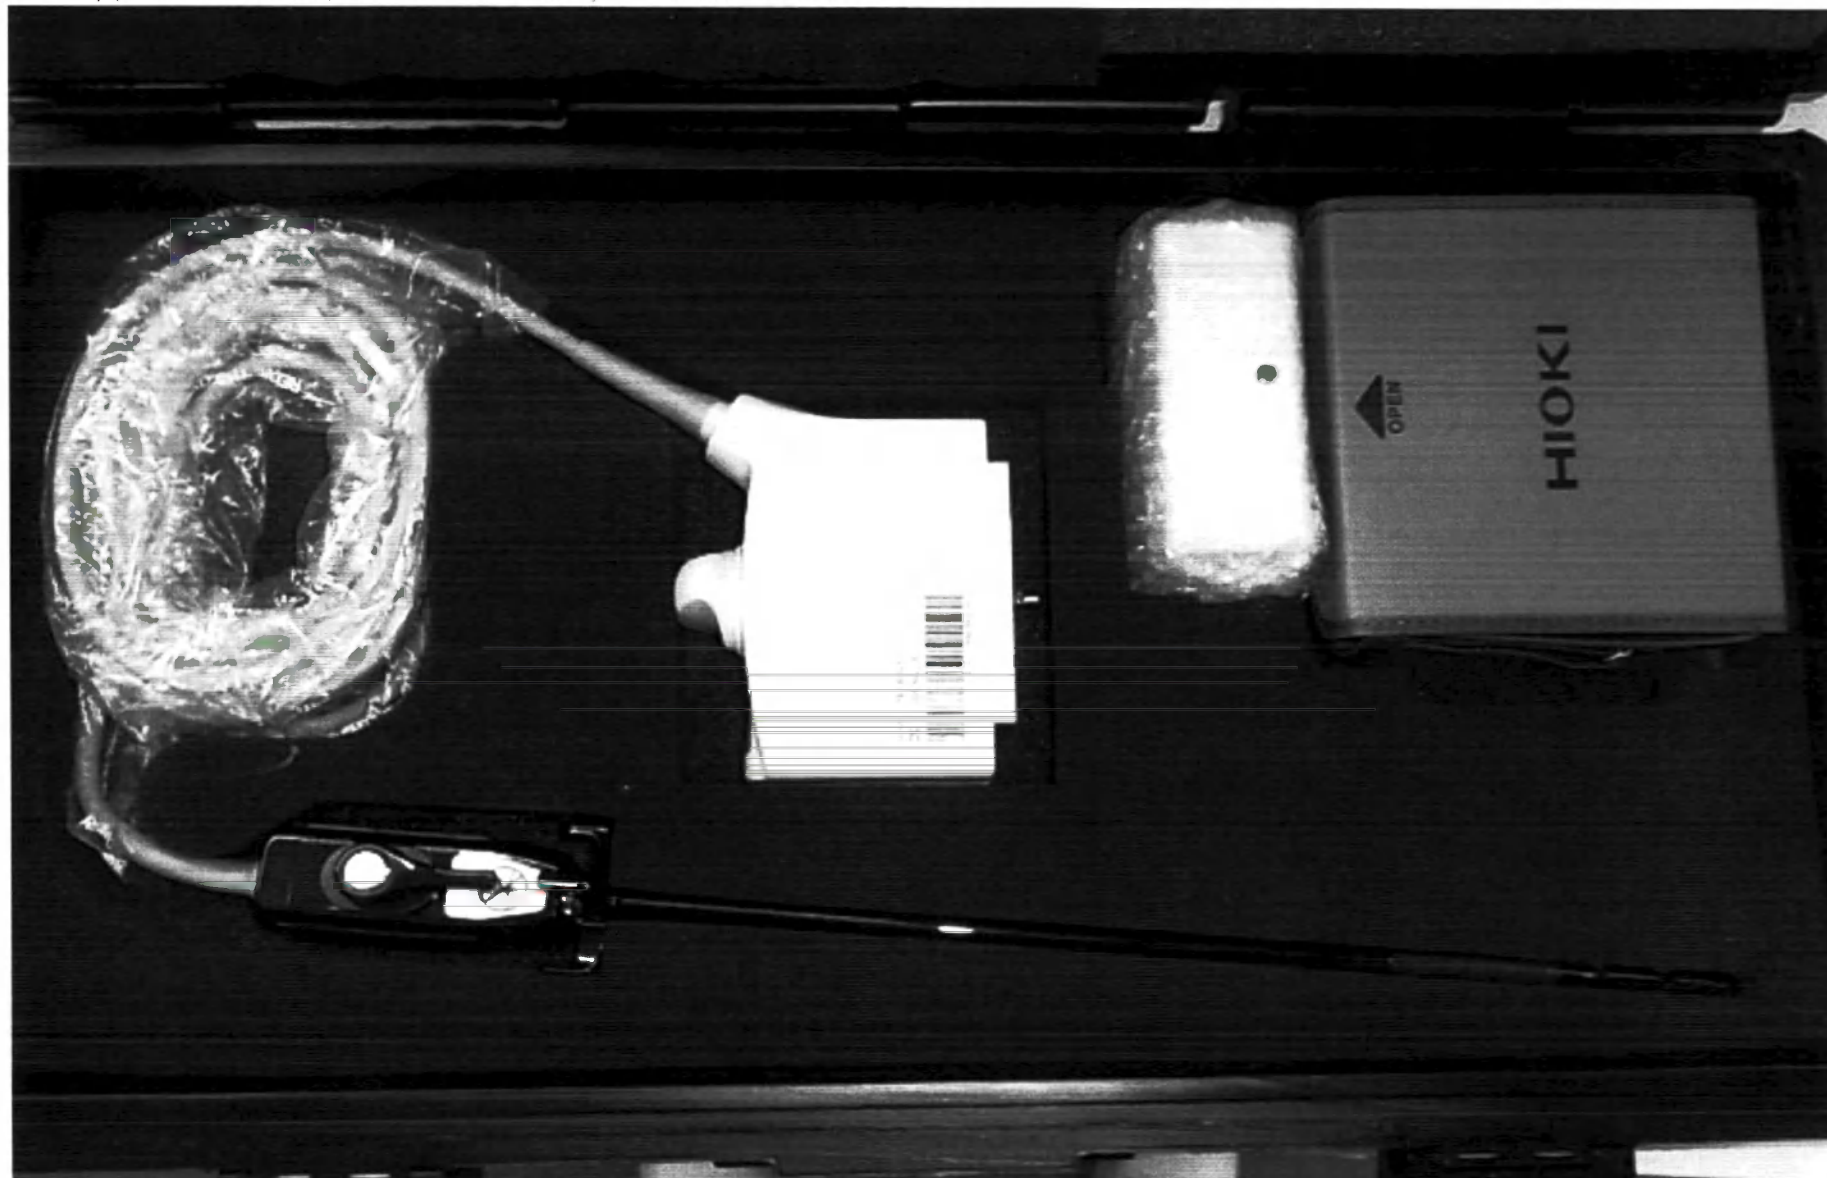


26. Датчик карандашный, модель PC-20M, РУ №РЗН 2015/2361



27. Датчик карандашный, модель РС-50М, РУ №РЗН 2015/2361



28. Кабель питания

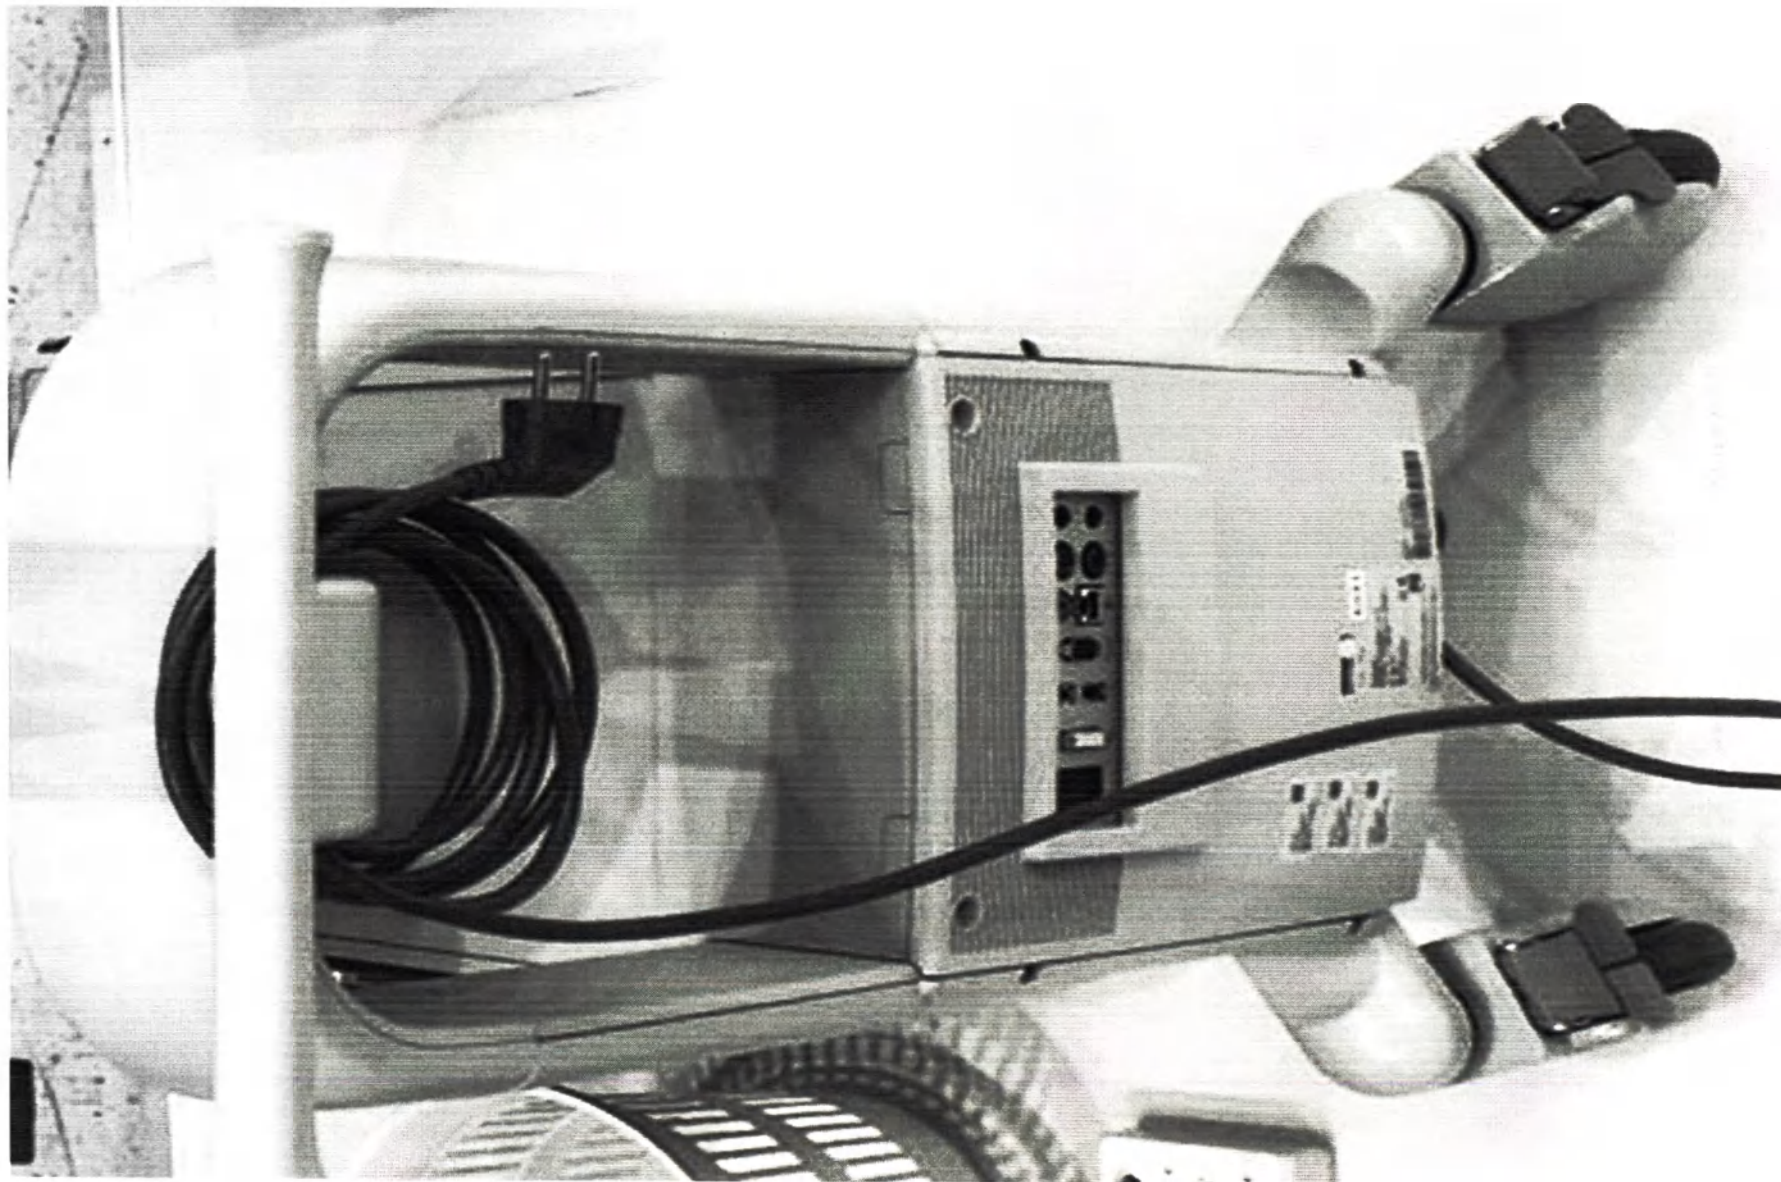

Canon

№ 2B771-310RU*G

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СИСТЕМЫ

Xario 200G / Xario 100G

МОДЕЛИ CUS-X200G/CUS-X100G

[ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ]

(2B771-310RU*G)

ВНИМАНИЕ!

Федеральный закон США разрешает приобретение и использование этого устройства только врачом или по предписанию врача.

ВАЖНО!

Перед работой с оборудованием изучите и усвойте настоящее руководство. После прочтения держите руководство в легкодоступном месте.

CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION


©CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION 2016-2019

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ


Выпущено 2019-05

Принадлежности:


1. Модуль непрерывно-волновой доплеровграфии (CW)

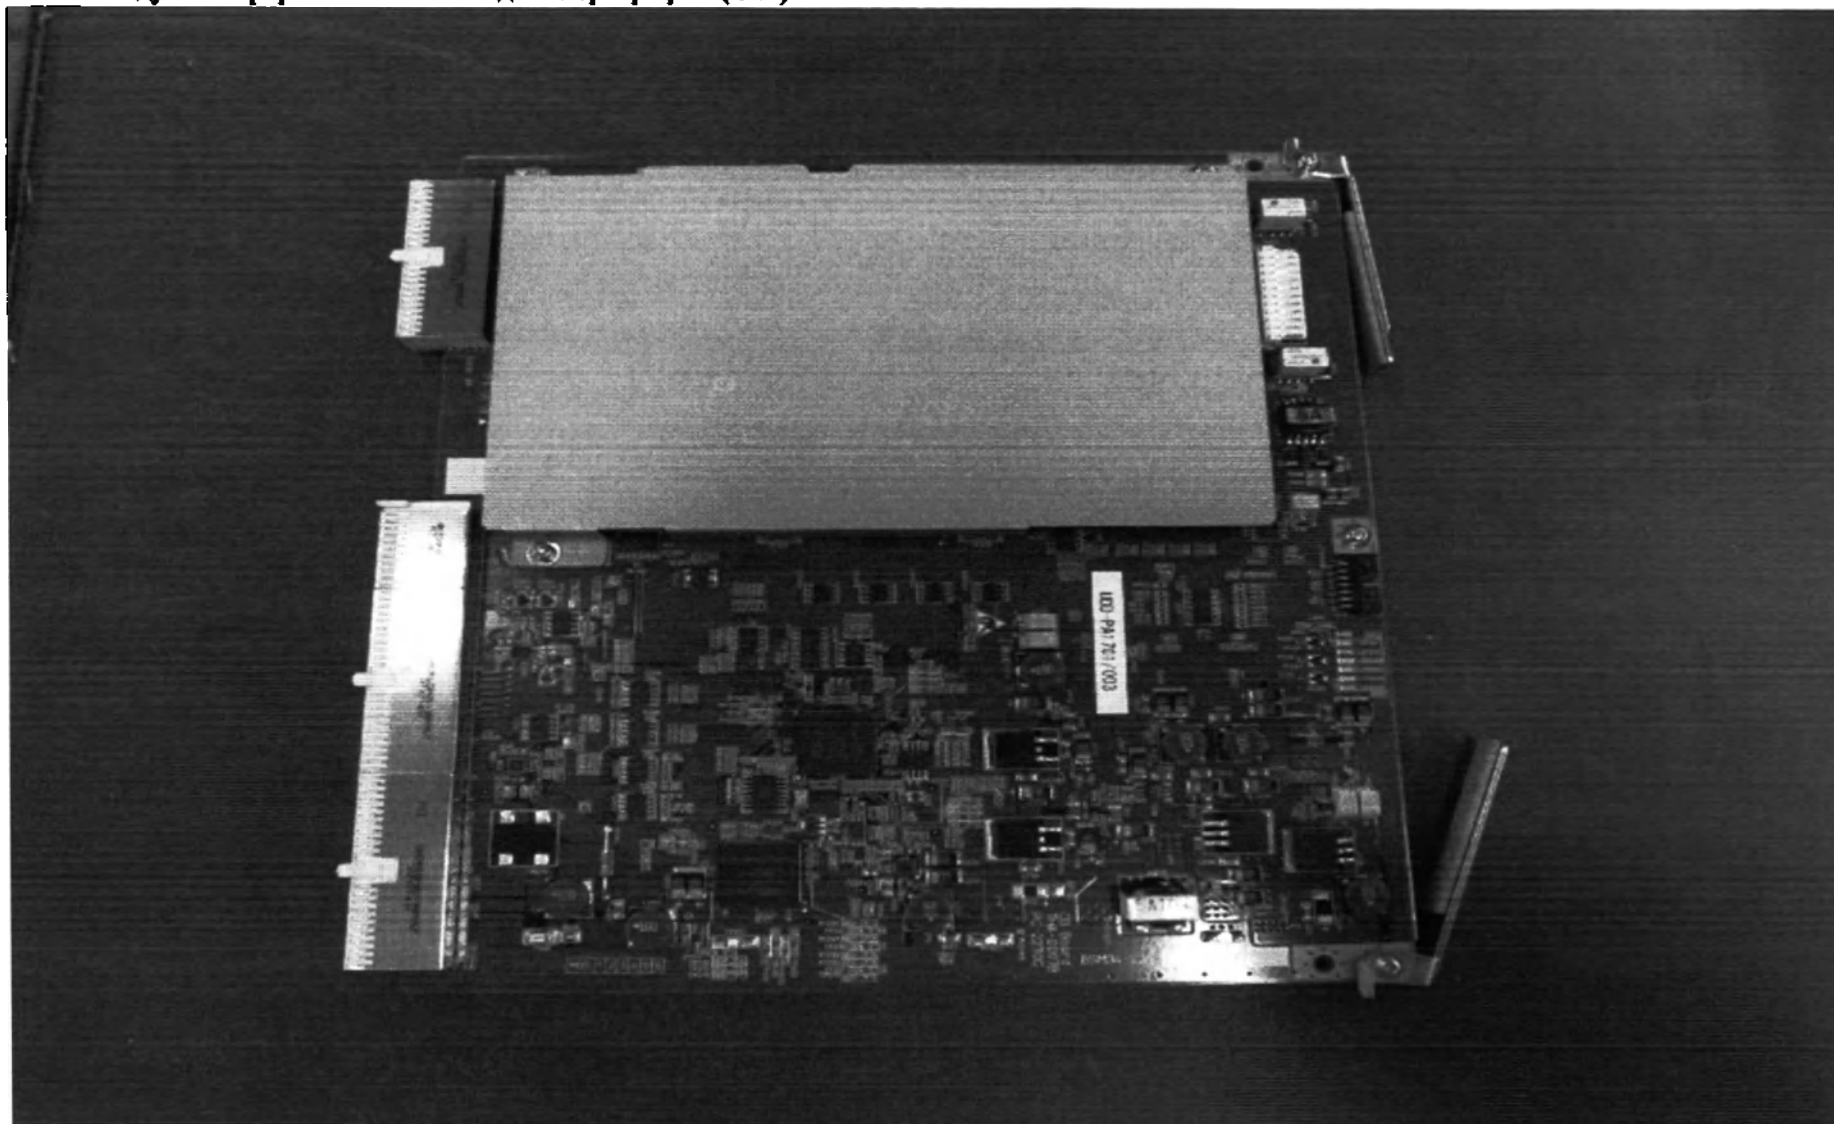

2. Модуль непрерывно-волновой доплеровграфии (CW) с разъемом карандашного датчика

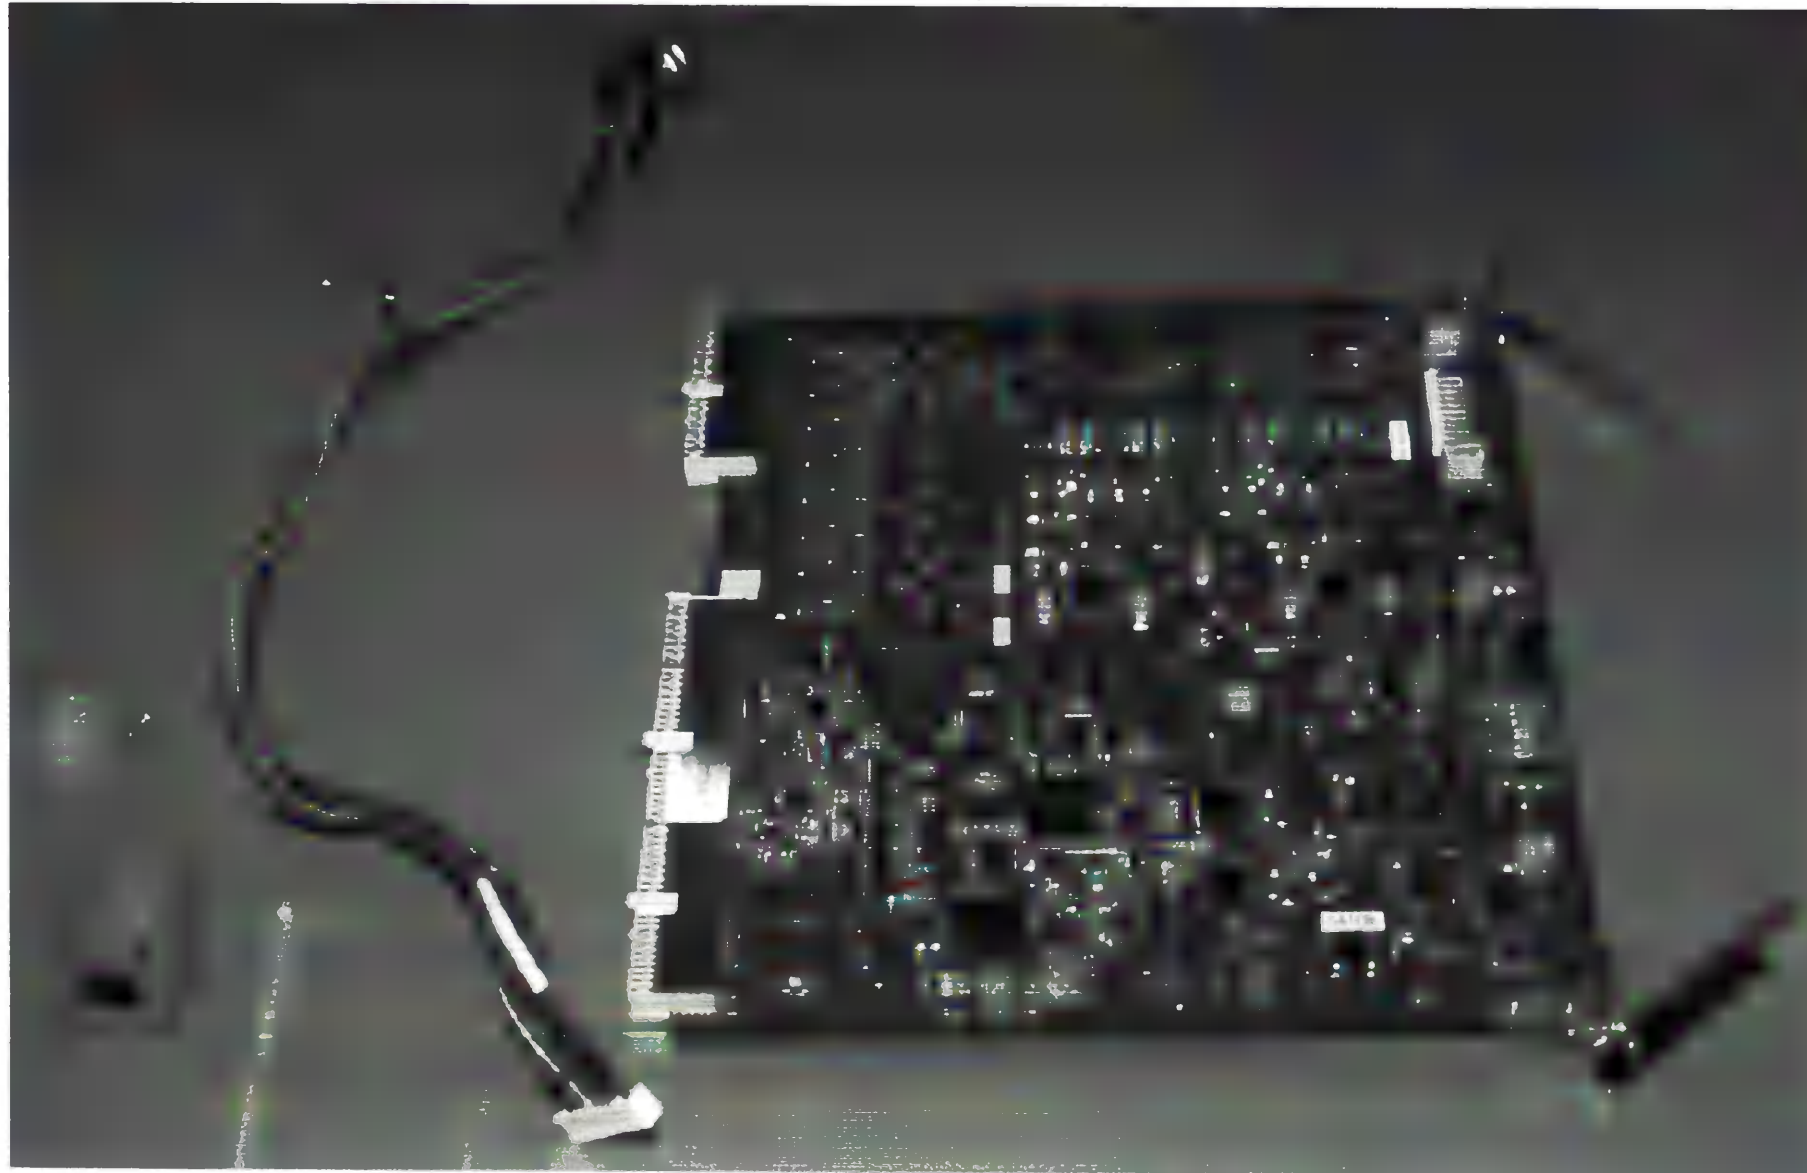


3. Модуль референсного сигнала

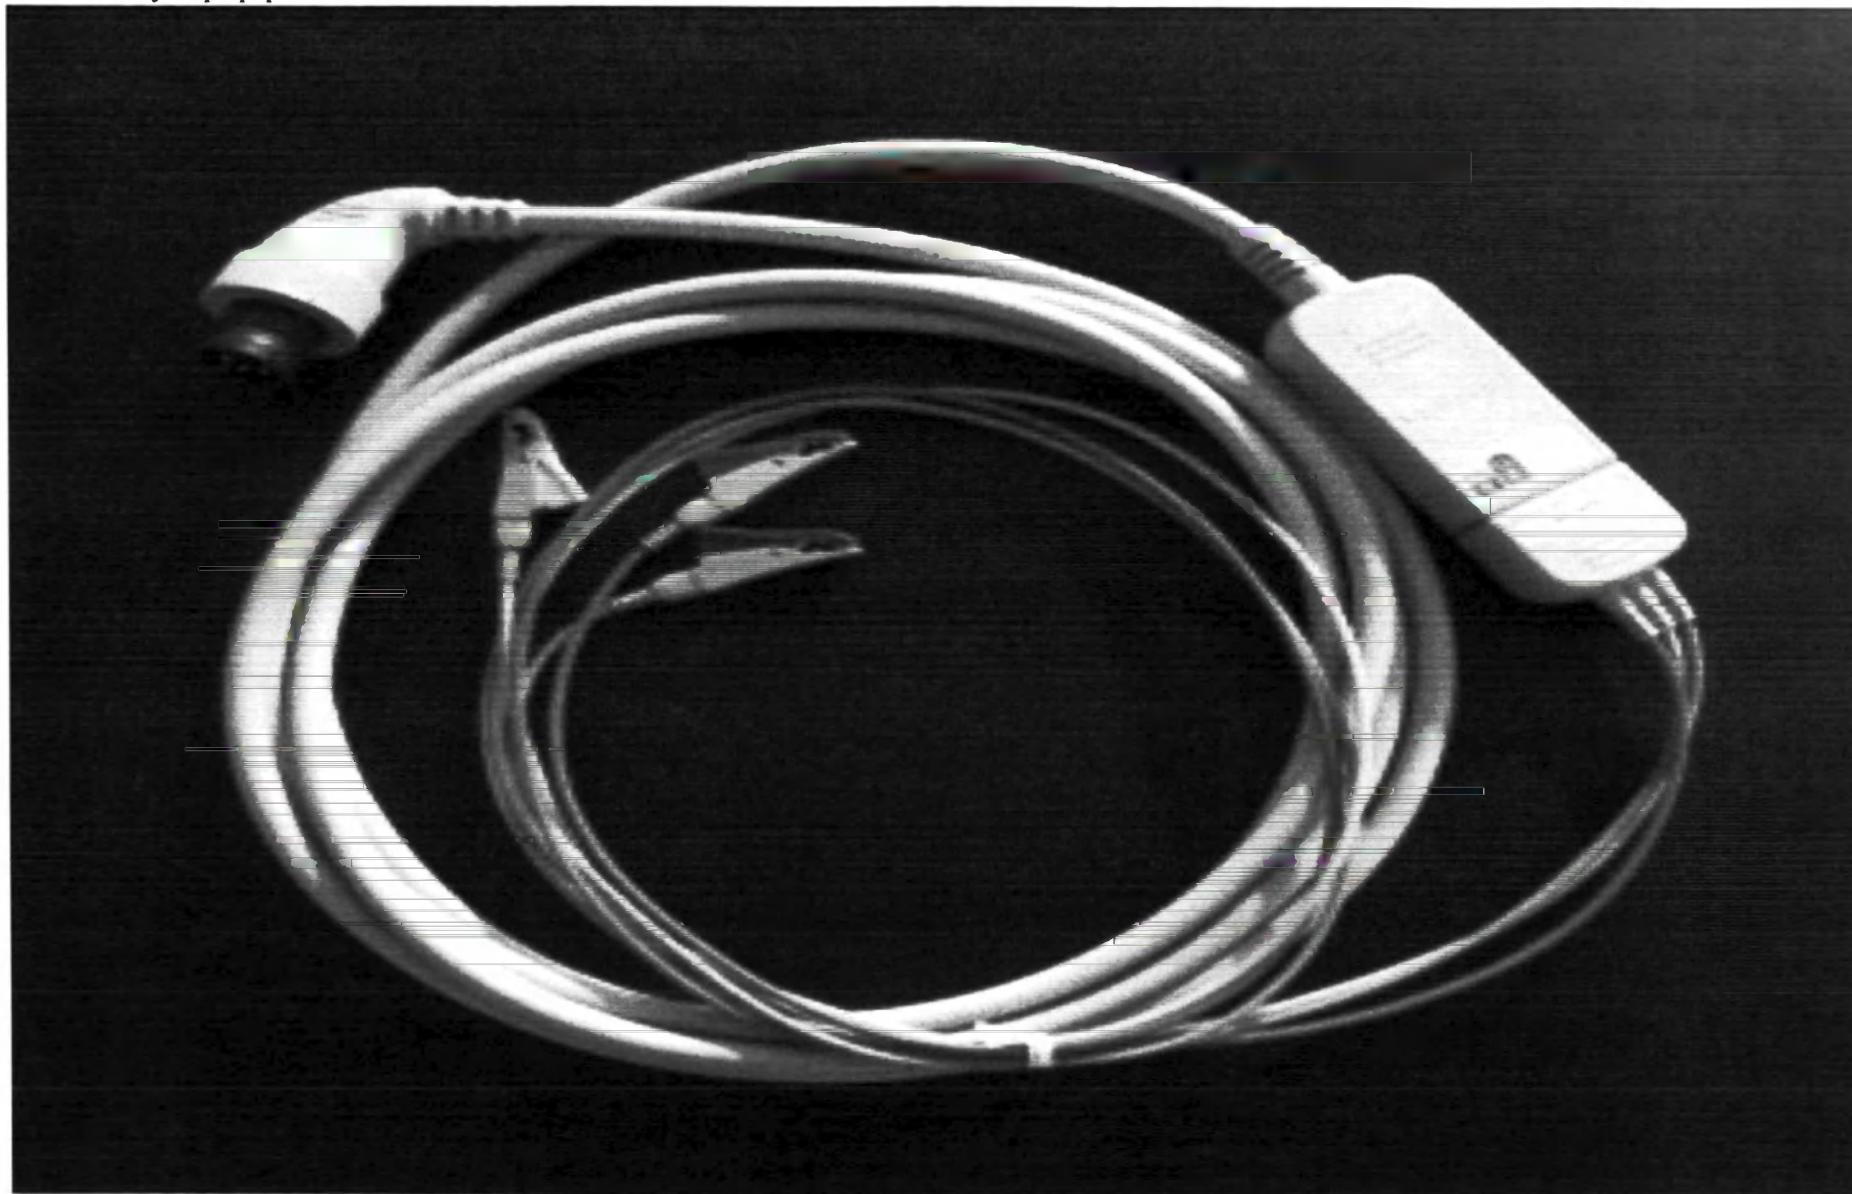


4. Программное приложение для анатомического М-режима (Flex-M)



5. Программное приложение для эластографии-FLR

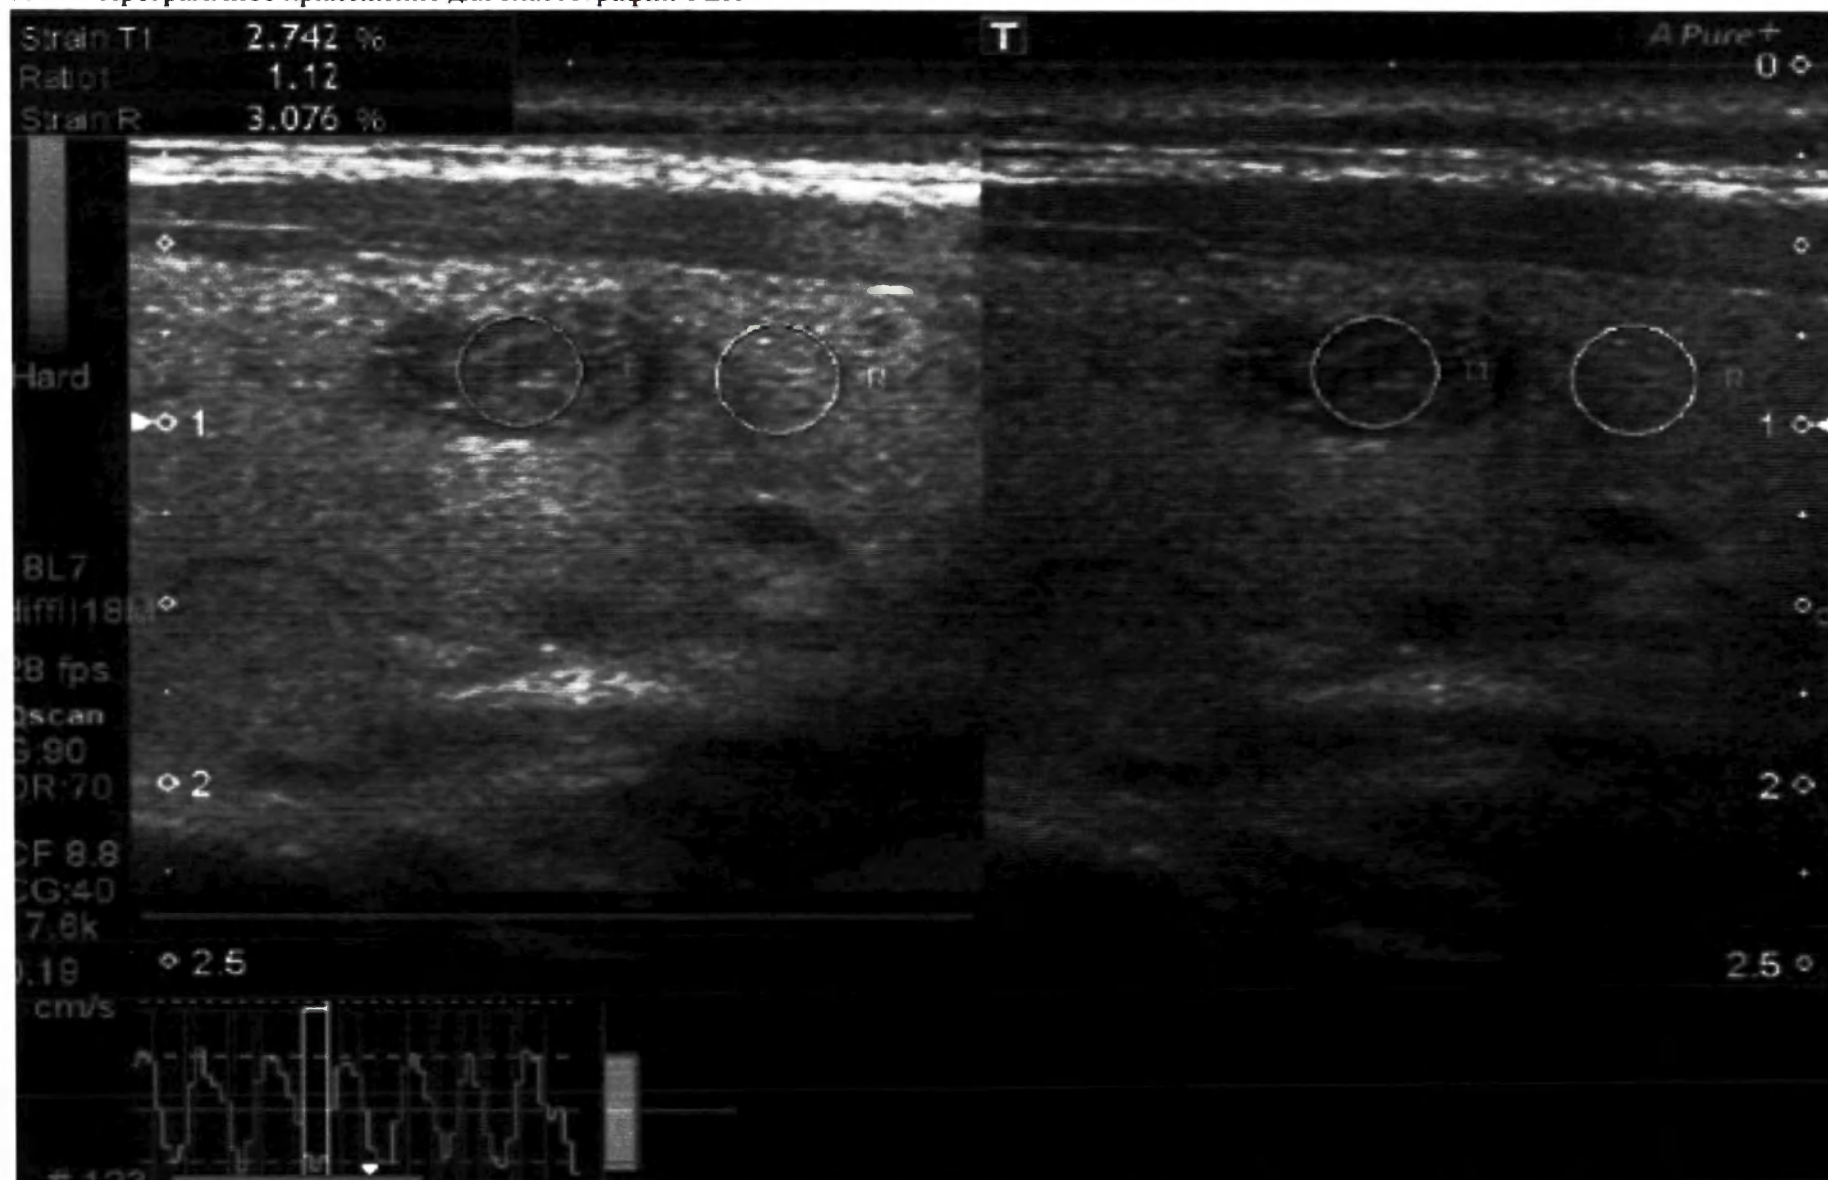


6. Модуль функции 4D

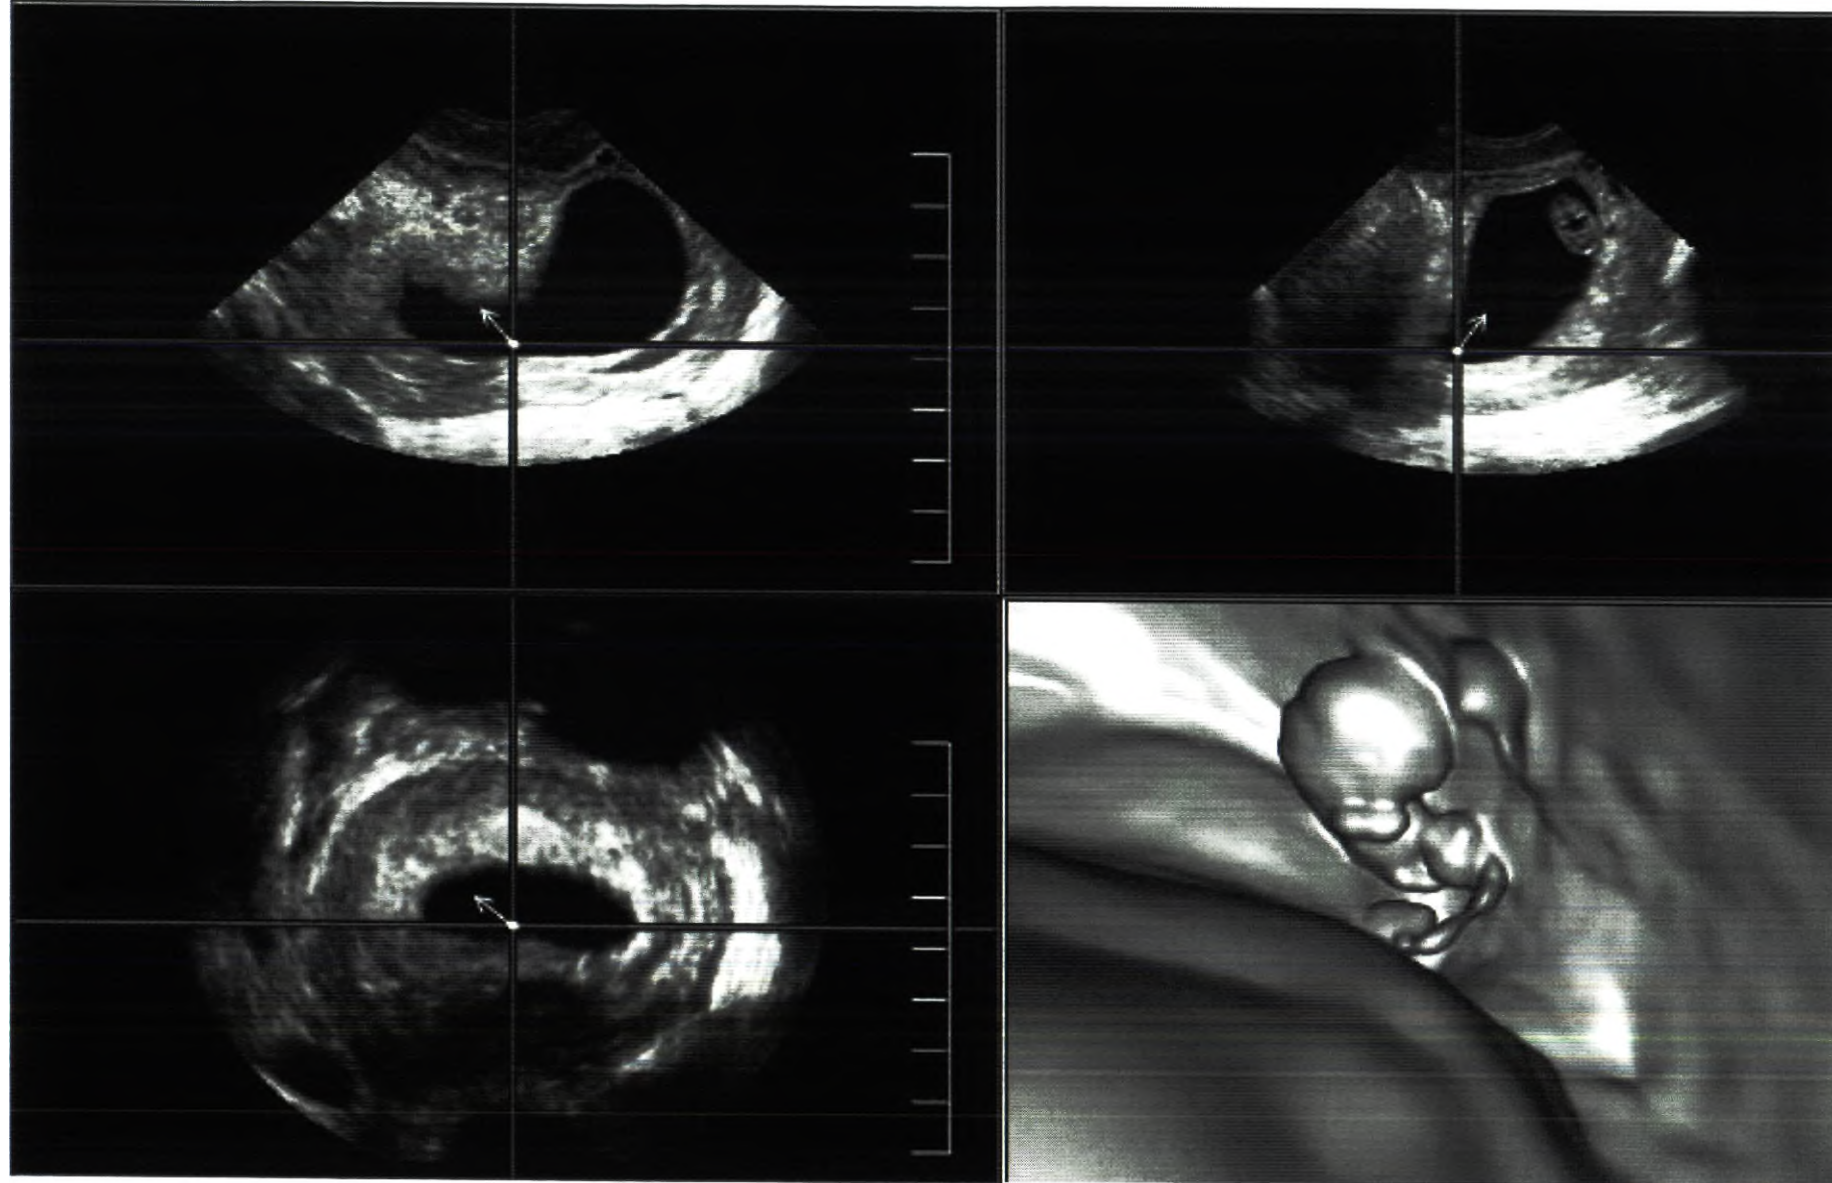

7. Программное приложение для виртуального освещения (Luminance)



8. Программное приложения для автоматического измерения воротникового пространства (Auto NT)

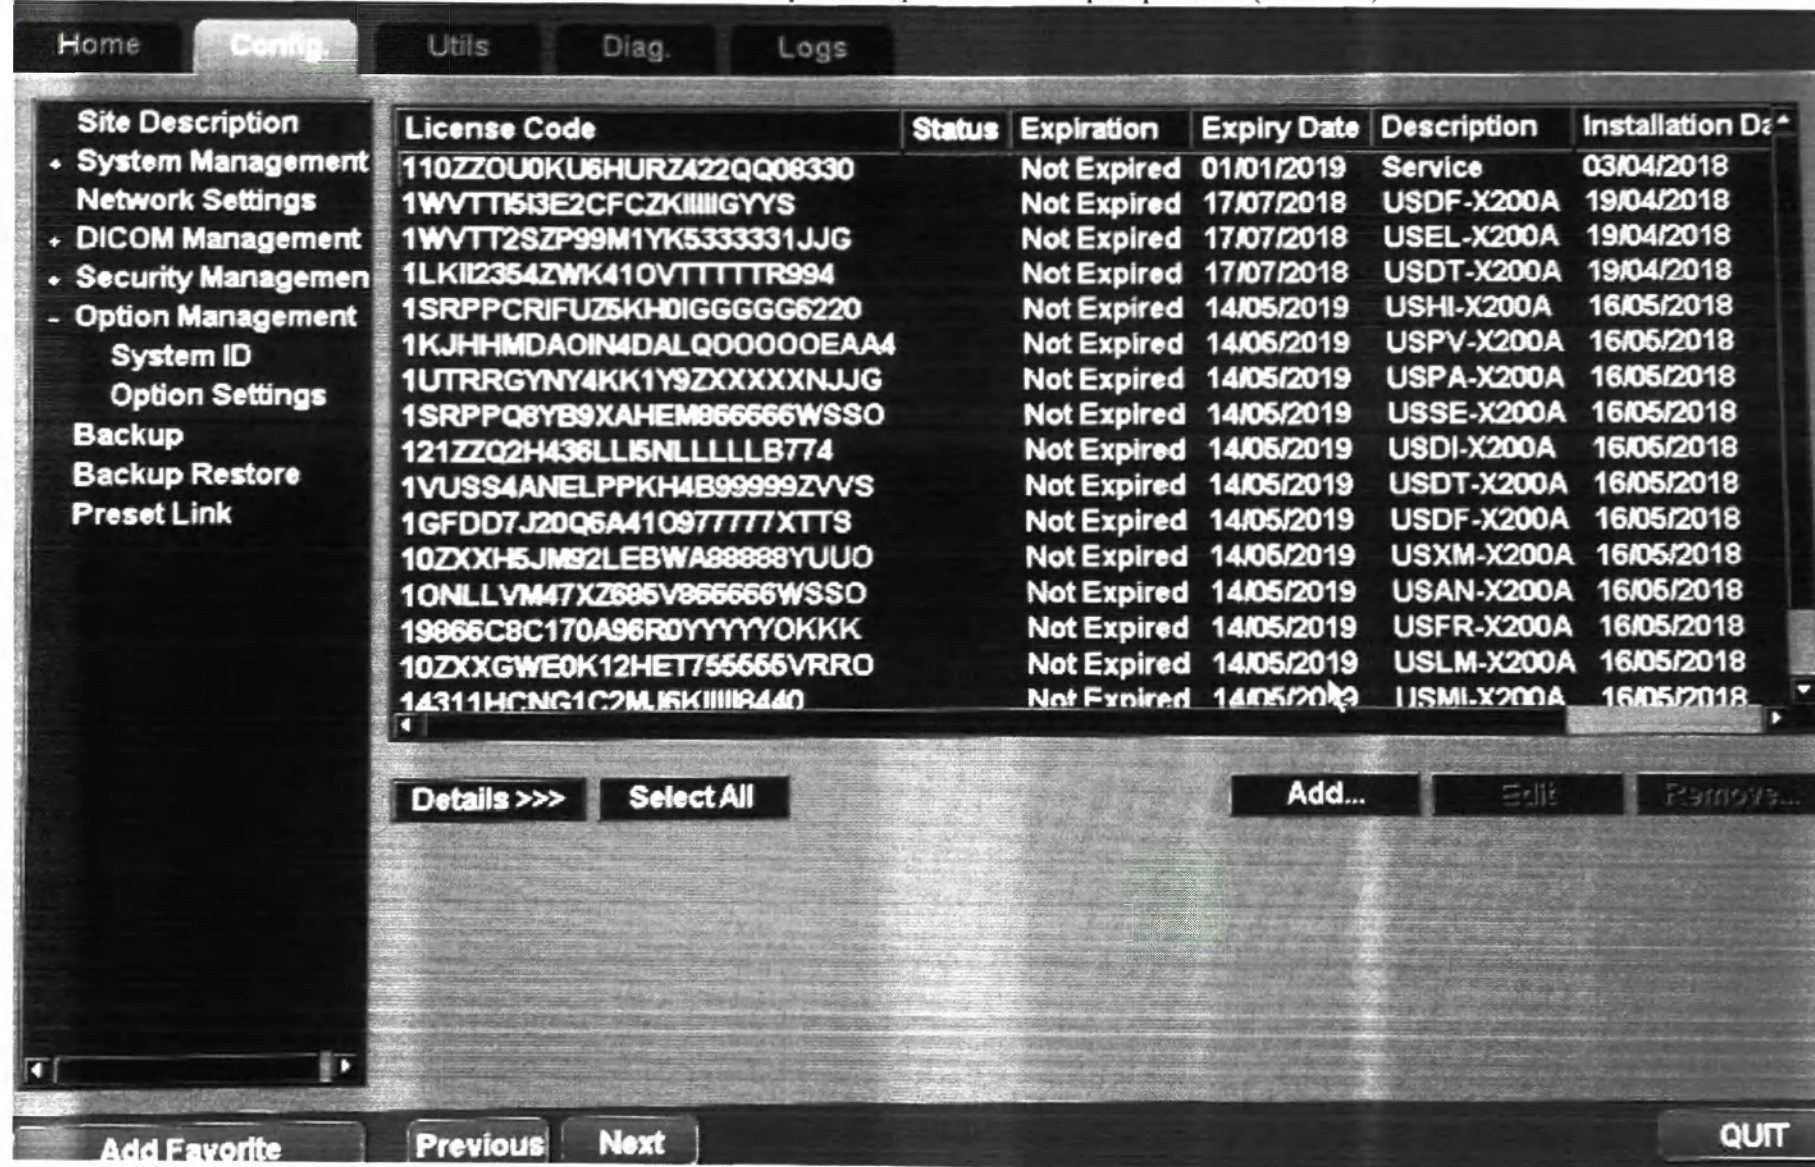

9. Программное приложение для дифференцированной тканевой гармоники (D-THI)



10. Программное приложение для улучшенного динамического потока (Dynamic Flow)



11. Программное приложение для прецизионной визуализации (Precision Imaging)

Home Config Utlis Diag Logs

Site Description


- System Management
- Network Settings
- DICOM Management
- Security Management
- Option Management
 - System ID
 - Option Settings
- Backup
- Backup Restore
- Preset Link

License Code	Status	Expiration	Expiry Date	Description	Installation Date
110ZZOU0KU6HURZ422QQ08330	Not Expired	01/01/2019	01/01/2019	Service	03/04/2018
1WVTTI53E2CFCZKIIIIIGYYS	Not Expired	17/07/2018	17/07/2018	USDF-X200A	19/04/2018
1WVTT2SZP99M1YK5333331JJG	Not Expired	17/07/2018	17/07/2018	USEL-X200A	19/04/2018
1LKII2354ZWK410VTTTTTR994	Not Expired	17/07/2018	17/07/2018	USDT-X200A	19/04/2018
1SRPPCRIFUZ5KH0IGGGGG6220	Not Expired	14/05/2019	14/05/2019	USHI-X200A	16/05/2018
1KJHHMDAOIN4DALQ00000EAA4	Not Expired	14/05/2019	14/05/2019	USPV-X200A	16/05/2018
1UTRRGYNY4KK1Y9ZXXXXXNJG	Not Expired	14/05/2019	14/05/2019	USPA-X200A	16/05/2018
1SRPPQ8YB9XAHM866666WSSO	Not Expired	14/05/2019	14/05/2019	USSE-X200A	16/05/2018
121ZZQ2H436LL5NLLLLLB774	Not Expired	14/05/2019	14/05/2019	USDI-X200A	16/05/2018
1VUSS4ANELPPKH4B99999ZVVS	Not Expired	14/05/2019	14/05/2019	USDT-X200A	16/05/2018
1GFDD7J20Q6A41097777XTTS	Not Expired	14/05/2019	14/05/2019	USDF-X200A	16/05/2018
10ZXXH5JM92LEBWA88888YUUD	Not Expired	14/05/2019	14/05/2019	USXM-X200A	16/05/2018
1ONLLVM47XZ685V866666WSSO	Not Expired	14/05/2019	14/05/2019	USAN-X200A	16/05/2018
19866C8C170A96R0YYYYYOKKK	Not Expired	14/05/2019	14/05/2019	USFR-X200A	16/05/2018
10ZXXGWE0K12HET755555VRRO	Not Expired	14/05/2019	14/05/2019	USLM-X200A	16/05/2018
14311HCNG1C2M16KIIIIIR440	Not Expired	14/05/2019	14/05/2019	USMI-X200A	16/05/2018

Details >>> Select All Add... Edit Remove...

Add Favorite Previous Next QUIT

12. Программное приложение многолучевого сканирования в реальном времени (ApliPure Plus)

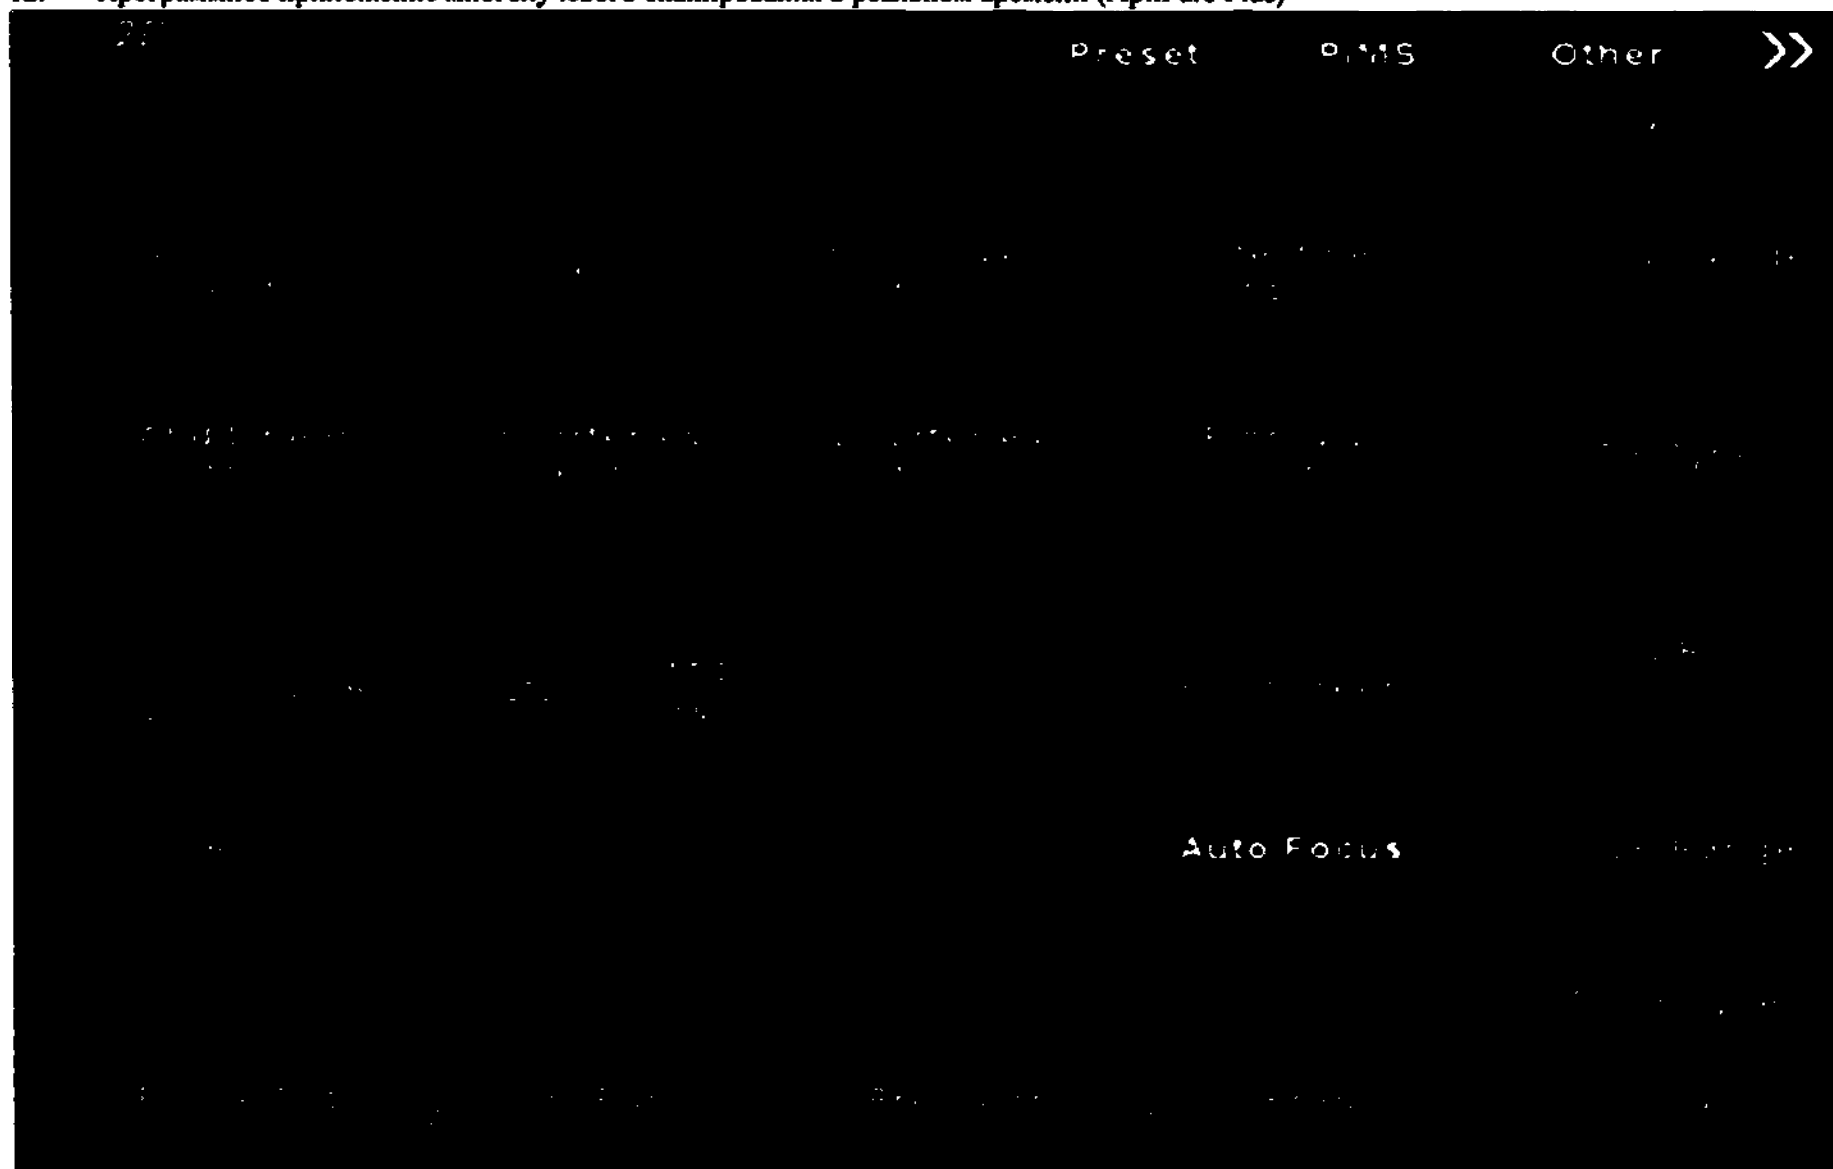

13. Программное приложение для специальной оптимизации тканевого отображения (TSO)

Home **Config** Utils Diag Logs

Site Description


- System Management
- Network Settings
- DICOM Management
- Security Management
- Option Management
 - System ID
 - Option Settings
- Backup
- Backup Restore
- Preset Link

License Code	Status	Expiration	Expiry Date	Description	Installation Date
110ZZOU0KU6HURZ422QQ08330	Not Expired	01/01/2019	Service	03/04/2018	
1WVTT5I3E2CFCZKIIIIIGYYS	Not Expired	17/07/2018	USDF-X200A	19/04/2018	
1WVTT2SZP99M1YK5333331JJG	Not Expired	17/07/2018	USEL-X200A	19/04/2018	
1LKII2354ZWK410VTTTTTR994	Not Expired	17/07/2018	USDT-X200A	19/04/2018	
1SRPPCRIFUZ5KH0IGGGGG6220	Not Expired	14/05/2019	USHI-X200A	16/05/2018	
1KJHHMDA0IN4DALQ00000EAAA	Not Expired	14/05/2019	USPV-X200A	16/05/2018	
1UTRRGYNY4KK1Y9ZXXXXXNJG	Not Expired	14/05/2019	USPA-X200A	16/05/2018	
1SRPPQ8YB9XAHM966666WSSO	Not Expired	14/05/2019	USSE-X200A	16/05/2018	
121ZZQ2H436LLI5NLLLLLB774	Not Expired	14/05/2019	USDI-X200A	16/05/2018	
1VUSS4ANELPPKH4899999ZVVS	Not Expired	14/05/2019	USDT-X200A	16/05/2018	
1GFDD7J20Q6A41097777XTTS	Not Expired	14/05/2019	USDF-X200A	16/05/2018	
10ZXXH5JM92LEBWA88888YUU0	Not Expired	14/05/2019	USXM-X200A	16/05/2018	
1ONLLVM47XZ685V966666WSSO	Not Expired	14/05/2019	USAN-X200A	16/05/2018	
19866C8C170A96R0YYYYYOKKK	Not Expired	14/05/2019	USFR-X200A	16/05/2018	
10ZXGXWE0K12HET755555VRRO	Not Expired	14/05/2019	USLM-X200A	16/05/2018	
14311HCNG1C2M16KIIIIIR440	Not Expired	14/05/2019	USML-X200A	16/05/2018	

Details >>> Select All Add... Edit Remove...

Add Favorite Previous Next QUIT


14. Программное приложения для панорамной реконструкции изображения (Panoramic View)

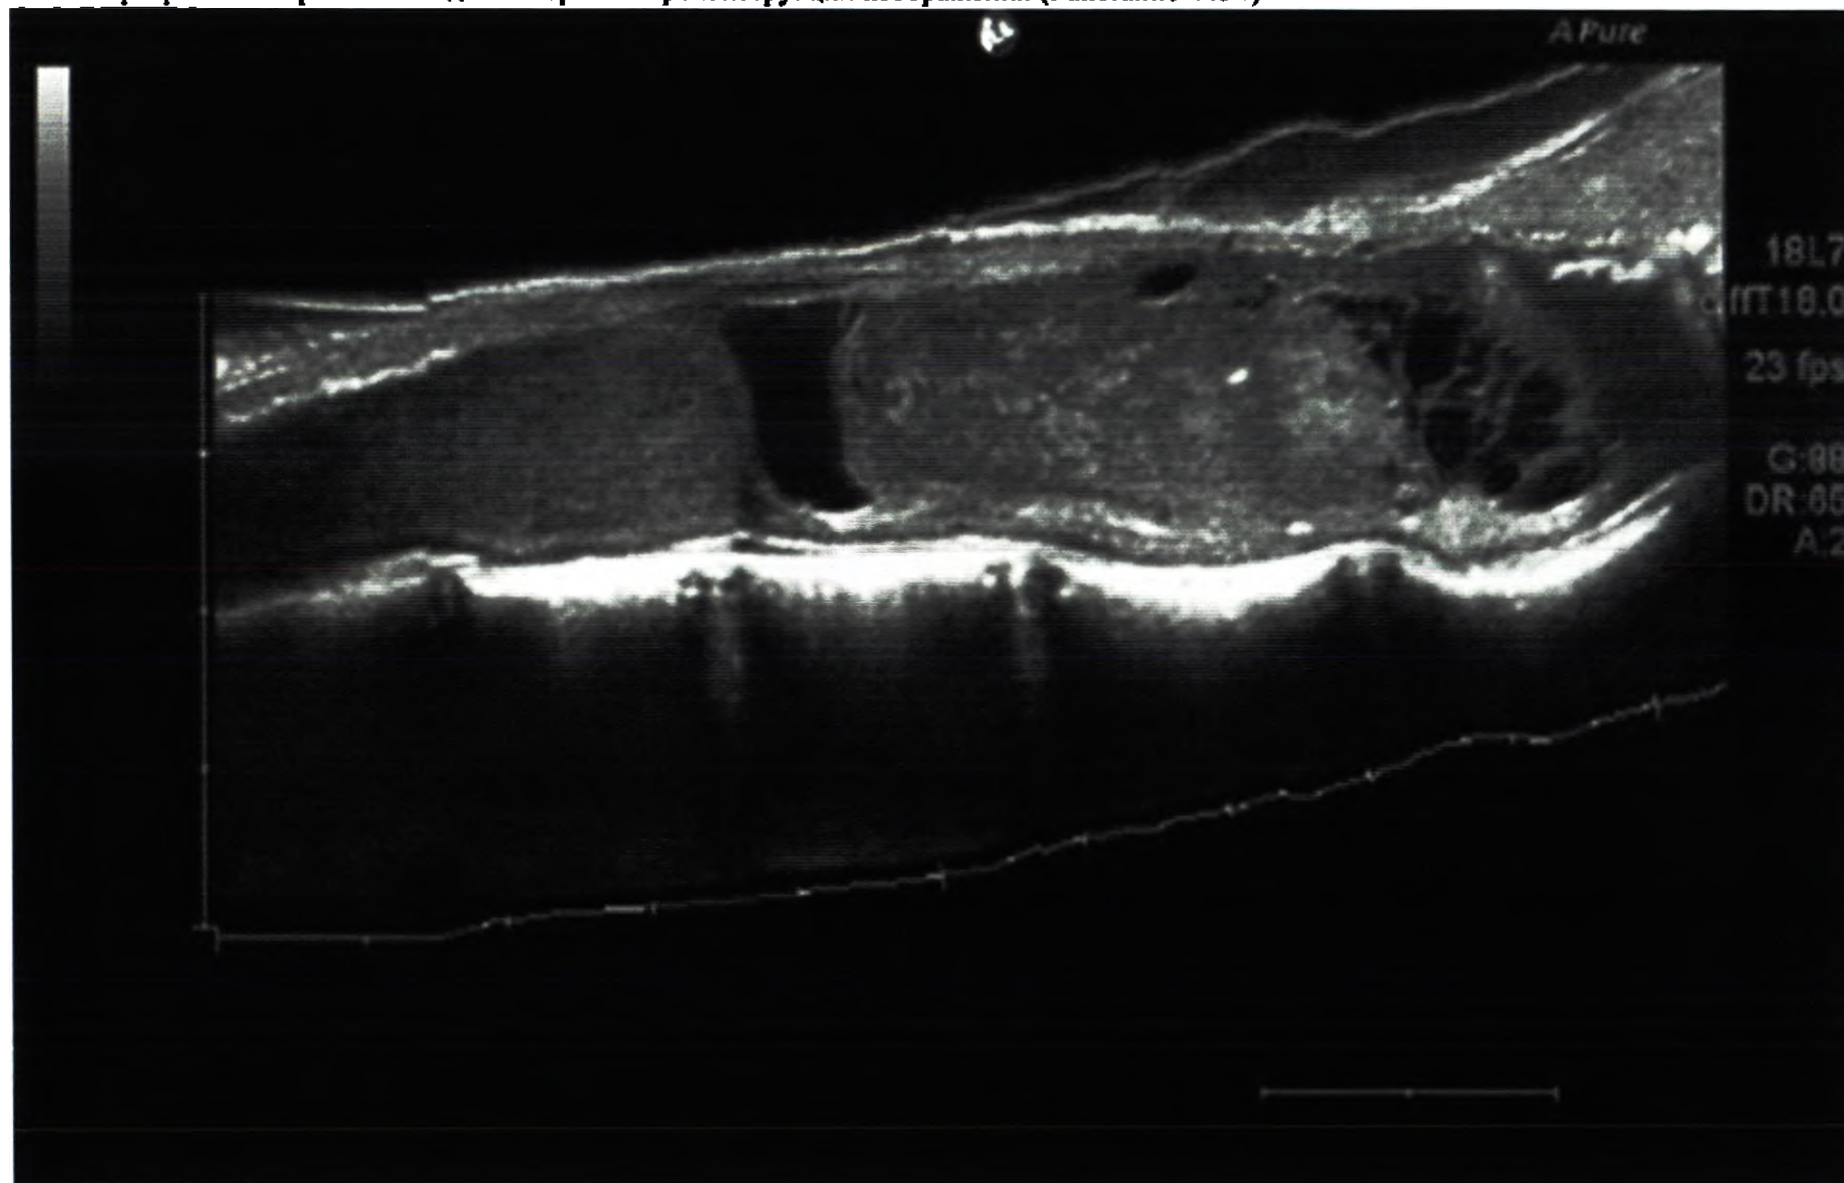


15. Программное приложение для трехмерной реконструкции изображения (Smart 3D)



16. Программное приложение для поддержки стандарта DICOM

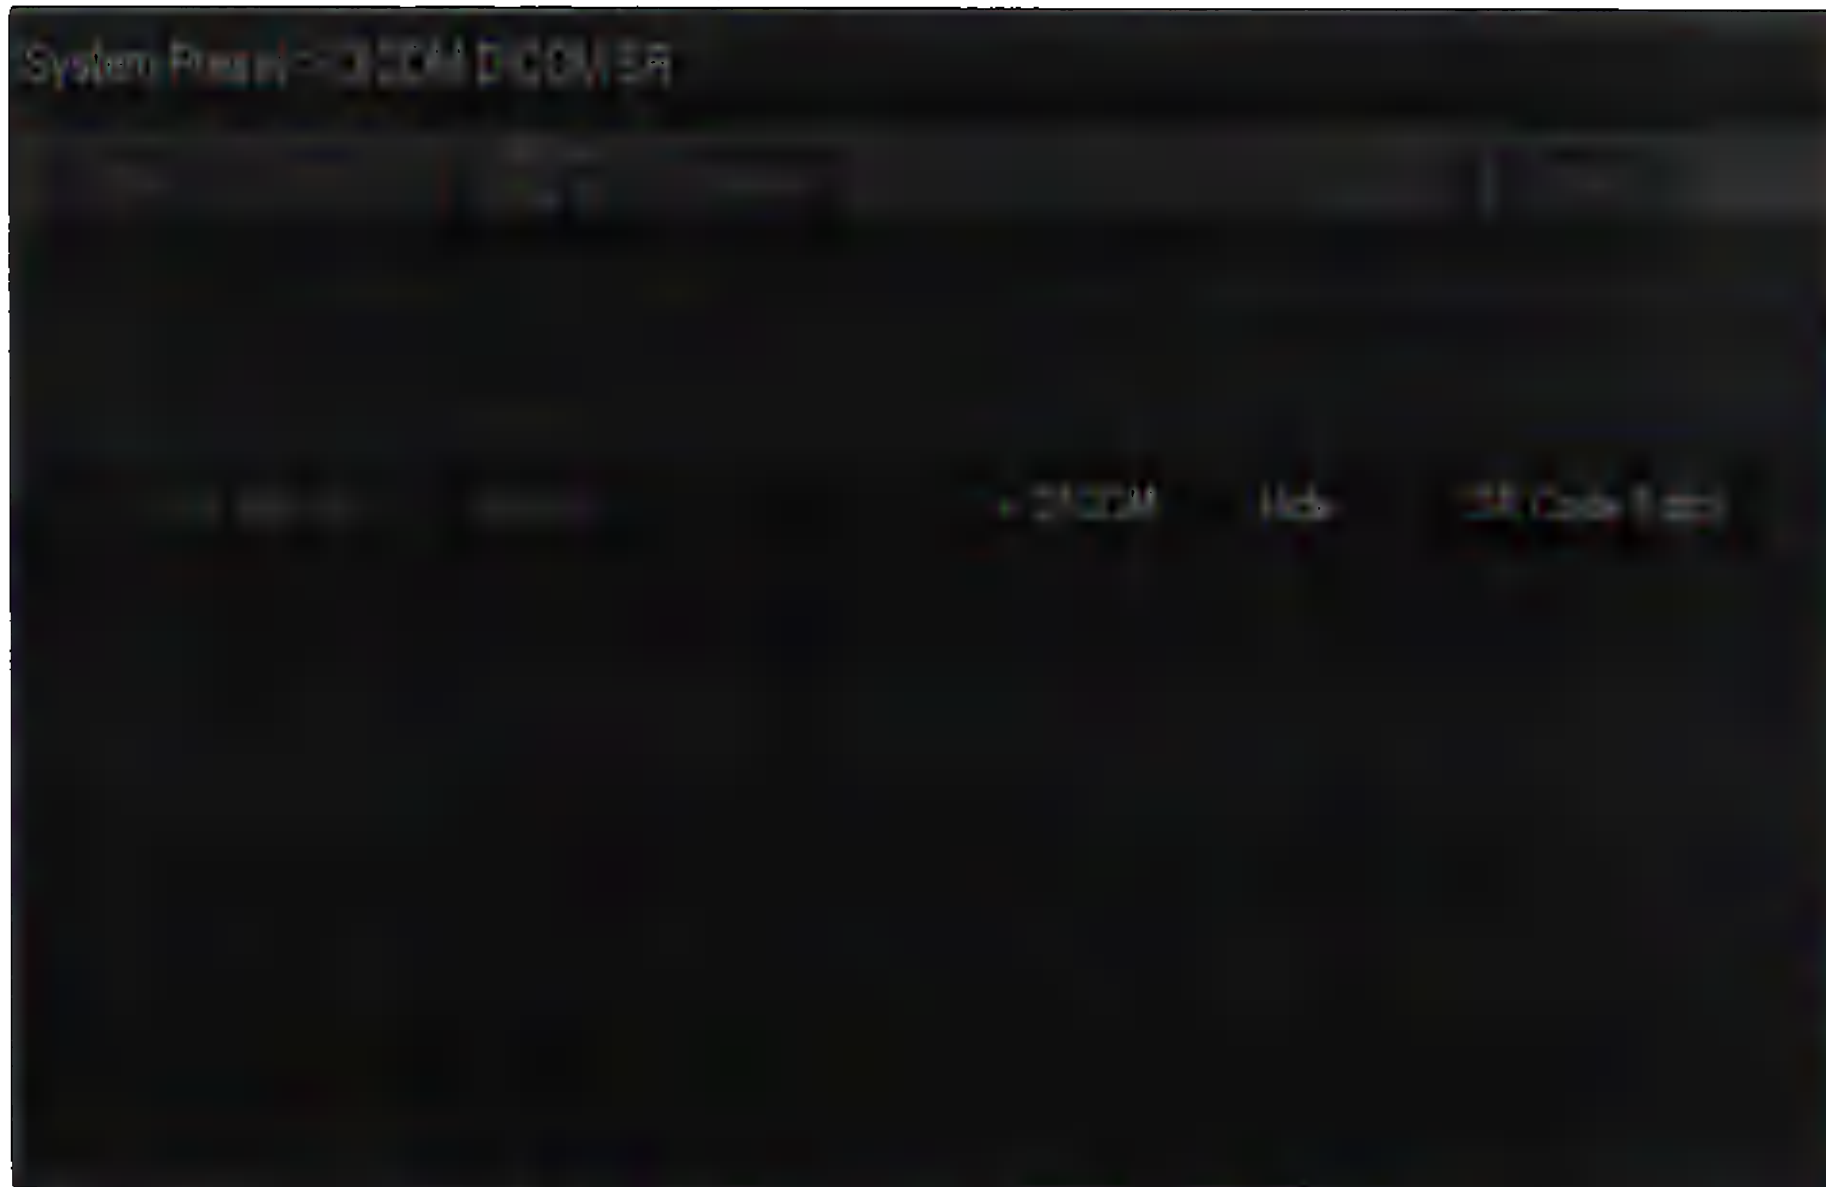

17. Программное приложение для обеспечения безопасности системы (Security Management)

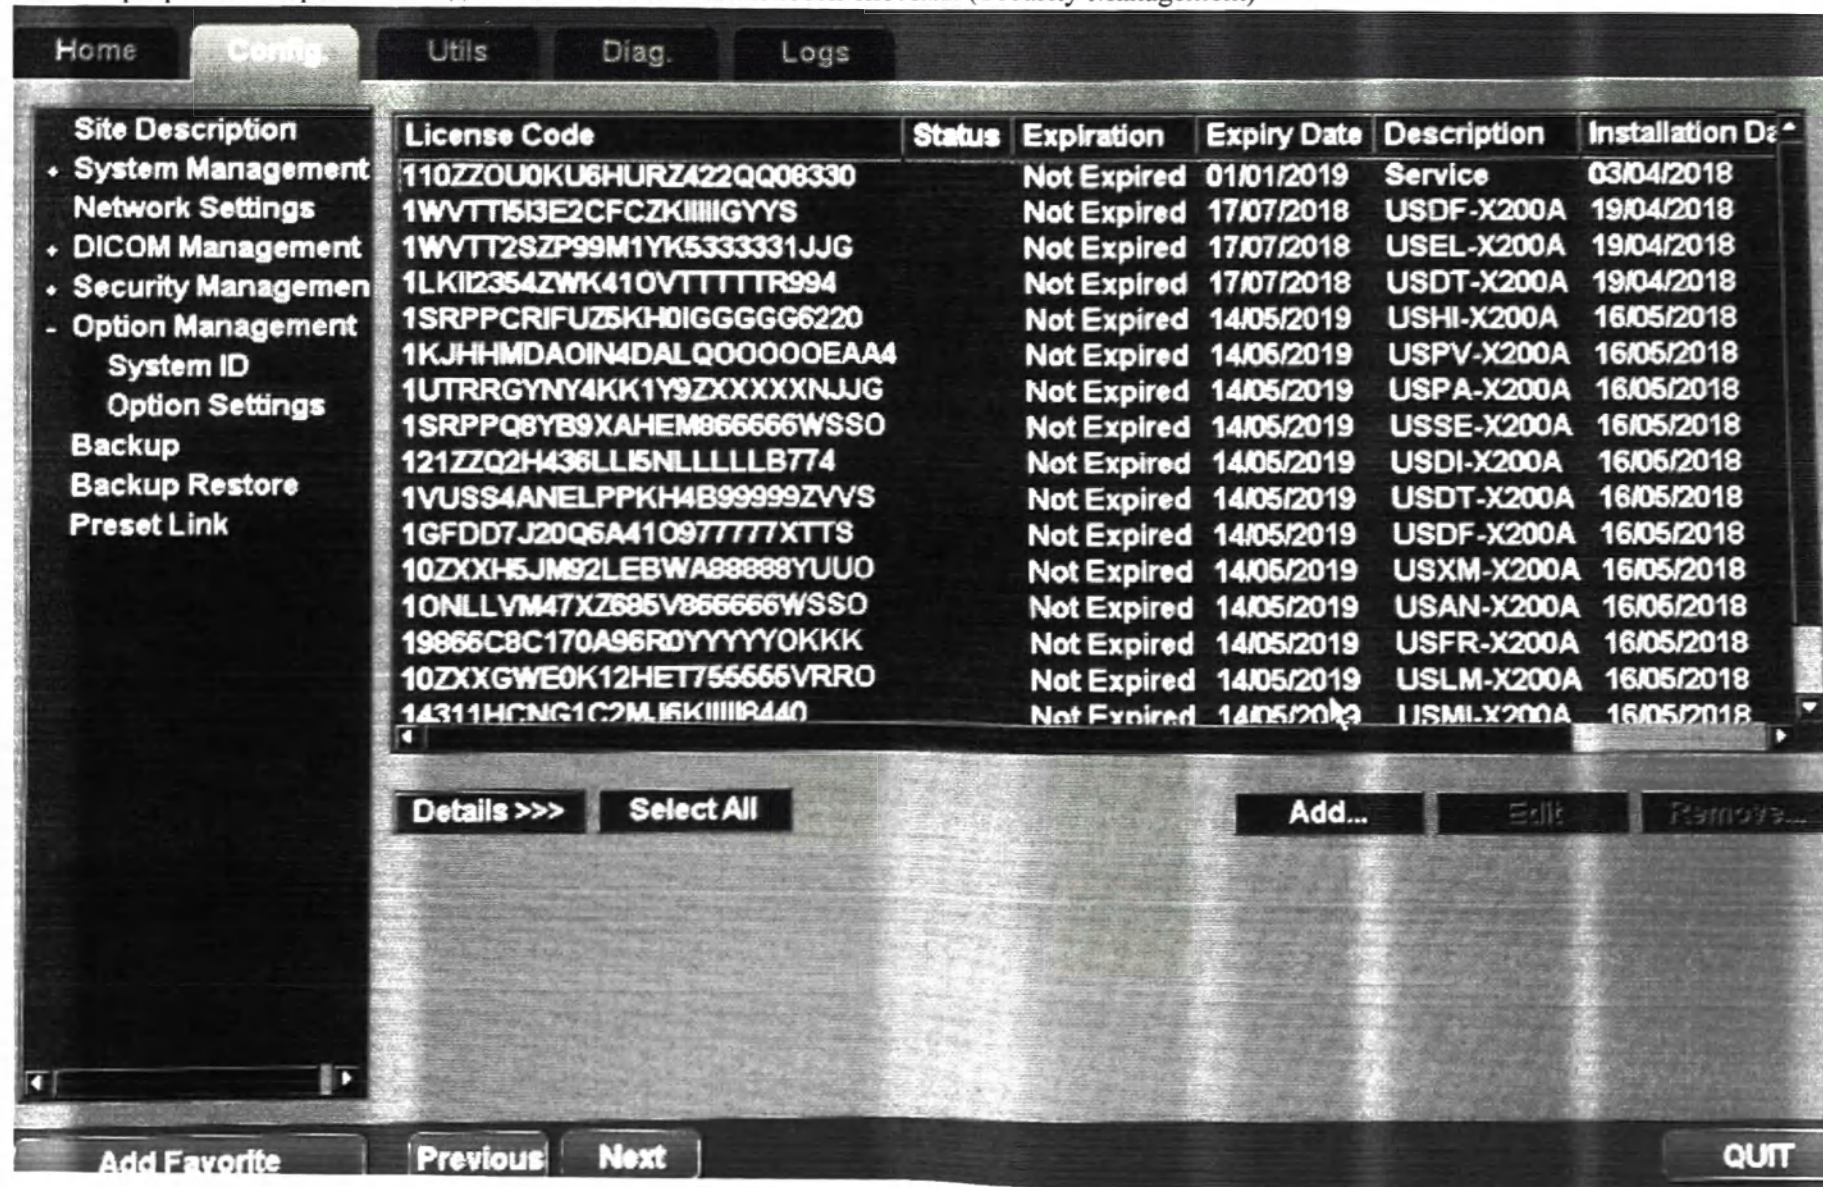


18. Ножная педаль управления



19. Подогреватель геля




20. Адаптер для подключения транспищеводного, лапароскопического датчиков

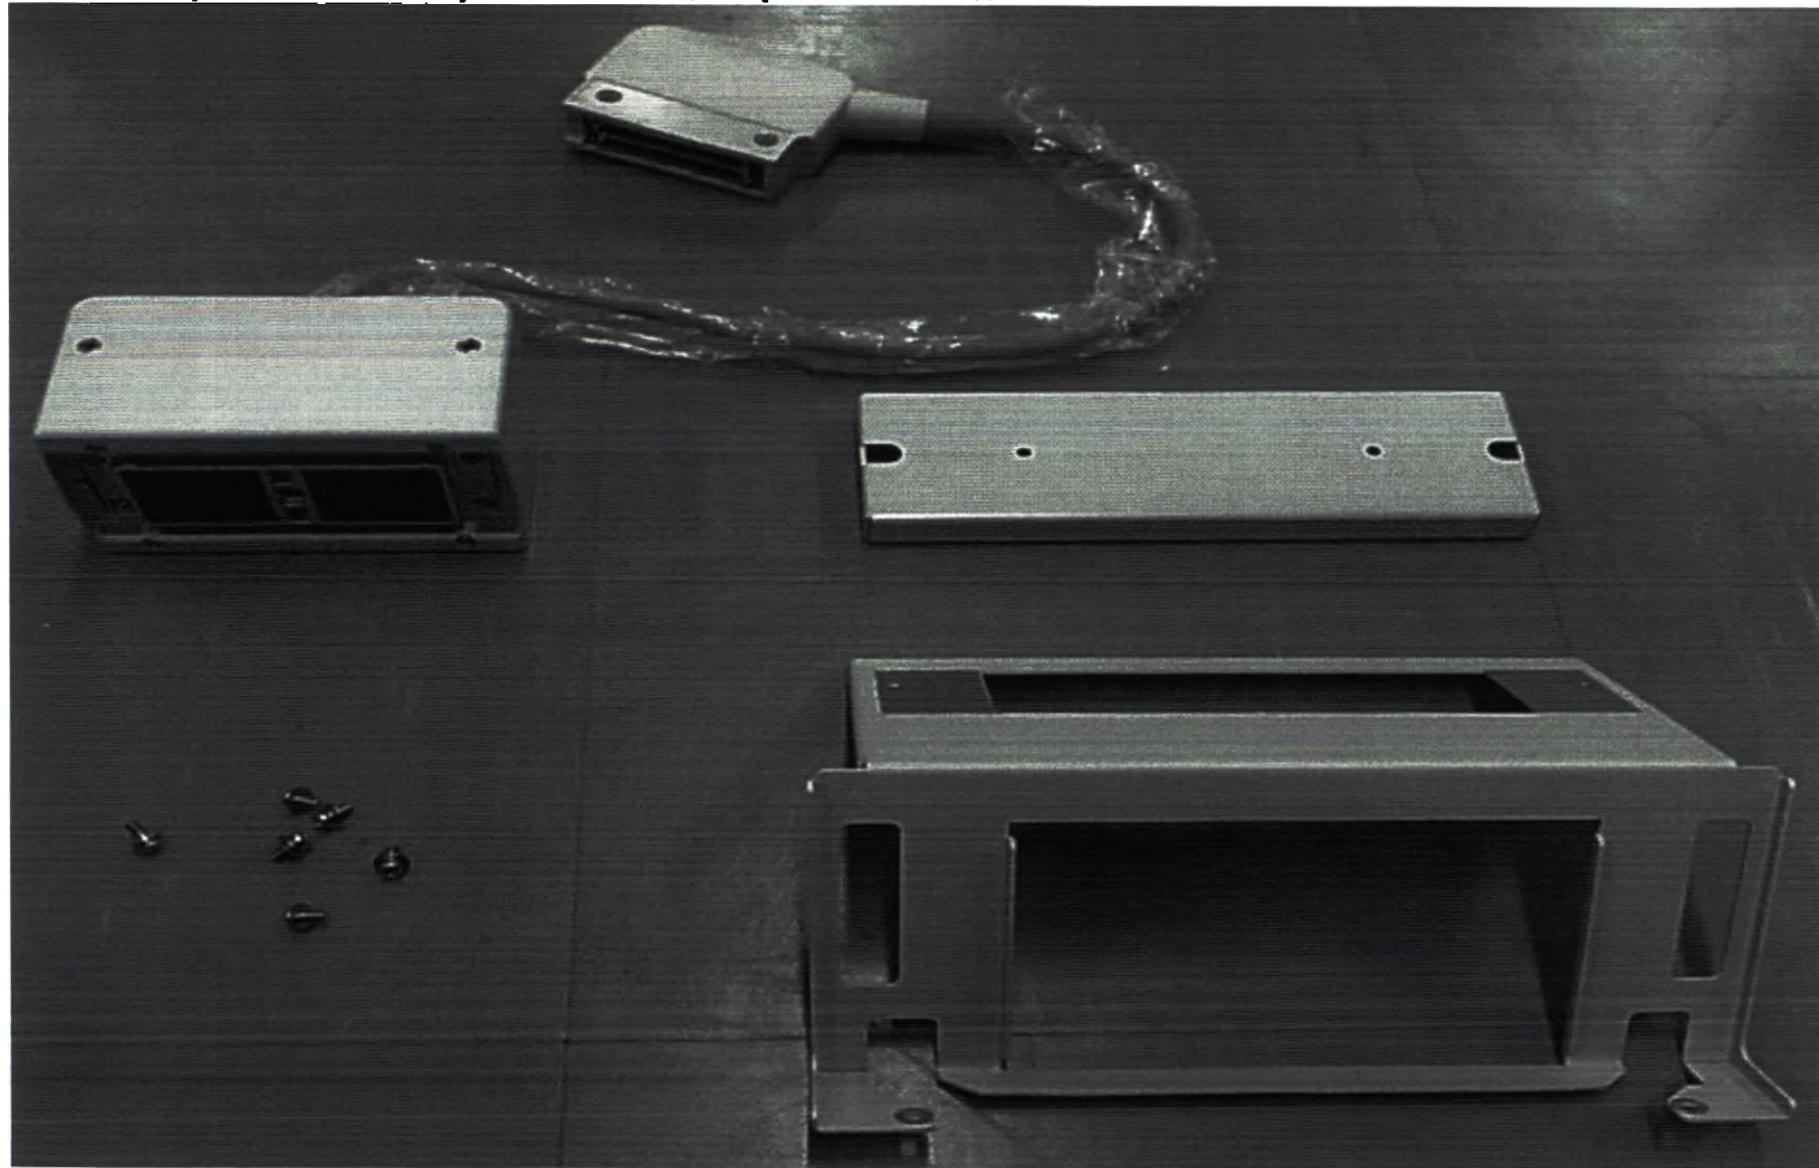

21. Держатель корзиночный




22. Держатель для кабелей датчиков

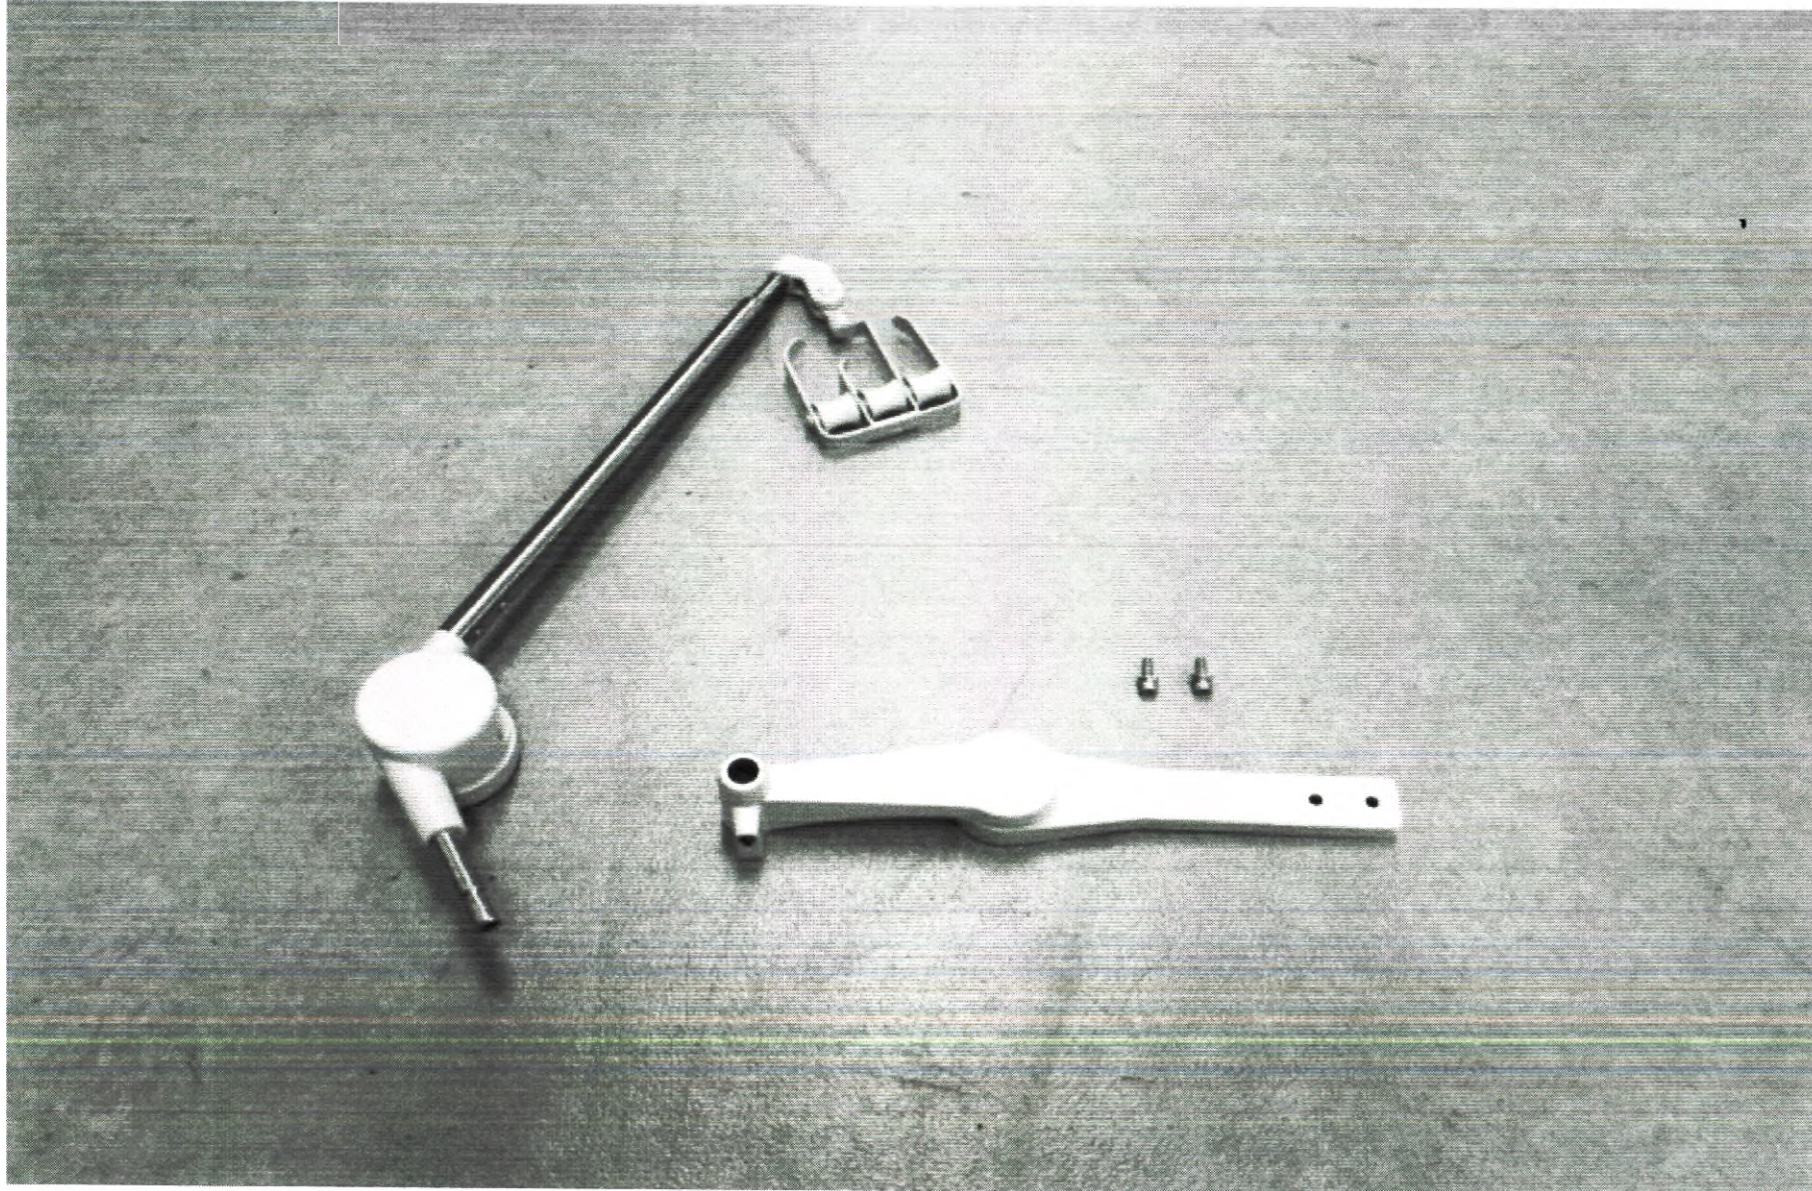

23. Держатель датчиков




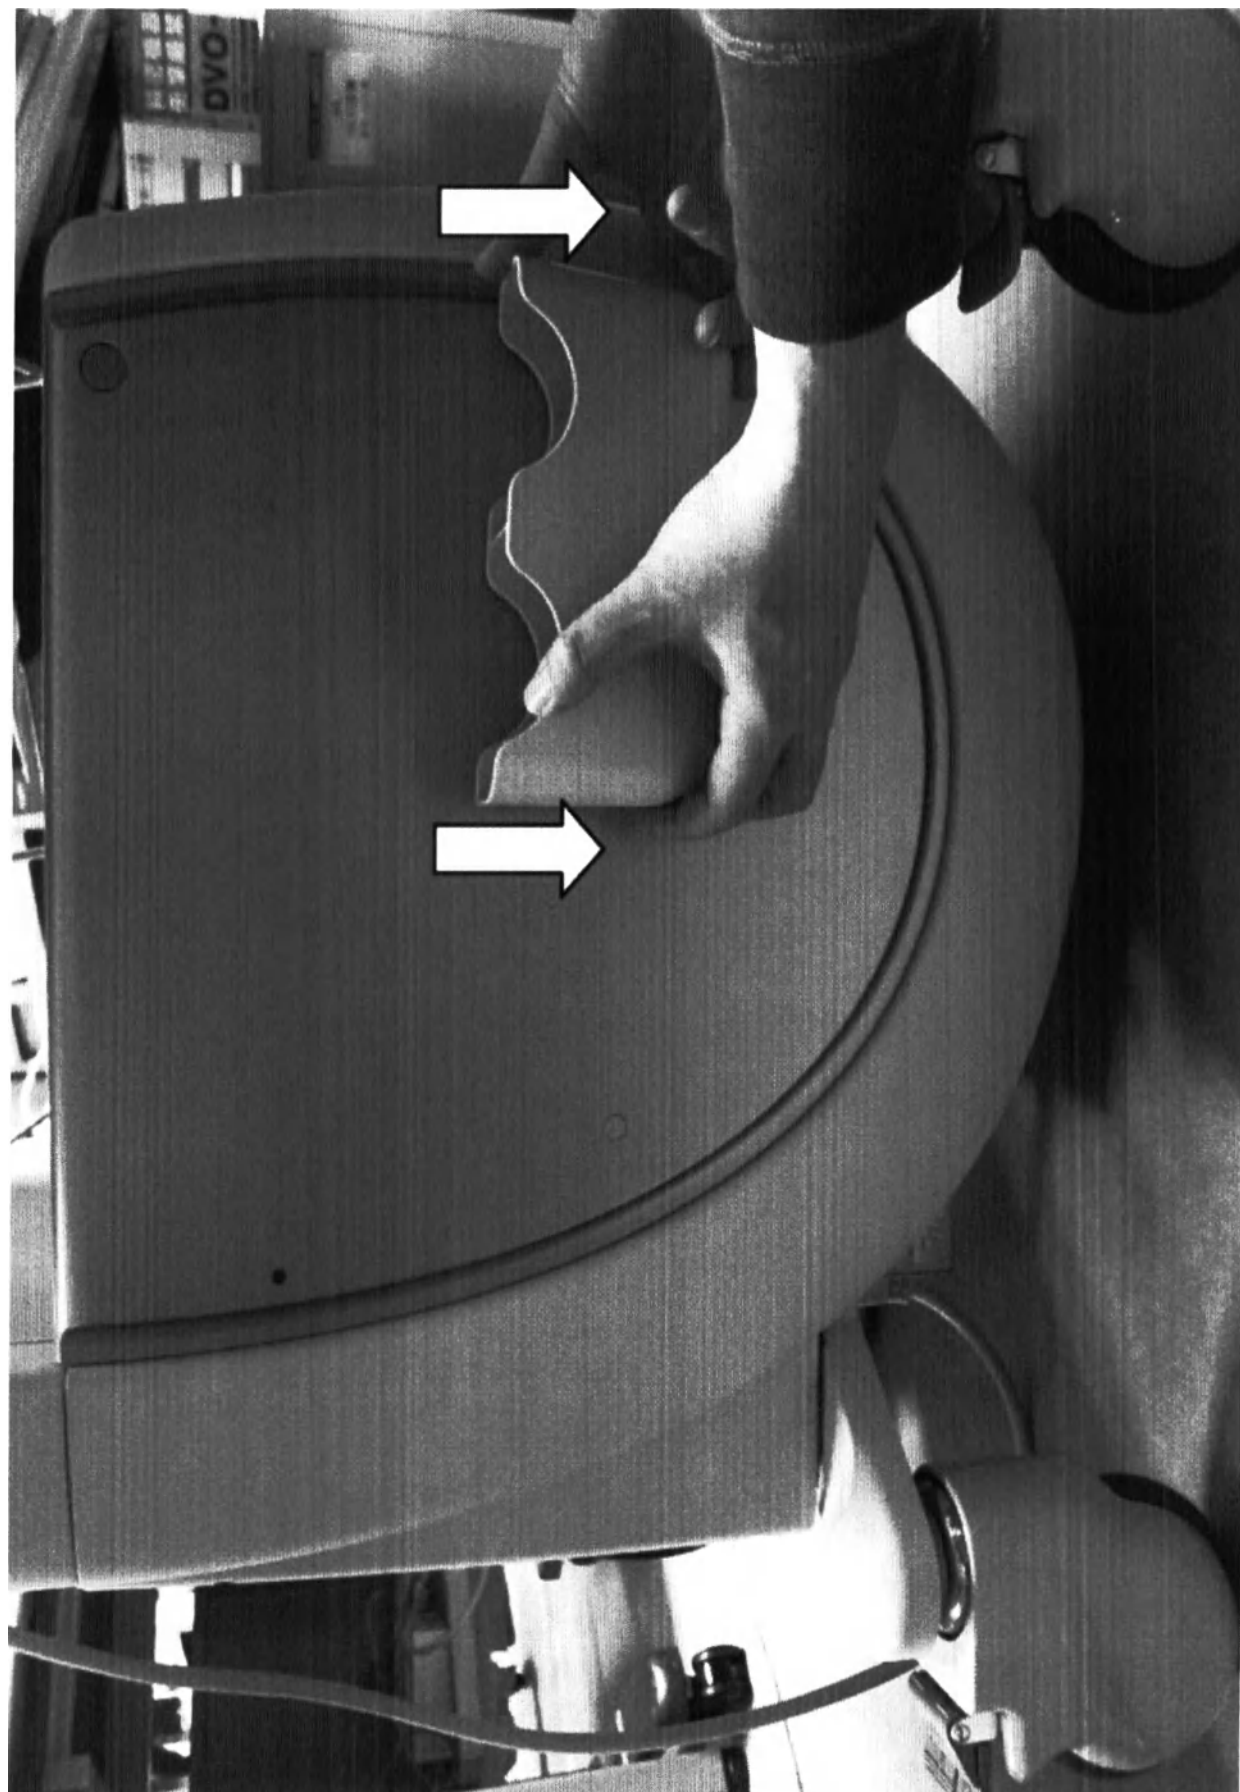


24. Блок аккумуляторов




25. Модуль поддержки русского языка

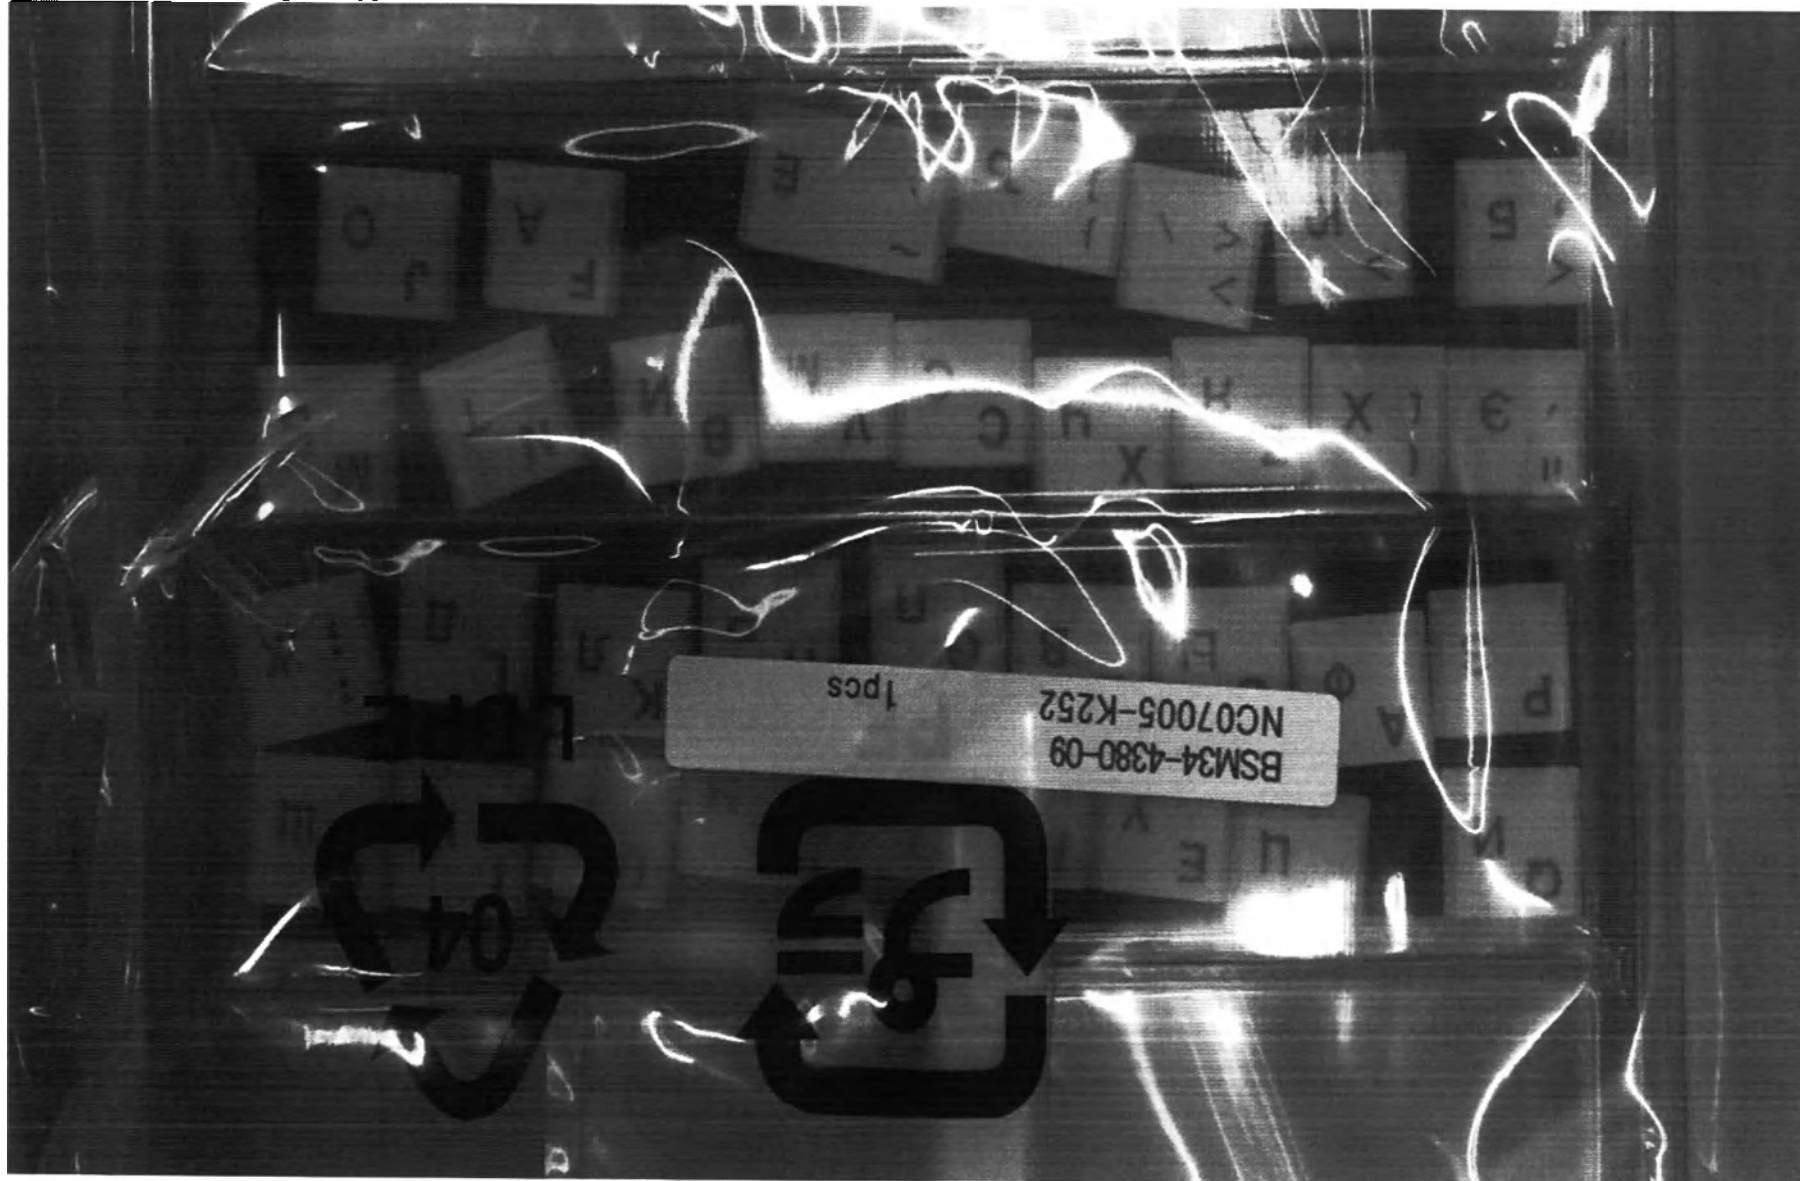


26. Модуль модернизации базового программного обеспечения

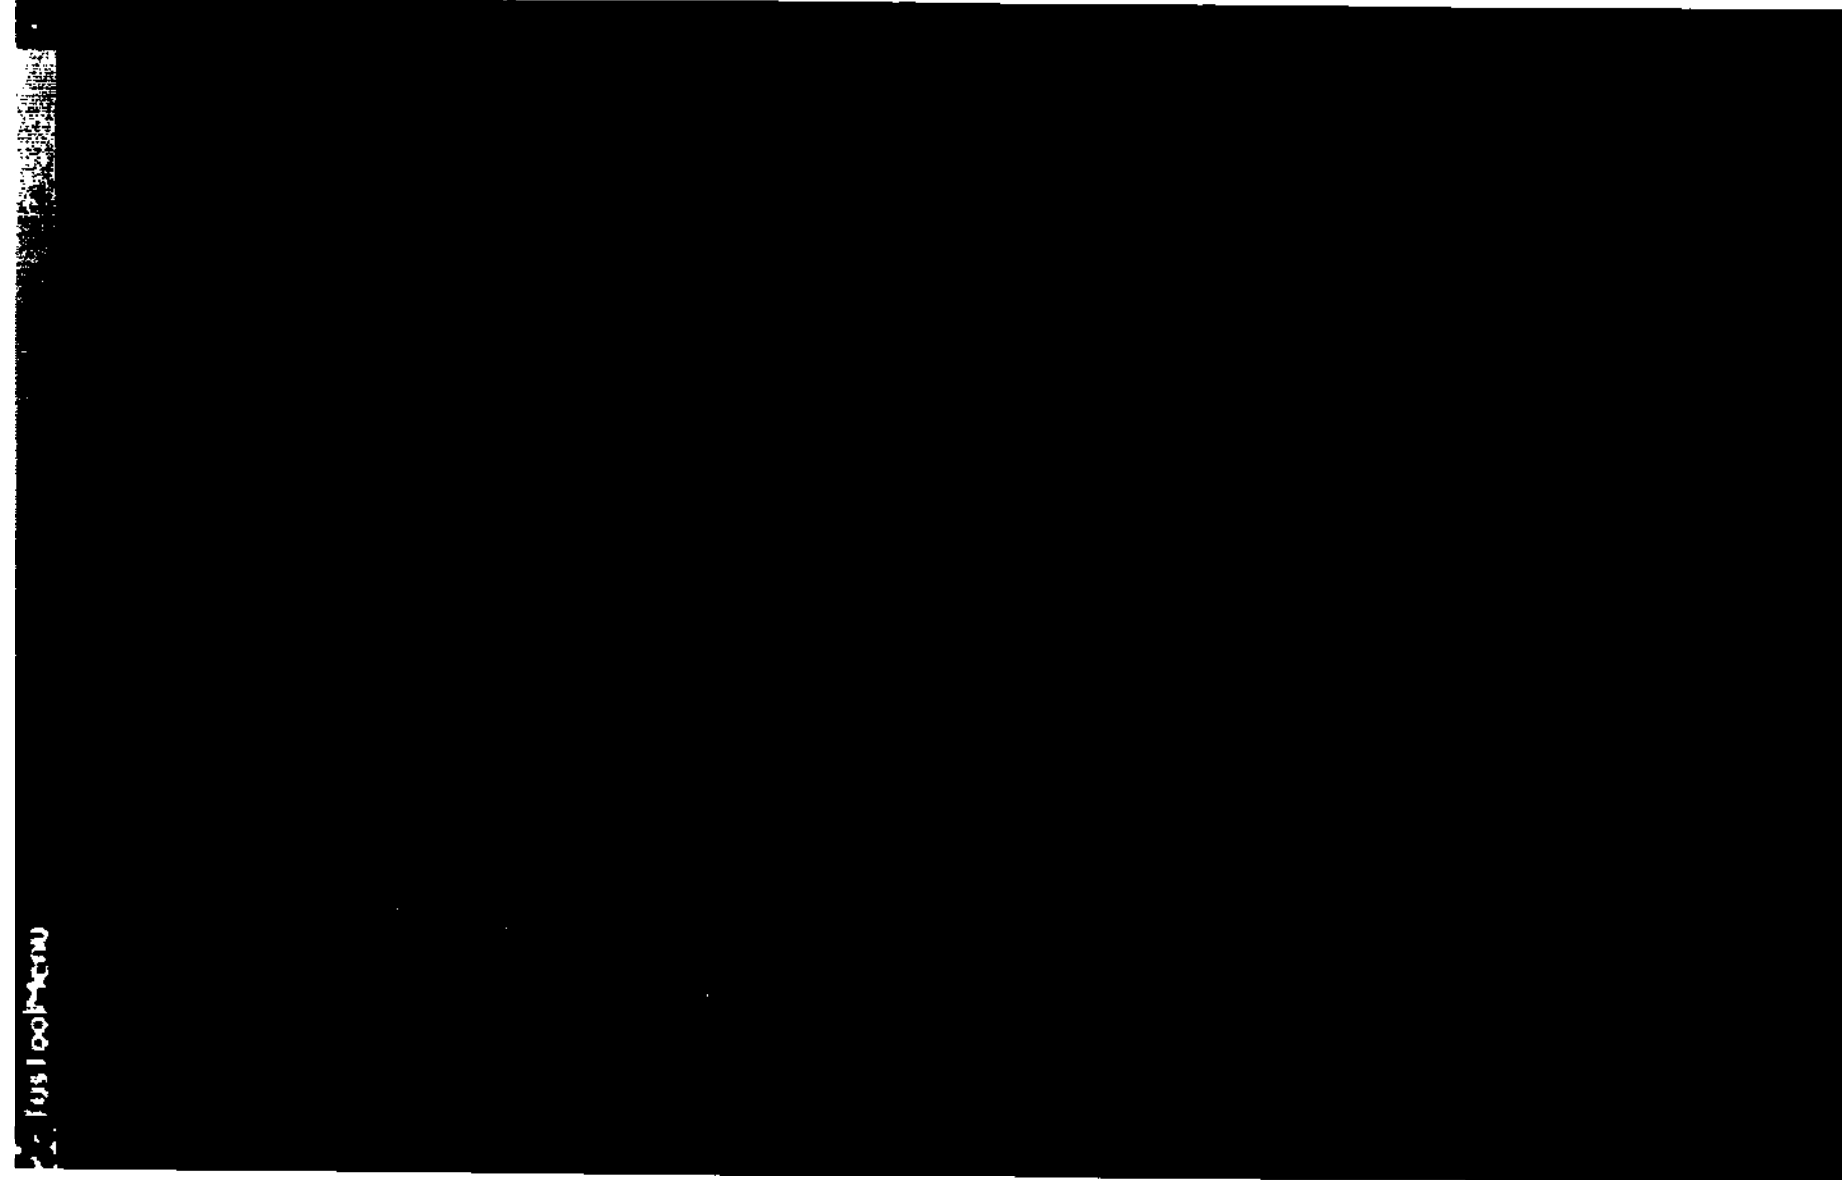


27. Крепление многозвенное для ЖК-монитора

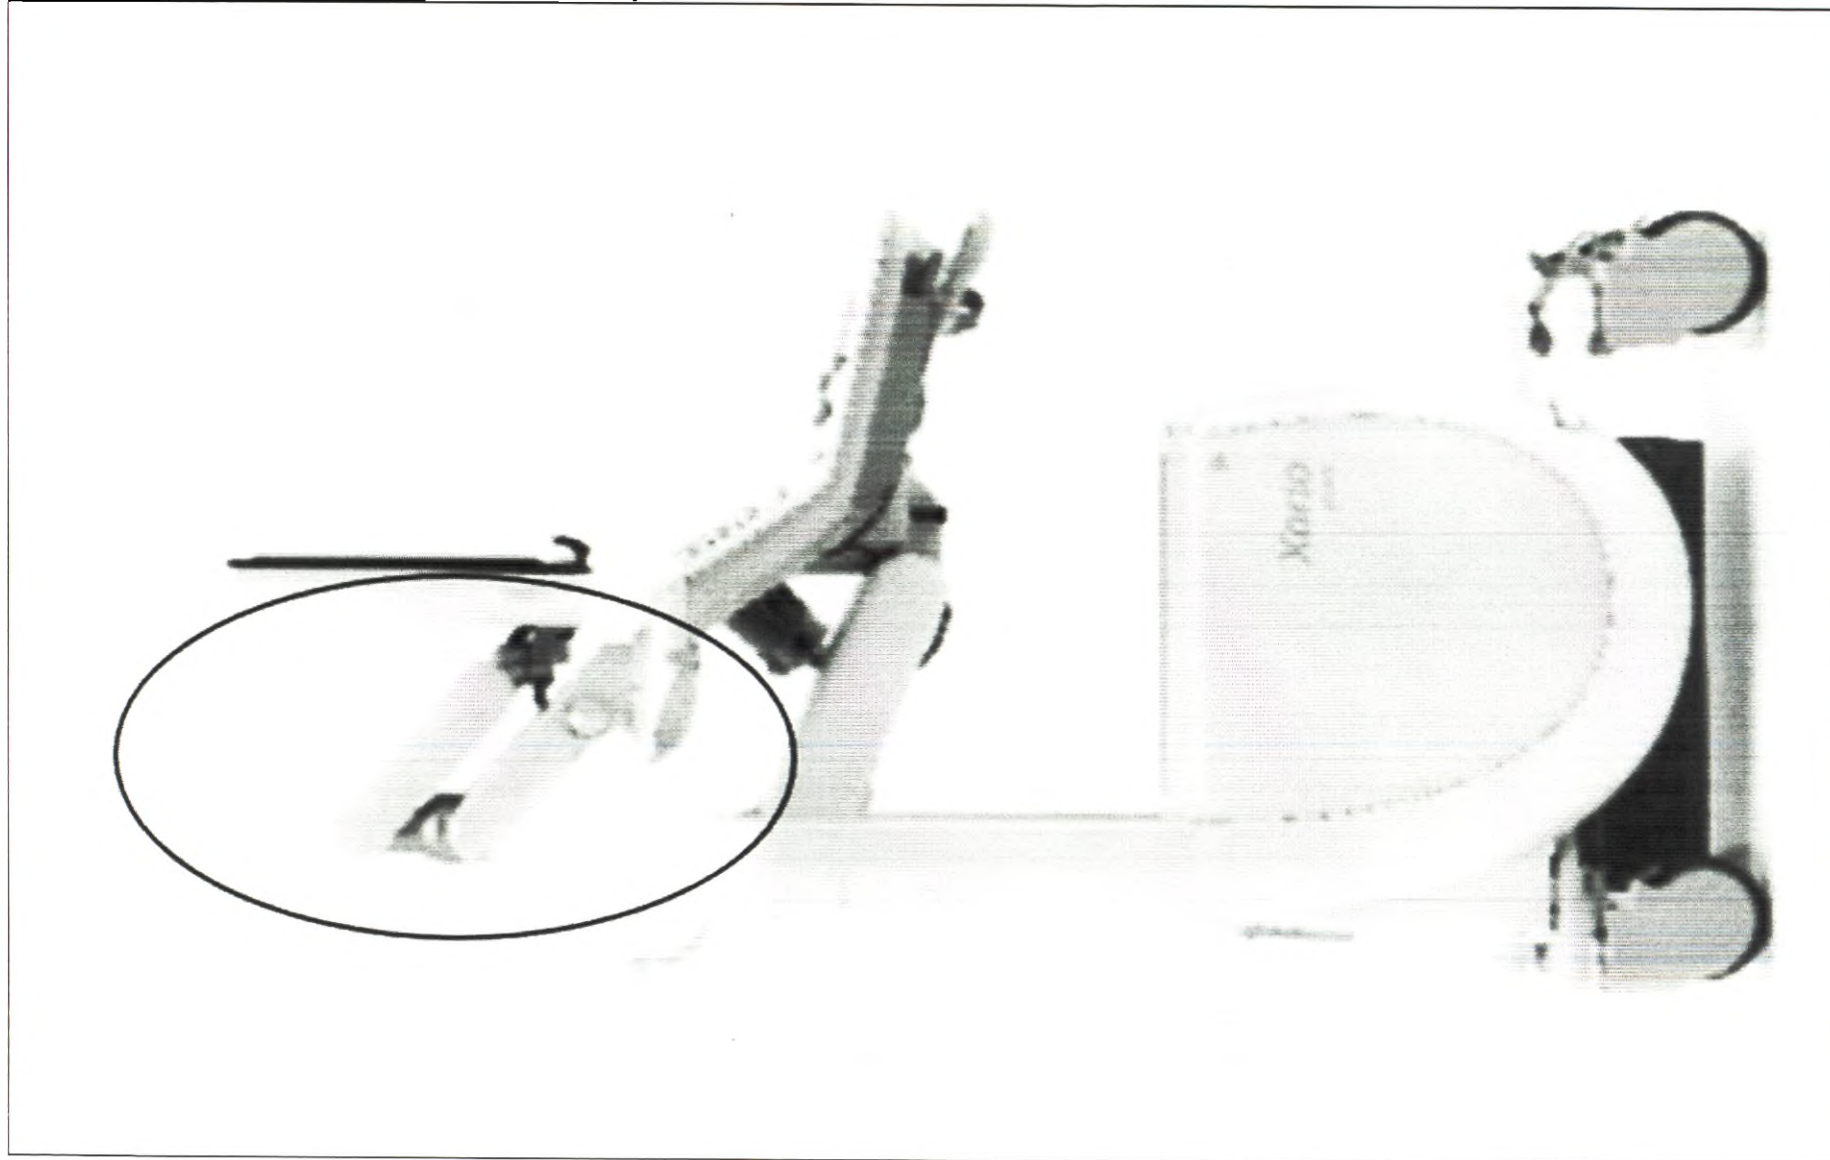


28. Изолирующий трансформатор для периферийного устройства

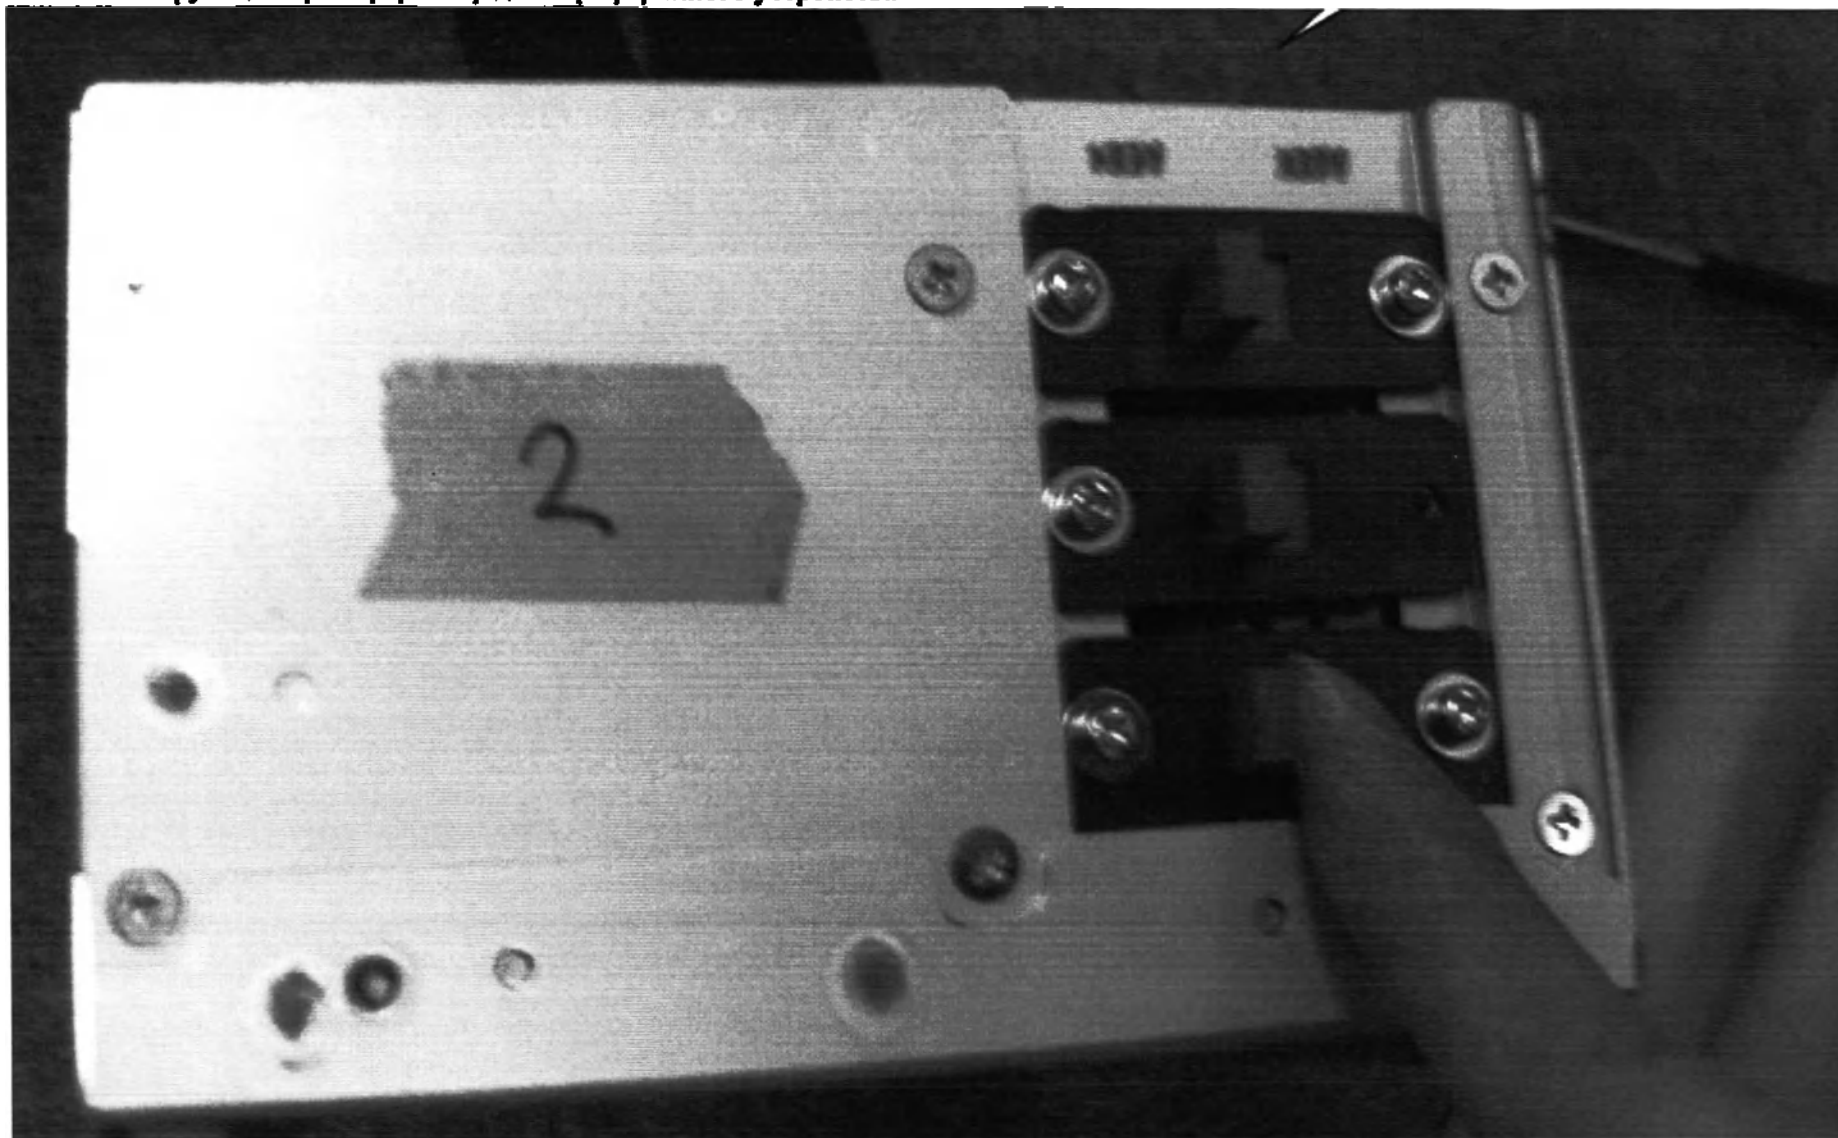


29. Комплект деталей для крепления черно-белого принтера слева

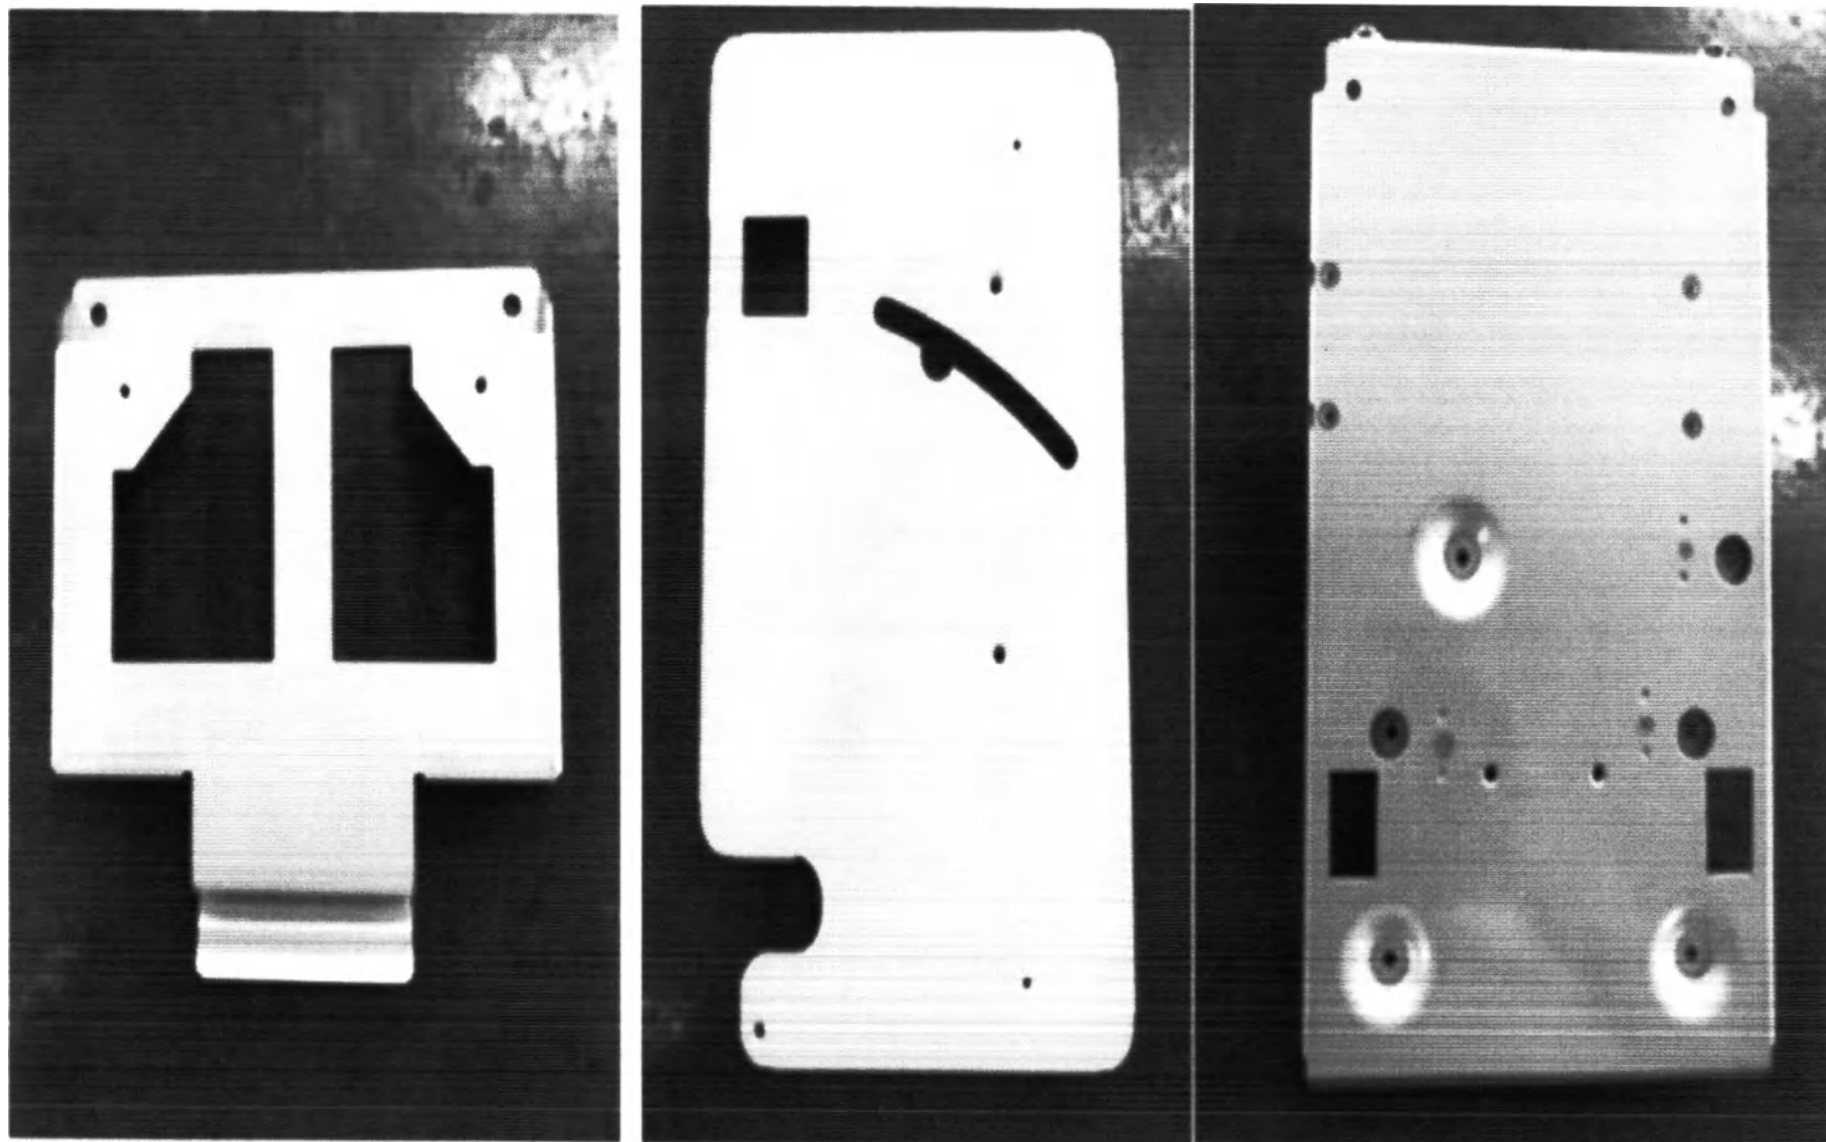

30. Комплект деталей для крепления черно-белого принтера справа

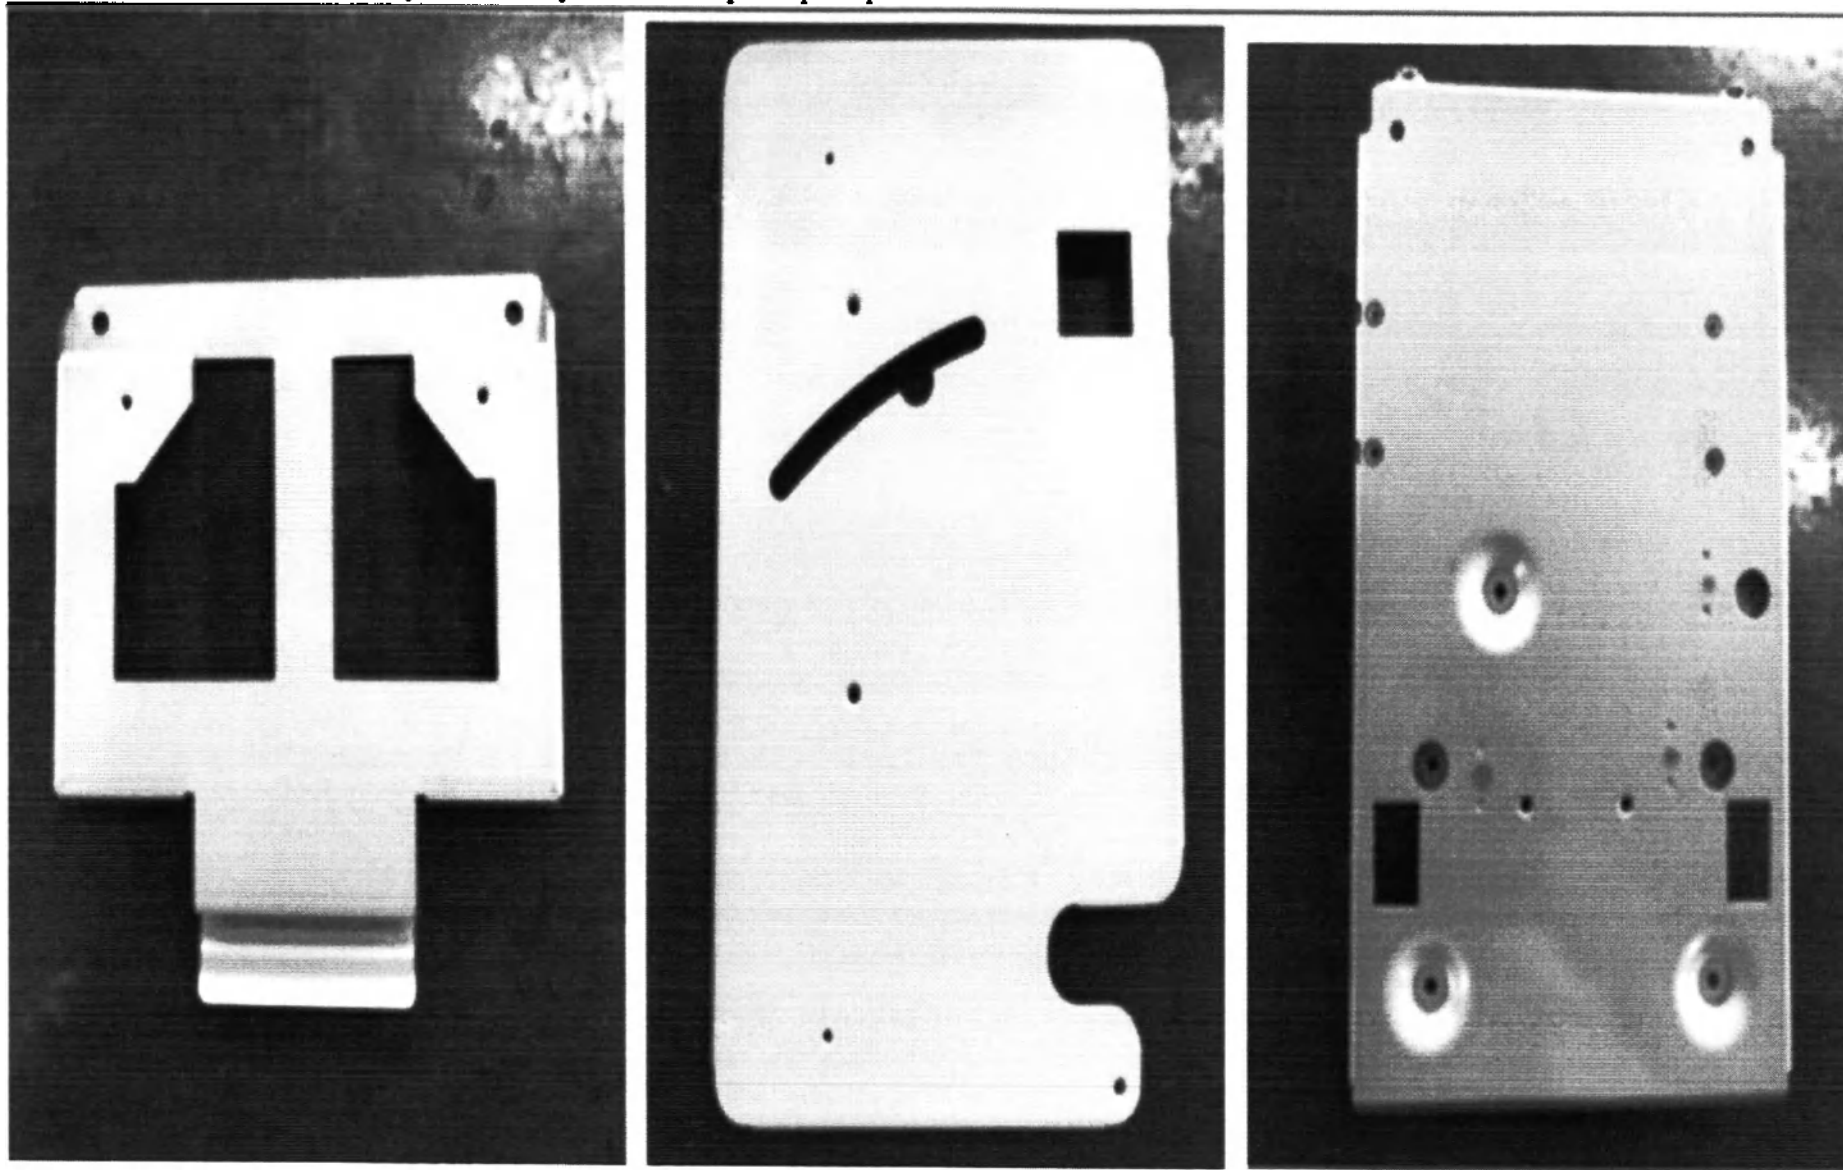

31. Комплект деталей для крепления цветного принтера

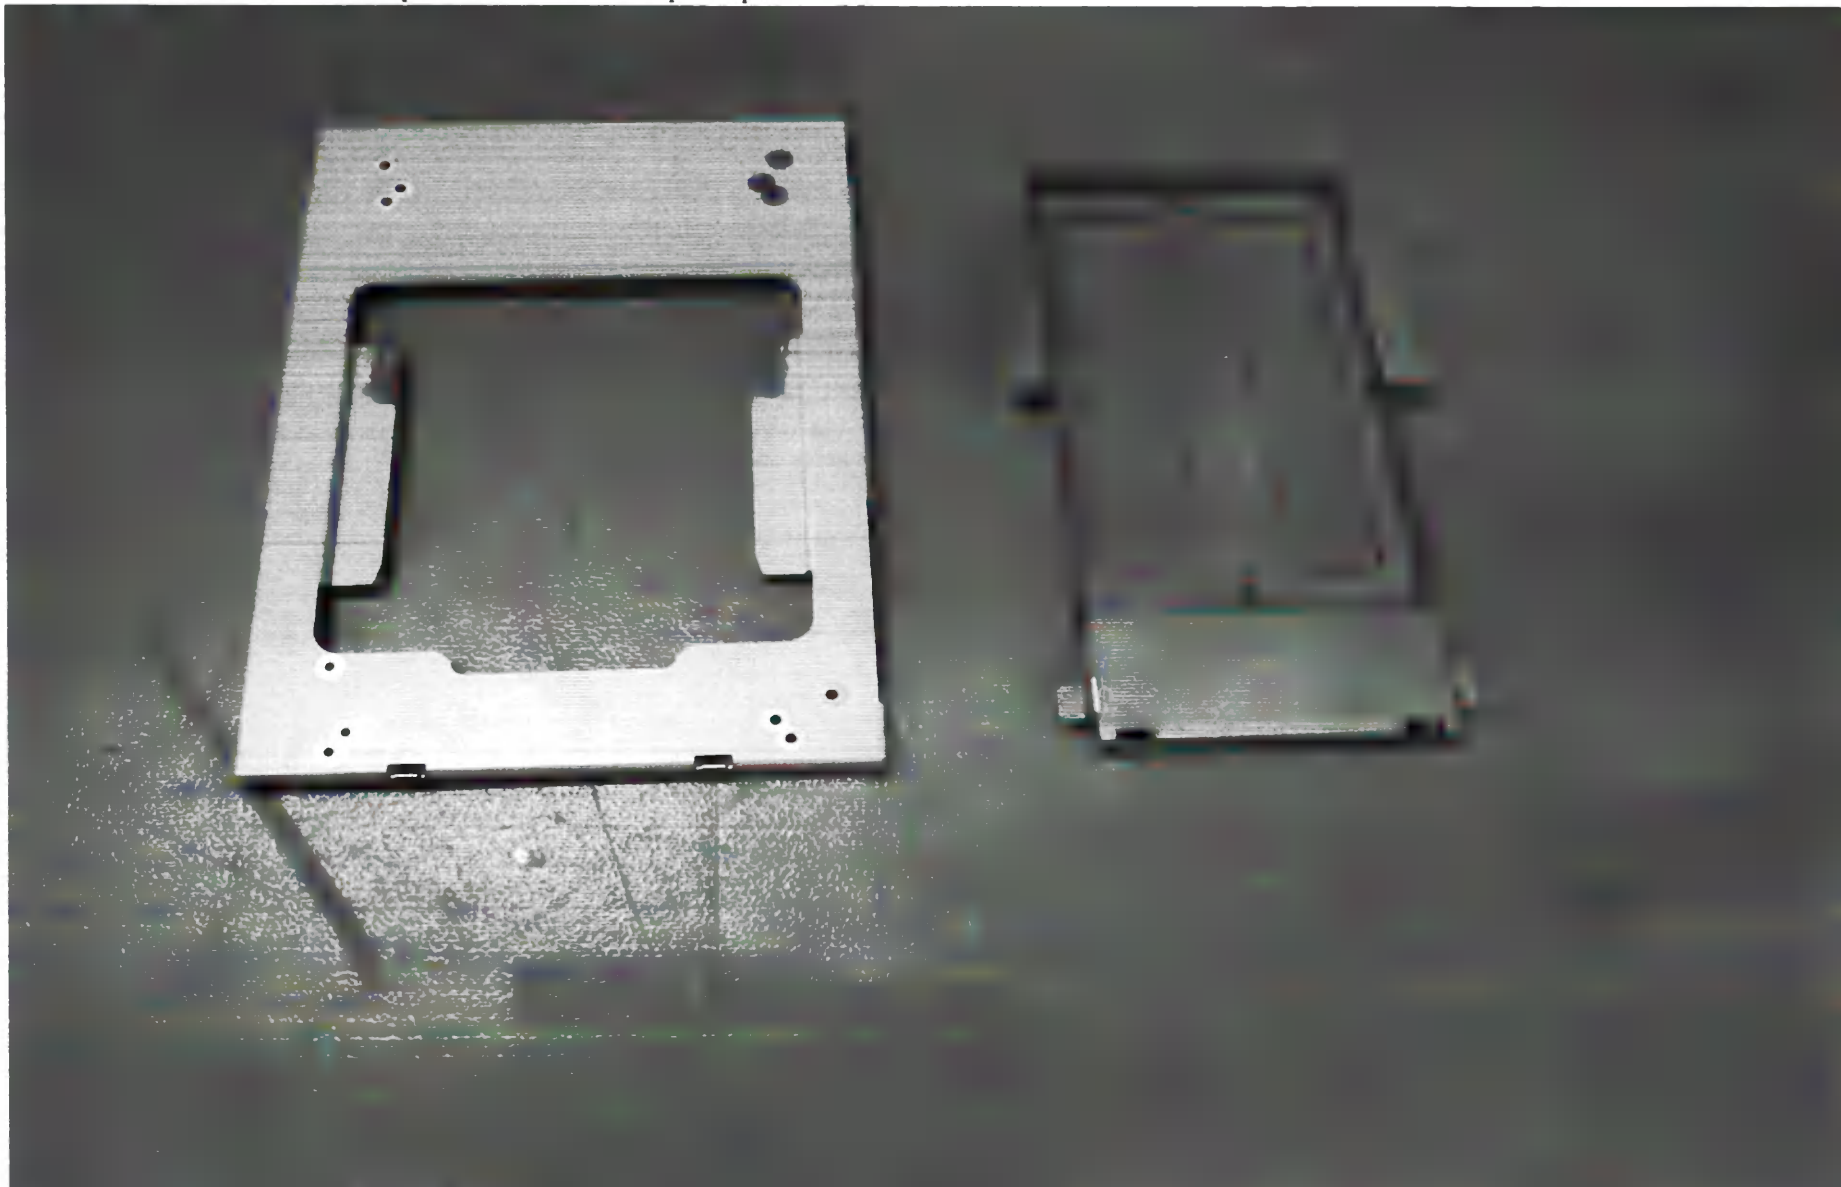


32. Комплект деталей для крепления DVD-рекордера



33. Комплект деталей для крепления цветного принтера и DVD-рекордера



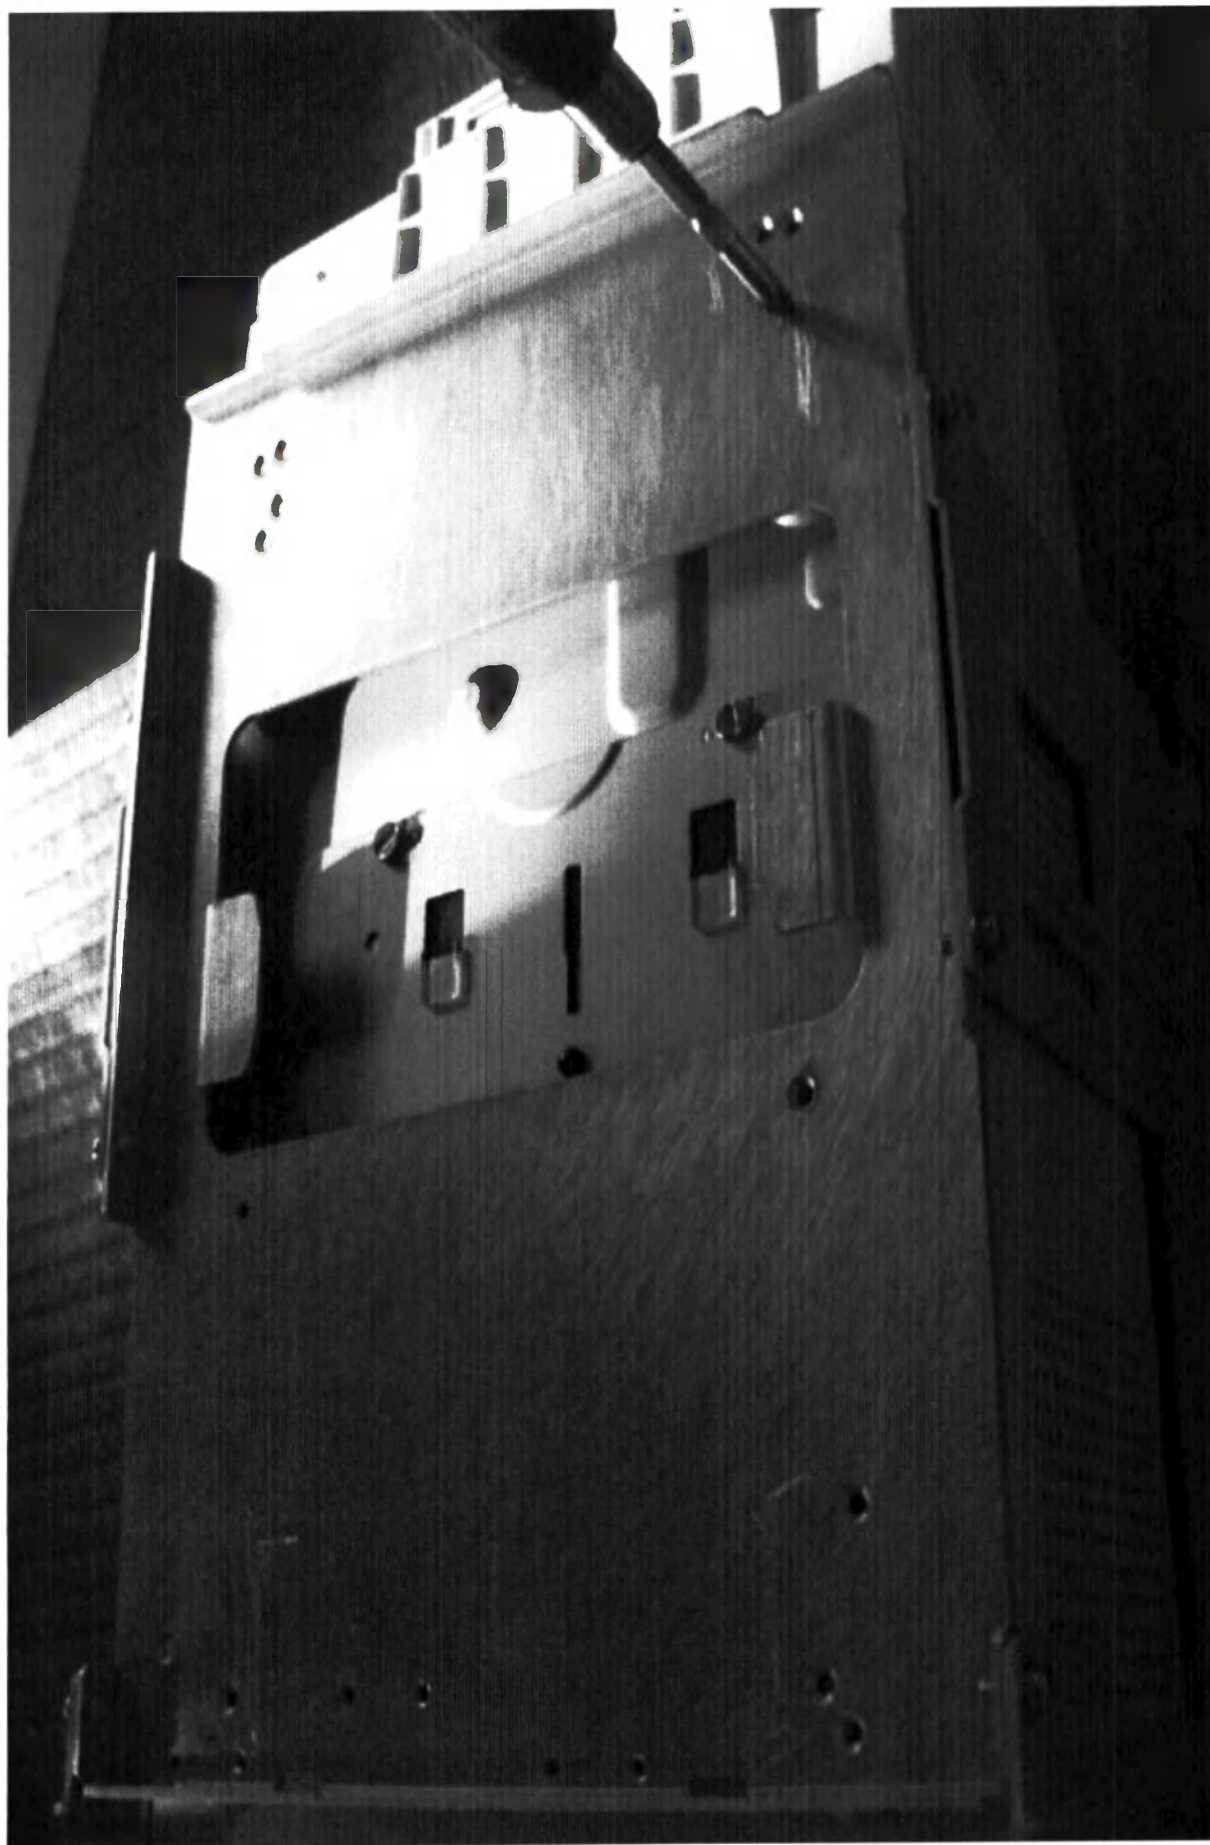

34. Комплект для установки черно-белого принтера, работающего от источника питания переменного тока




Система диагностическая ультразвуковая, вариант исполнения XARIO 200G (модель CUS-X200G), базовый состав:


1. Основной блок системы




2. Программное обеспечение системы базовое

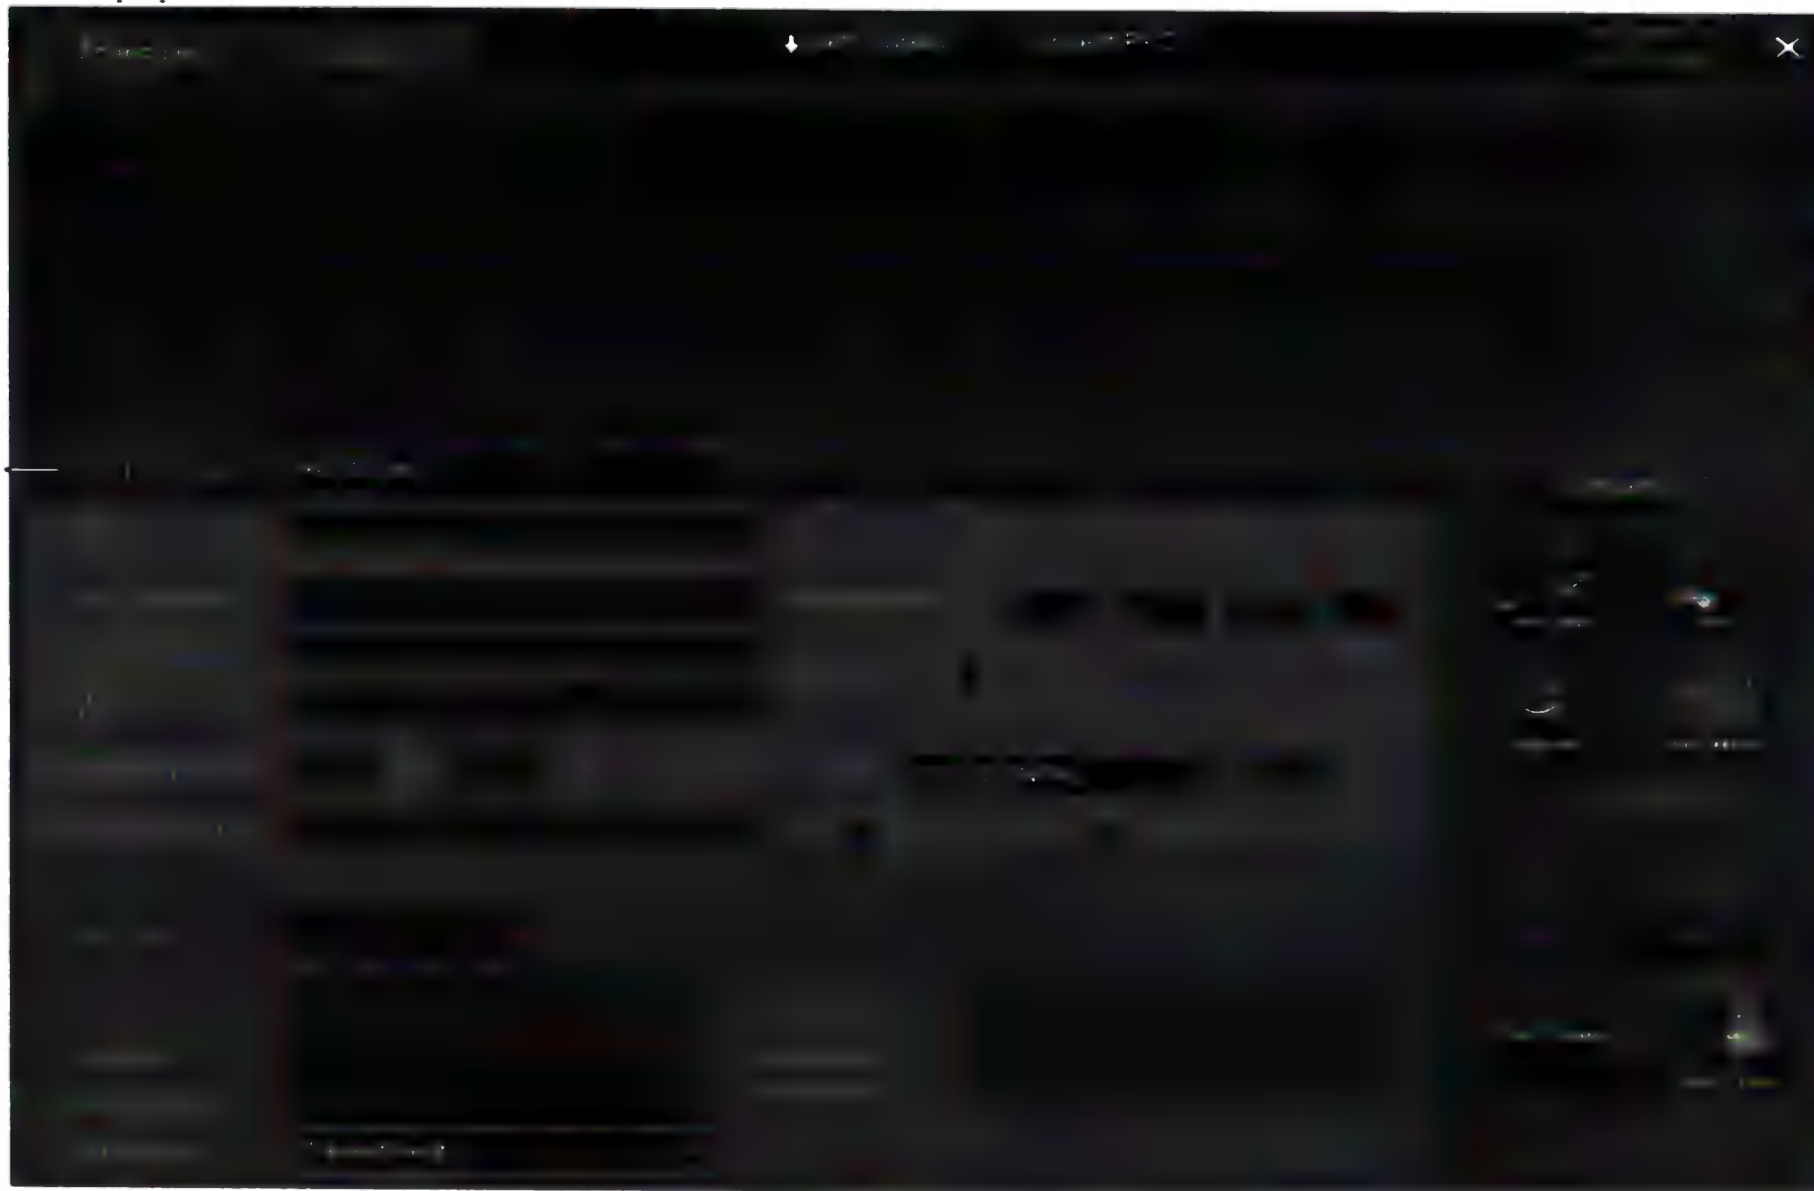


3. Монитор цветной жидкокристаллический

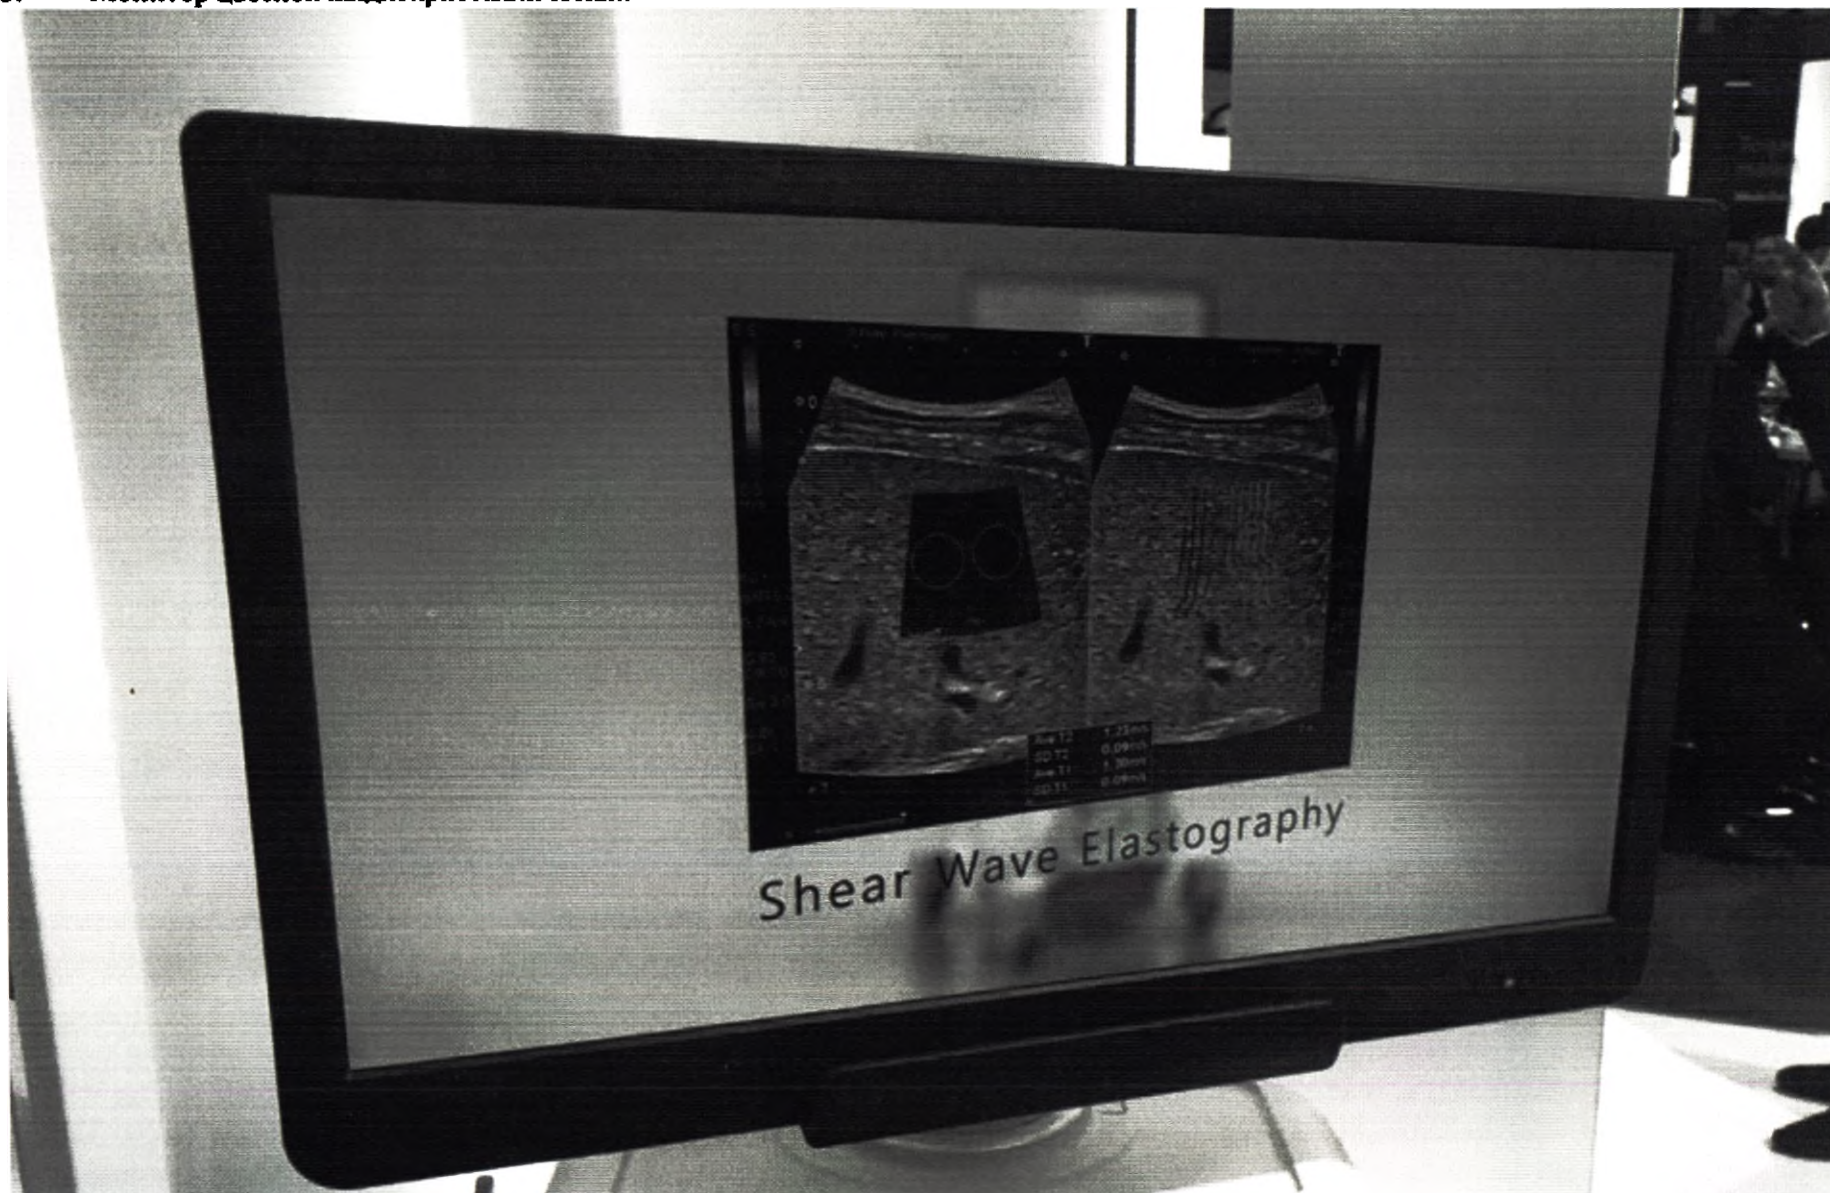


4. Датчик секторный, модель PSU-25BT, РУ №РЗН 2015/2361

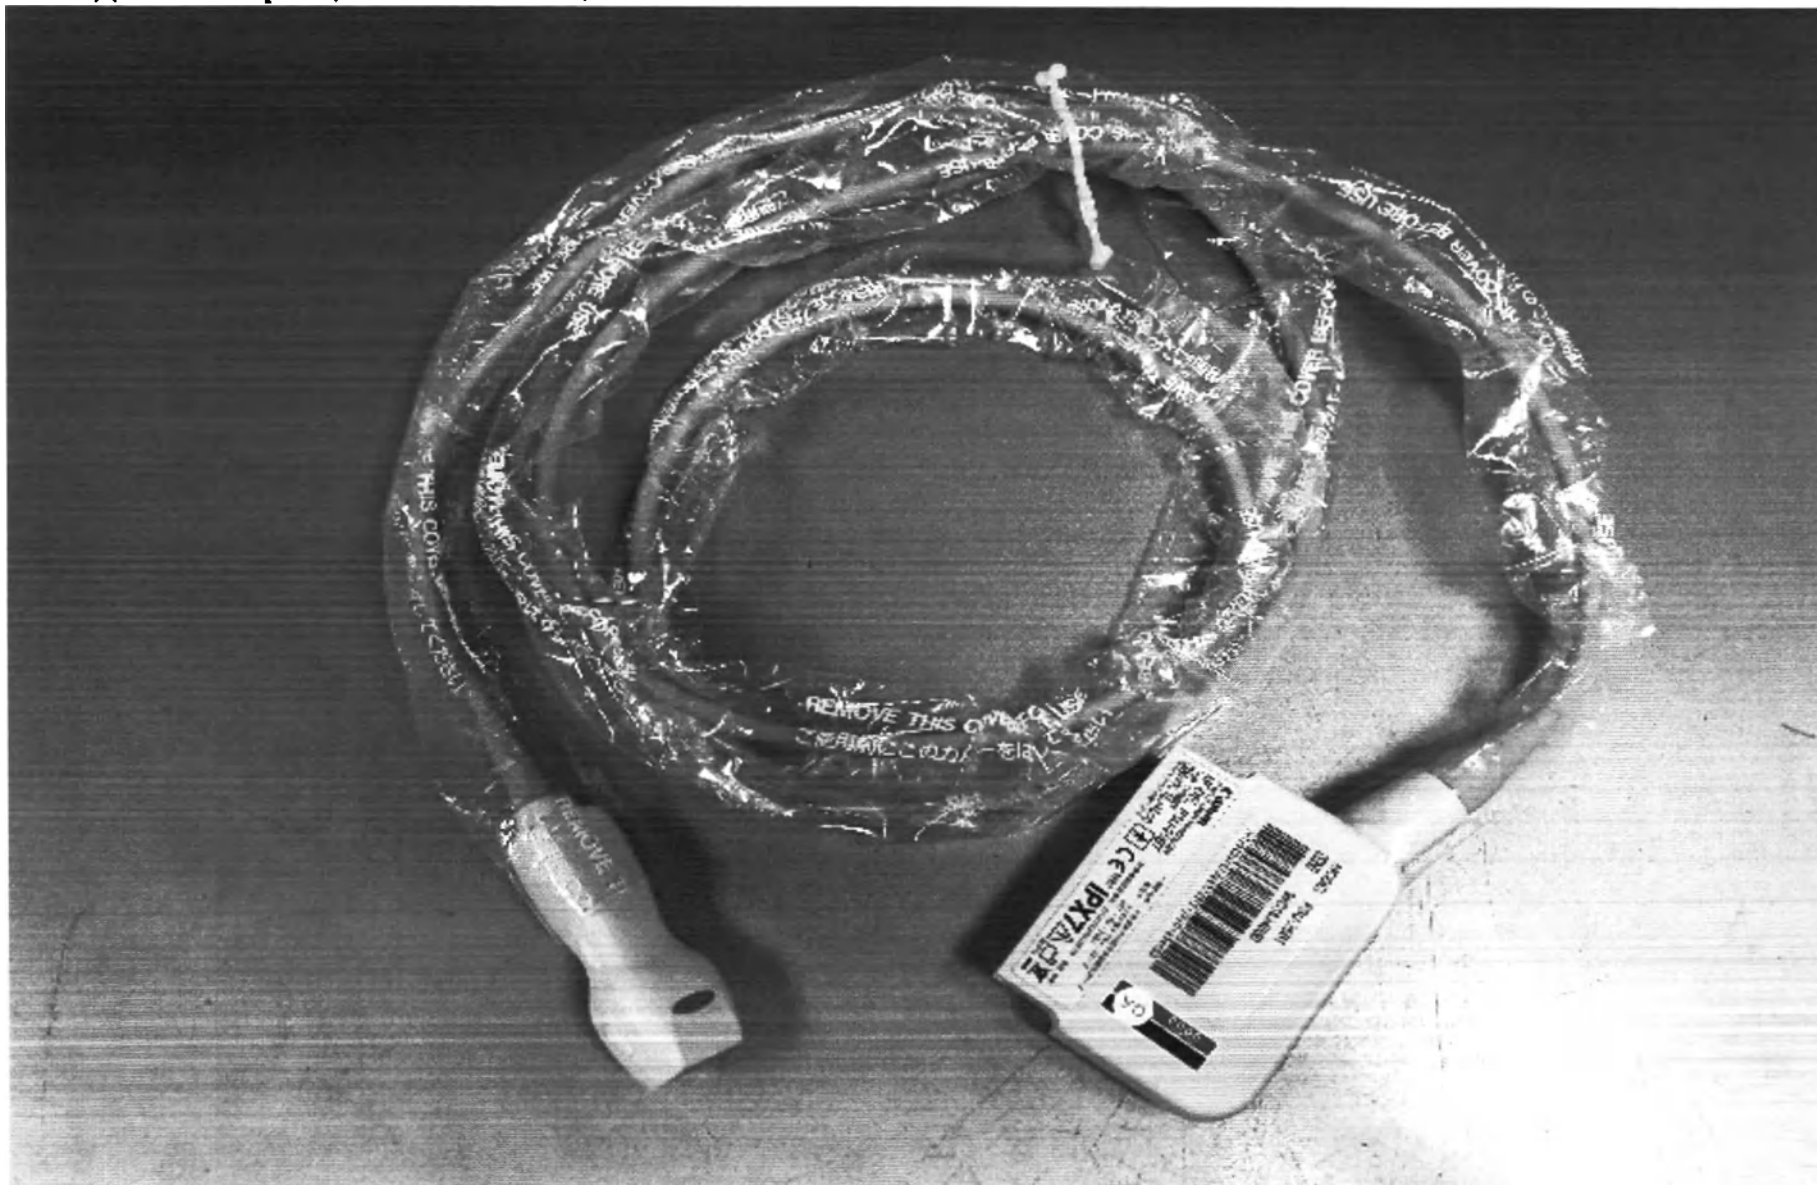

5. Датчик секторный, модель PSU-30BT, РУ №РЭН 2015/2361

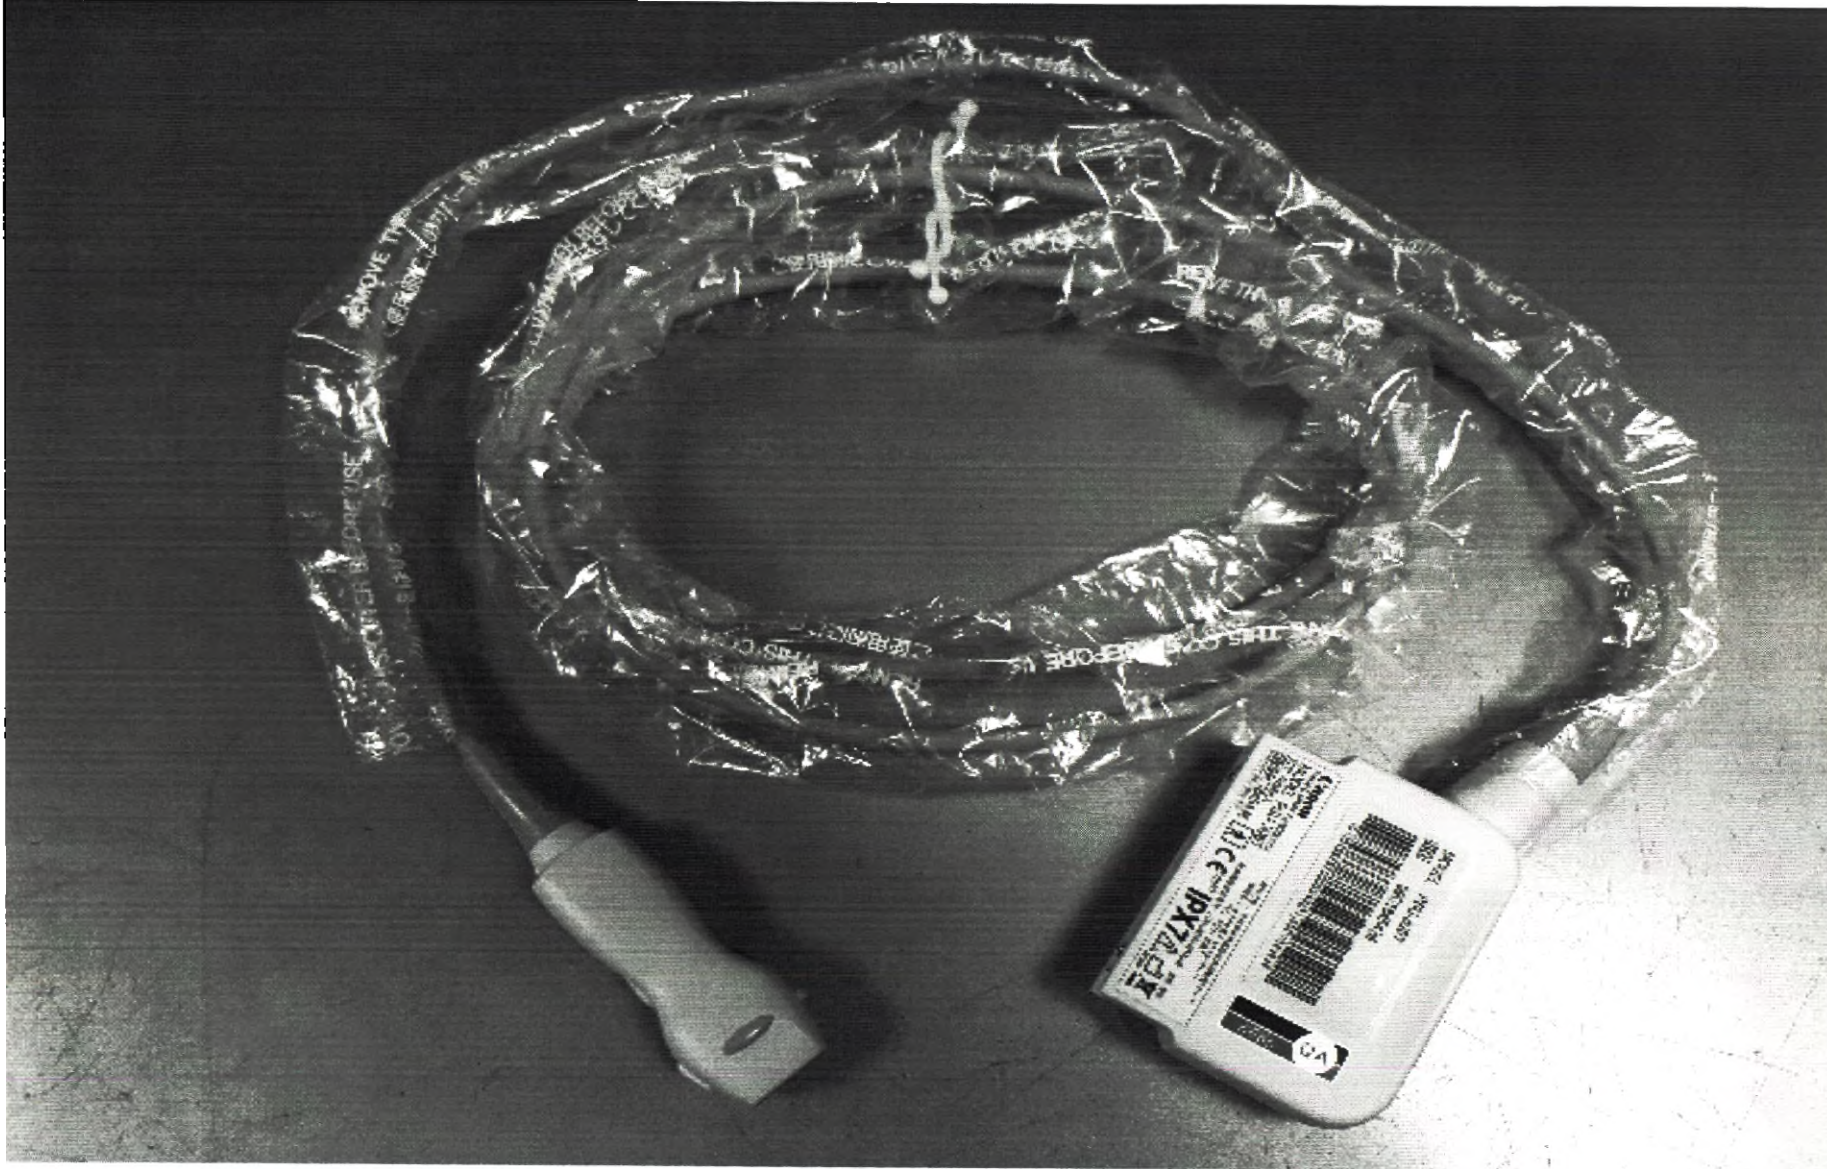


6. Датчик секторный, модель PSU-50BT, РУ №РЗН 2015/2361

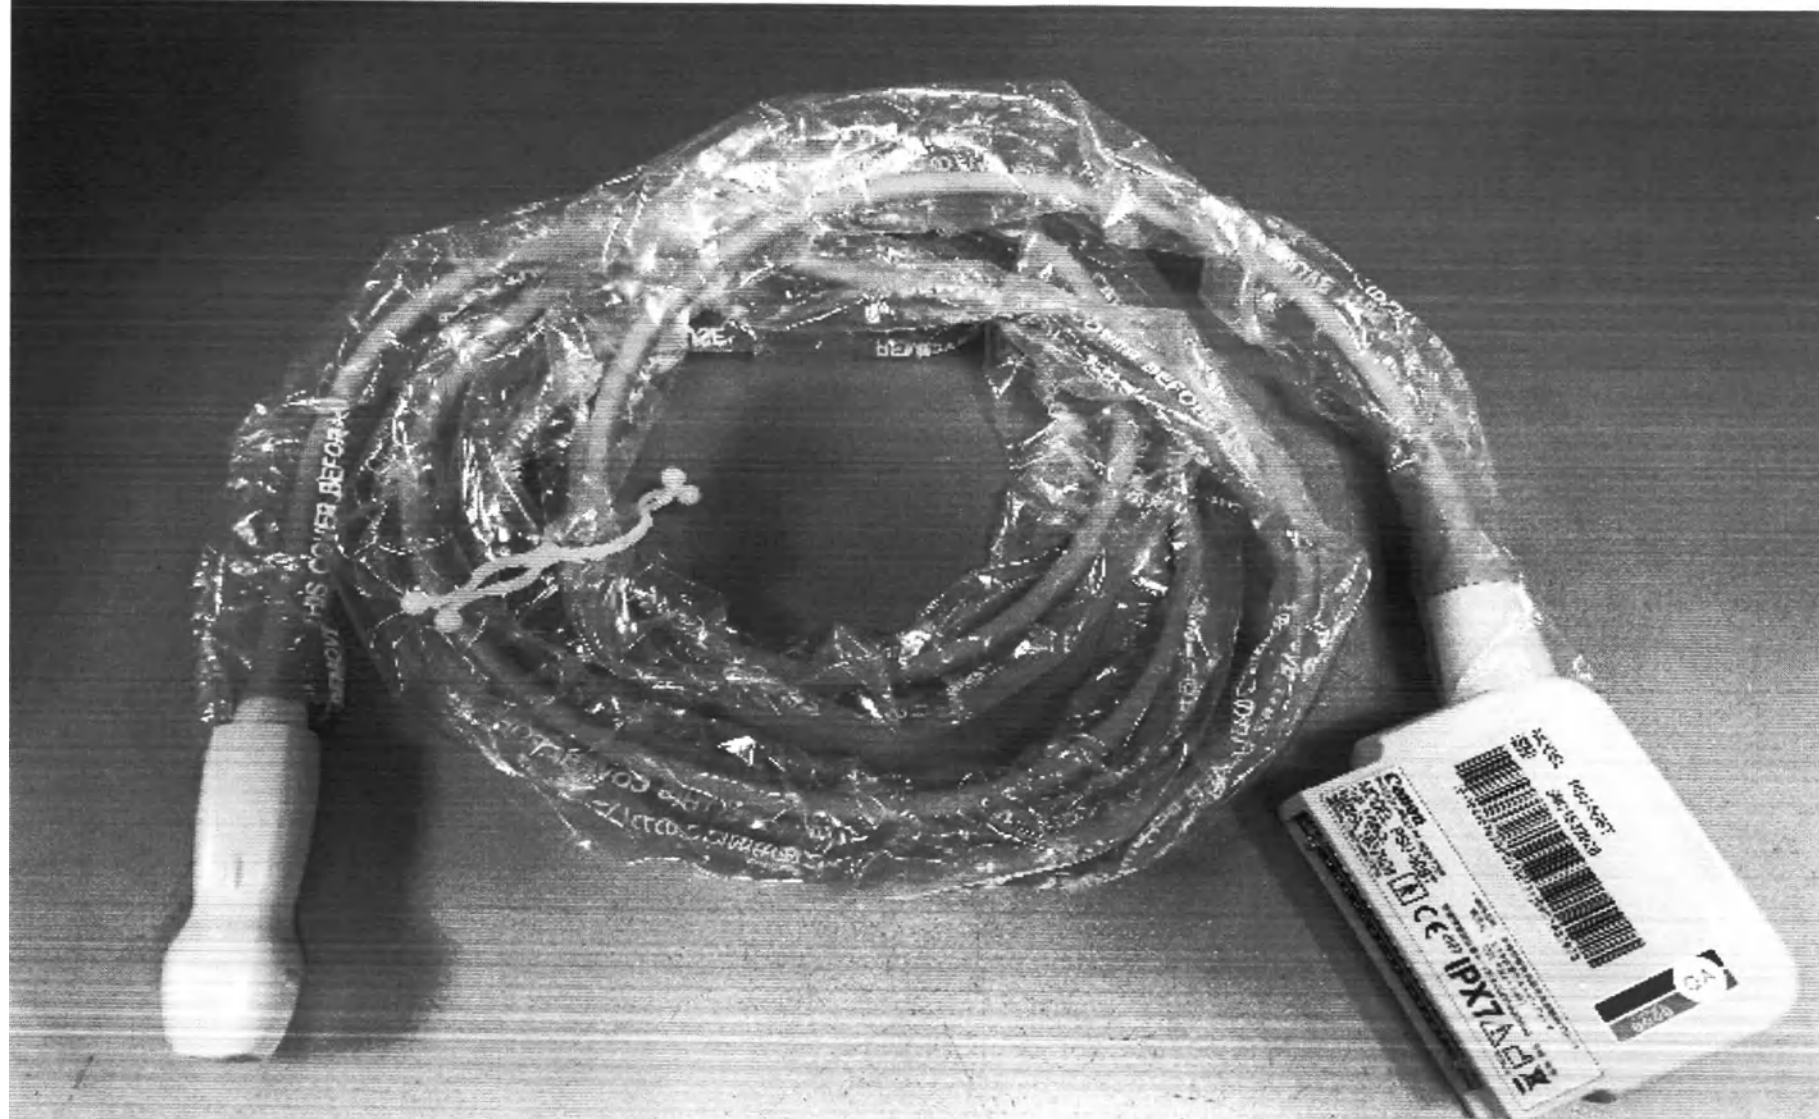

7. Датчик секторный, модель PSU-70BT, РУ №РЗН 2015/2361



8. Датчик конвексный, модель PVU-375BT, РУ №РЗН 2015/2361

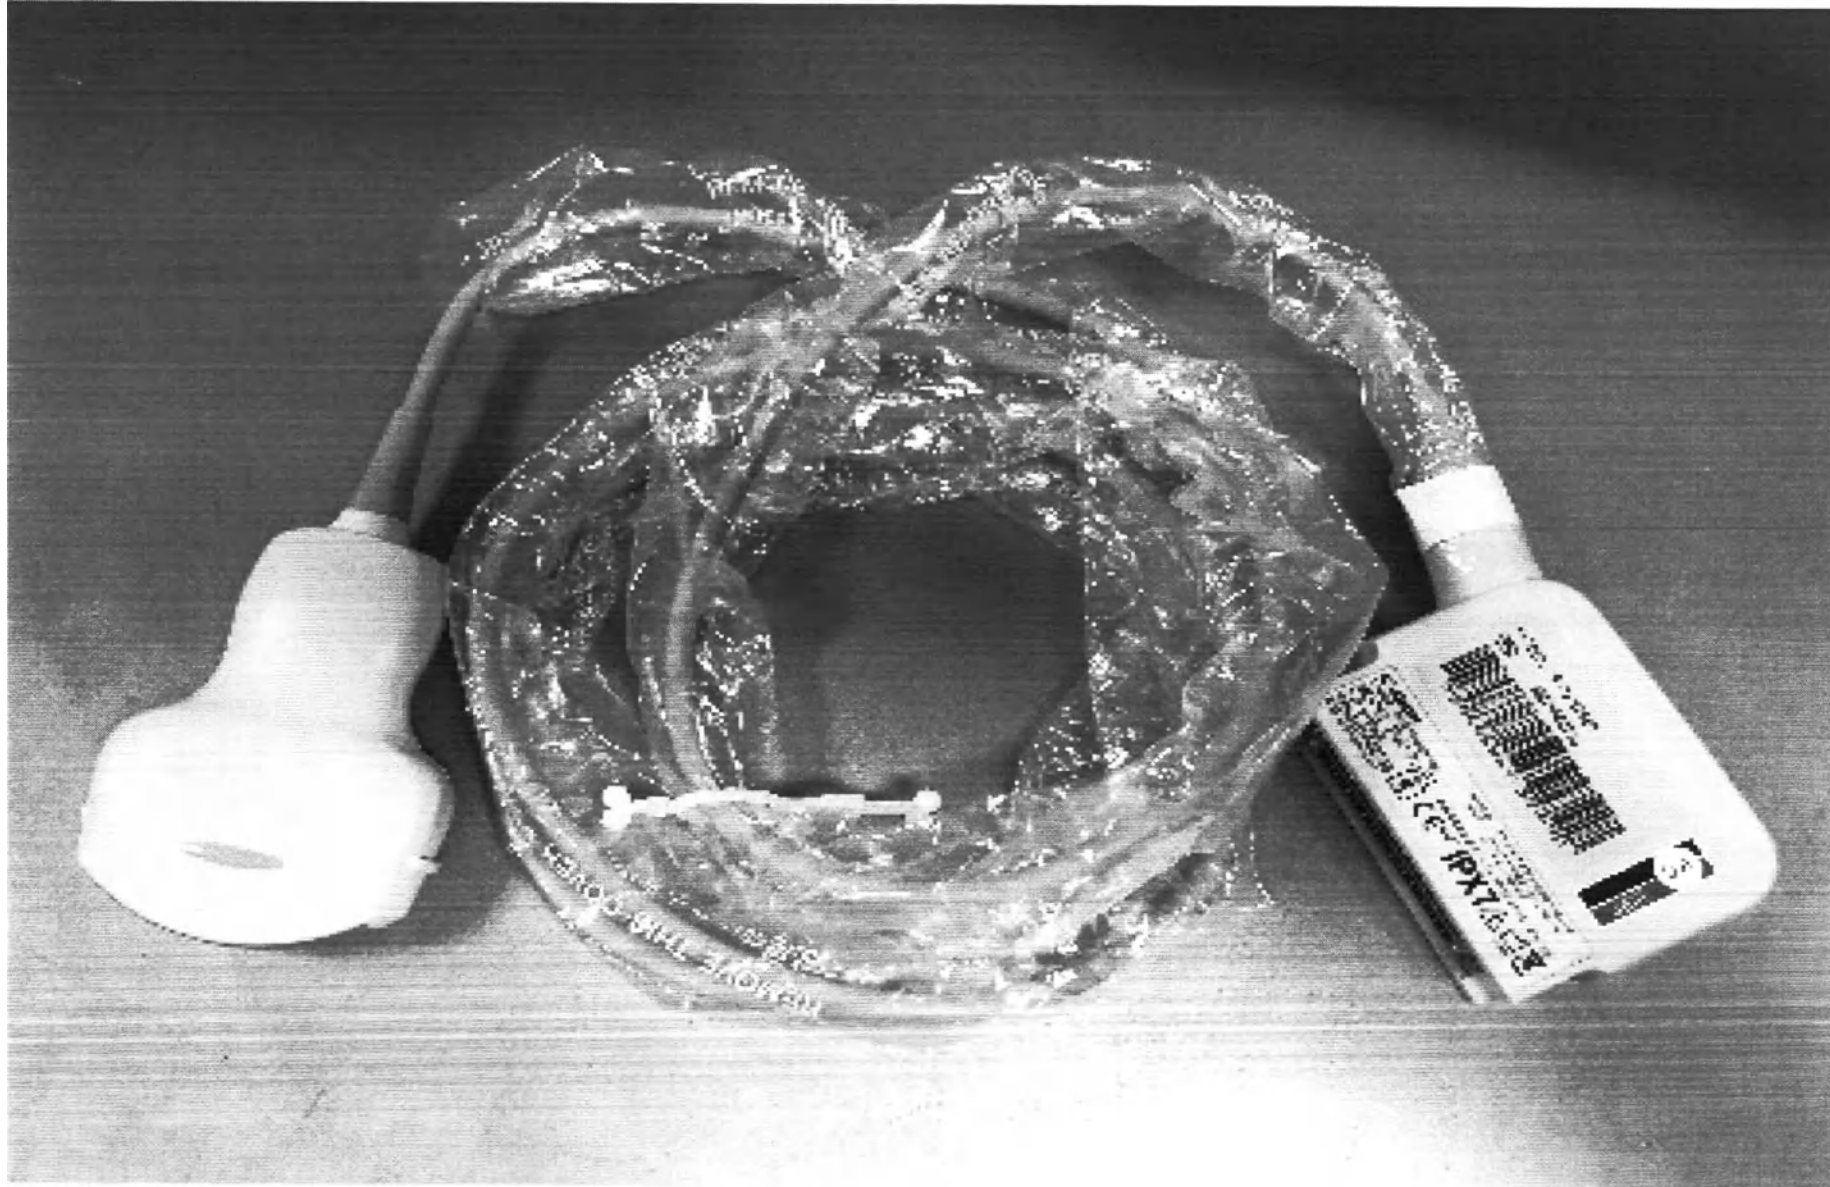

9. Датчик конвексный, модель PVU-674В, РУ №РЗН 2015/2361



10. Датчик конвексный, модель PVU-674MV, РУ №РЗН 2015/2361



11. Датчик внутрисполостной, модель PVU-681MVL, РУ №РЗН 2015/2361



12. Датчик конвексный, модель PVU-712BT, РУ №РЗН 2015/2361




13. Датчик конвексный, модель PVU-745BTF, РУ №РЗН 2015/2361



14. Датчик конвексный, модель PVU-745BTH, РУ №РЗН 1015/2361



15. Датчик внутривидеоскопический, модель PVU-770ST, РУ №РЗН 2015/2361

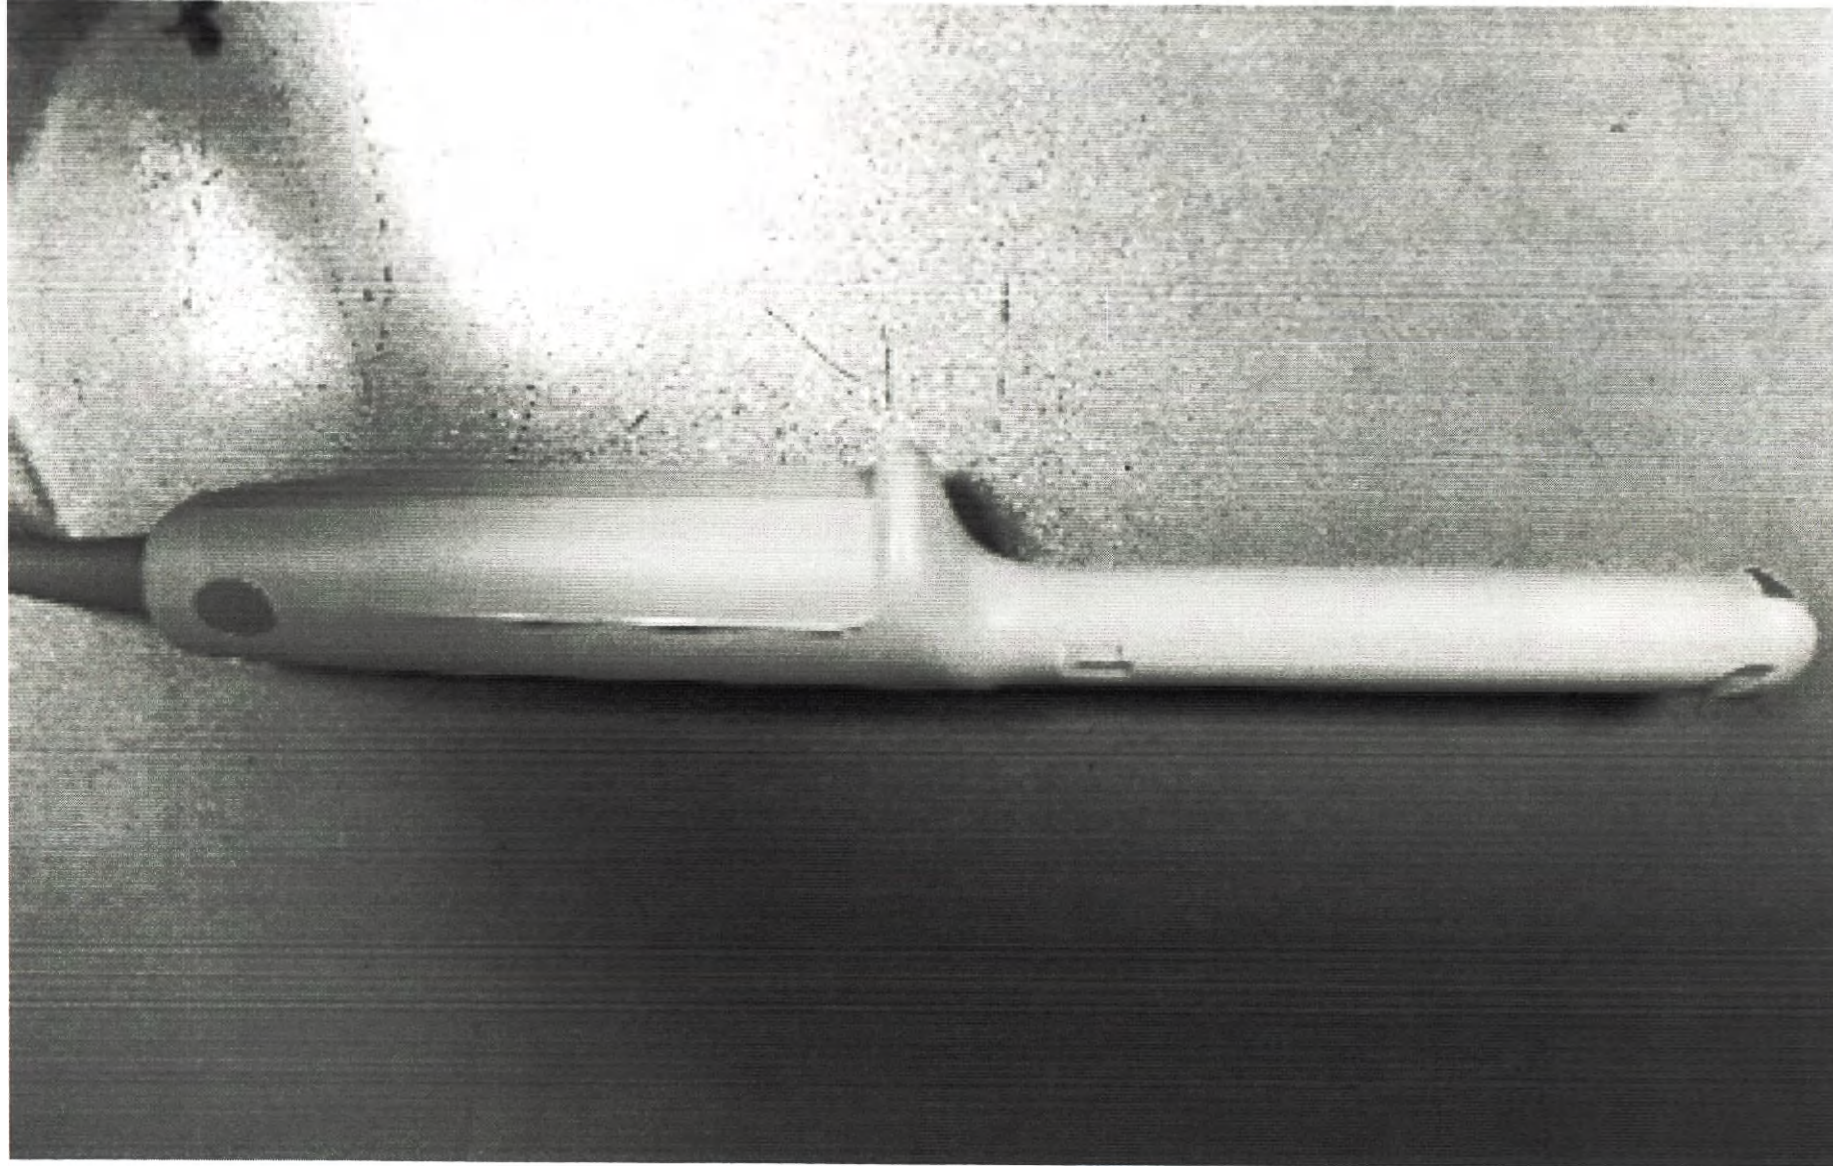


16. Датчик внутрисполостной, модель PVU-781VT, РУ №РЗН 2015/2361



17. Датчик внутривидеоскопной, модель PVU-781VTE, РУ №РЗН 2015/2361




18. Датчик внутривидеолостной, модель PVL-715RS, РУ №РЗН 2015/2361

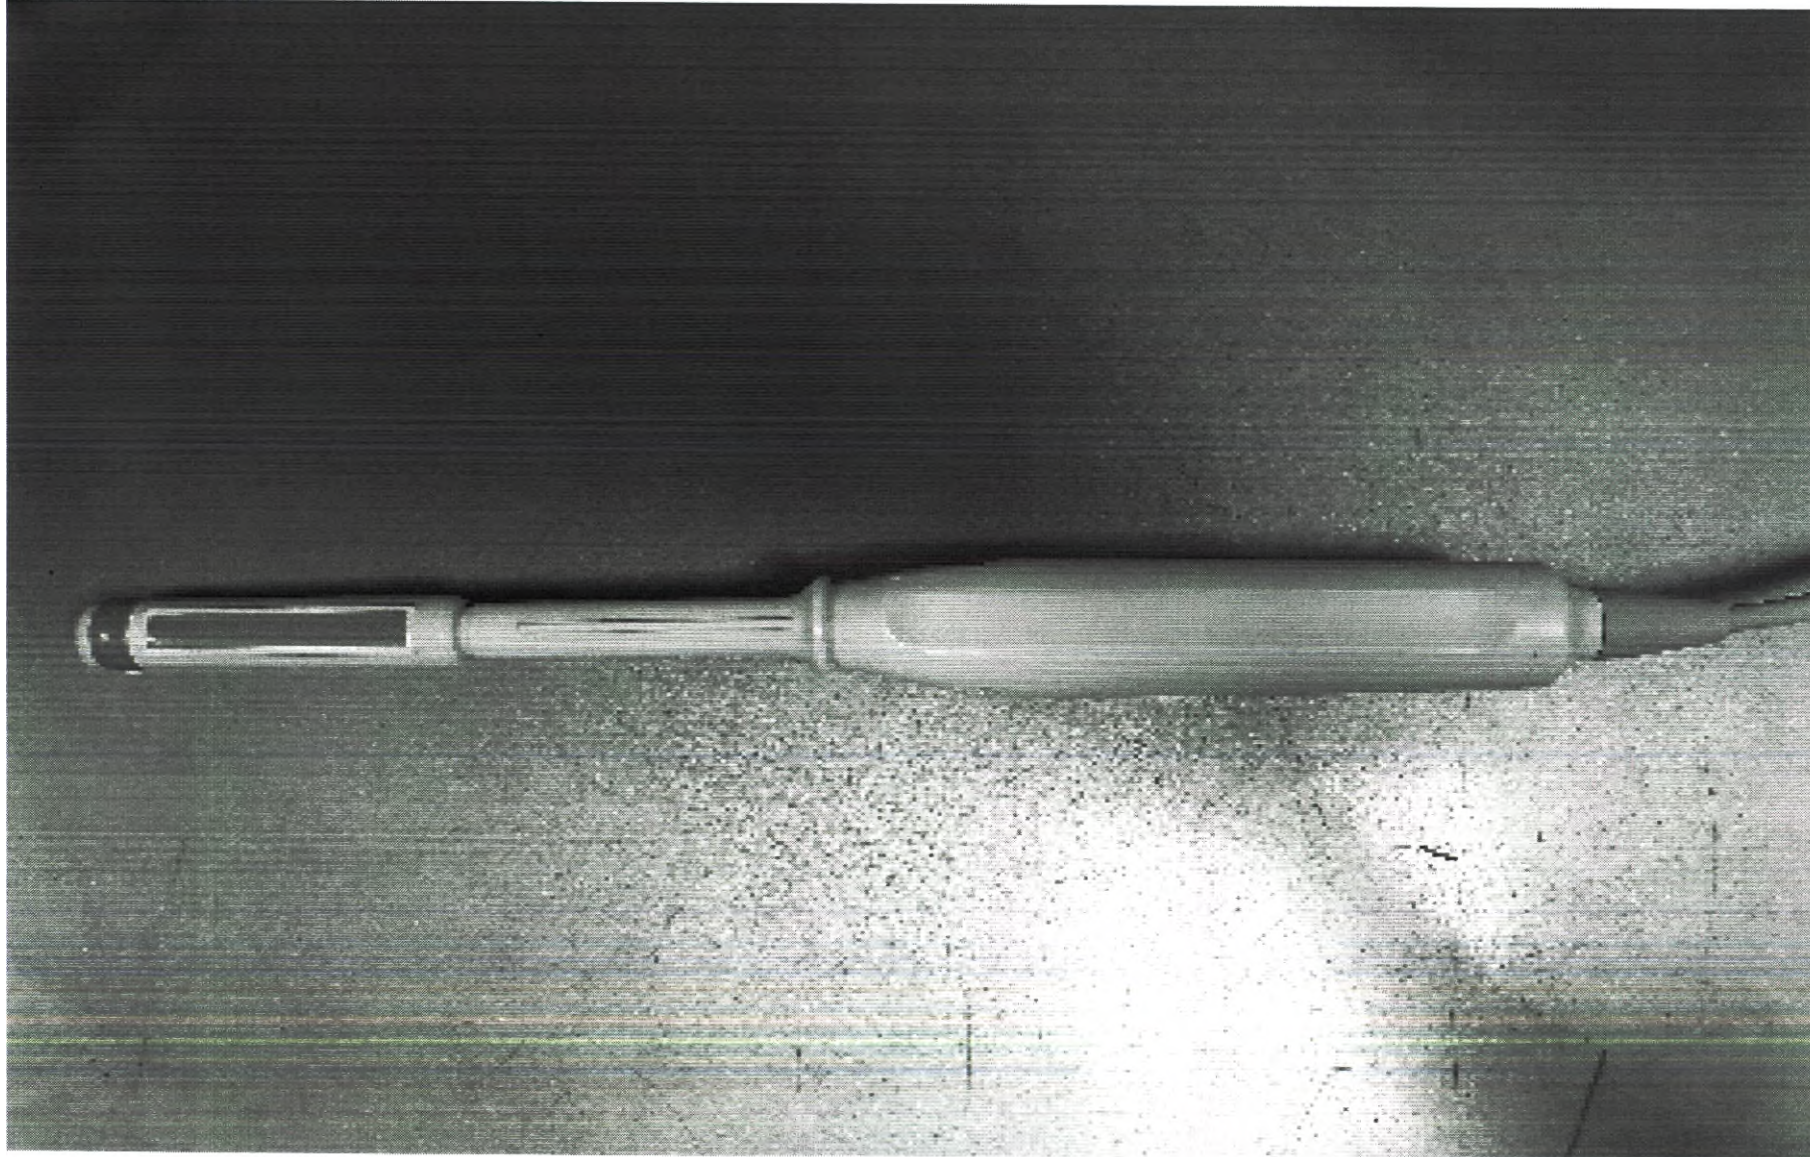


19. Датчик линейный биопсийный, модель PLU-308BTP, РУ №РЗН 2015/2361



20. Датчик линейный, модель PLU-704BT, РУ №РЗН 2015/2361

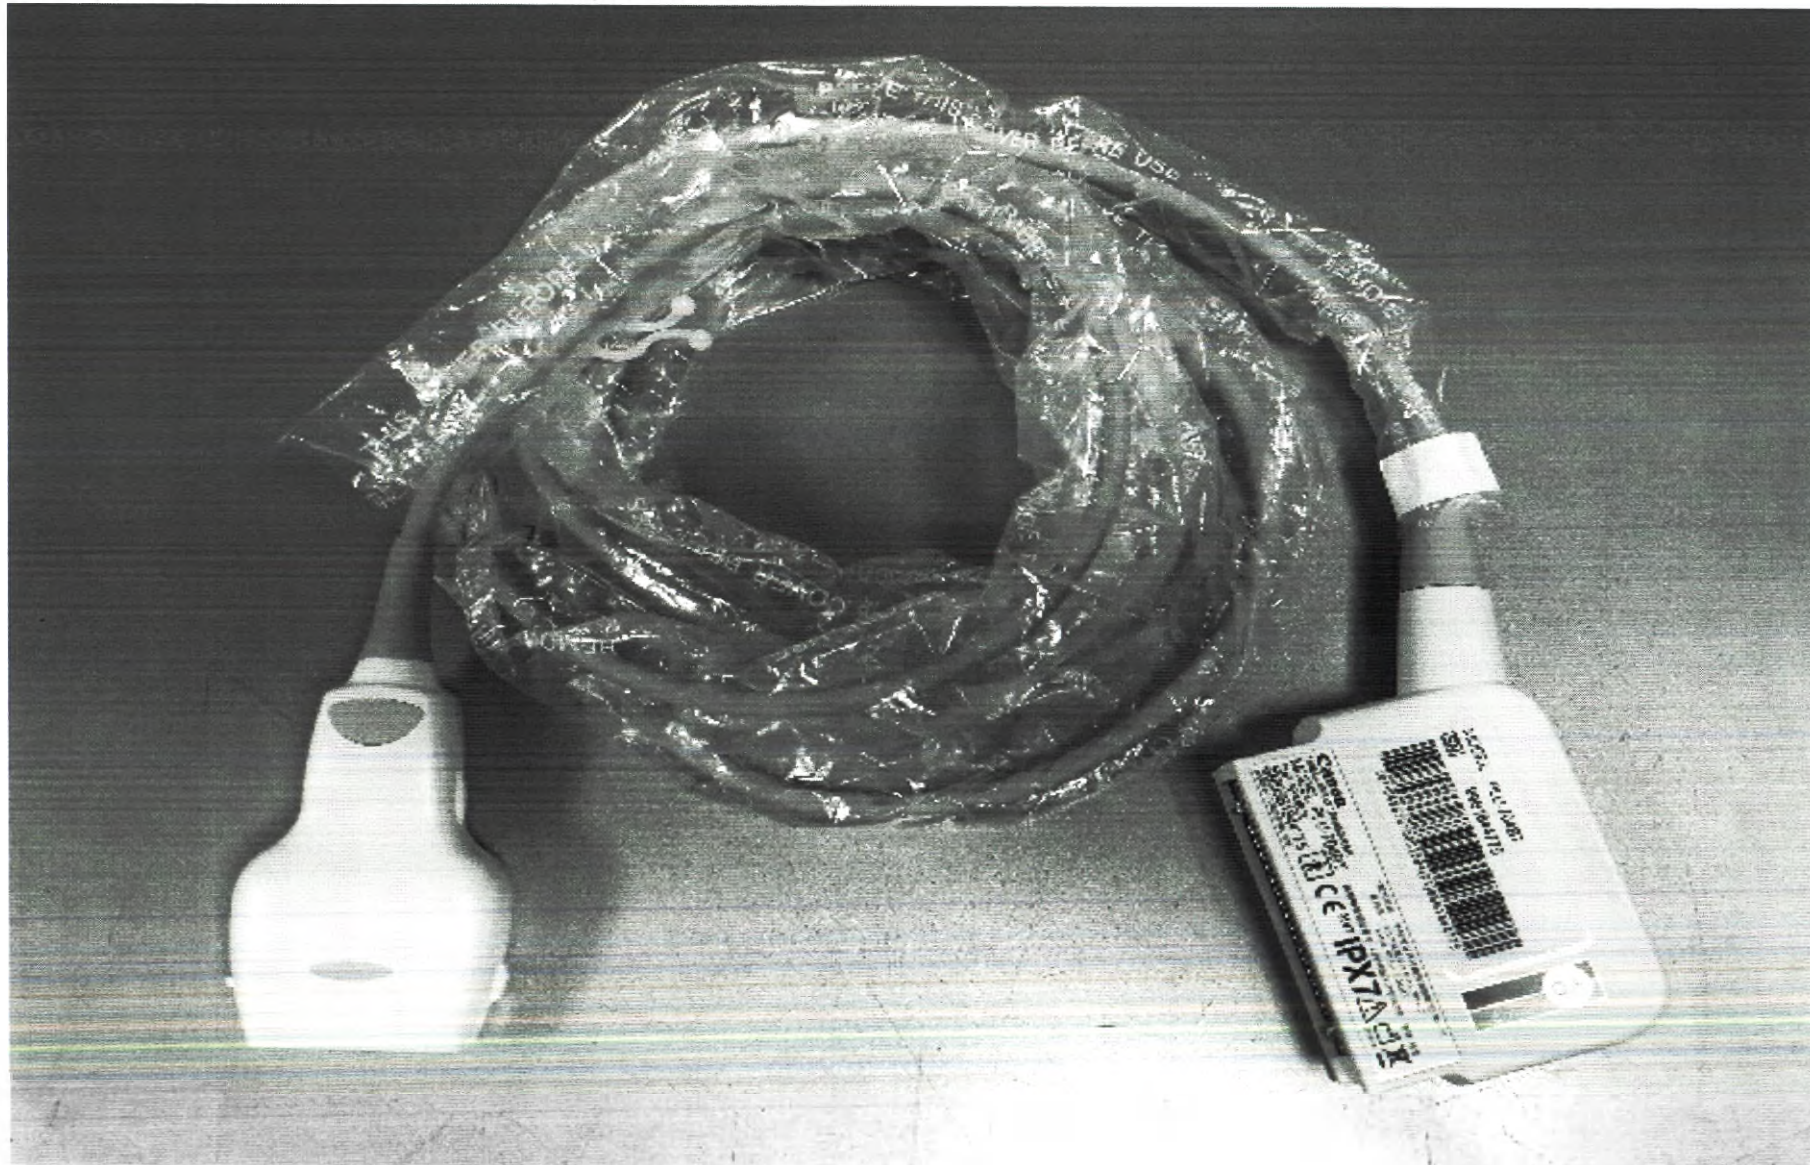


21. Датчик линейный, модель PLU-1005BT, РУ №РЗН 2015/2361

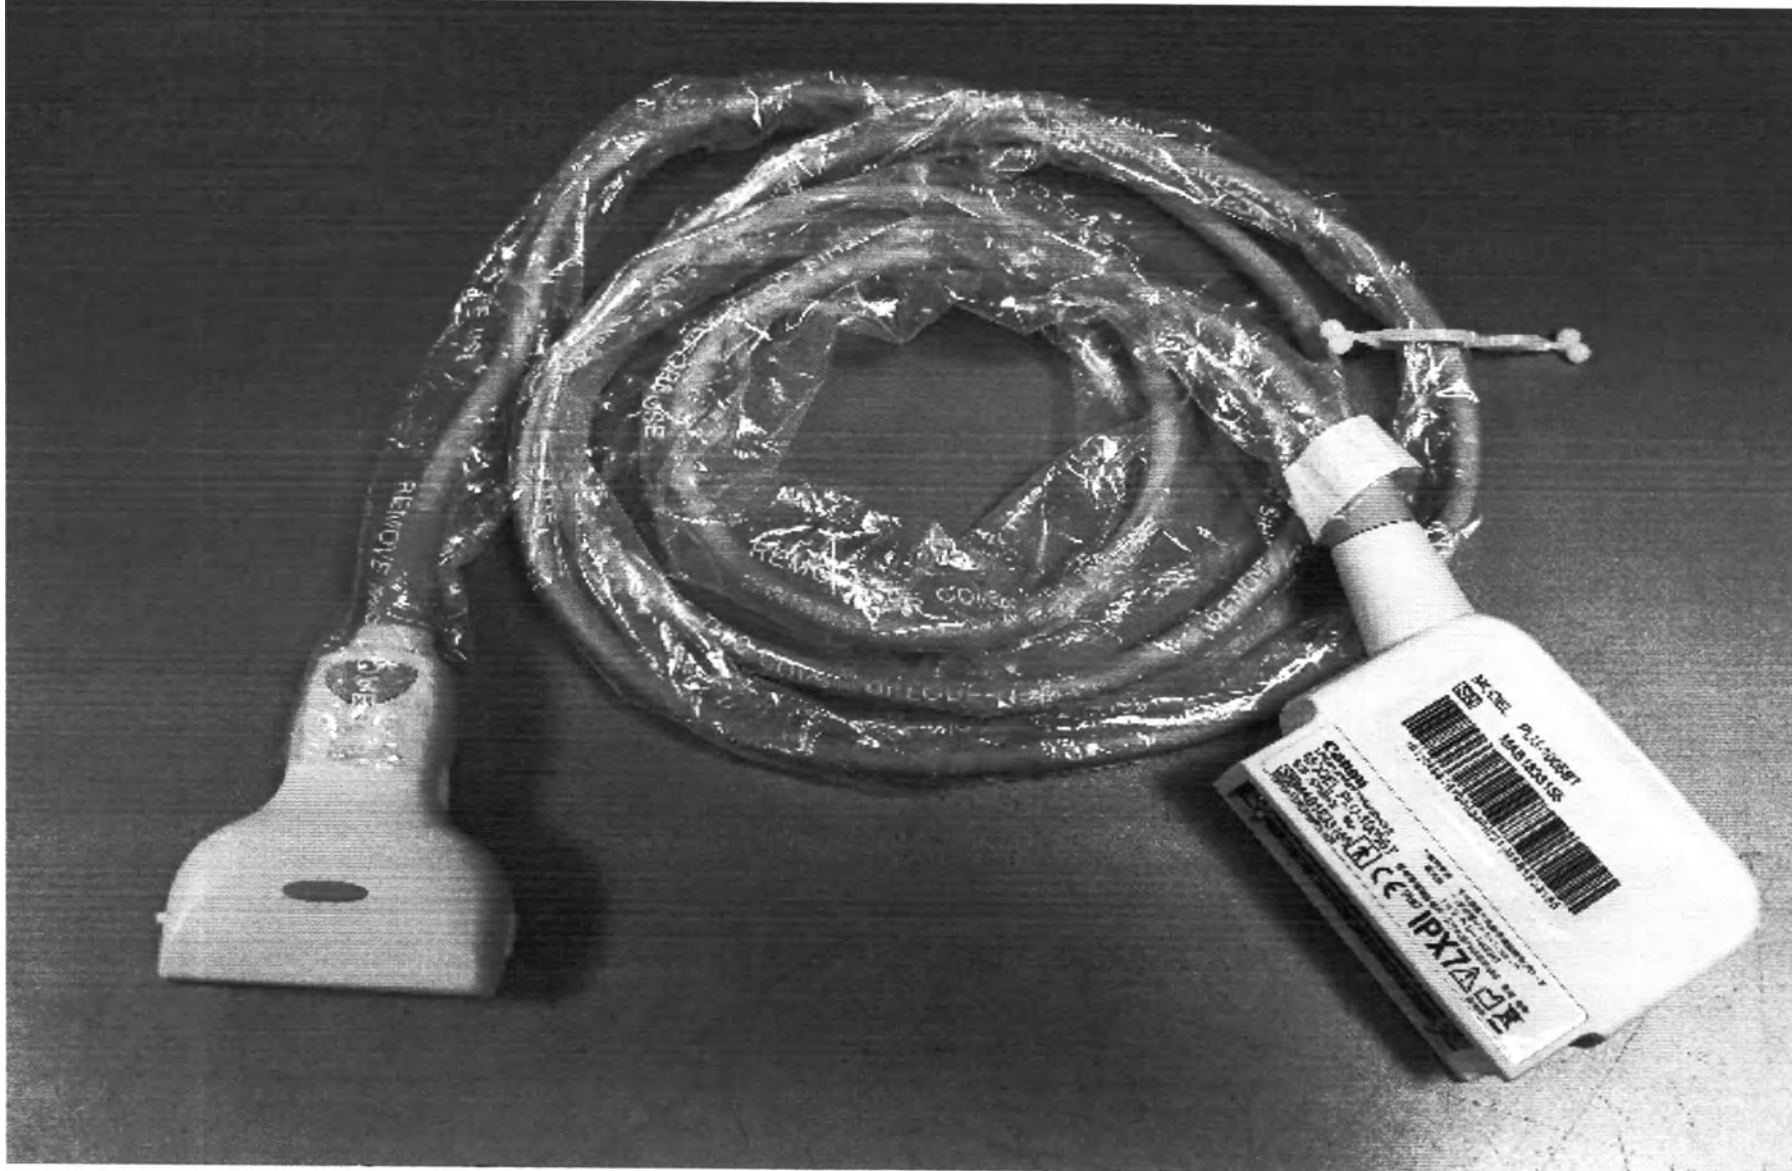


22. Датчик линейный, модель PLU-1202BT, РУ №РЗН 2015/2361




23. Датчик линейный, модель PLU-1204BT, РУ №РЗН 2015/2361

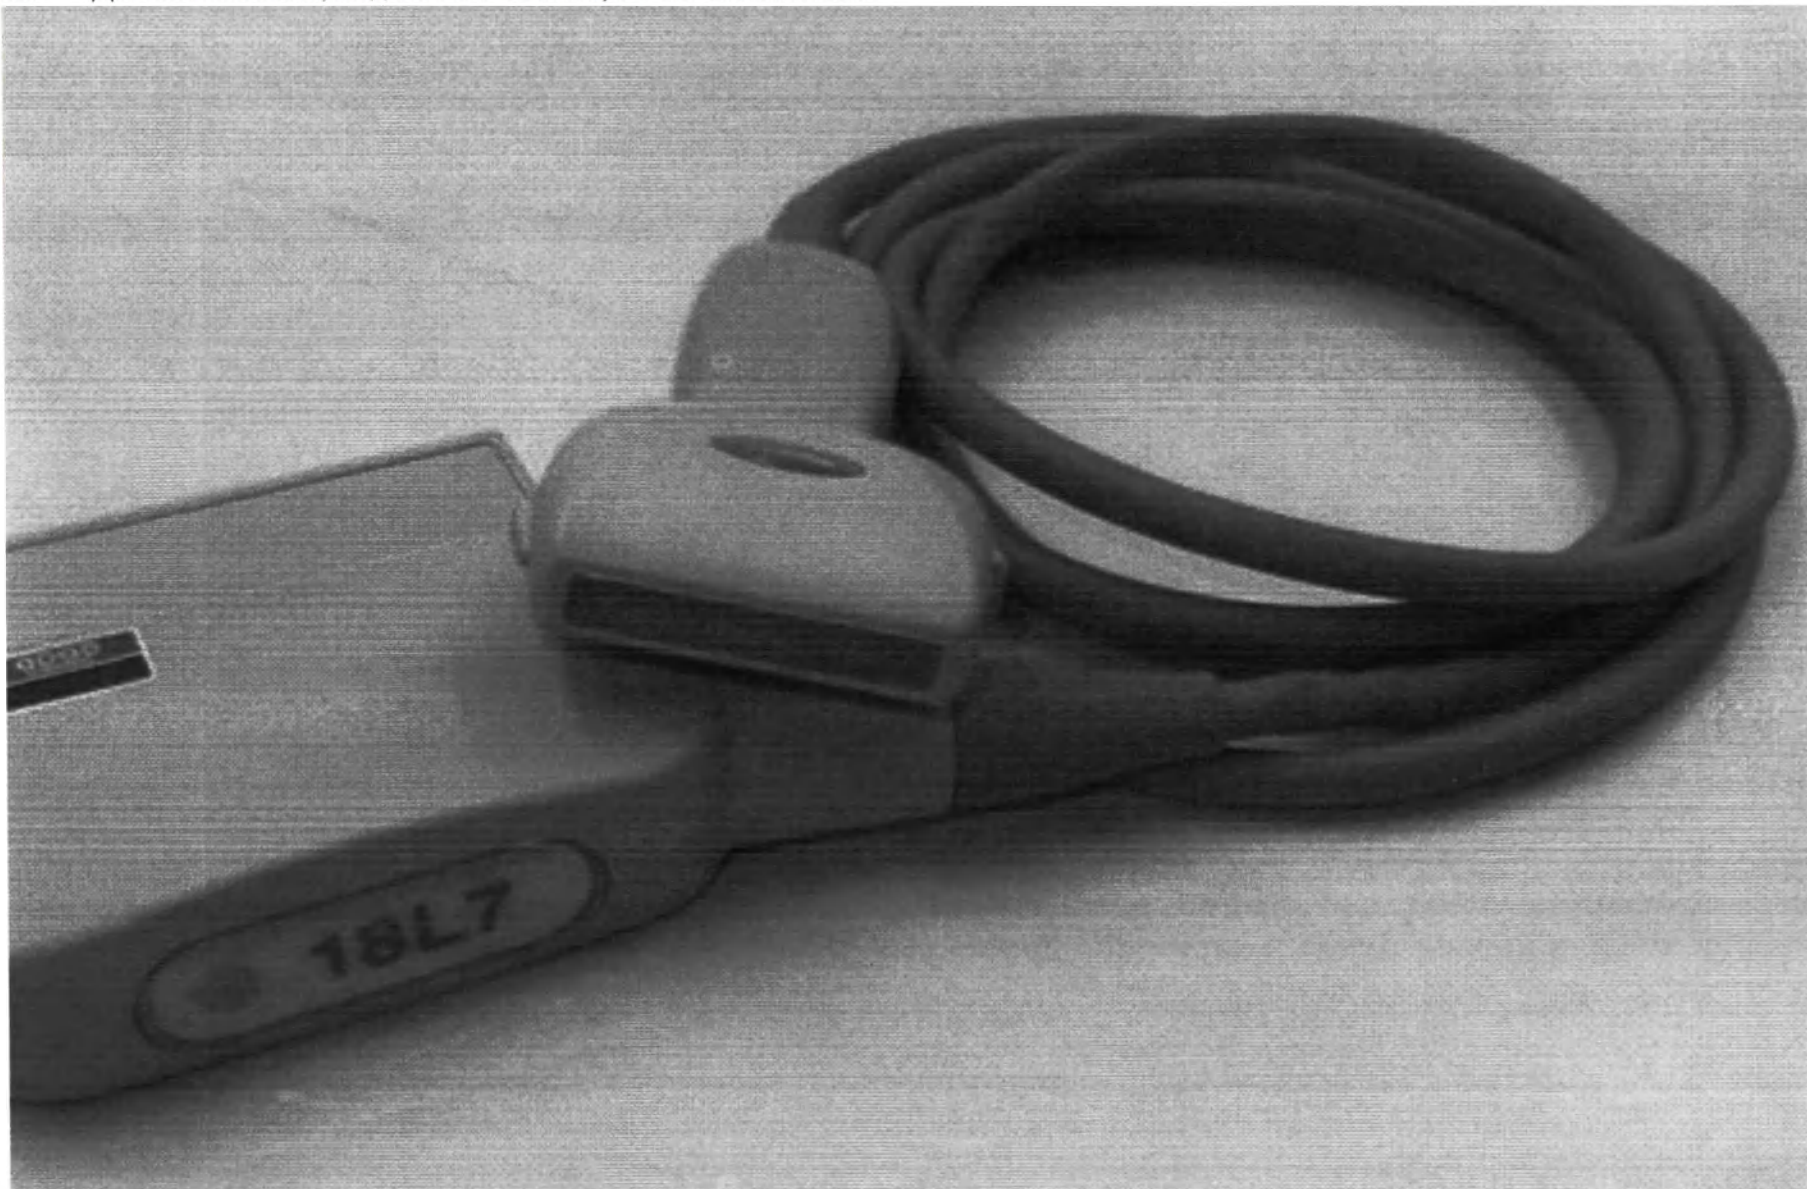

24. Датчик транспищеводный мультиплановый, модель РЕТ-512MD, РУ №РЗН 2015/2361

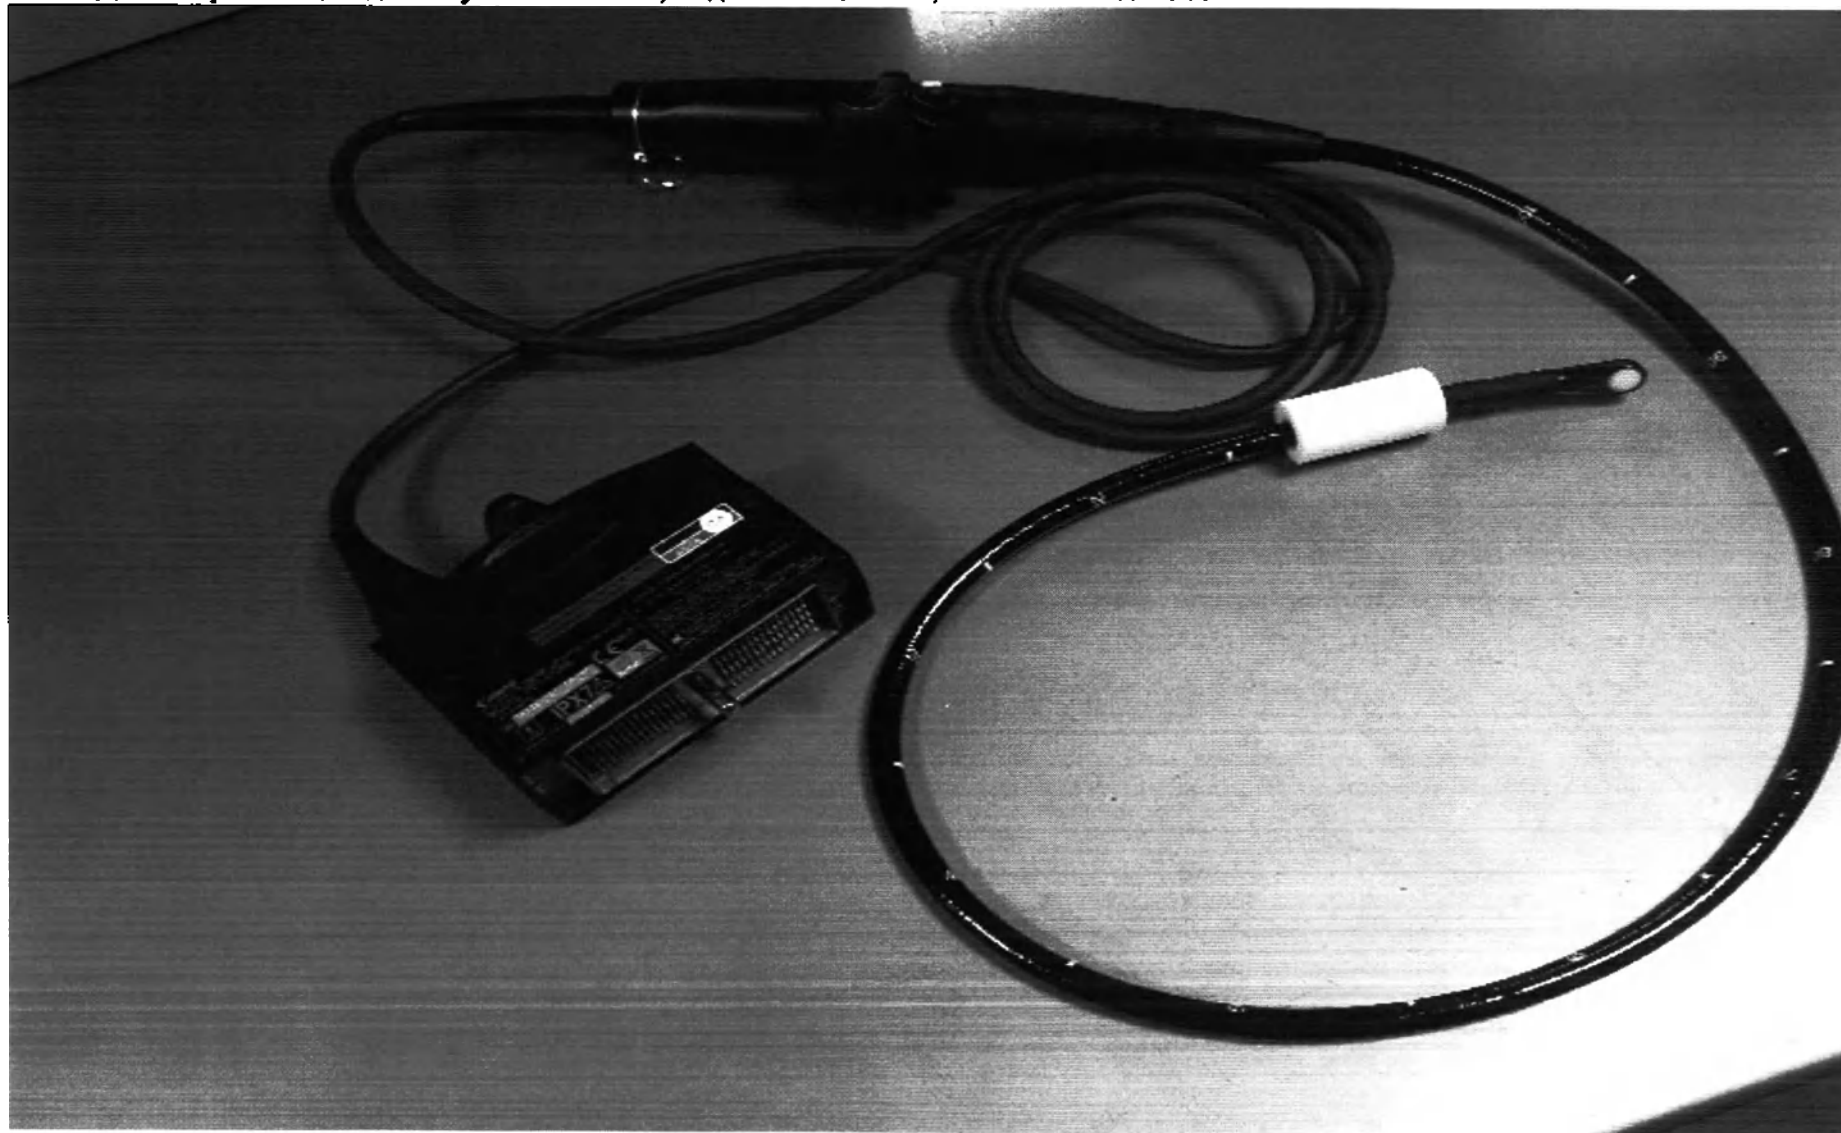


25. Датчик линейный, модель PET-805LA, РУ №РЗН 2015/2361

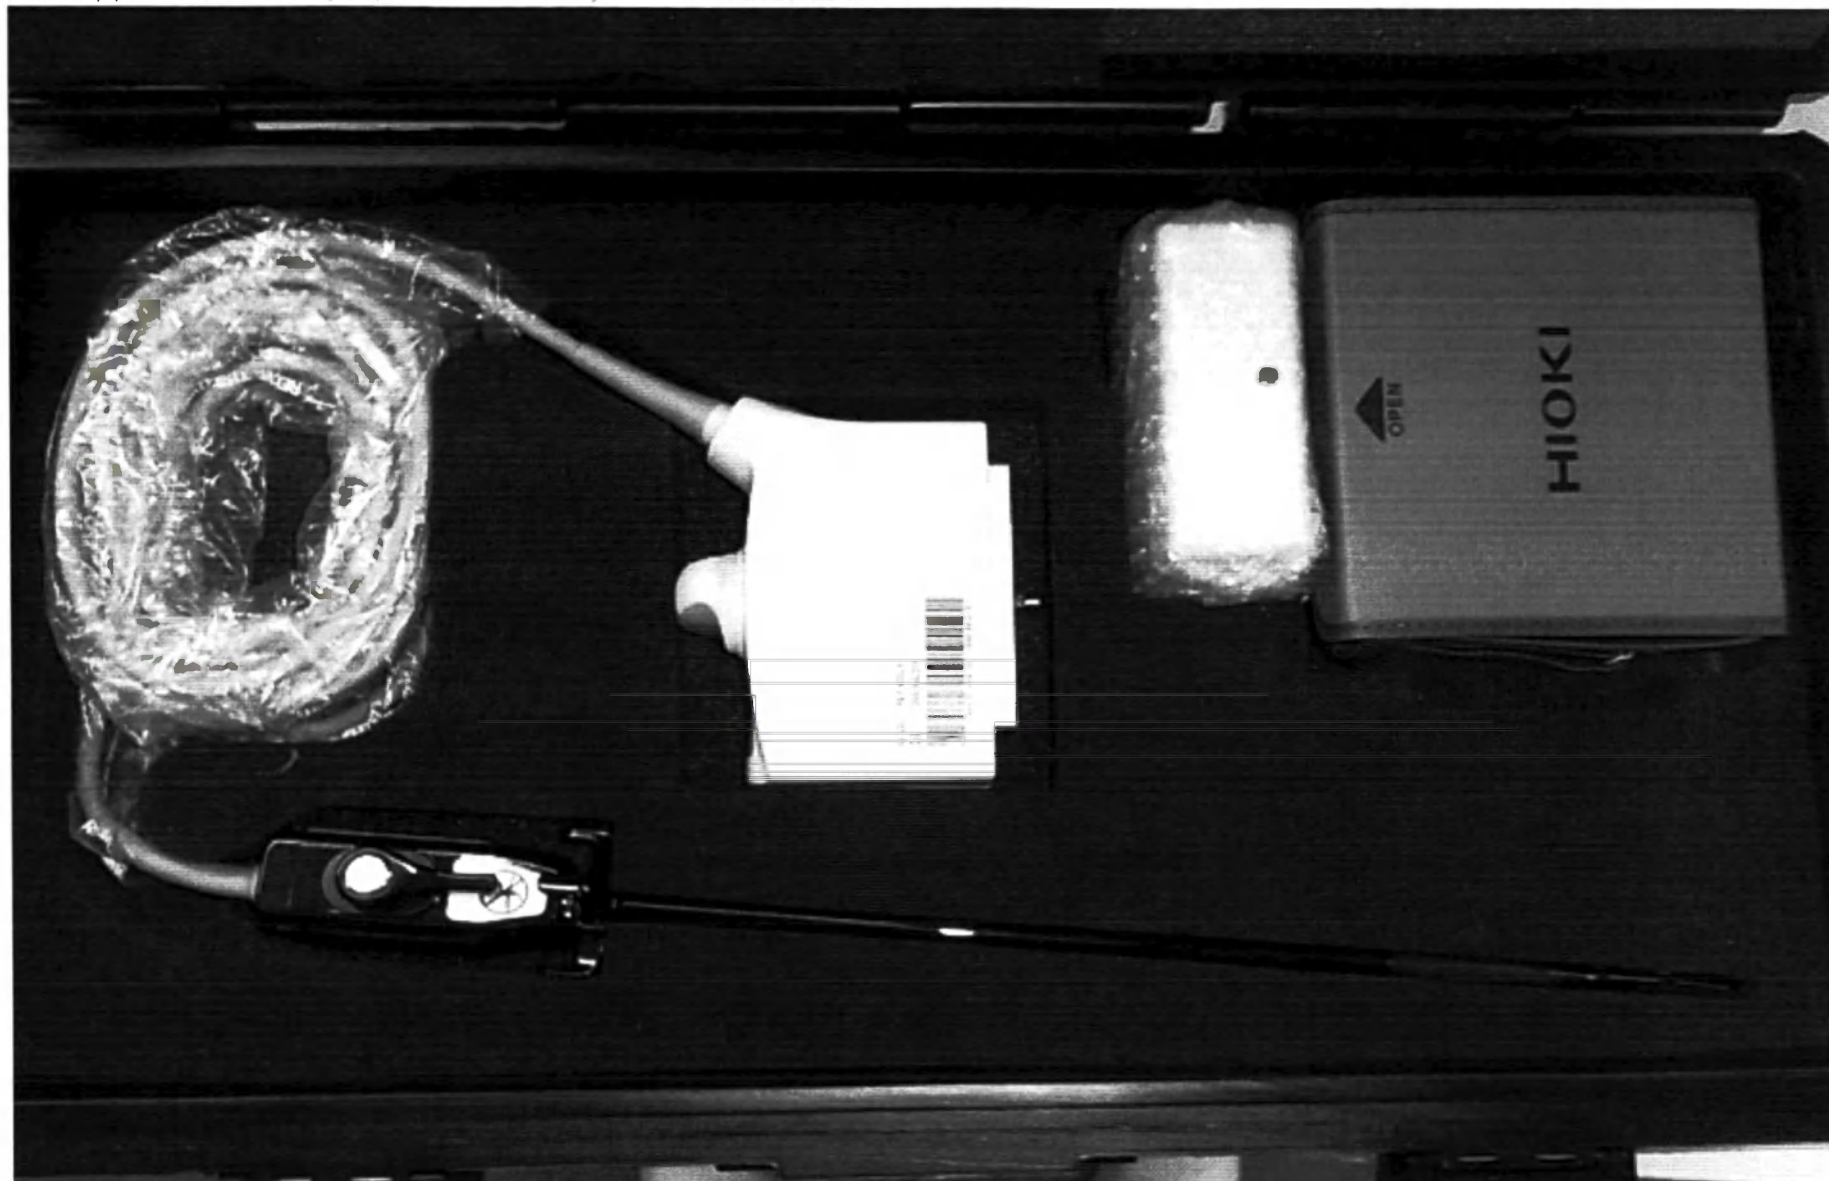


26. Датчик карандашный, модель PC-20M, РУ №РЗН 2015/2361



27. Датчик карандашный, модель PC-50M, РУ №РЗН 2015/2361

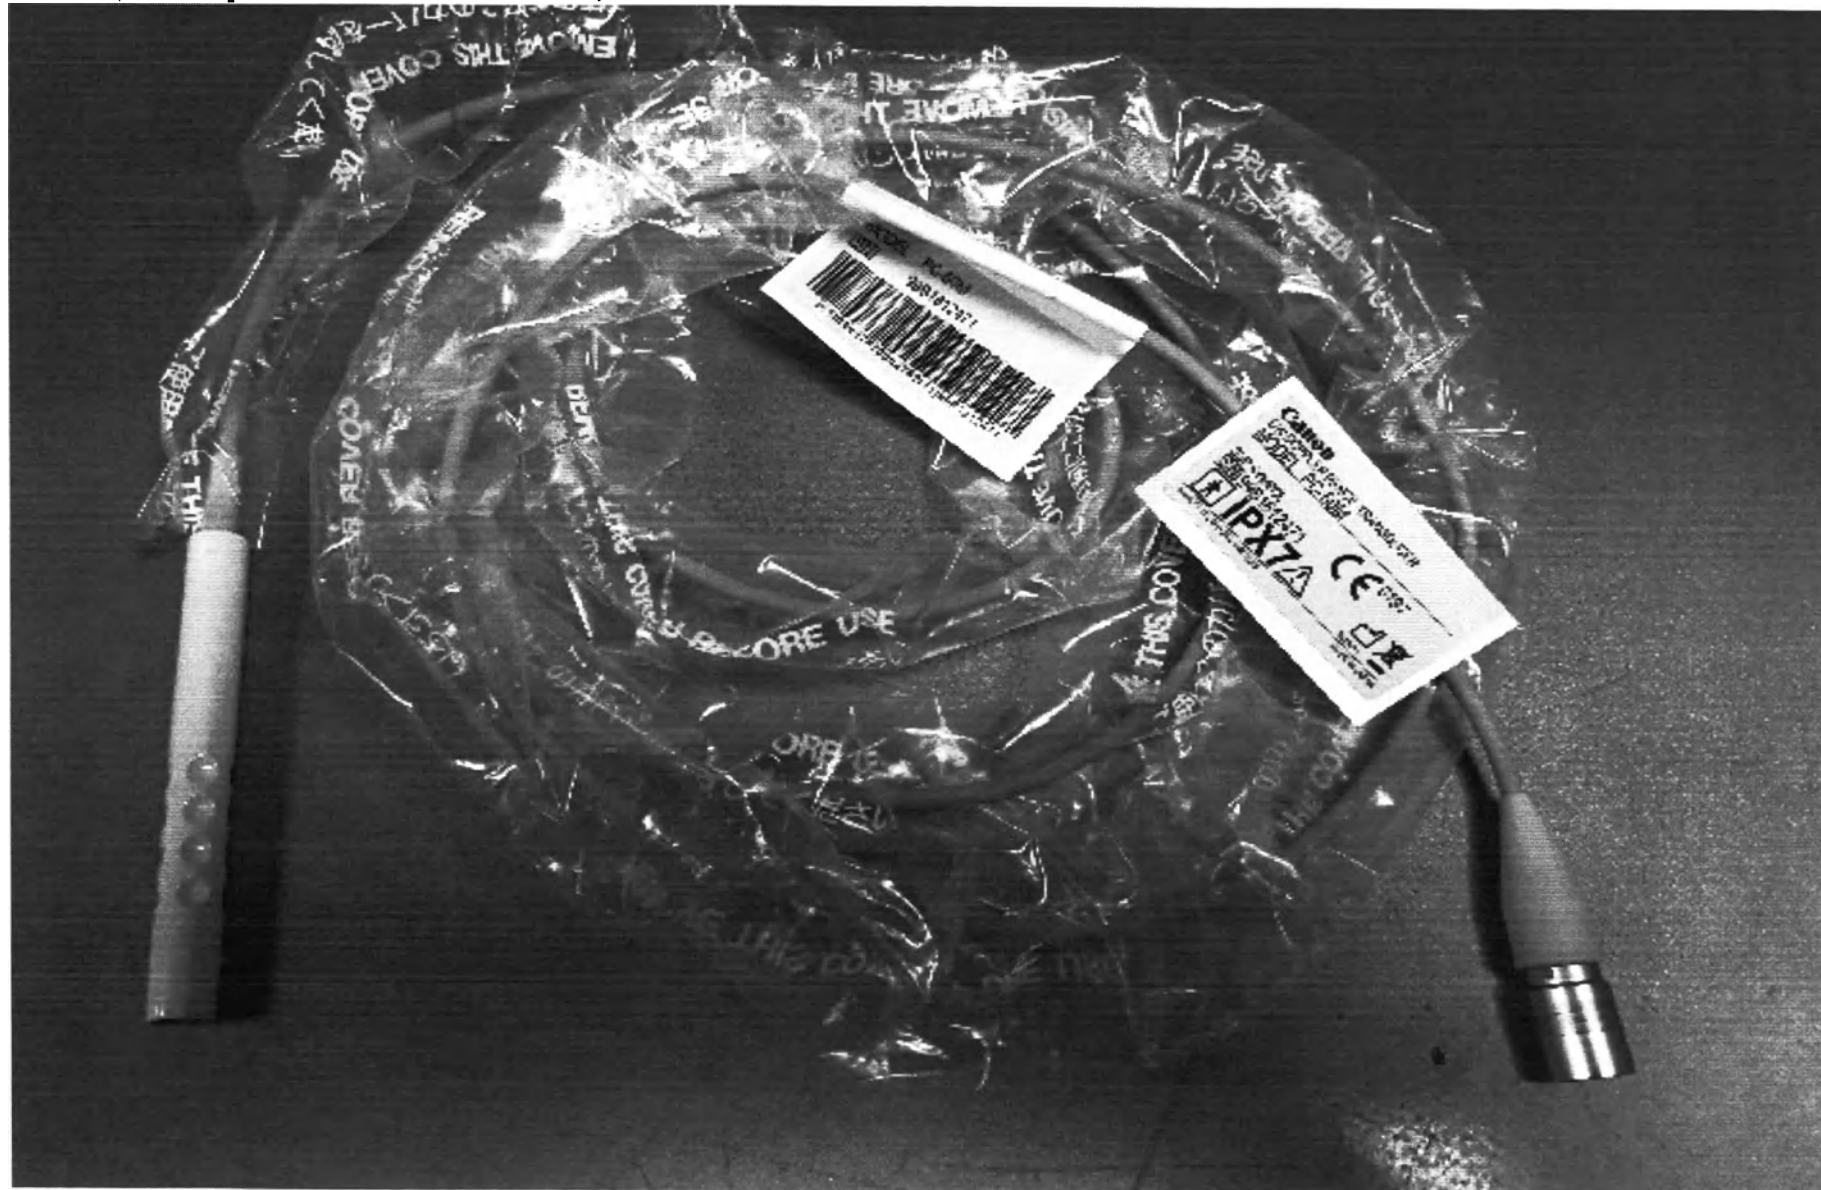

28. Кабель питания

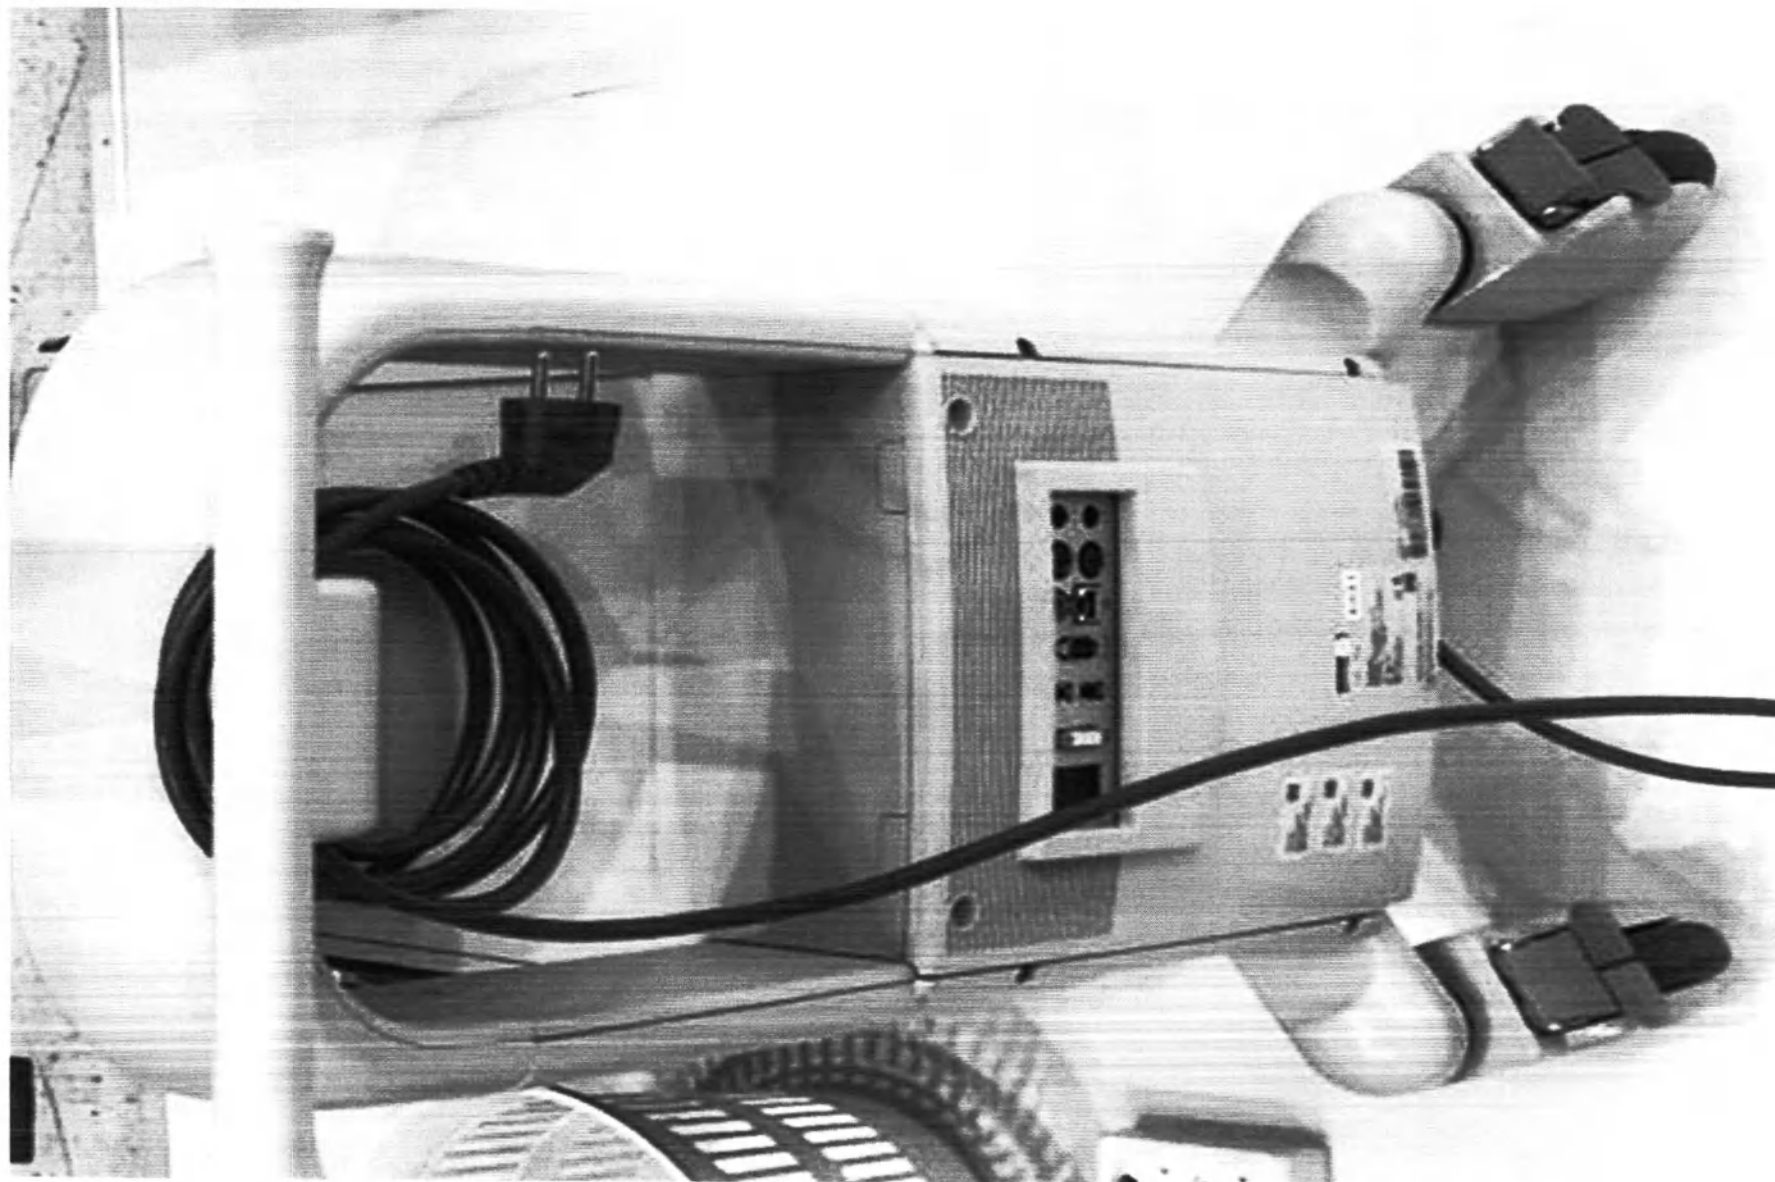

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СИСТЕМЫ

Xario 200G / Xario 100G

МОДЕЛИ CUS-X200G/CUS-X100G

[ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ]

(2B771-310RU*G)

ВНИМАНИЕ!

Федеральный закон США разрешает
приобретение и использование этого устройства
только врачом или по предписанию врача.

ВАЖНО!

Перед работой с оборудованием изучите
и усвойте настоящее руководство. После
прочтения держите руководство в легкодоступном
месте.

CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION


©CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION 2018-2019

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ


Выпущено: 2019-05

Принадлежности:


1. Модуль непрерывно-волновой доплеровграфии (CW)

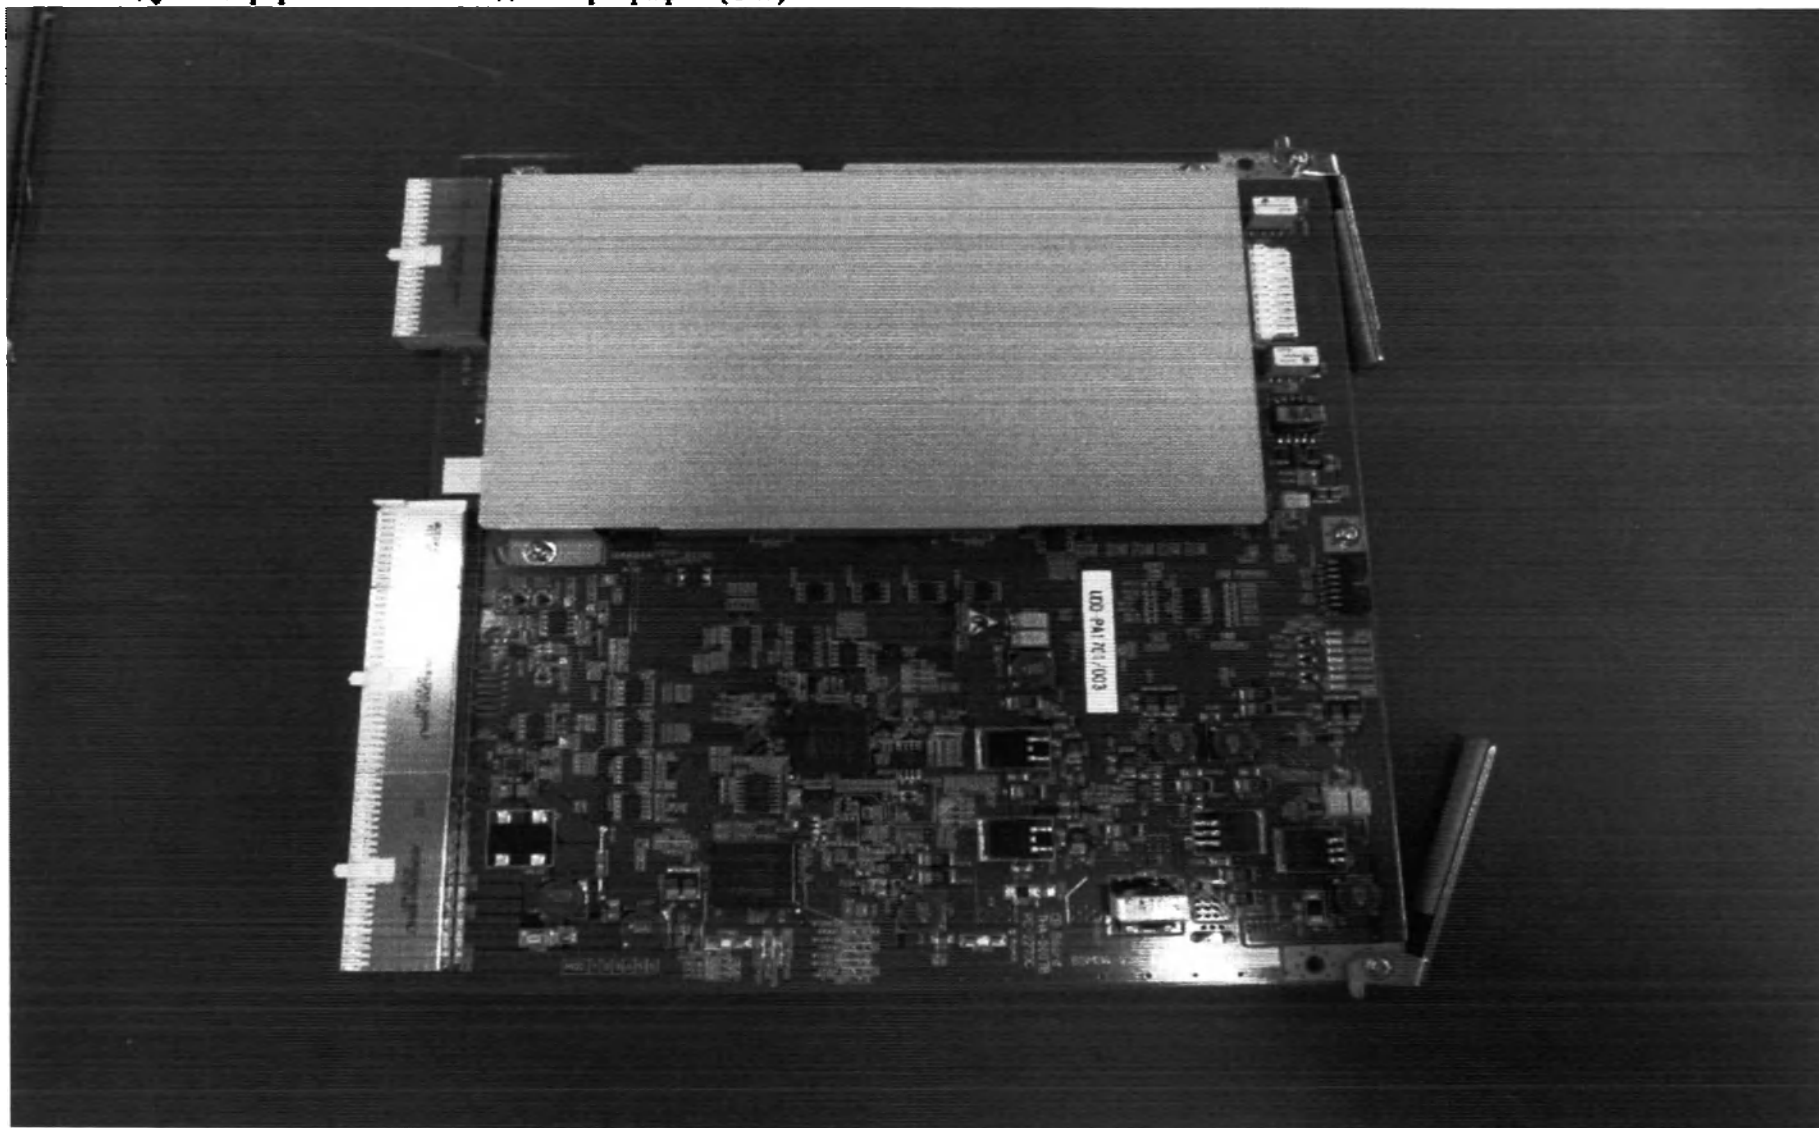

2. Модуль непрерывно-волновой доплеровграфии (CW) с разъемом карандашного датчика

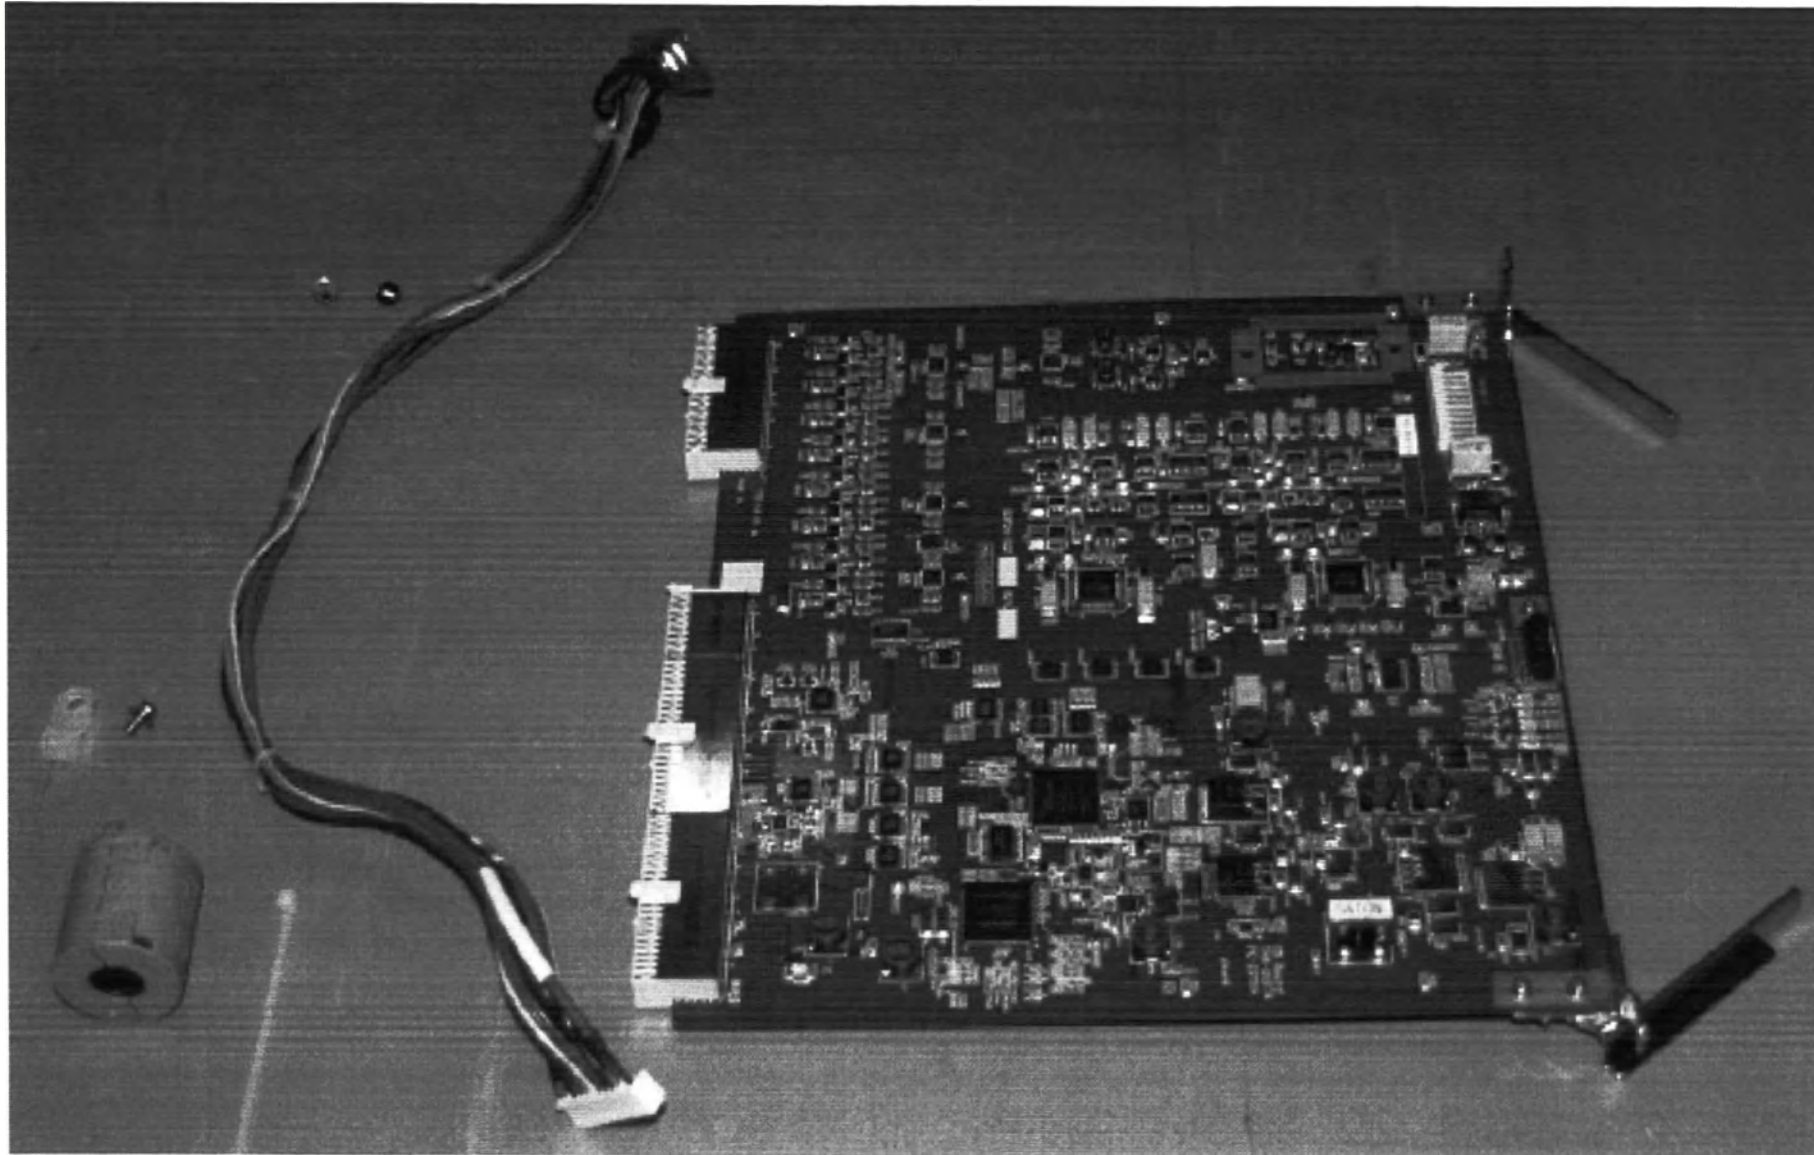


3. Модуль референсного сигнала

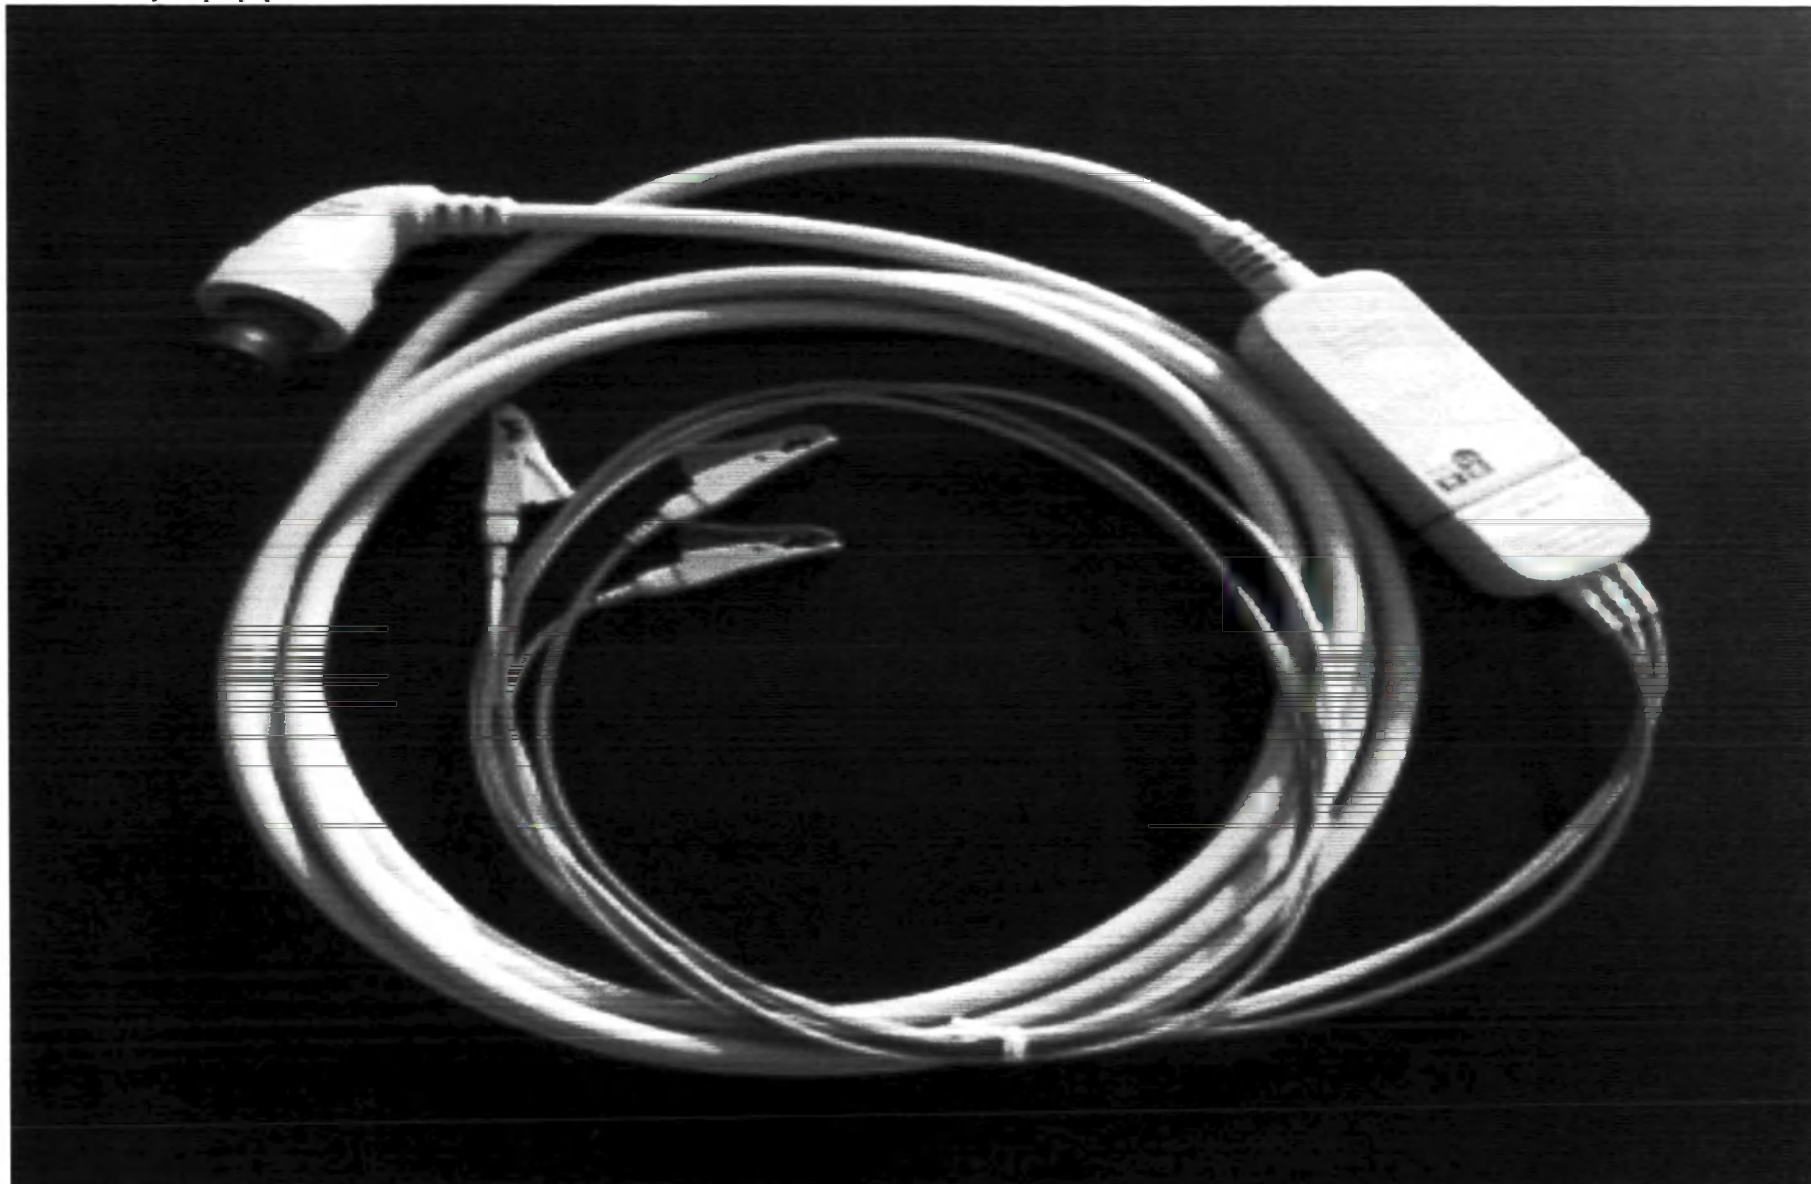


4. Программное приложение для стресс-эхокардиографии (Stress Echo)




5. Программное приложение для отслеживания движения стенок миокарда в 2D режиме (2D Wall Motion Tracking)

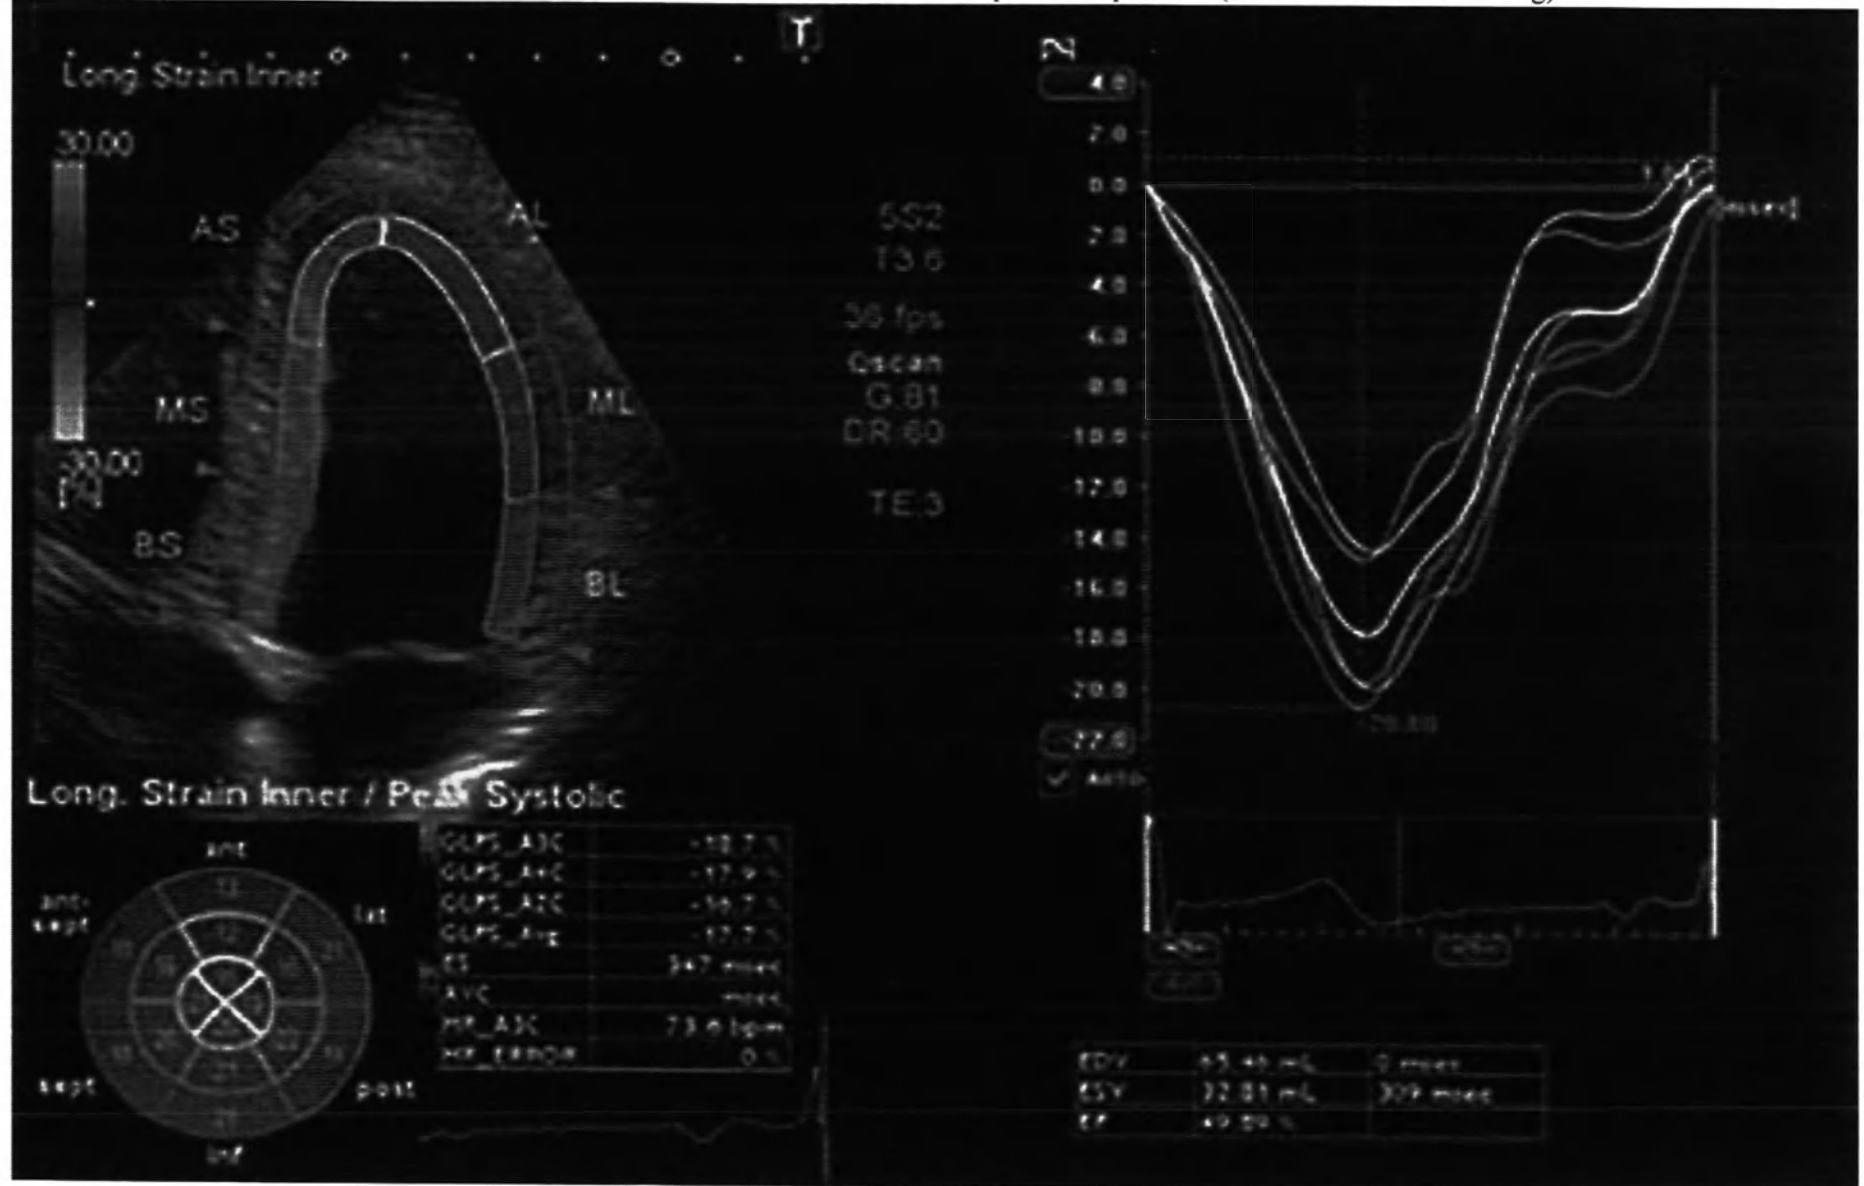


6. Держатель для транспищеводного датчика

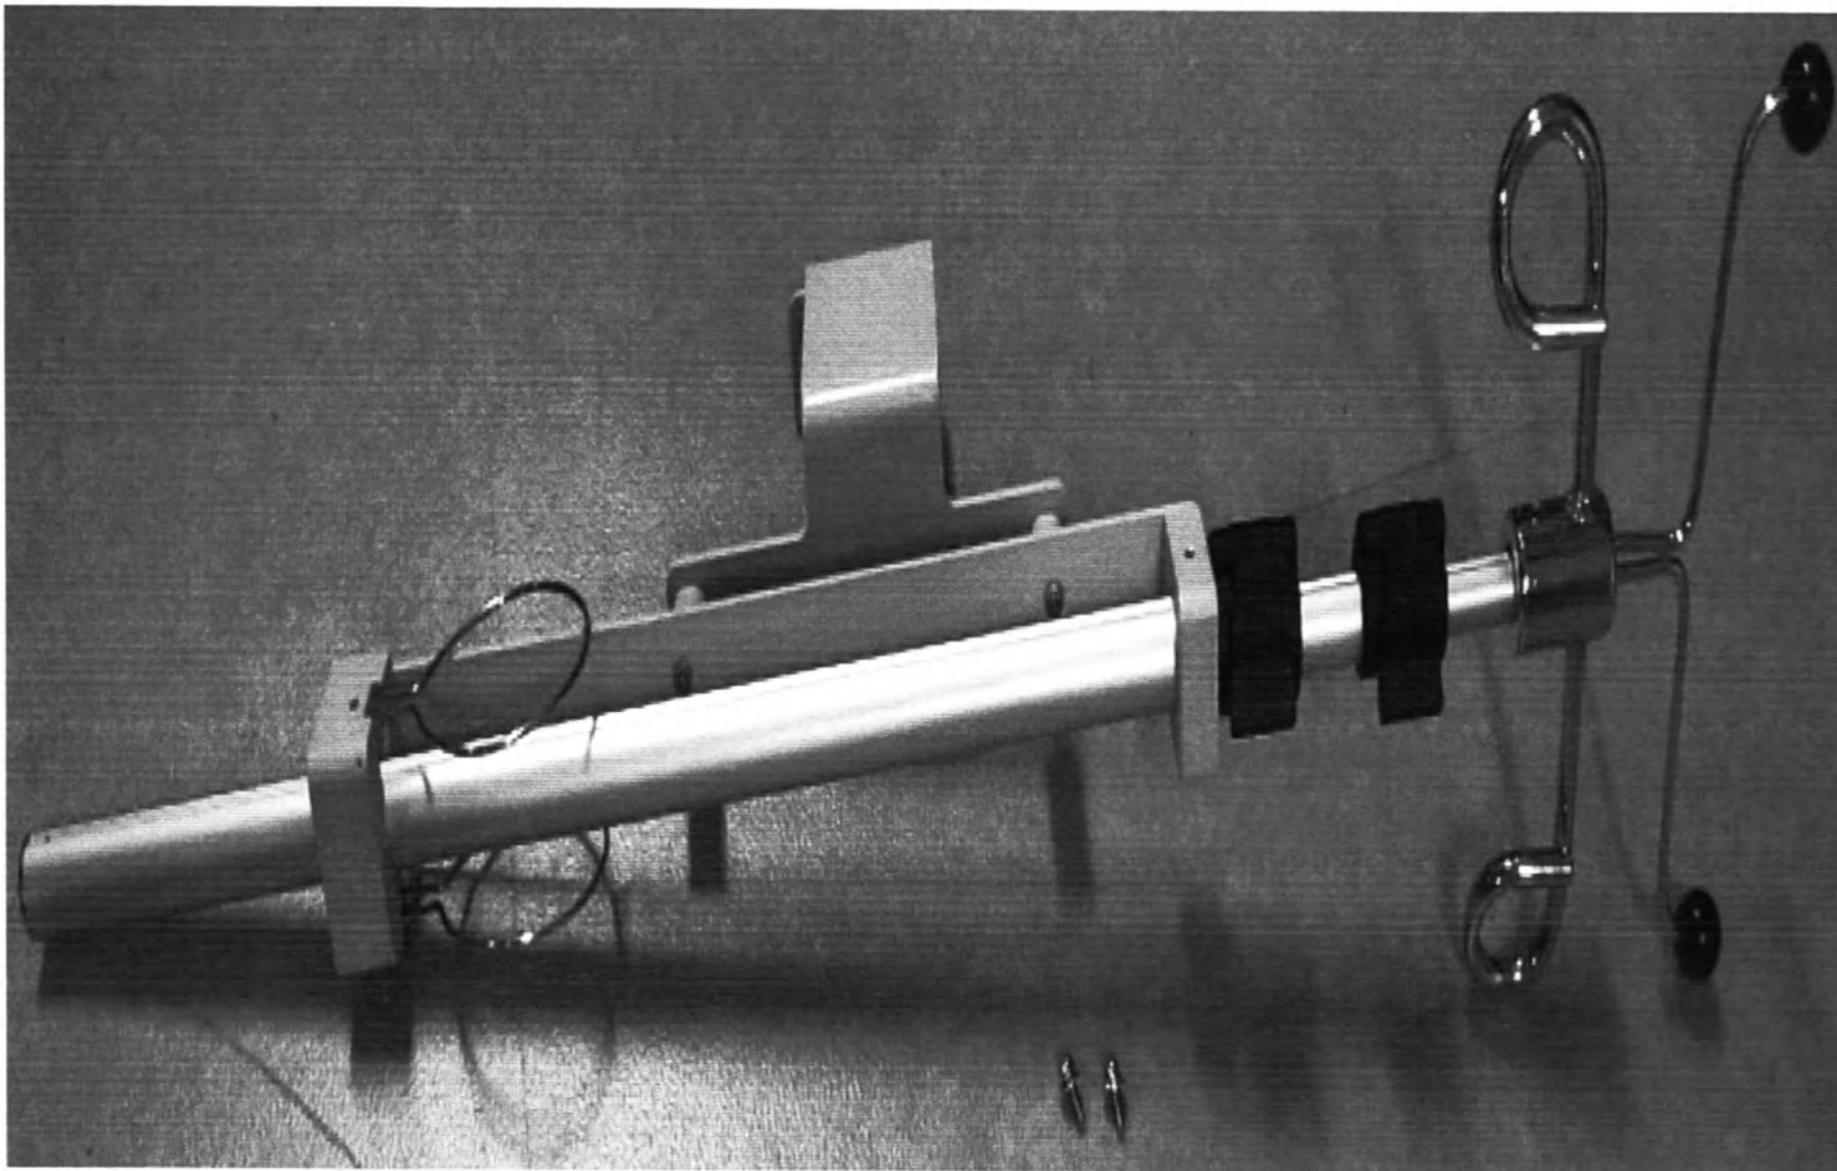

7. Программное приложение для анатомического М-режима (Flex-M)

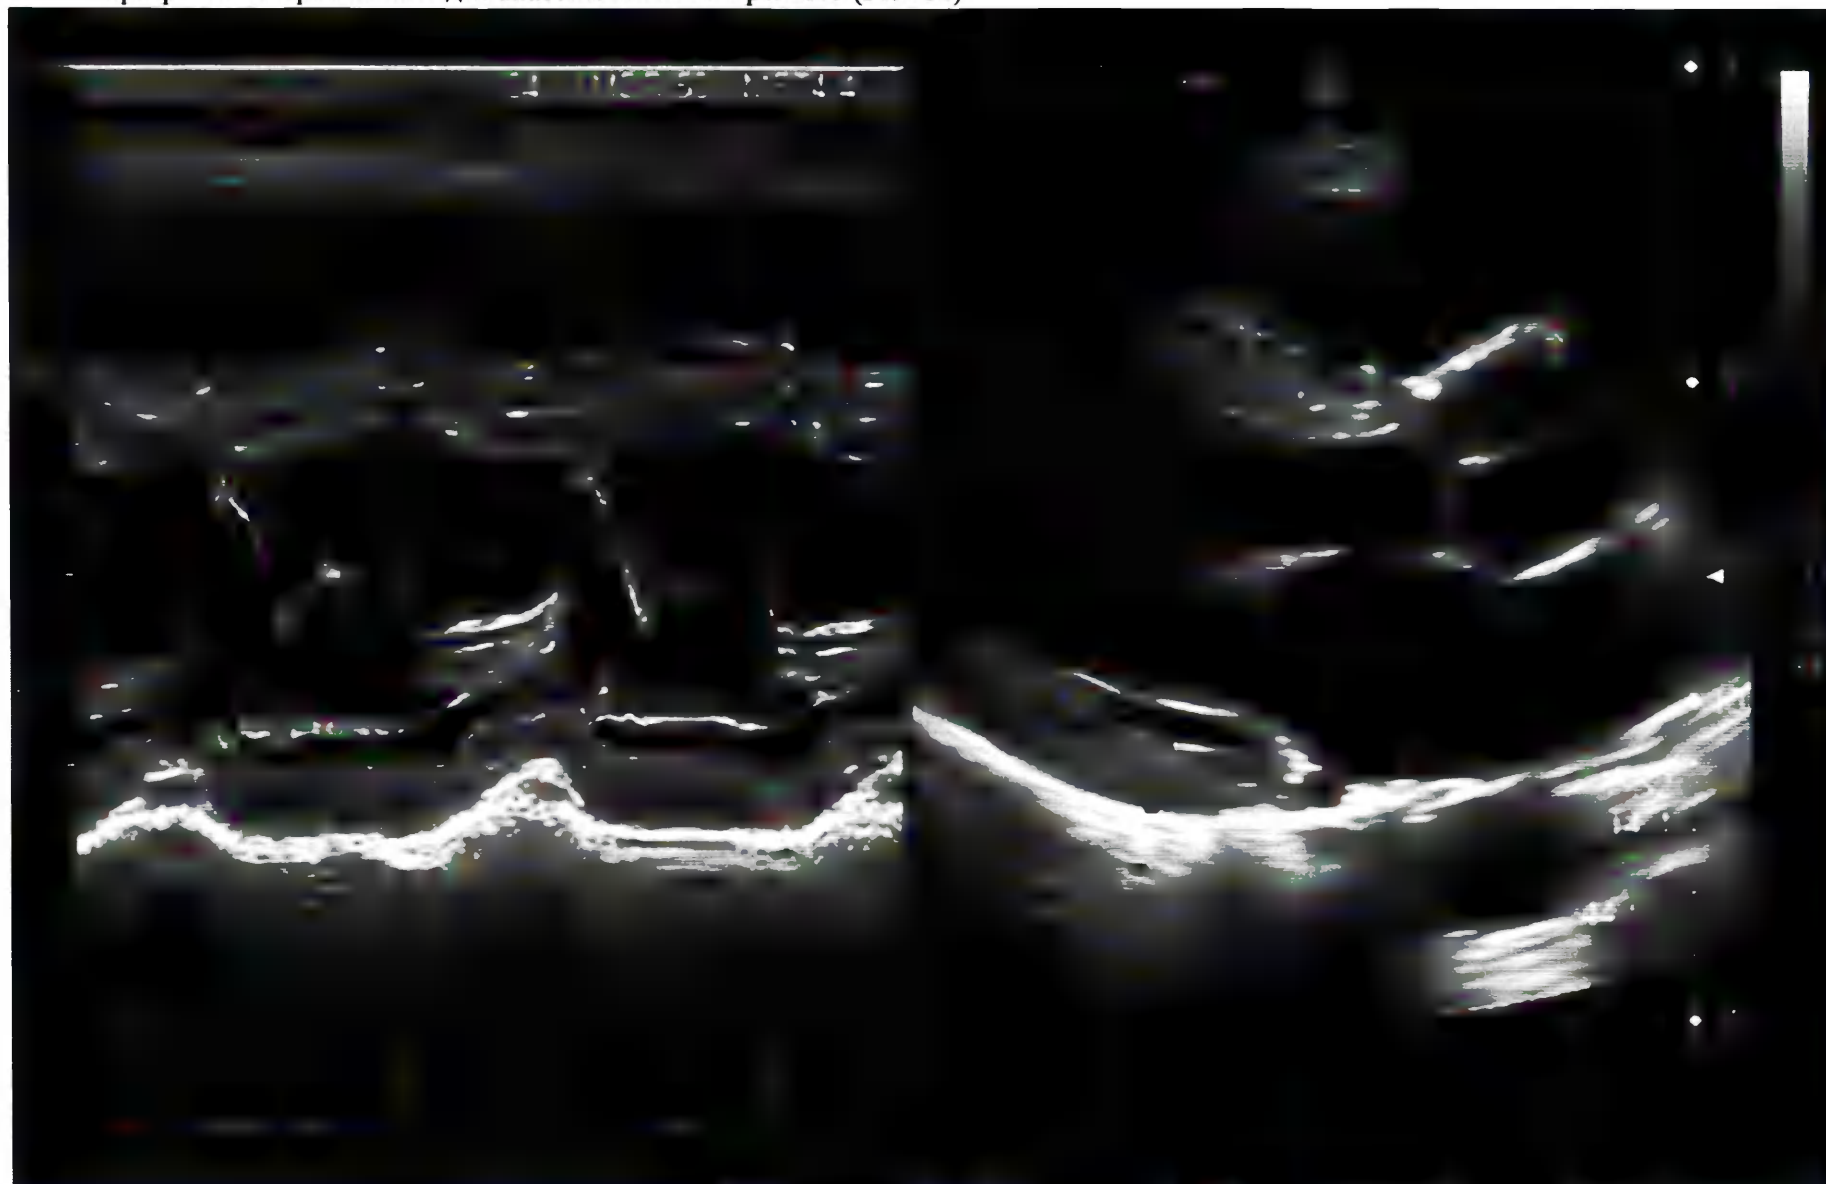


8. Программное приложение для исследования с контрастами (CHI)

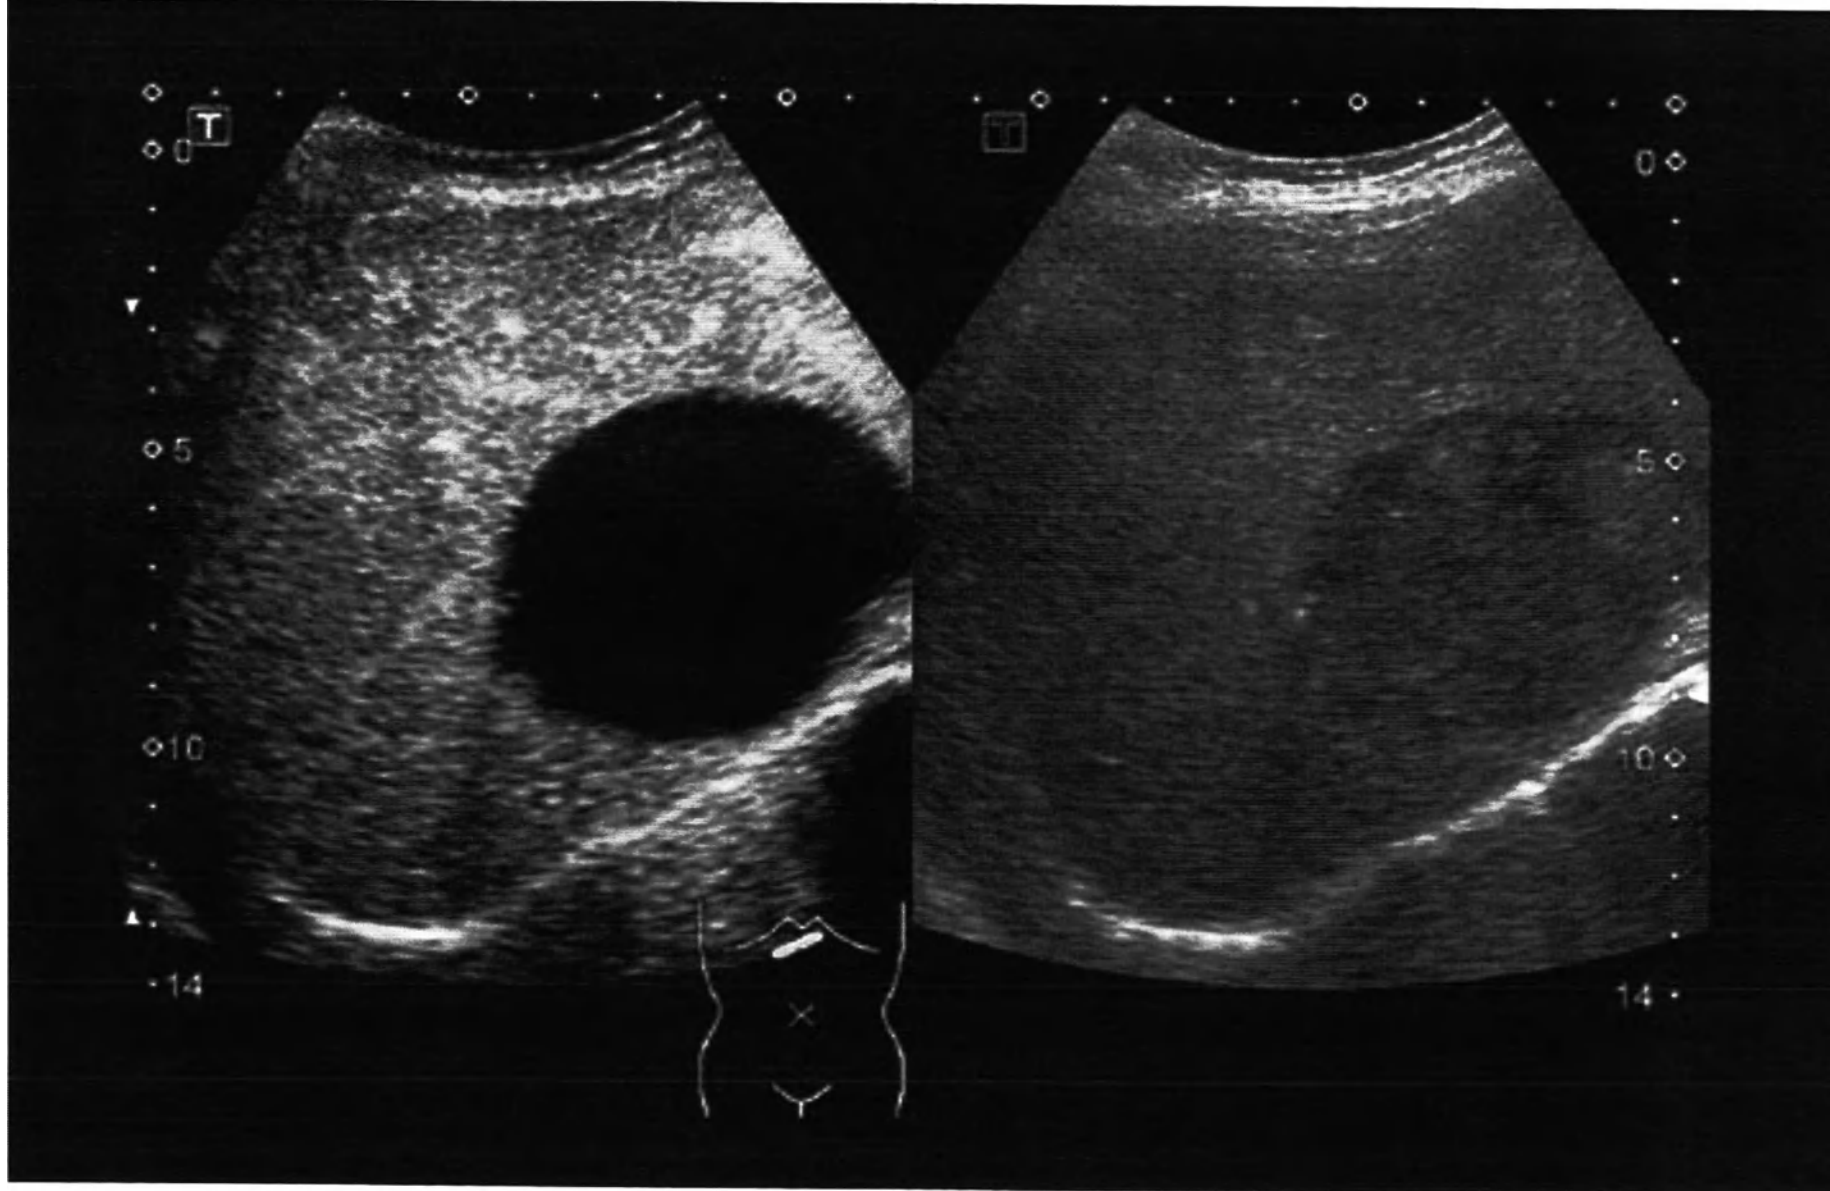

10. Программное приложение для визуализации сдвиговой волны (Shear wave)




11. Модуль функции 4D

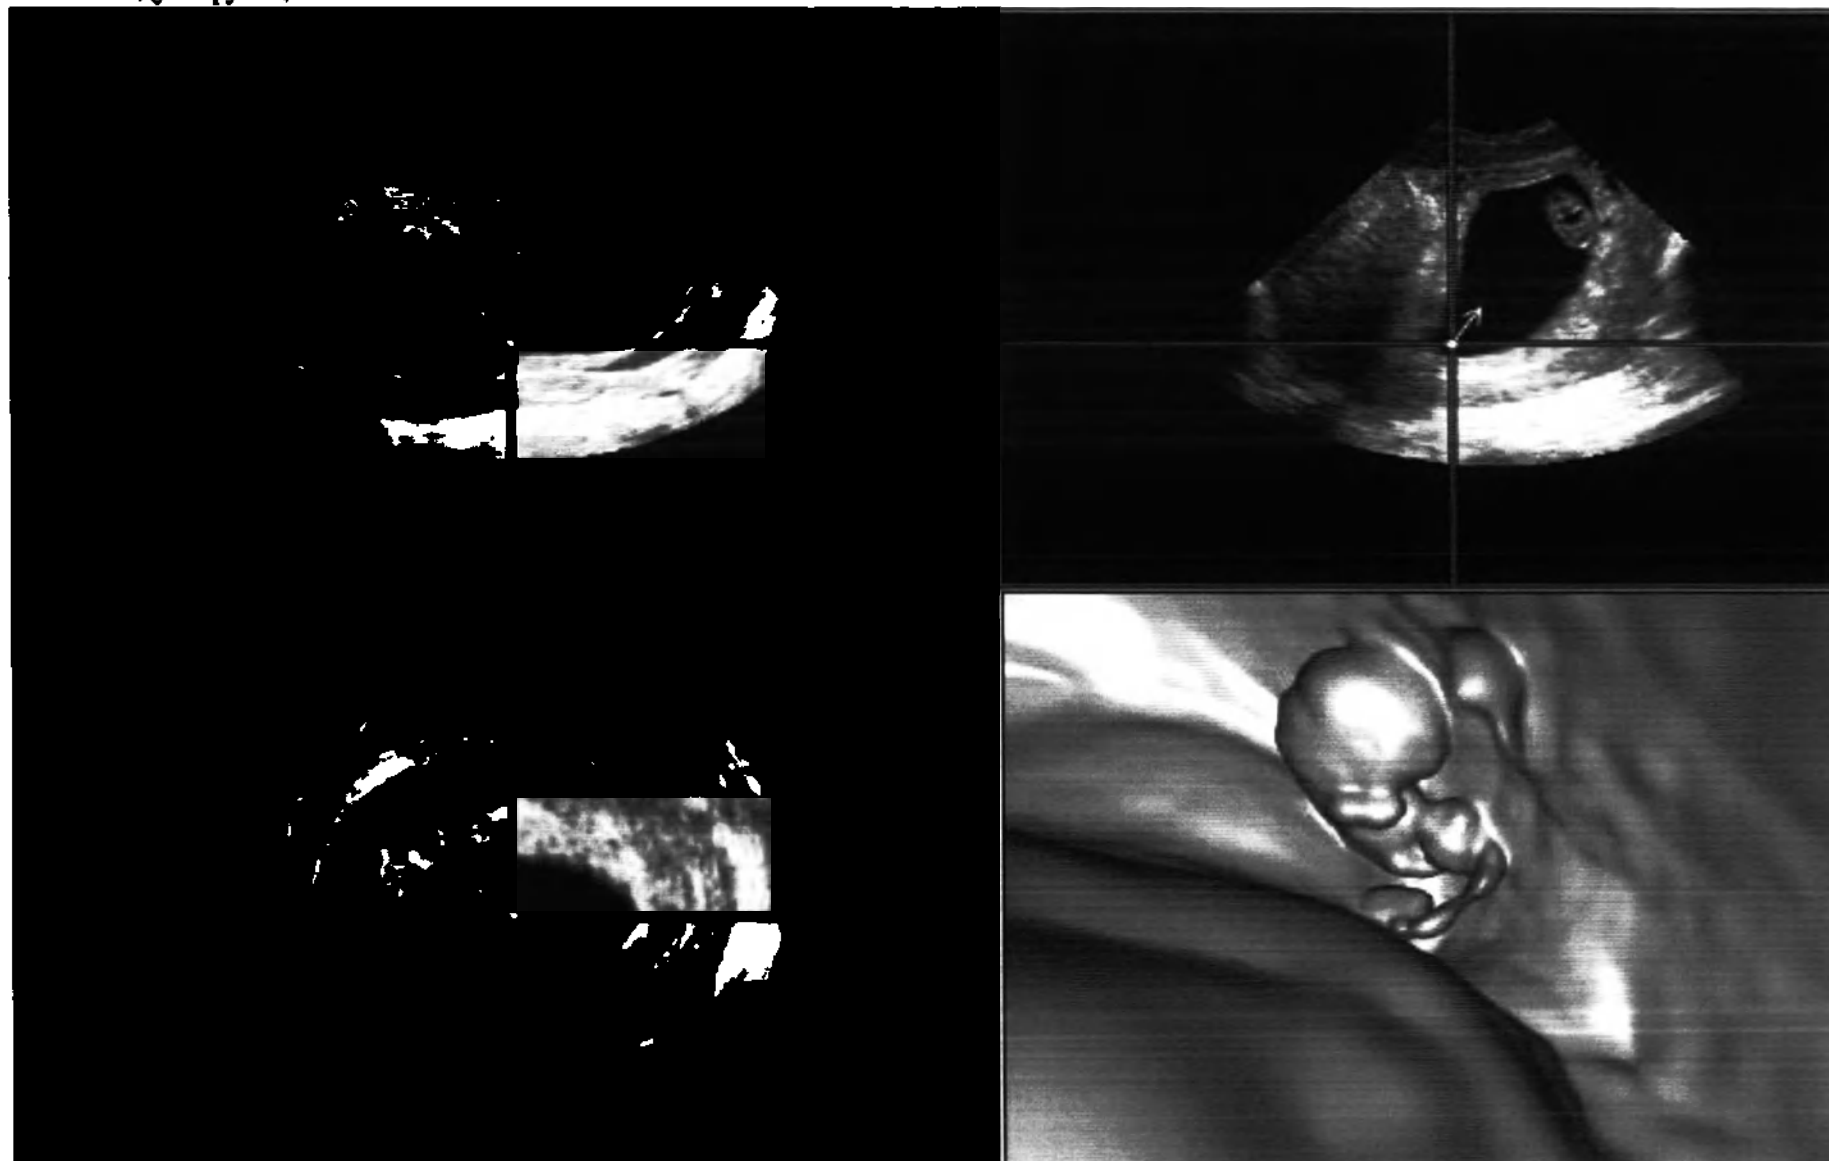


12. Программное приложение для виртуального освещения (Luminance)



13. Программное приложения для автоматического измерения воротникового пространства (Auto NT)

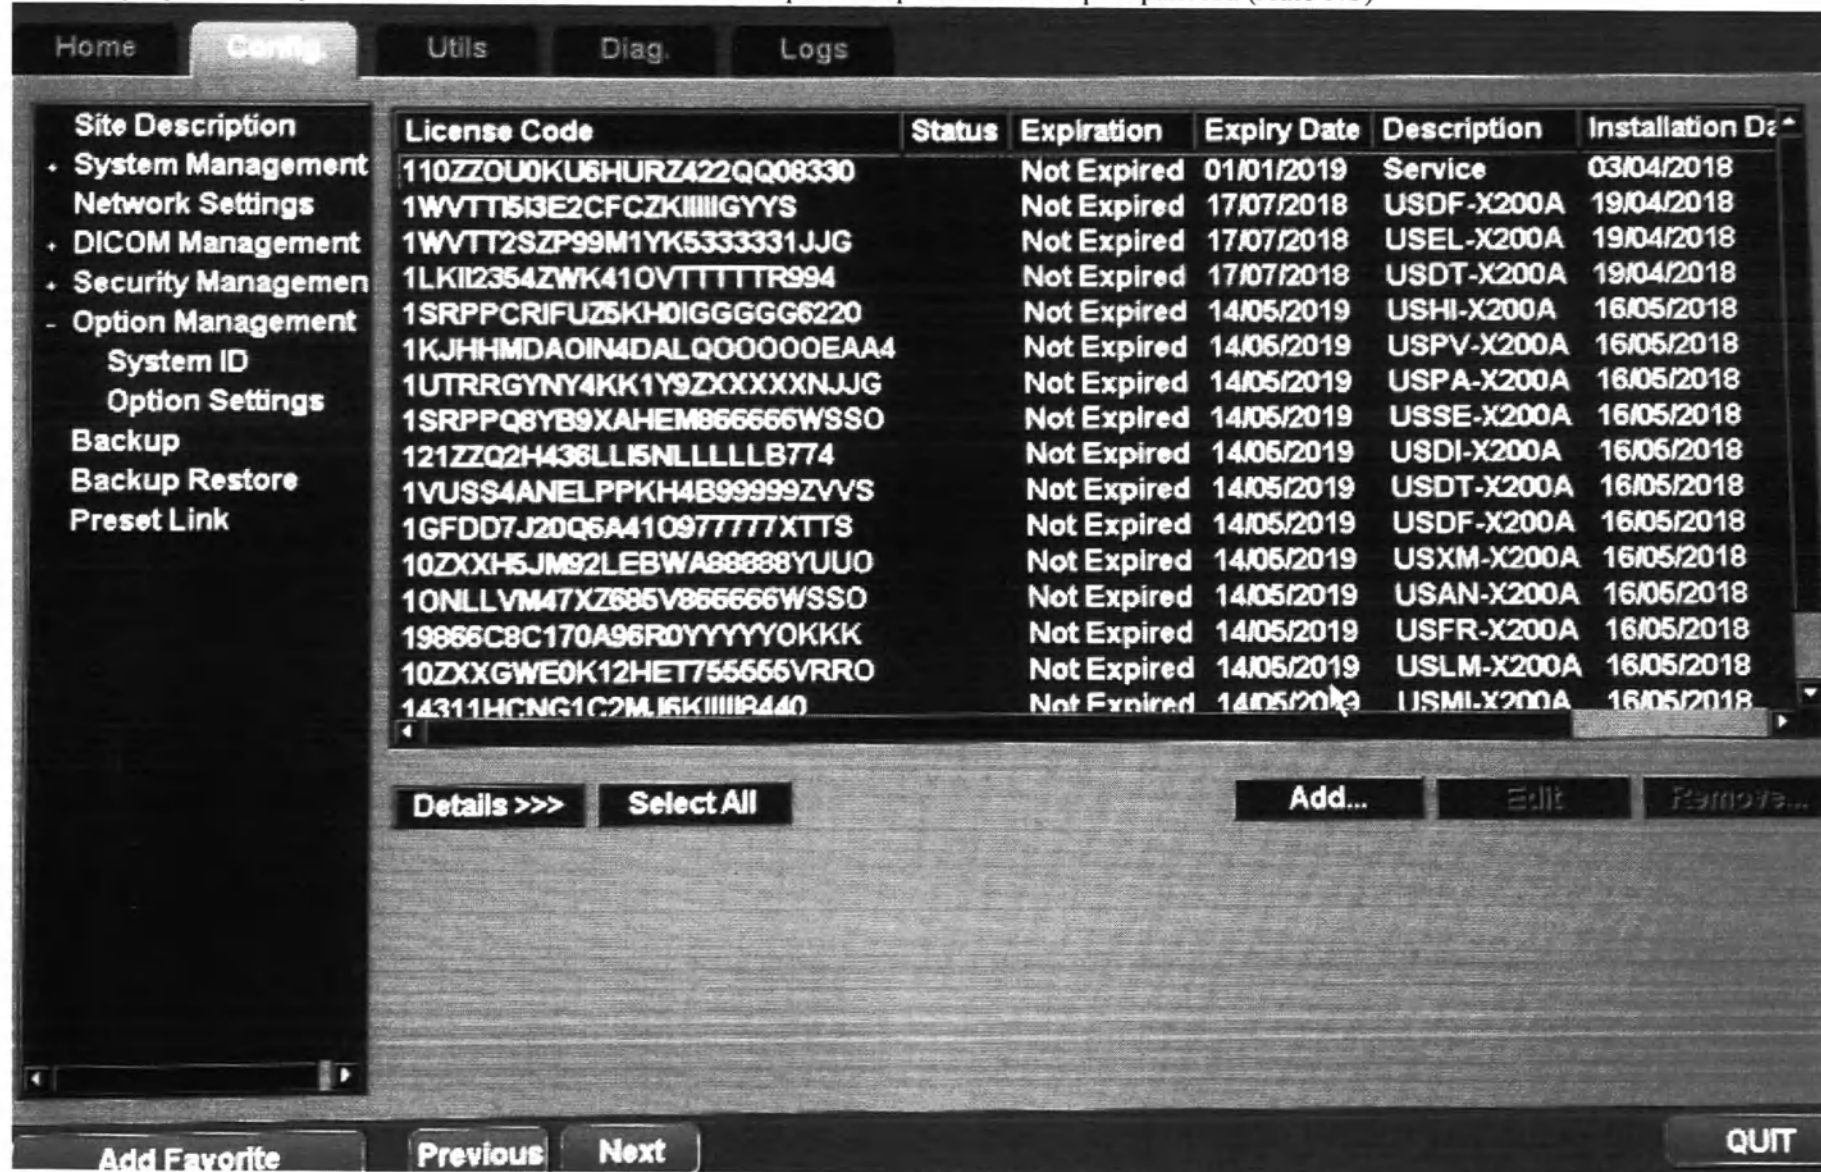

14. Программное приложение для высококачественной визуализации микрососудистого кровотока (Superb Micro Vascular Imaging)

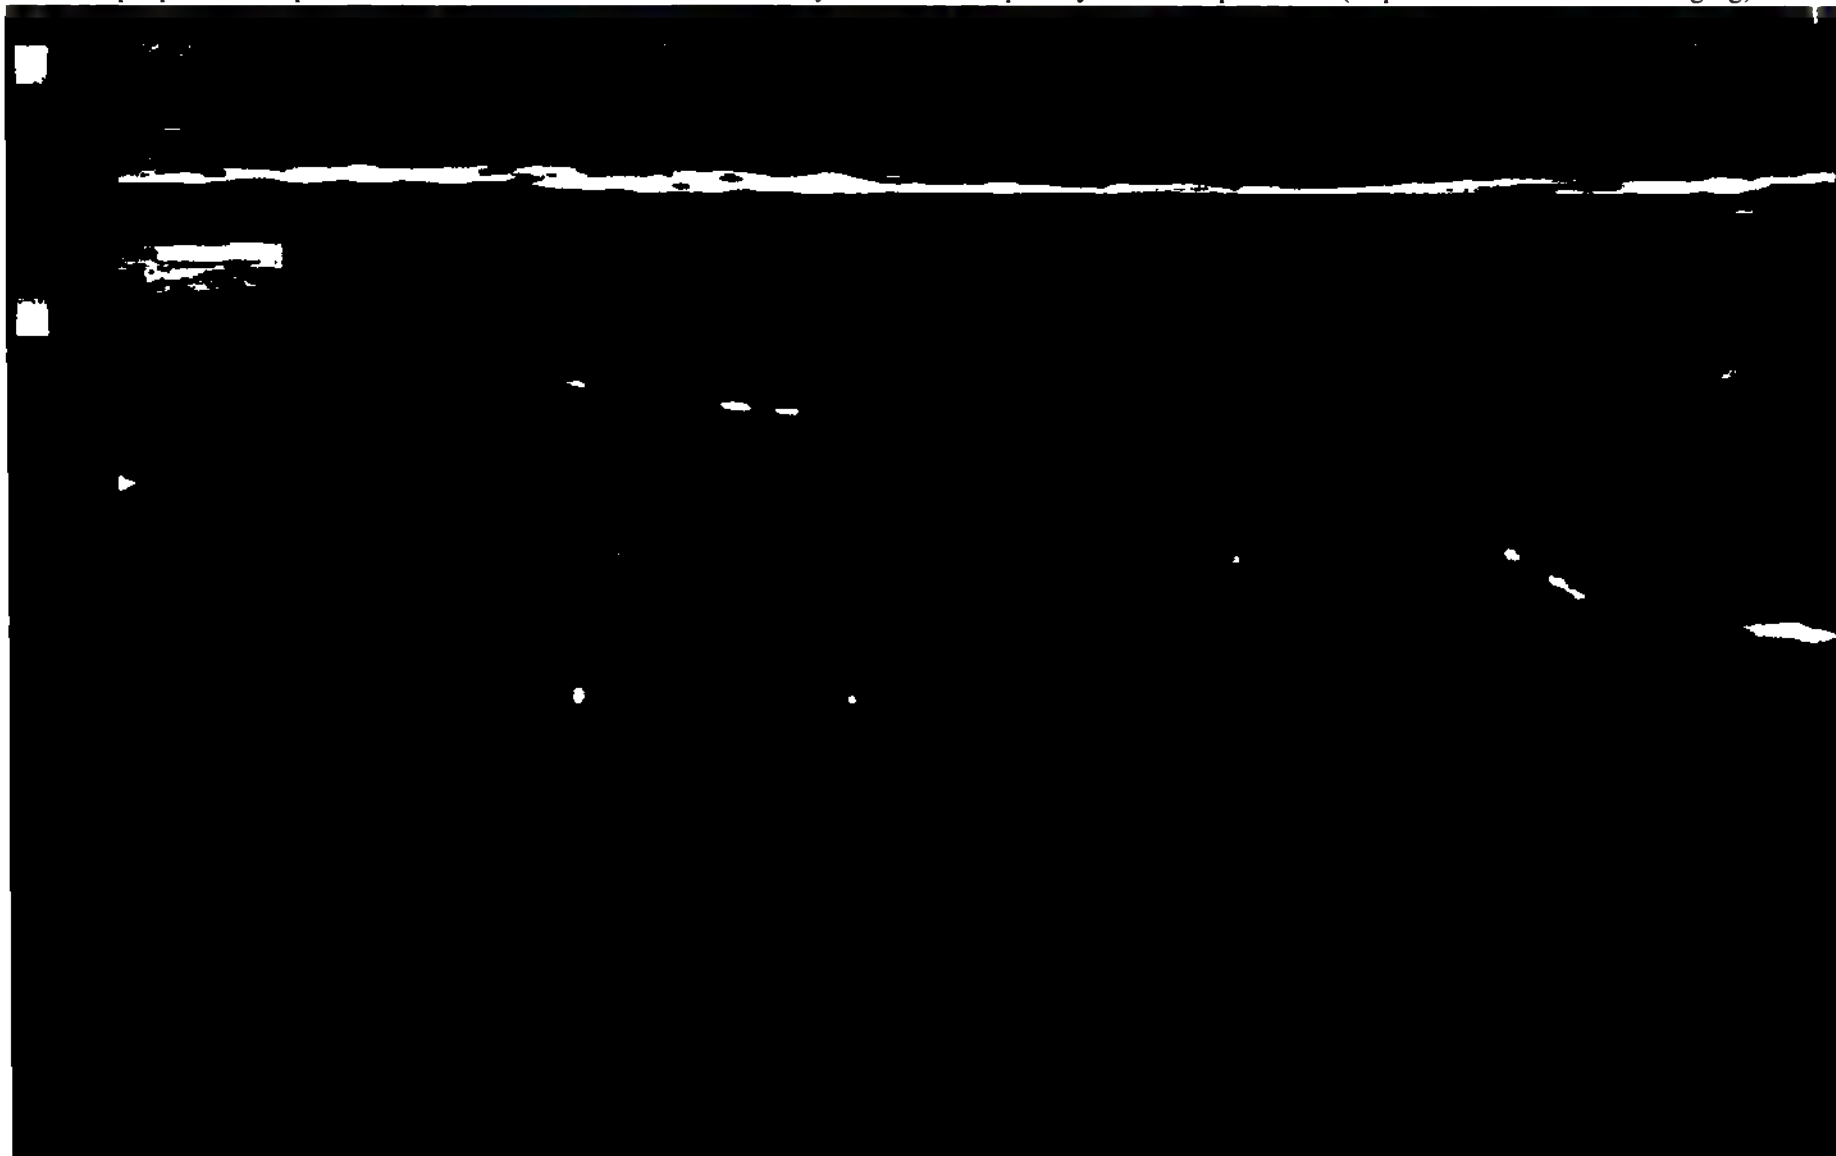


15. Программное приложение для дифференцированной тканевой гармоники (D-THI)



16. Программное приложение для улучшенного динамического потока (Dynamic Flow)



17. Программное приложение для улучшенной прецизионной визуализации (Precision Plus)

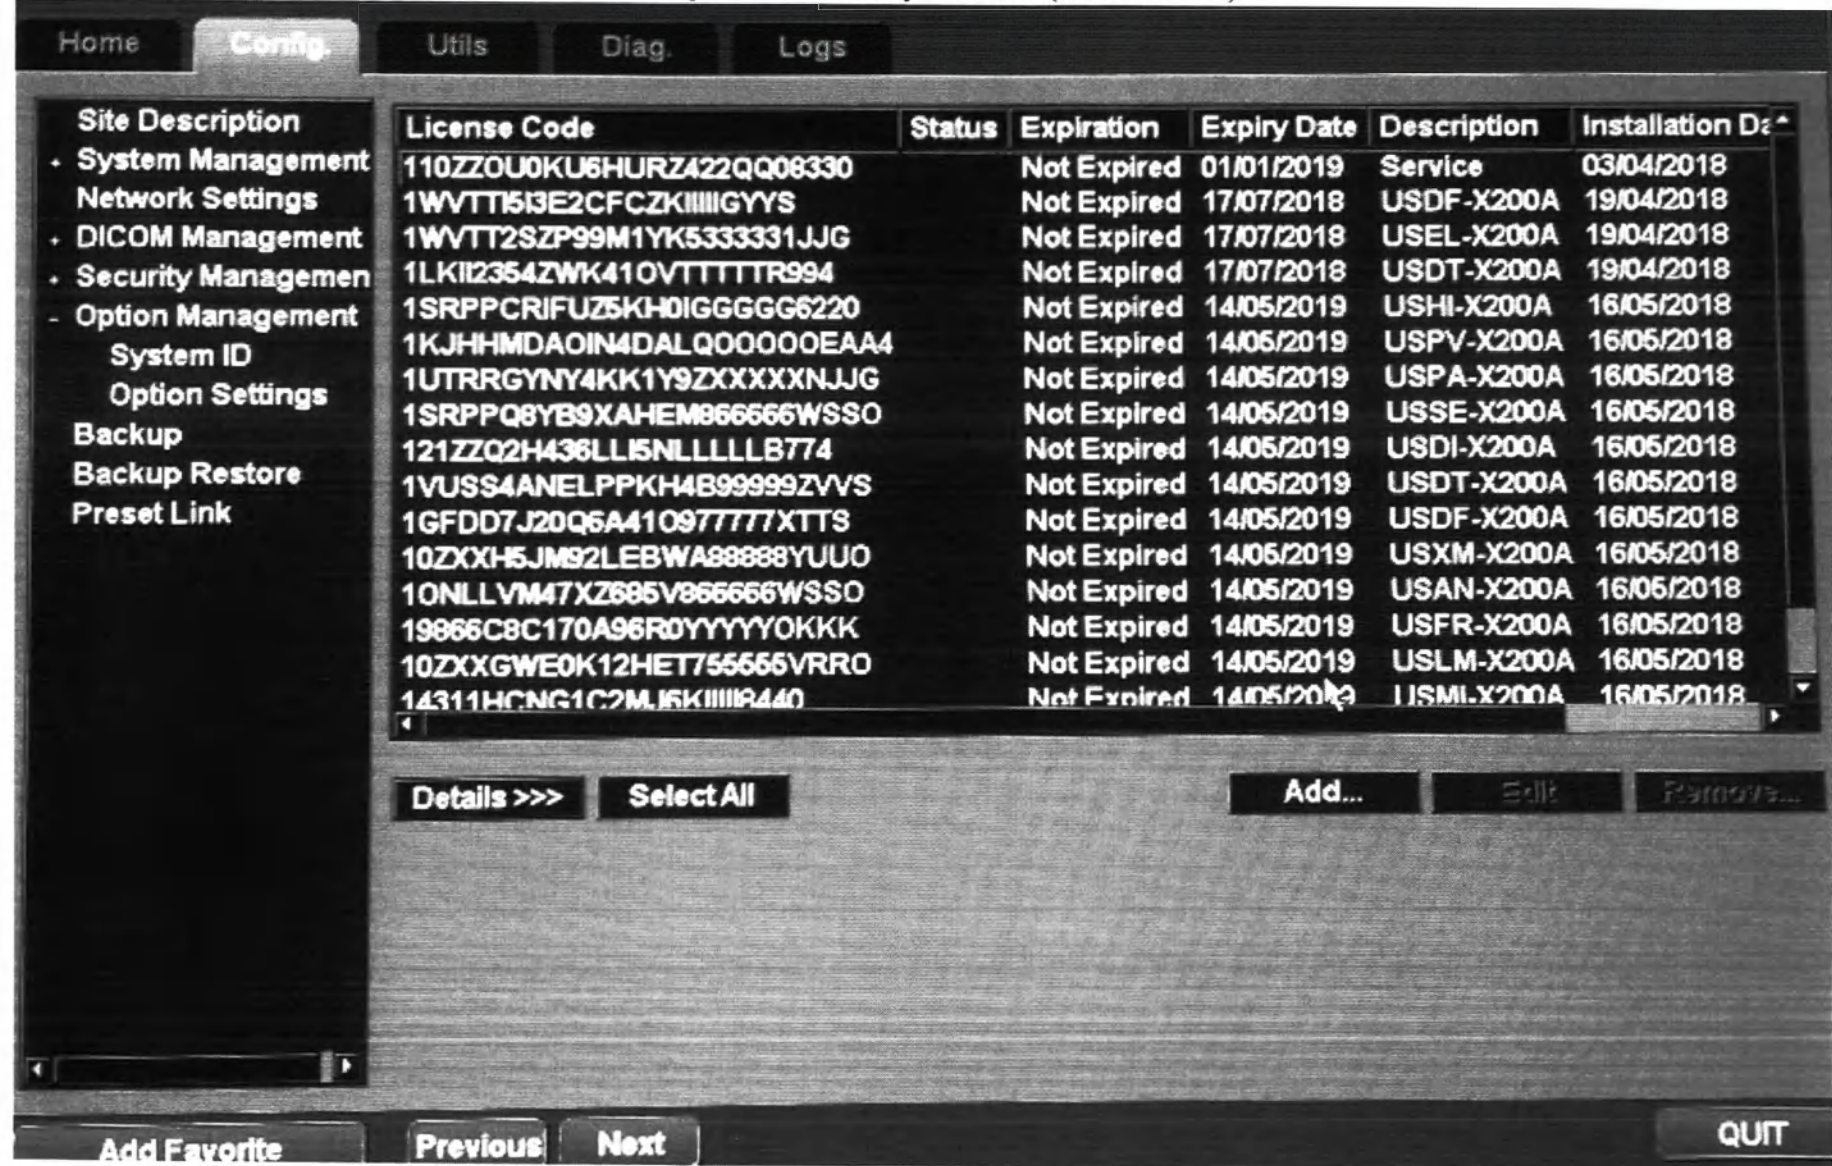

18. Программное приложение для специальной оптимизации тканевого отображения (TSO)

Home **Config** Utils Diag. Logs

Site Description

- System Management
- Network Settings
- DICOM Management
- Security Management
- Option Management
 - System ID
 - Option Settings
- Backup
- Backup Restore
- Preset Link

License Code	Status	Expiration	Expiry Date	Description	Installation Date
110ZZOU0KU6HURZ422QQ08330	Not Expired	01/01/2019	Service	03/04/2018	
1WVTTI53E2CFCZKIIIIIGYYS	Not Expired	17/07/2018	USDF-X200A	19/04/2018	
1WVTT2SZP99M1YK5333331JJG	Not Expired	17/07/2018	USEL-X200A	19/04/2018	
1LKII2354ZWK410VTTTTTR994	Not Expired	17/07/2018	USDT-X200A	19/04/2018	
1SRPPCRIFUZ5KH0IGGGGG6220	Not Expired	14/05/2019	USHI-X200A	16/05/2018	
1KJHHMDA0IN4DALQ00000EAA4	Not Expired	14/05/2019	USPV-X200A	16/05/2018	
1UTRRGYNY4KK1Y9ZXXXXXNJG	Not Expired	14/05/2019	USPA-X200A	16/05/2018	
1SRPPQ8YB9XAHM866666WSSO	Not Expired	14/05/2019	USSE-X200A	16/05/2018	
121ZZQ2H436LLI5NLLLLLB774	Not Expired	14/05/2019	USDI-X200A	16/05/2018	
1VUSS4ANELPPKH4B99999ZVVS	Not Expired	14/05/2019	USDT-X200A	16/05/2018	
1GFDD7J20Q6A41097777XTTS	Not Expired	14/05/2019	USDF-X200A	16/05/2018	
10ZXXH5JM92LEBWA88888YUUD	Not Expired	14/05/2019	USXM-X200A	16/05/2018	
1ONLLVM47XZ685V866666WSSO	Not Expired	14/05/2019	USAN-X200A	16/05/2018	
19866C8C170A96R0YYYYYOKKK	Not Expired	14/05/2019	USFR-X200A	16/05/2018	
10ZXXGWE0K12HET755555VRR0	Not Expired	14/05/2019	USLM-X200A	16/05/2018	
14311HCNG1C2ML6KIIIIIR440	Not Expired	14/05/2019	USMI-X200A	16/05/2018	


Details >>> Select All Add... Edit Remove...

Add Favorite Previous Next QUIT


19. Программное приложения для панорамной реконструкции изображения (Panoramic View)




20. Программное приложение для трехмерной реконструкции изображения (Smart 3D)

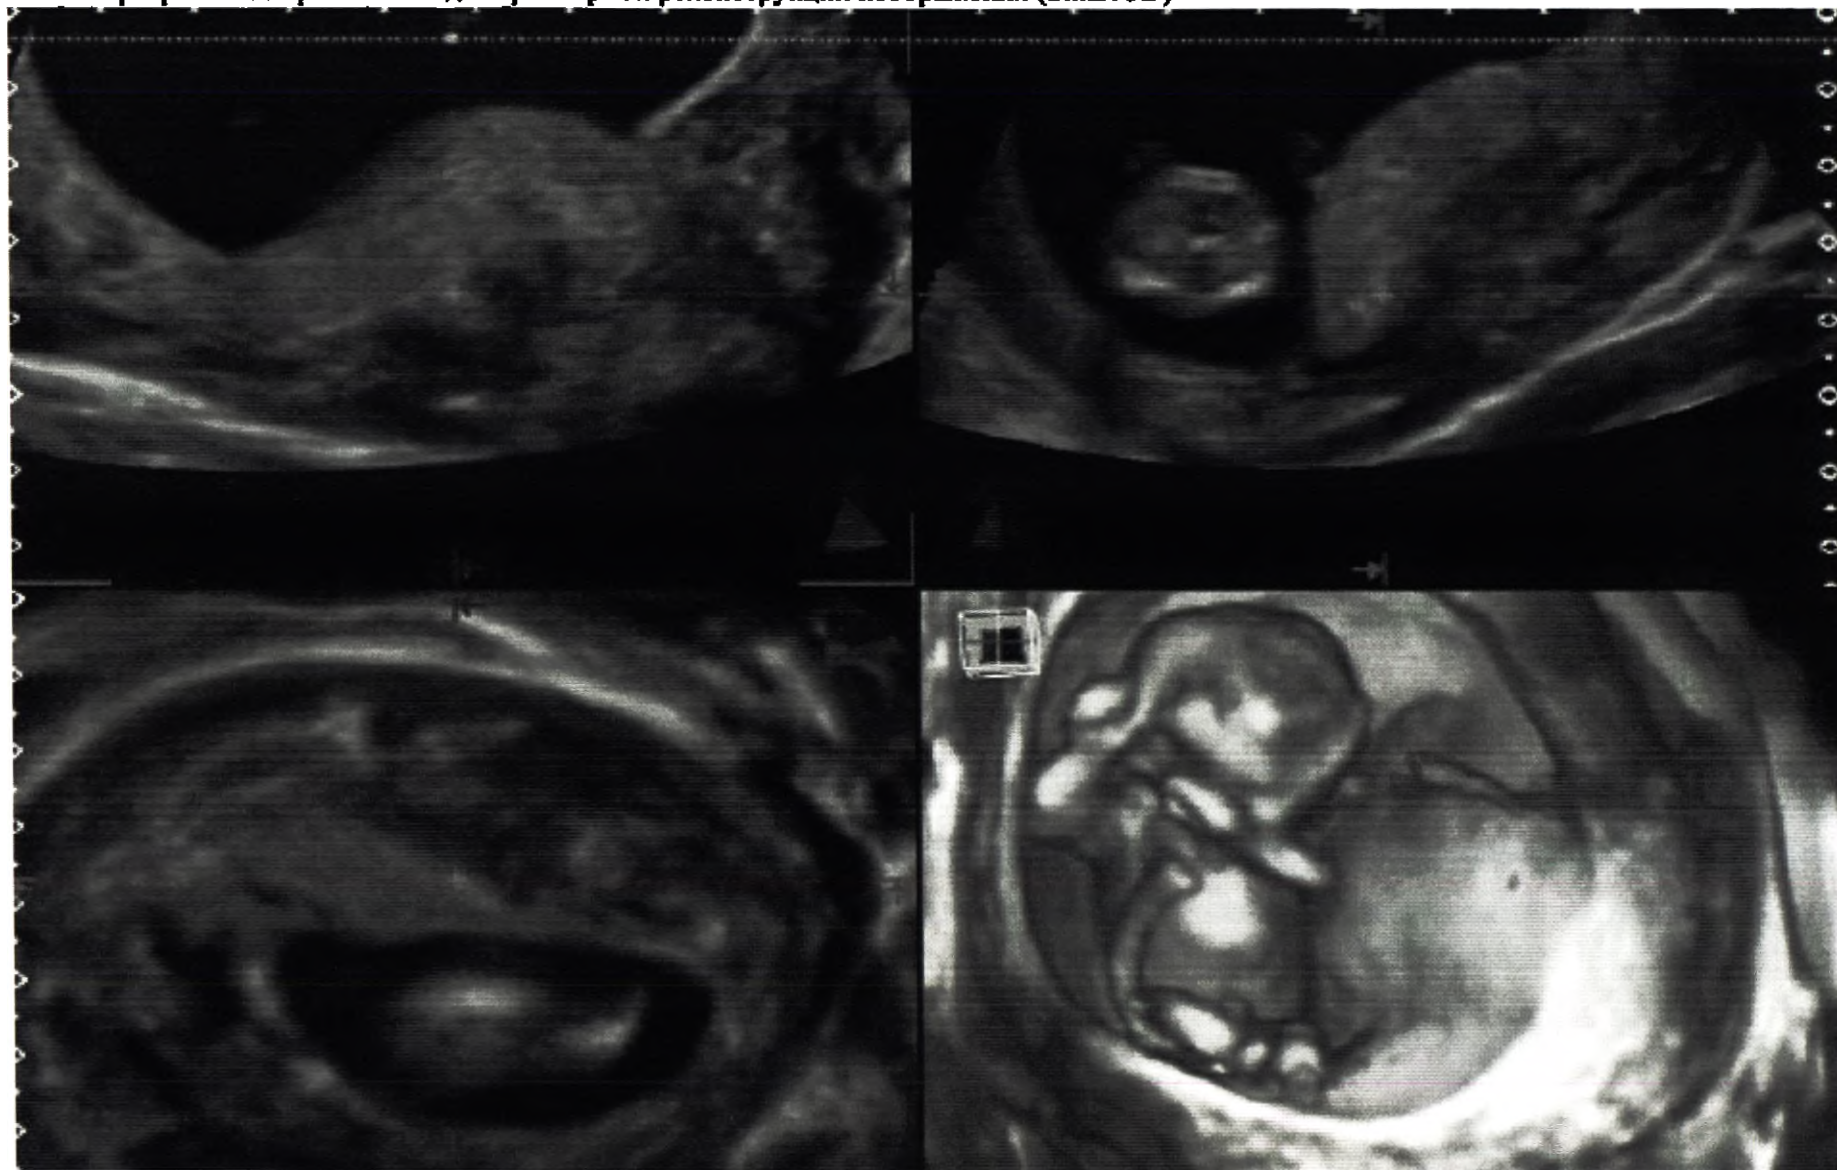


21. Программное приложение для поддержки стандарта DICOM



22. Программное приложение для формирования протокола исследования (Protocol Assistant)

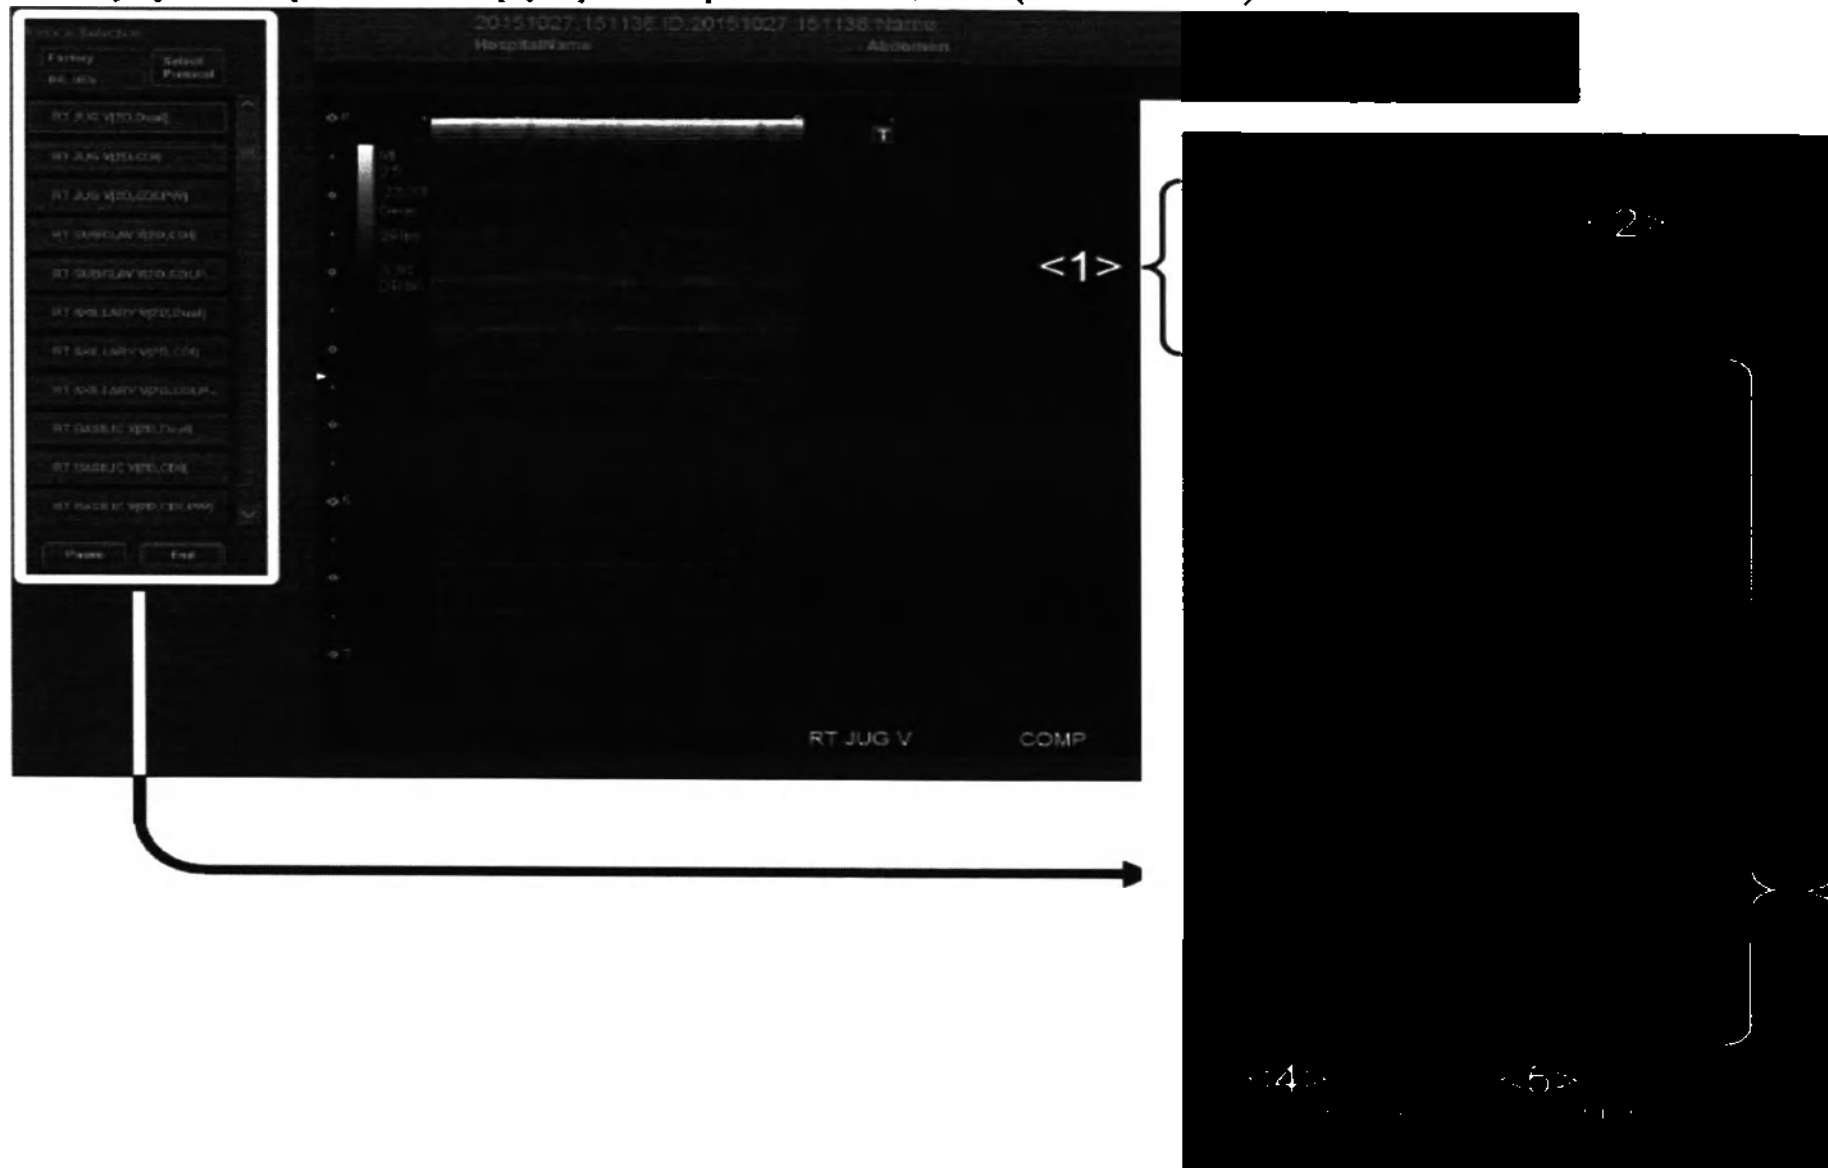

23. Программное приложение для обеспечения безопасности системы (Security Management)

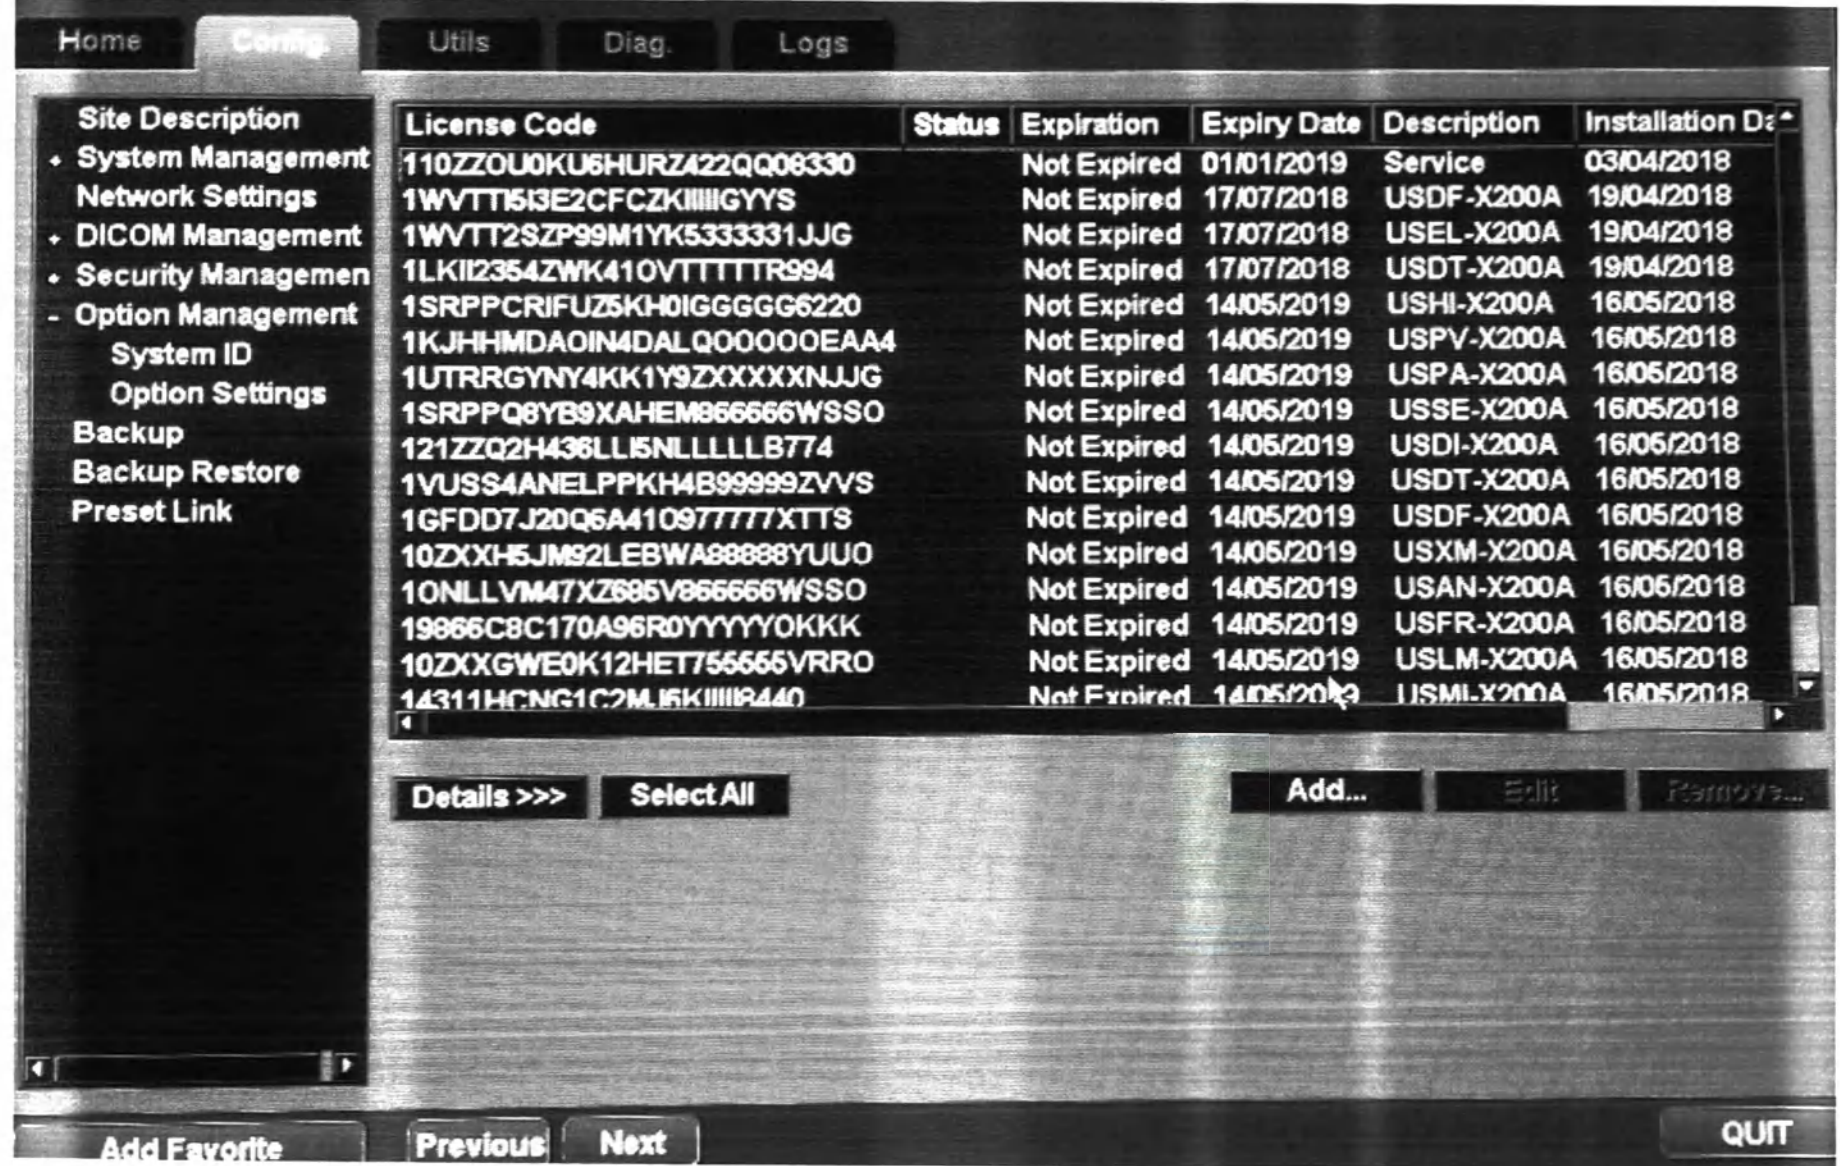

24. Ножная педаль управления



25. Подогреватель геля


120




26. Адаптер для подключения транспищеводного, лапароскопического датчиков



27. Держатель корзиночный

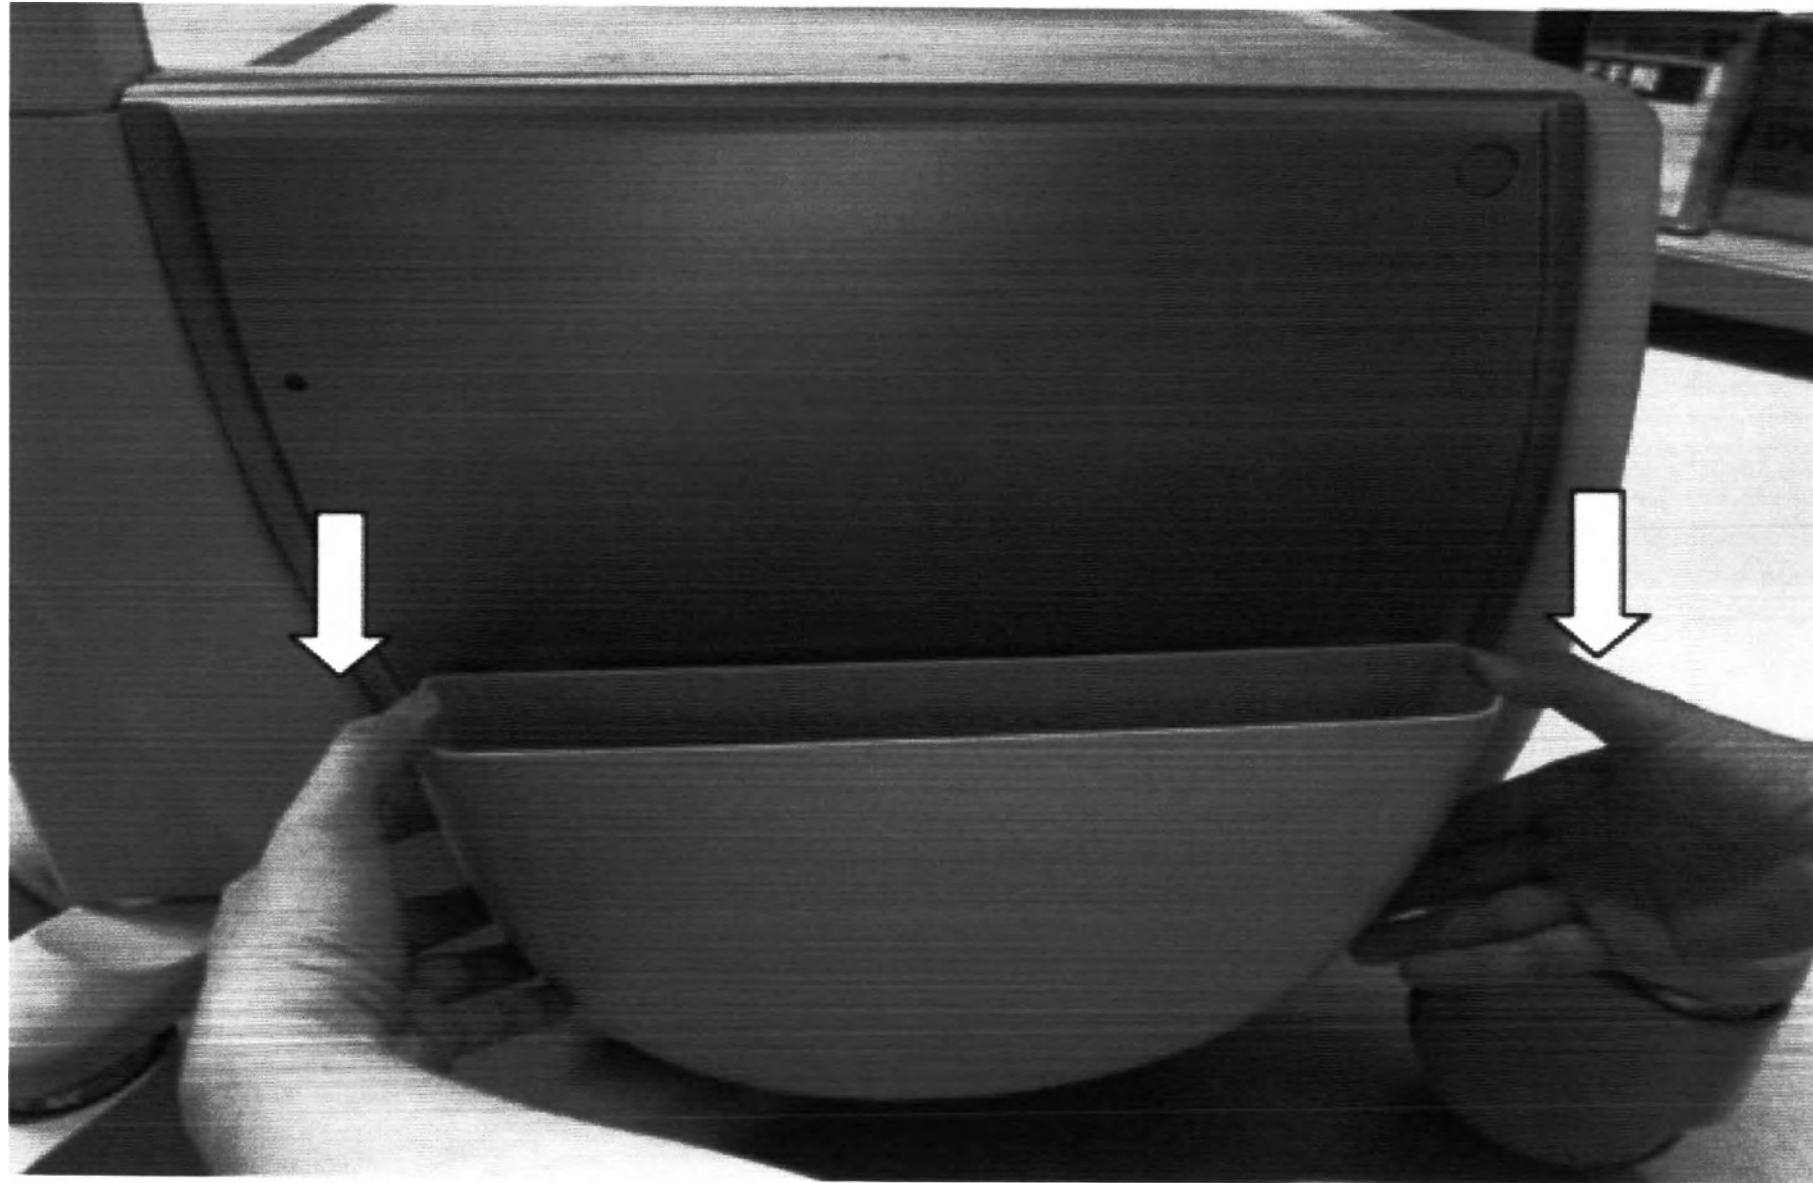


28. Держатель для кабелей датчиков

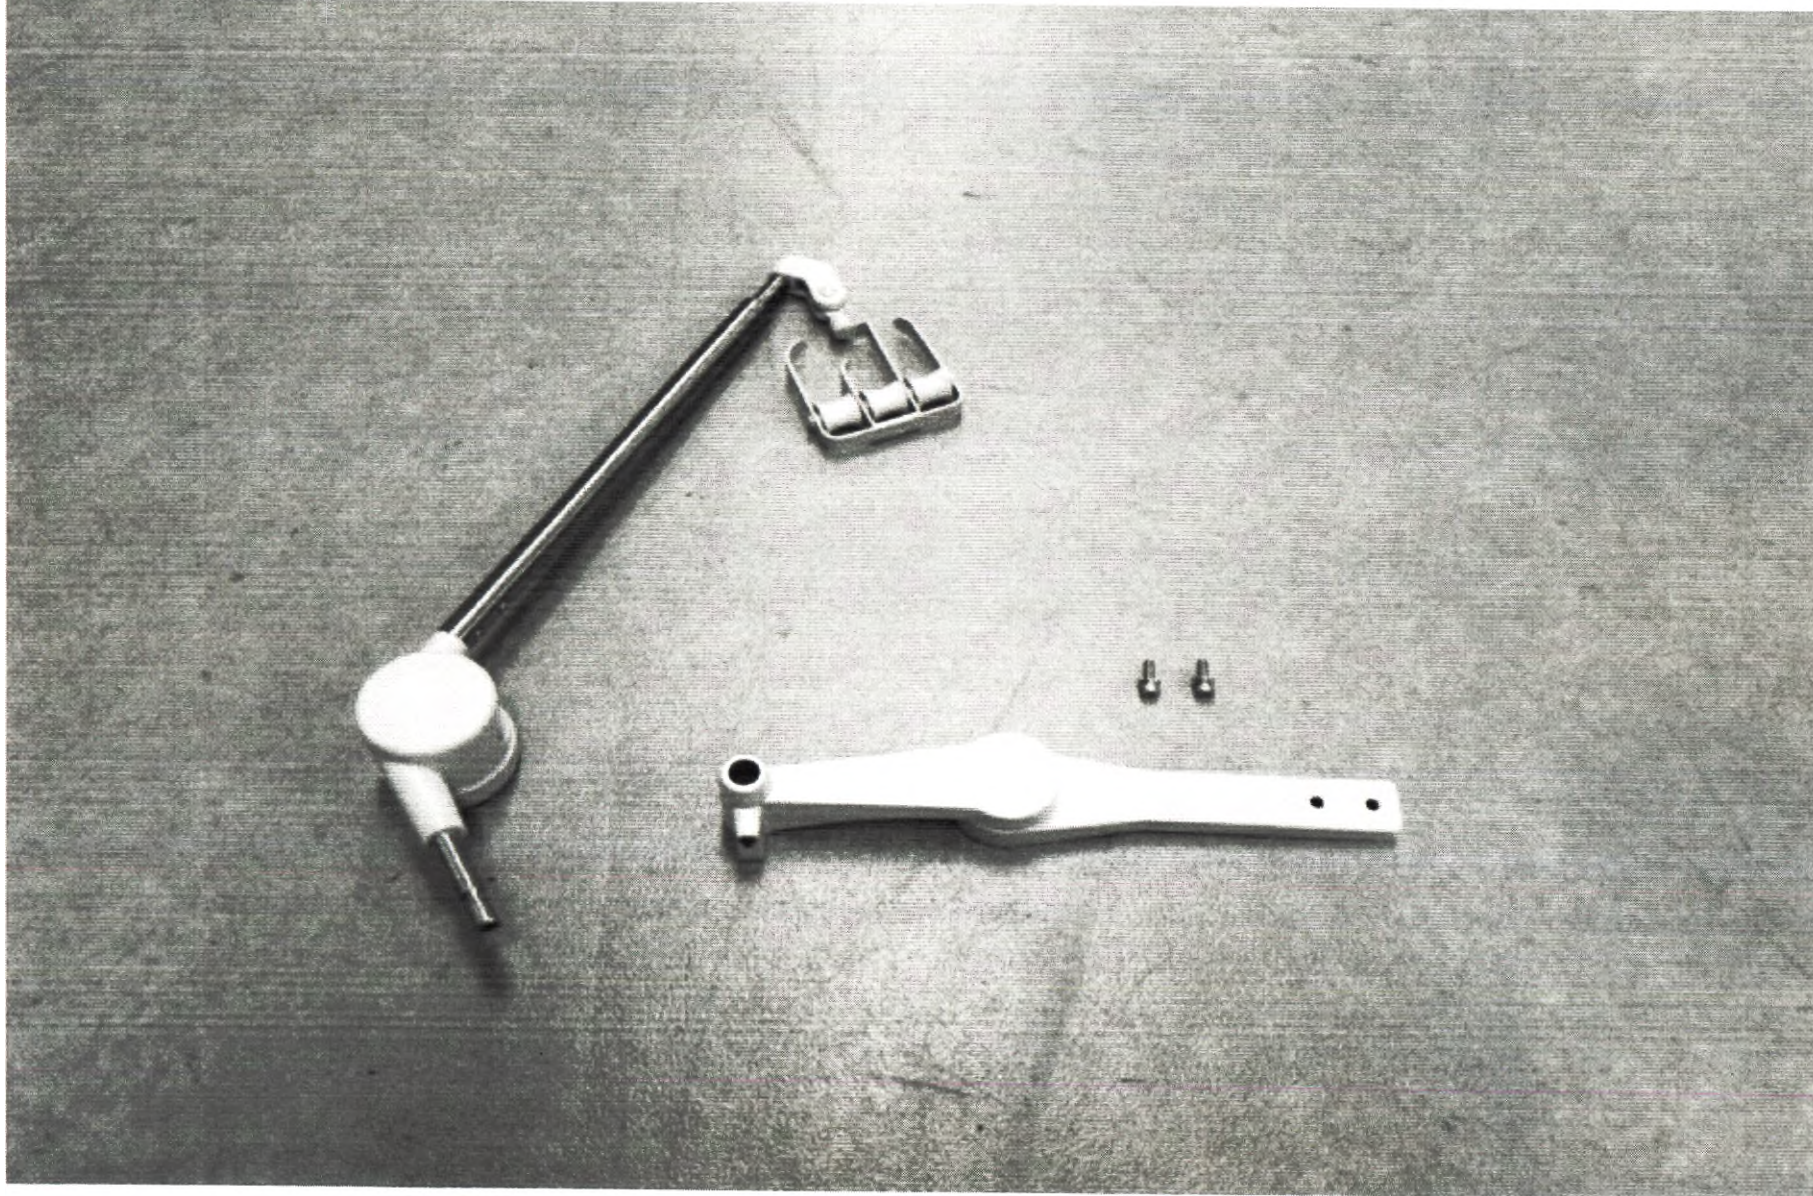

29. Держатель датчиков



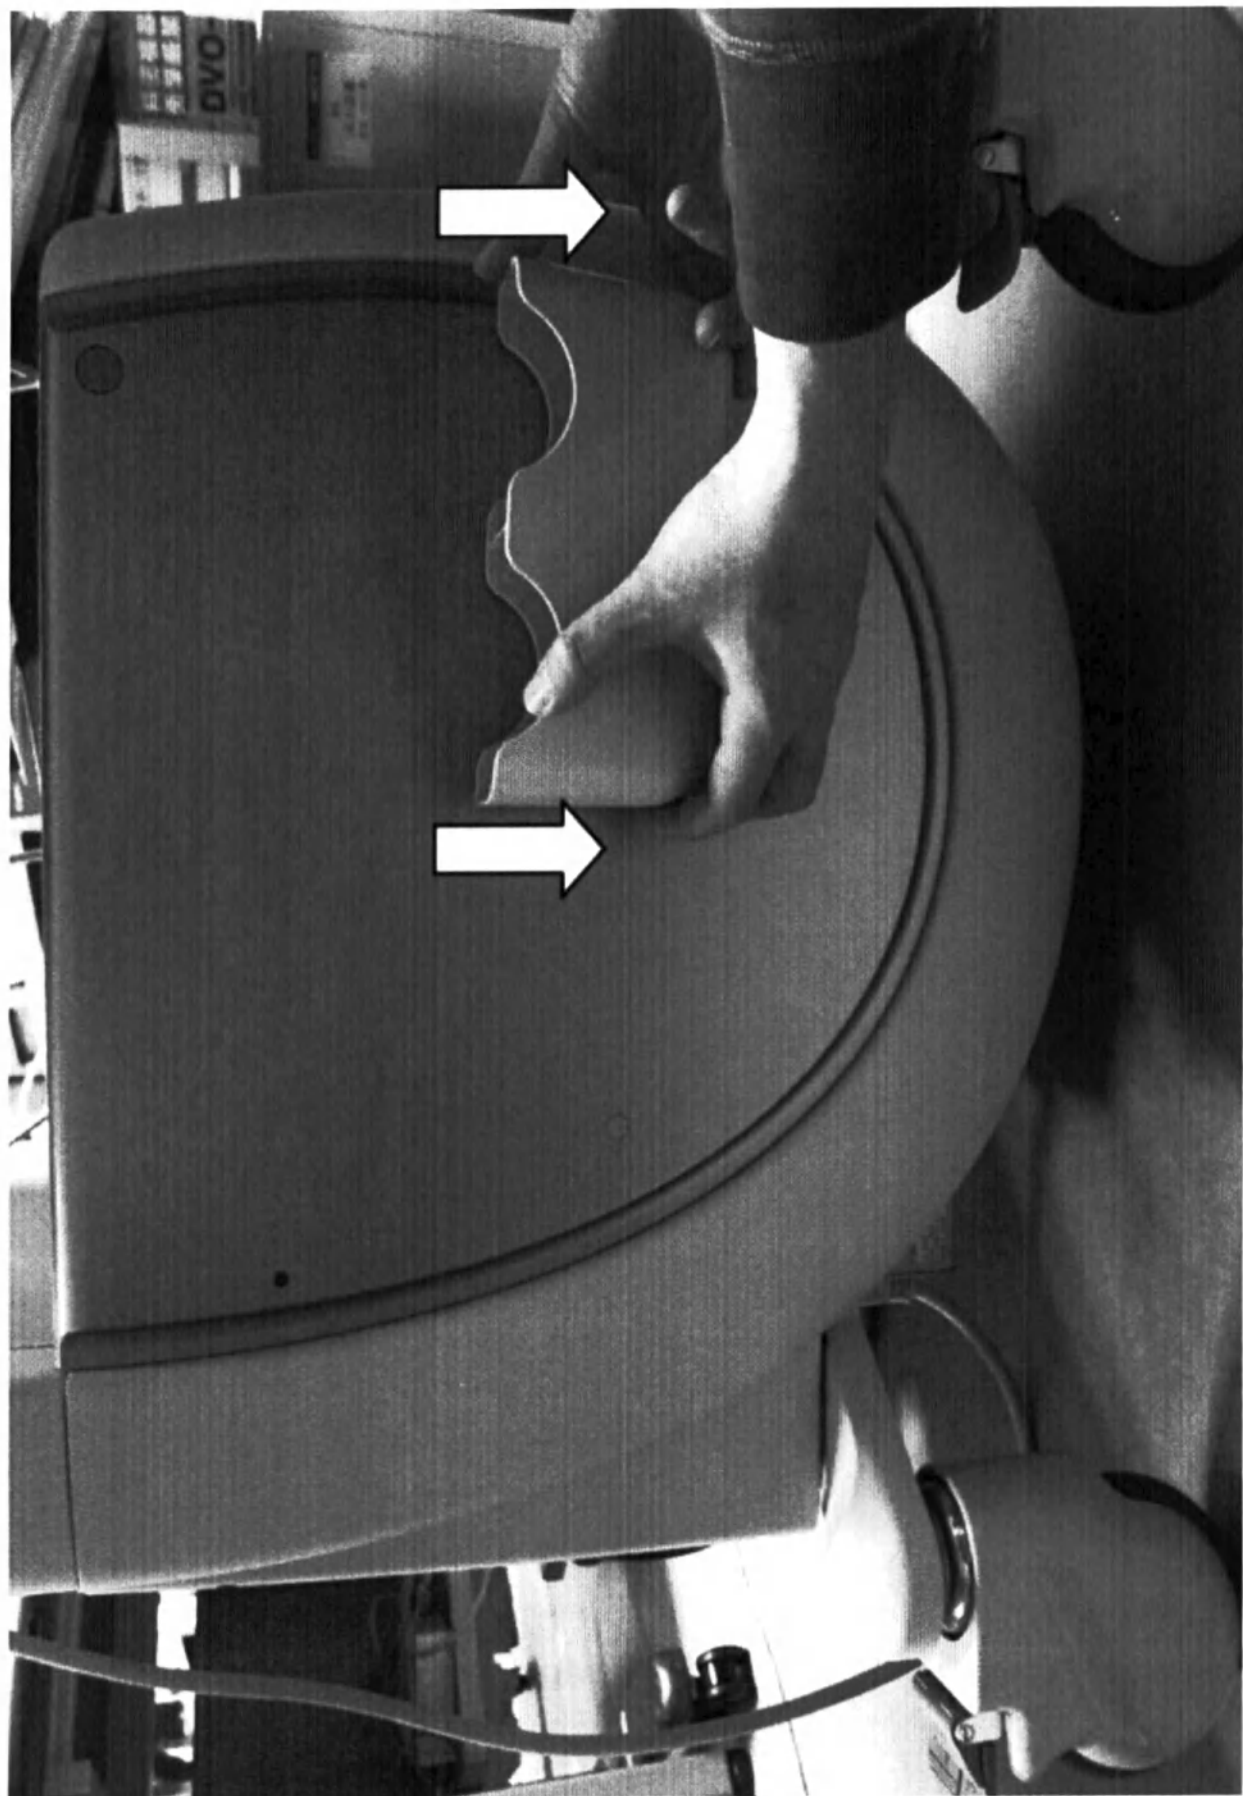

30. Блок аккумуляторов





31. Комплект для установки третьего блока аккумуляторов




32. Комплект для установки четвертого блока аккумуляторов




33. Комплект для установки третьего и четвертого блока аккумуляторов

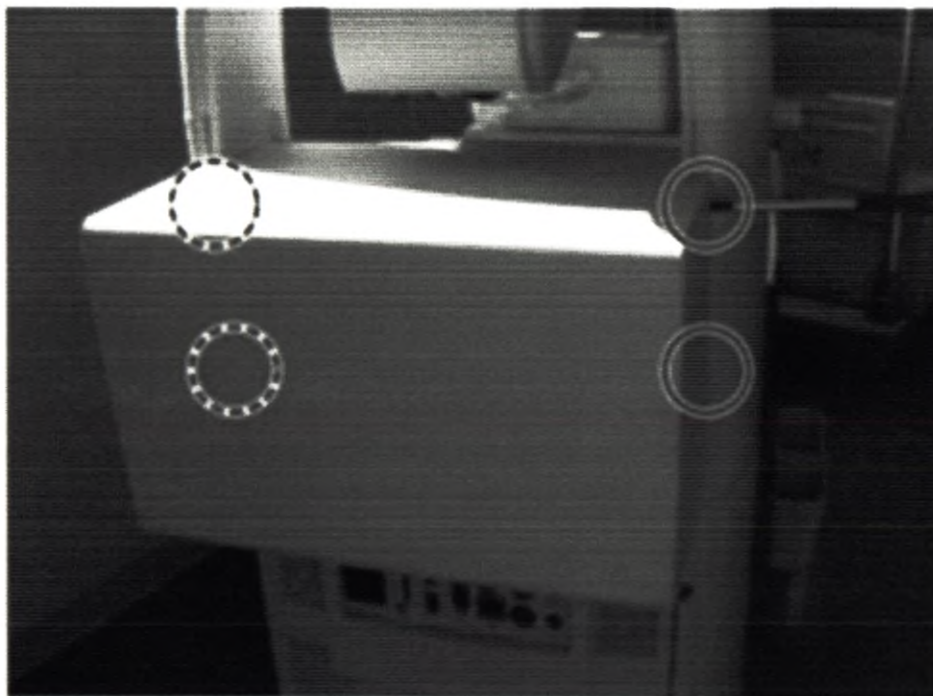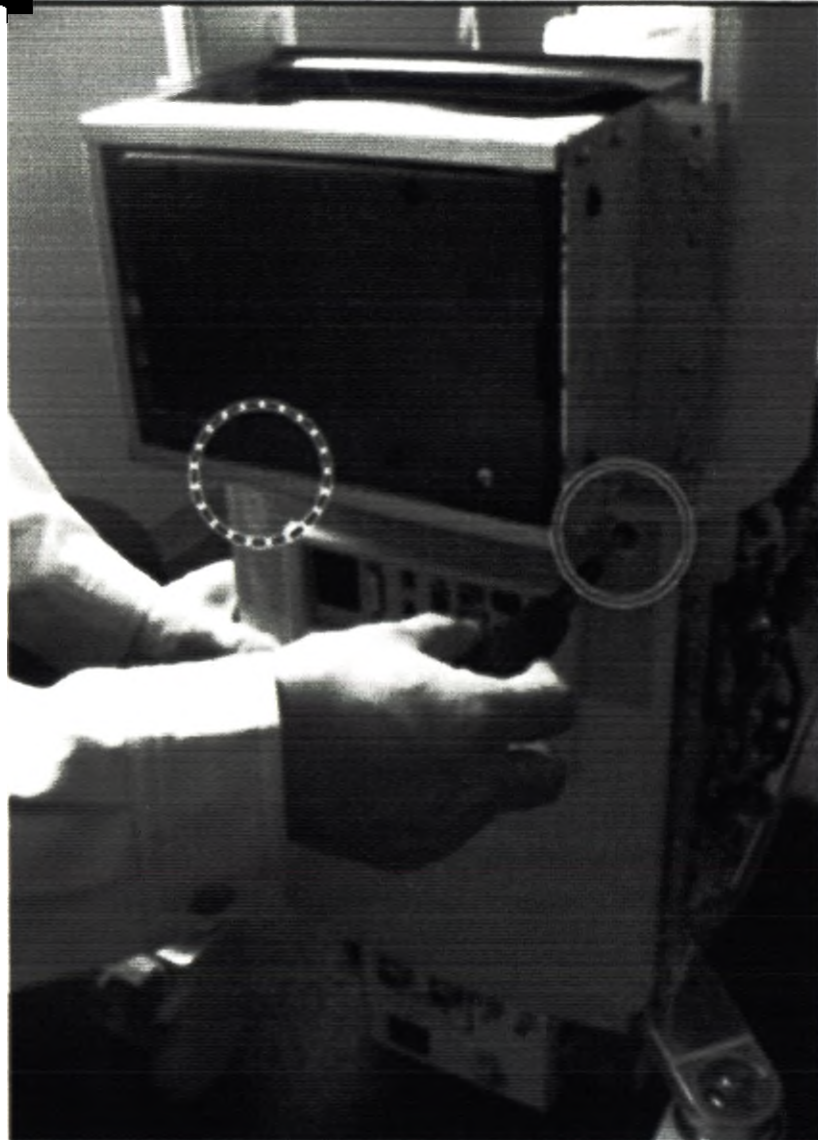

34. Модуль поддержки русского языка

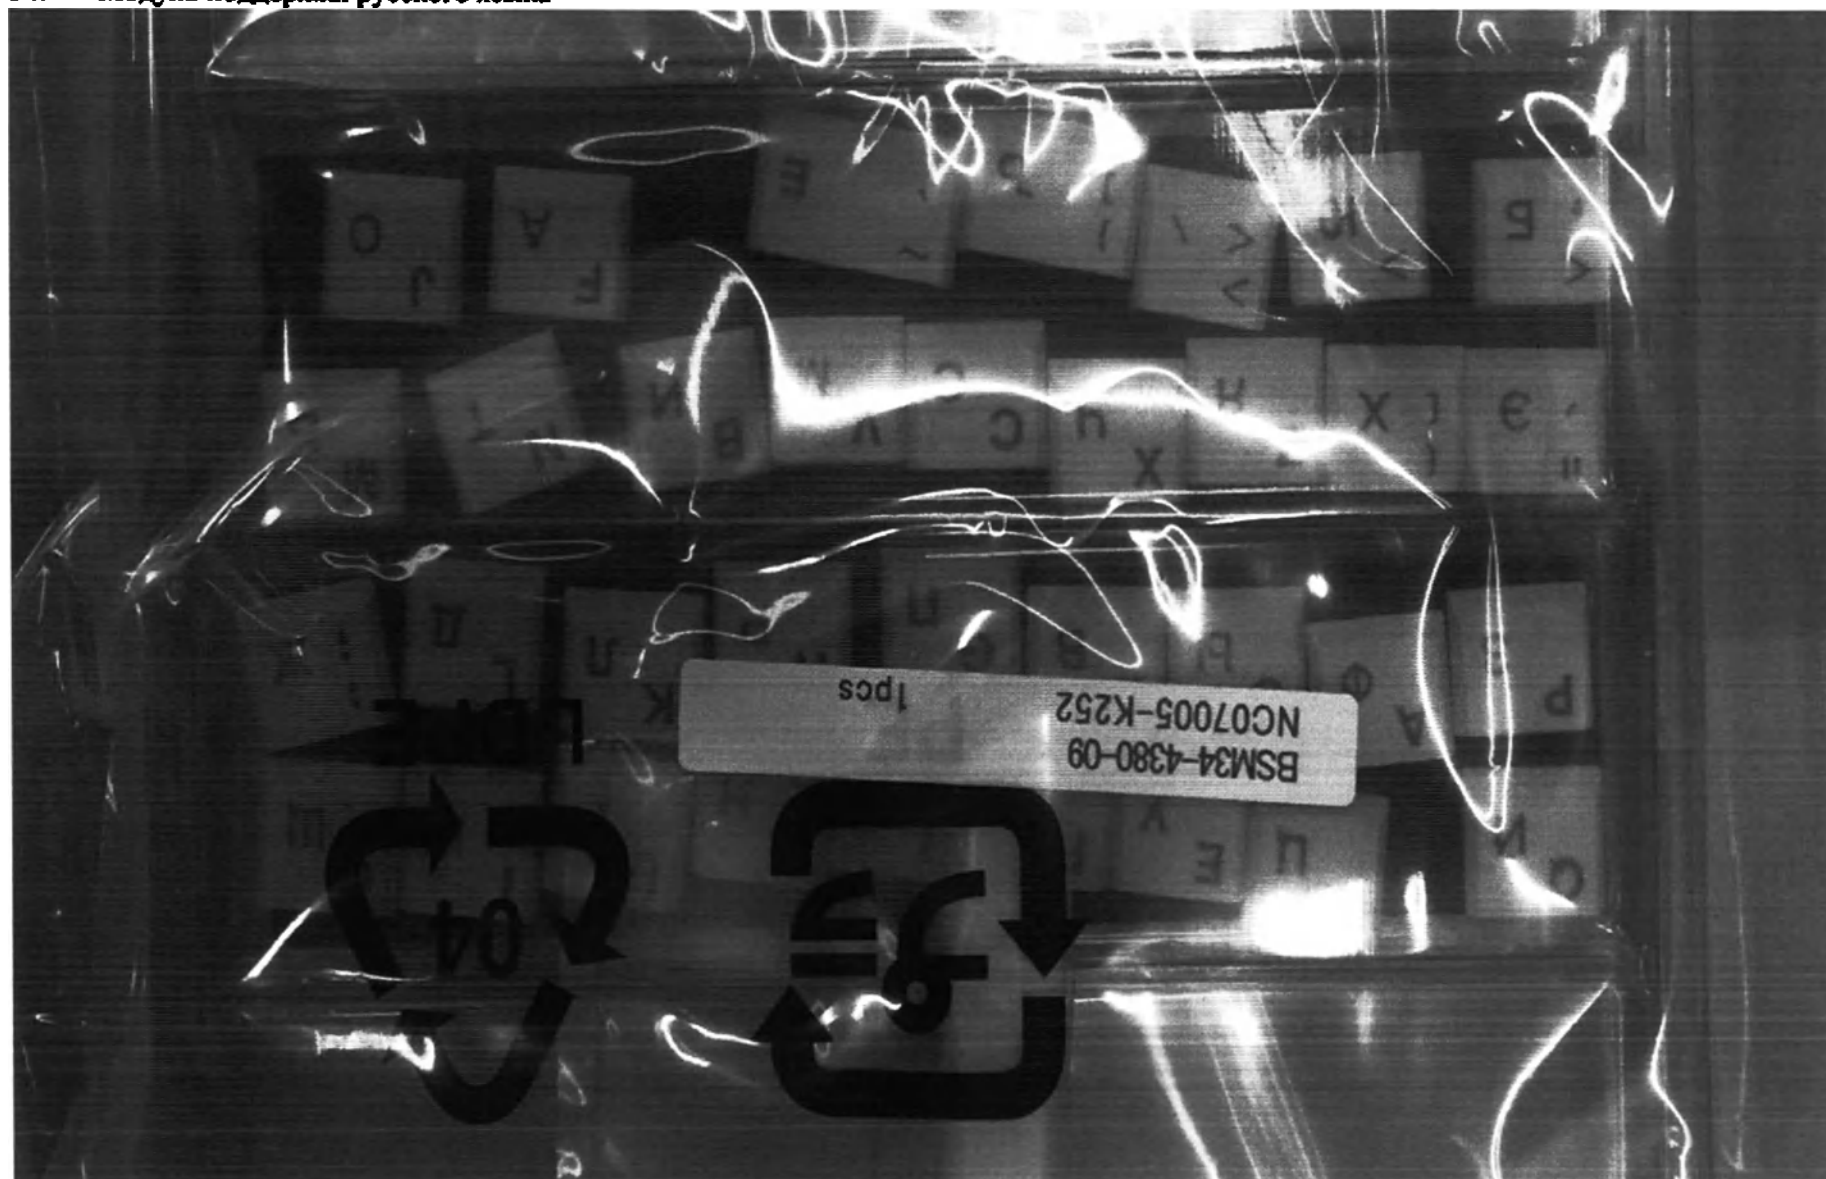


35. Модуль модернизации базового программного обеспечения

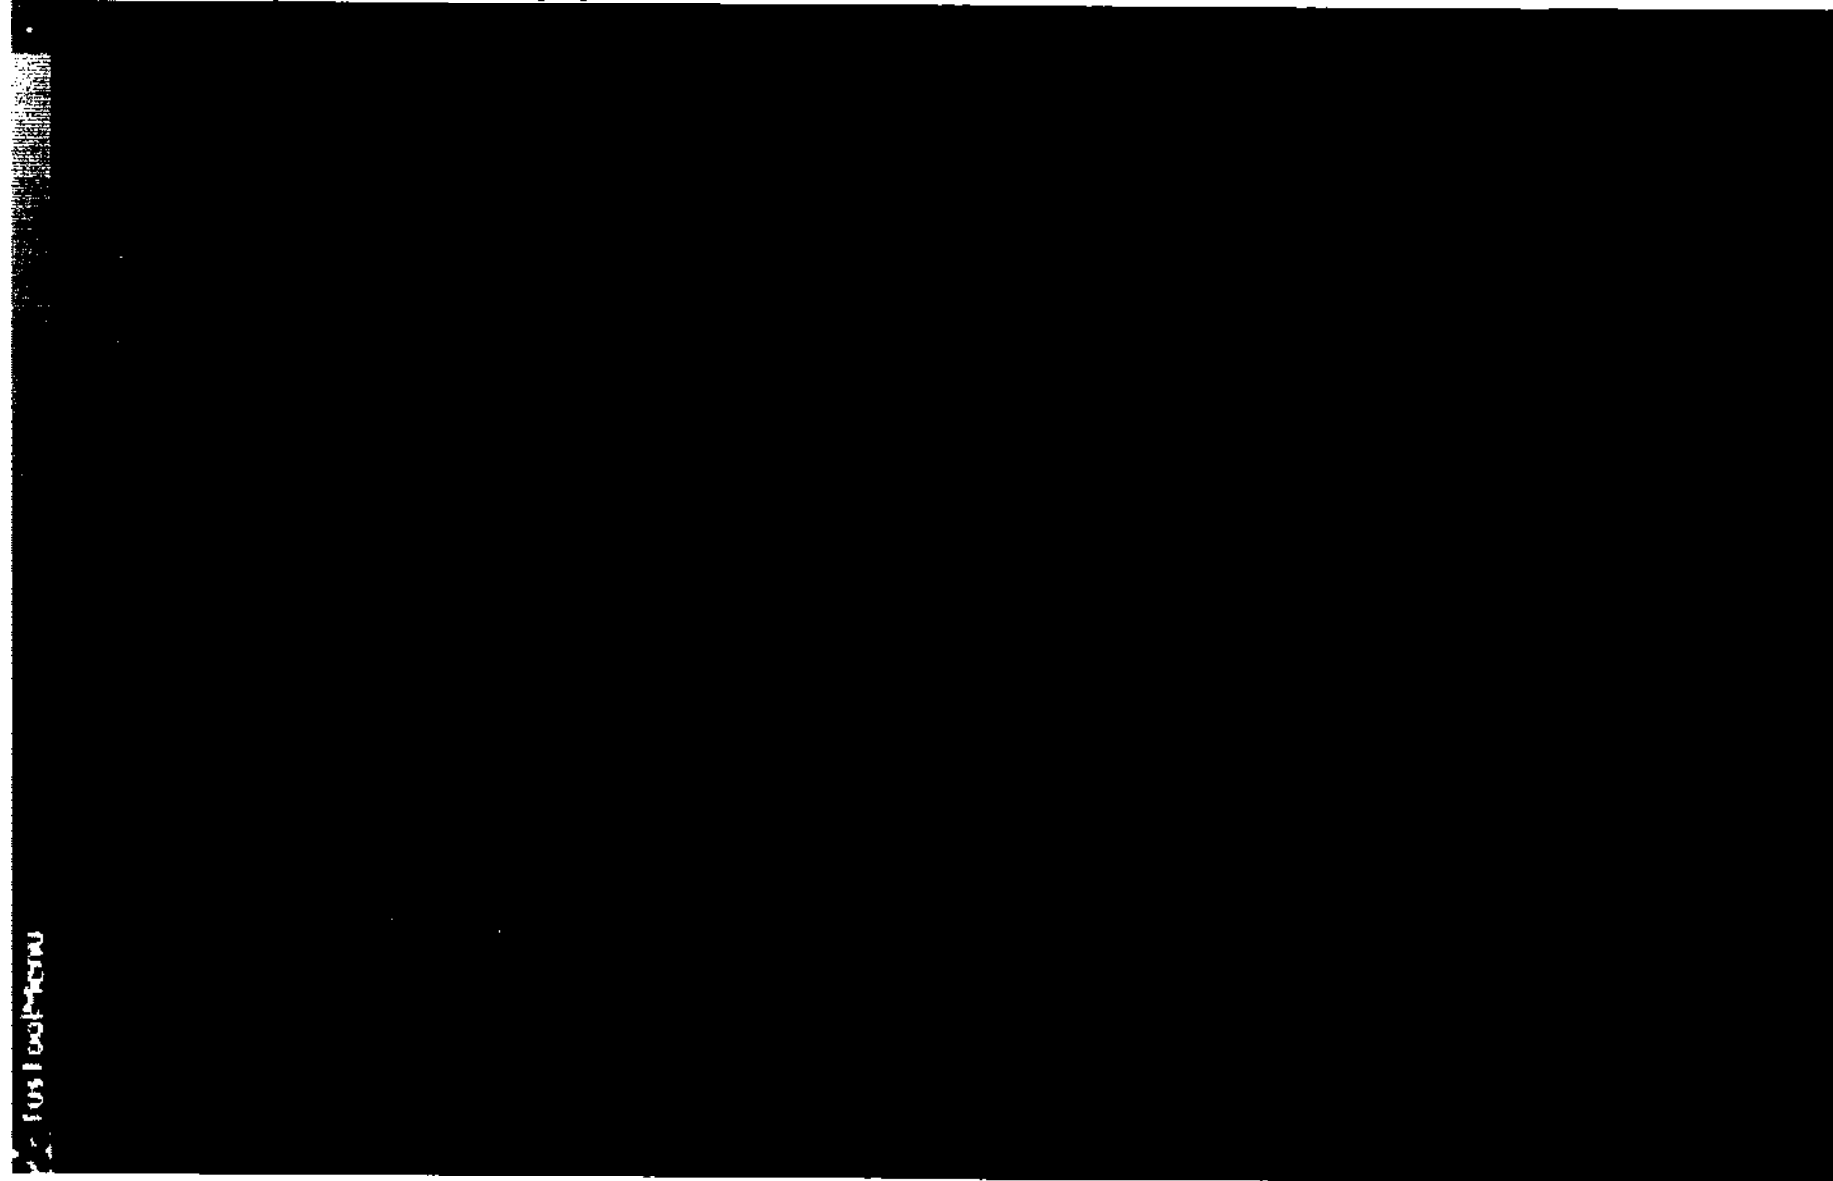


С. С. Ткаченко


36. Изолирующий трансформатор для периферийного устройства

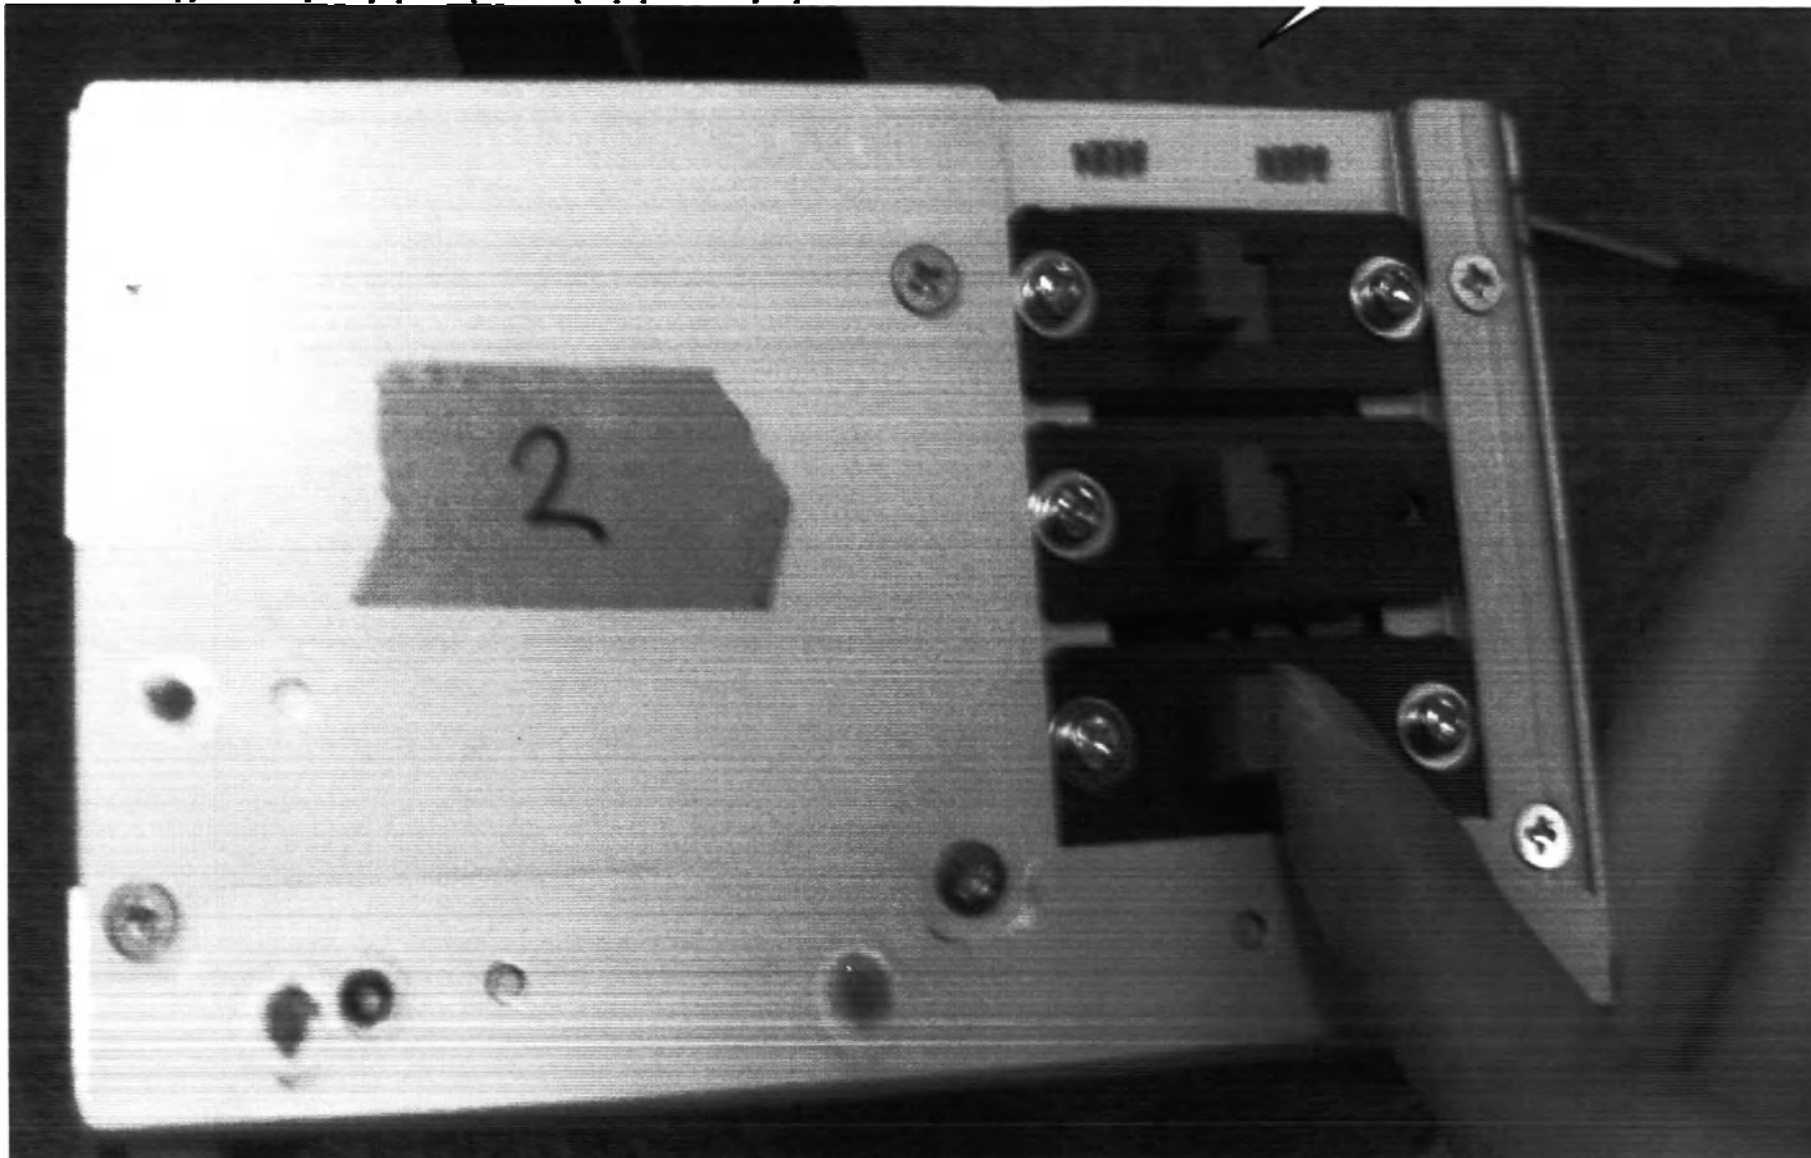


37. Комплект деталей для крепления черно-белого принтера слева

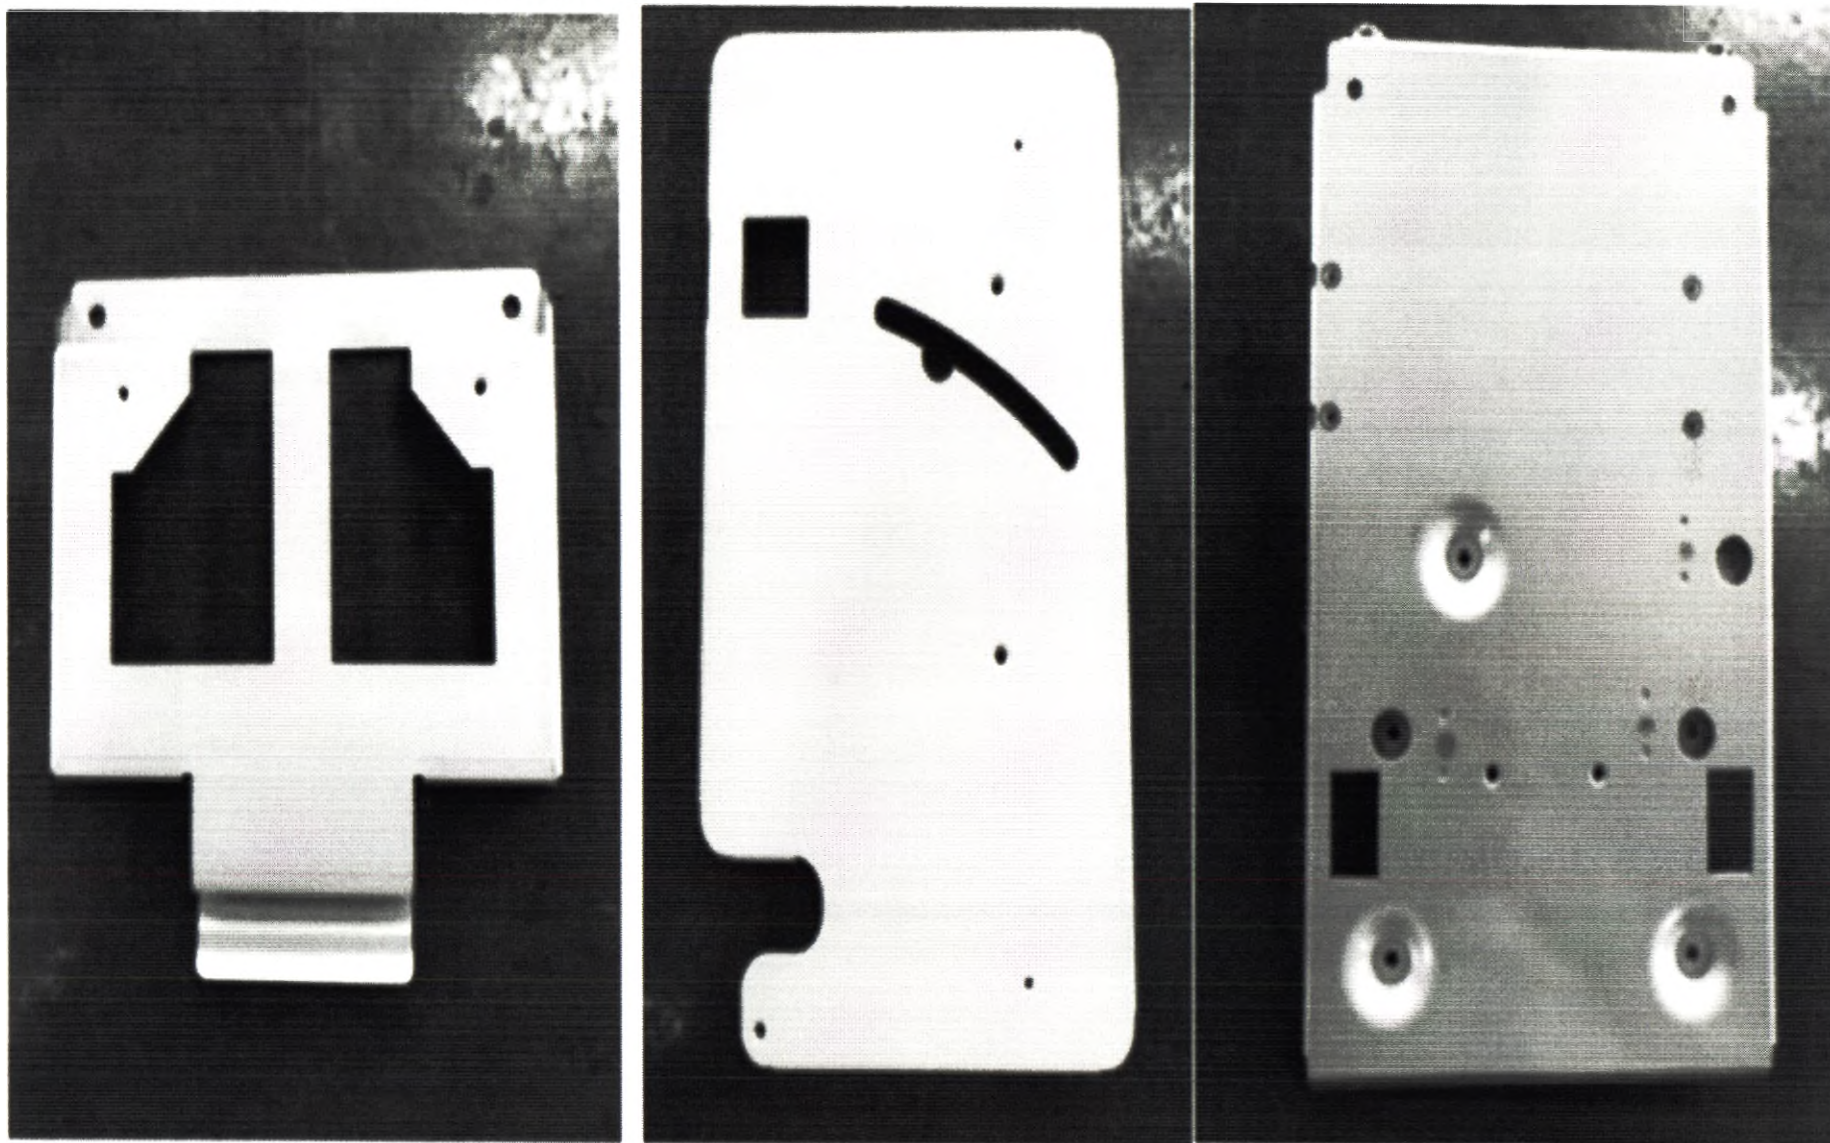


38. Комплект деталей для крепления черно-белого принтера справа

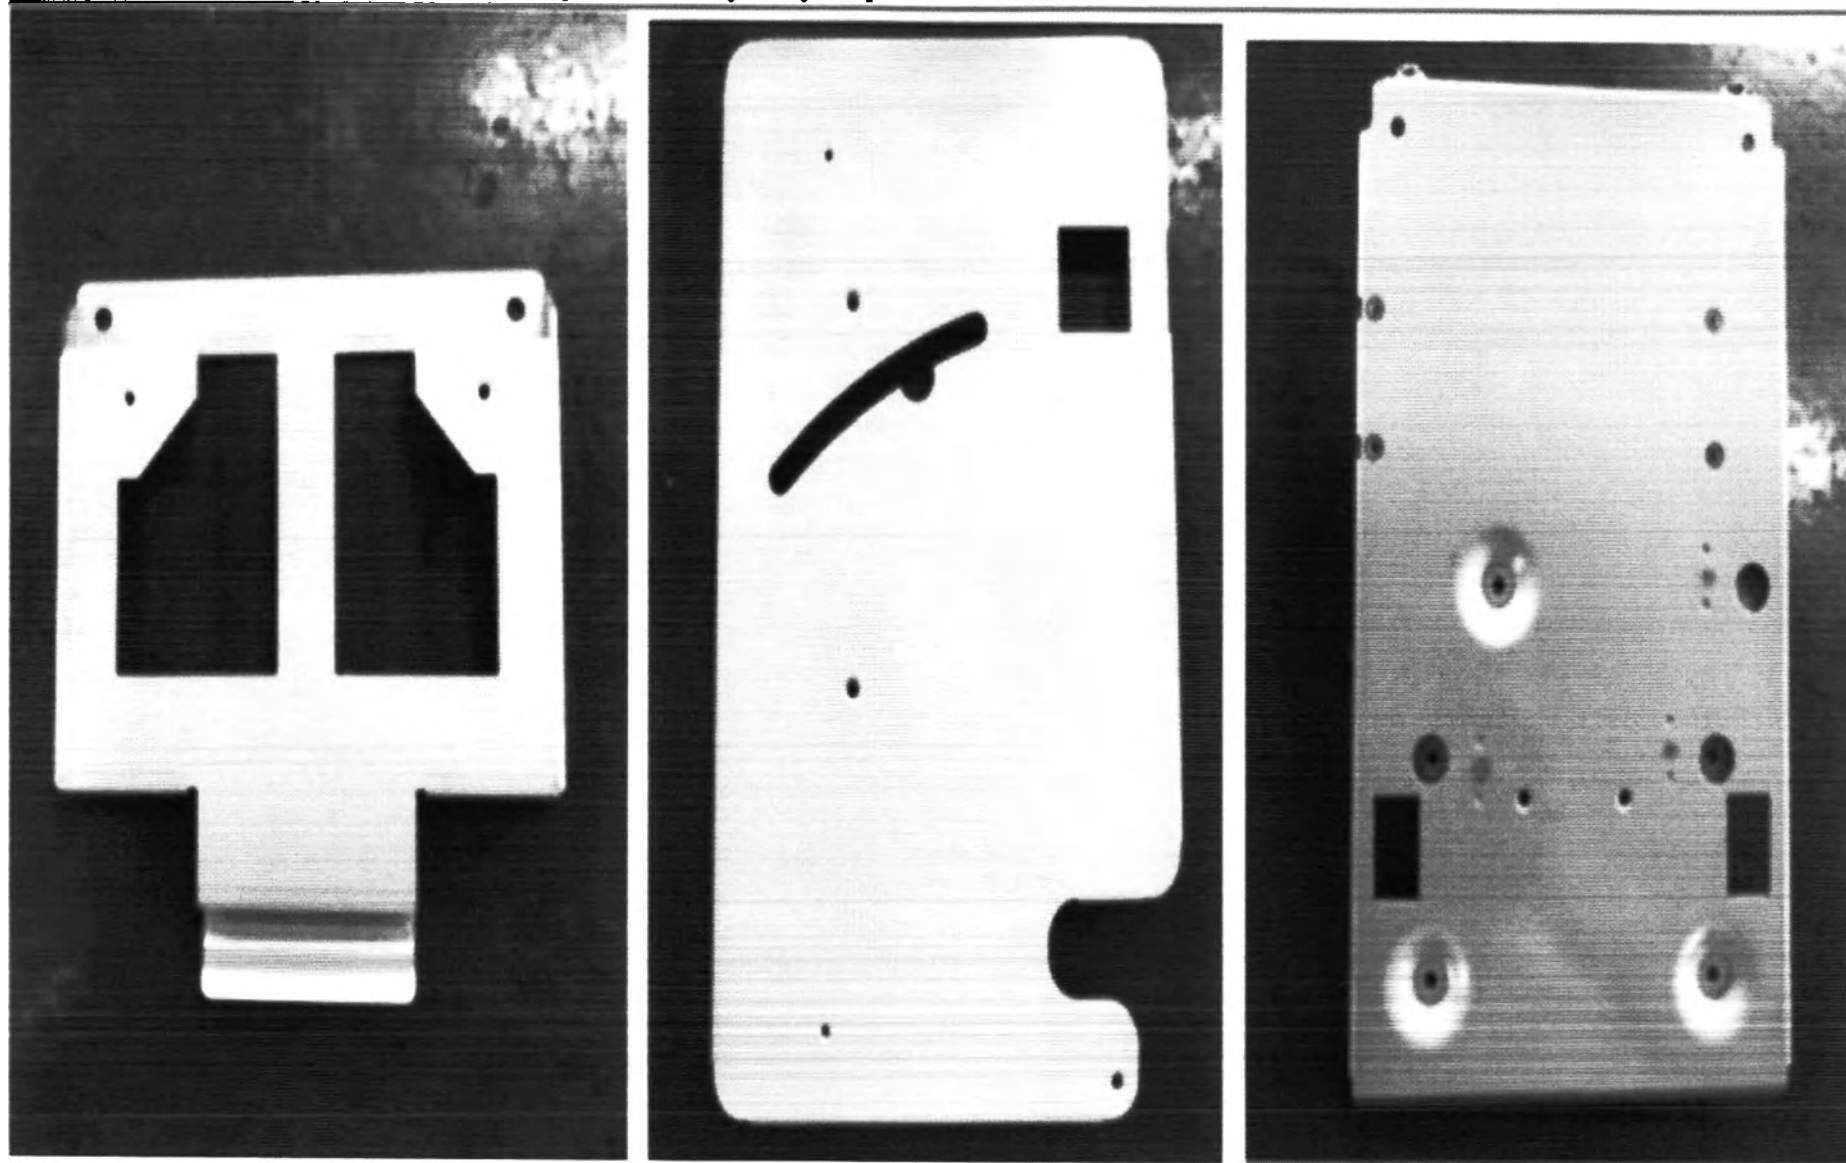


39. Комплект деталей для крепления цветного принтера

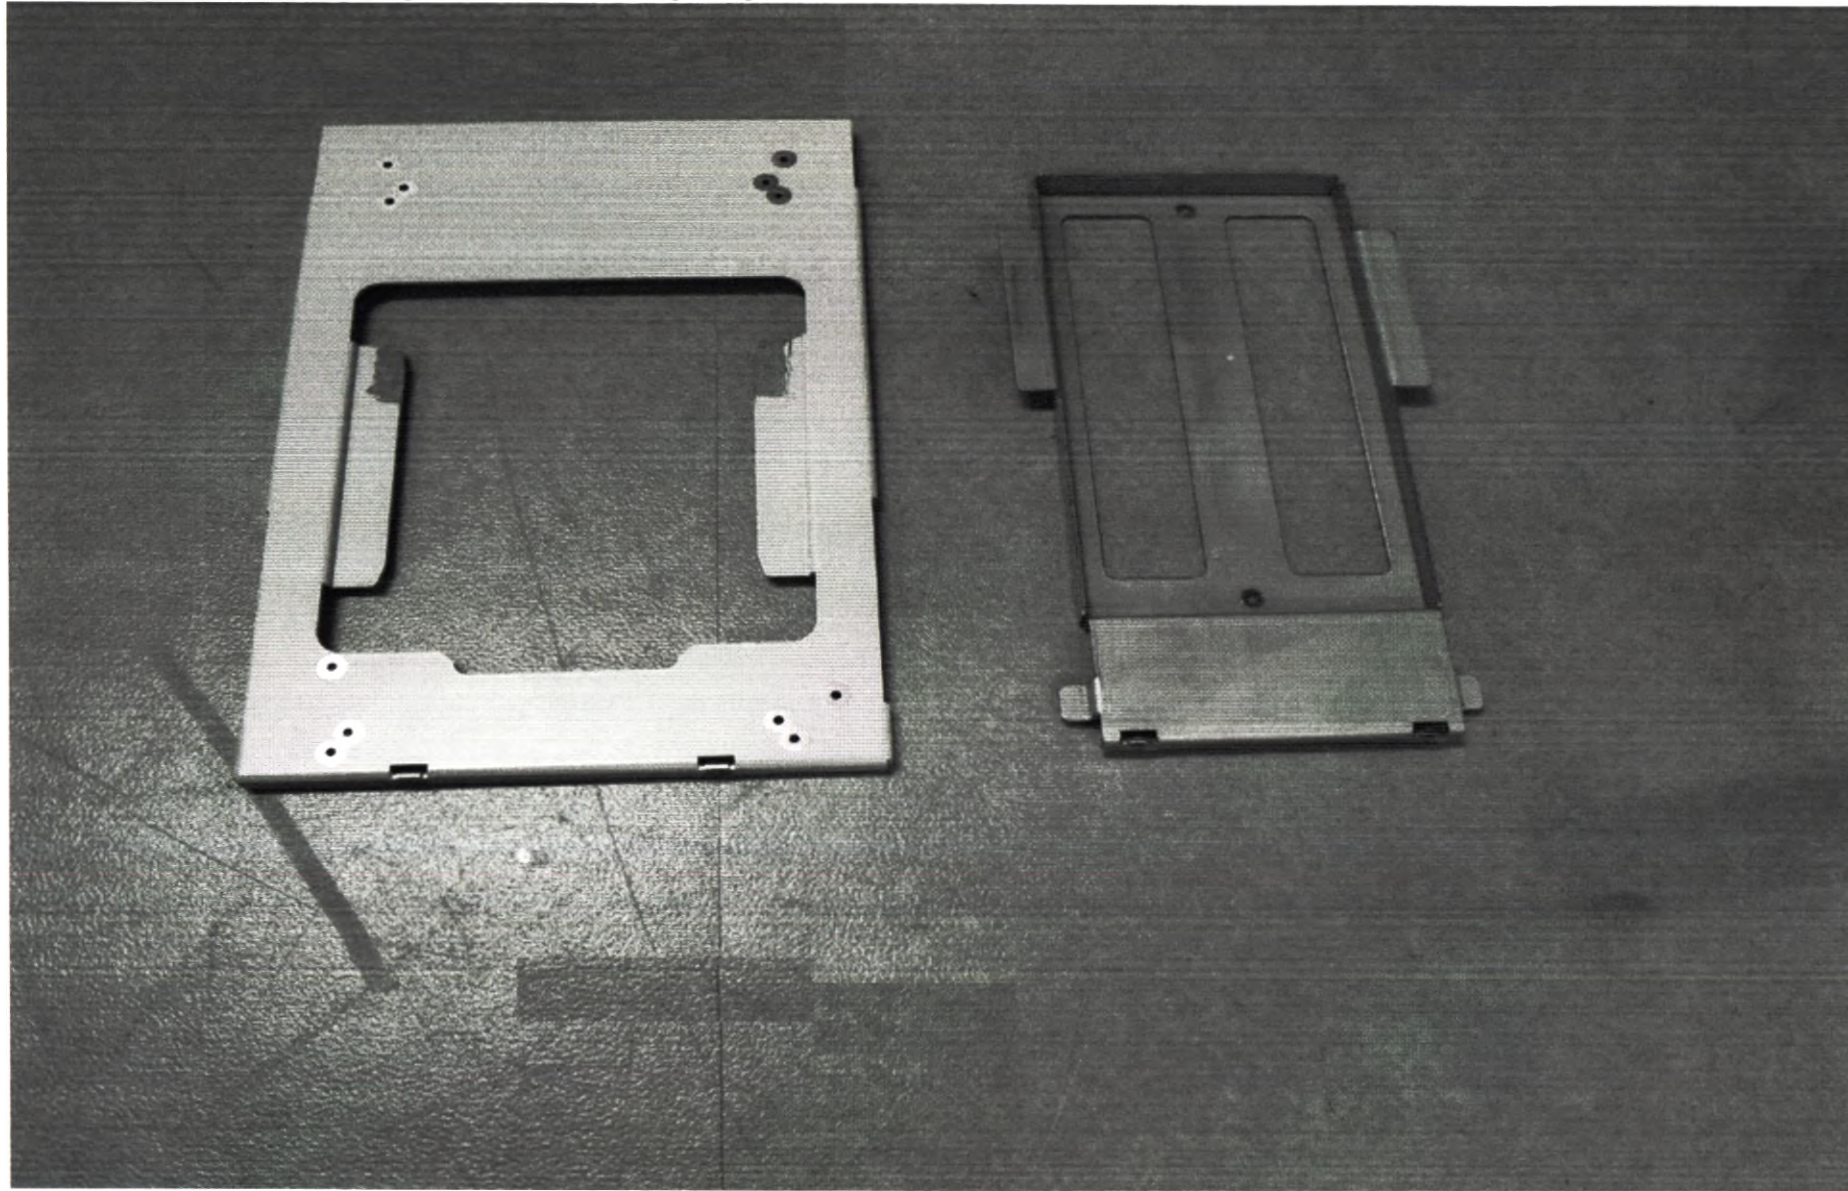


40. Комплект деталей для крепления DVD-рекордера

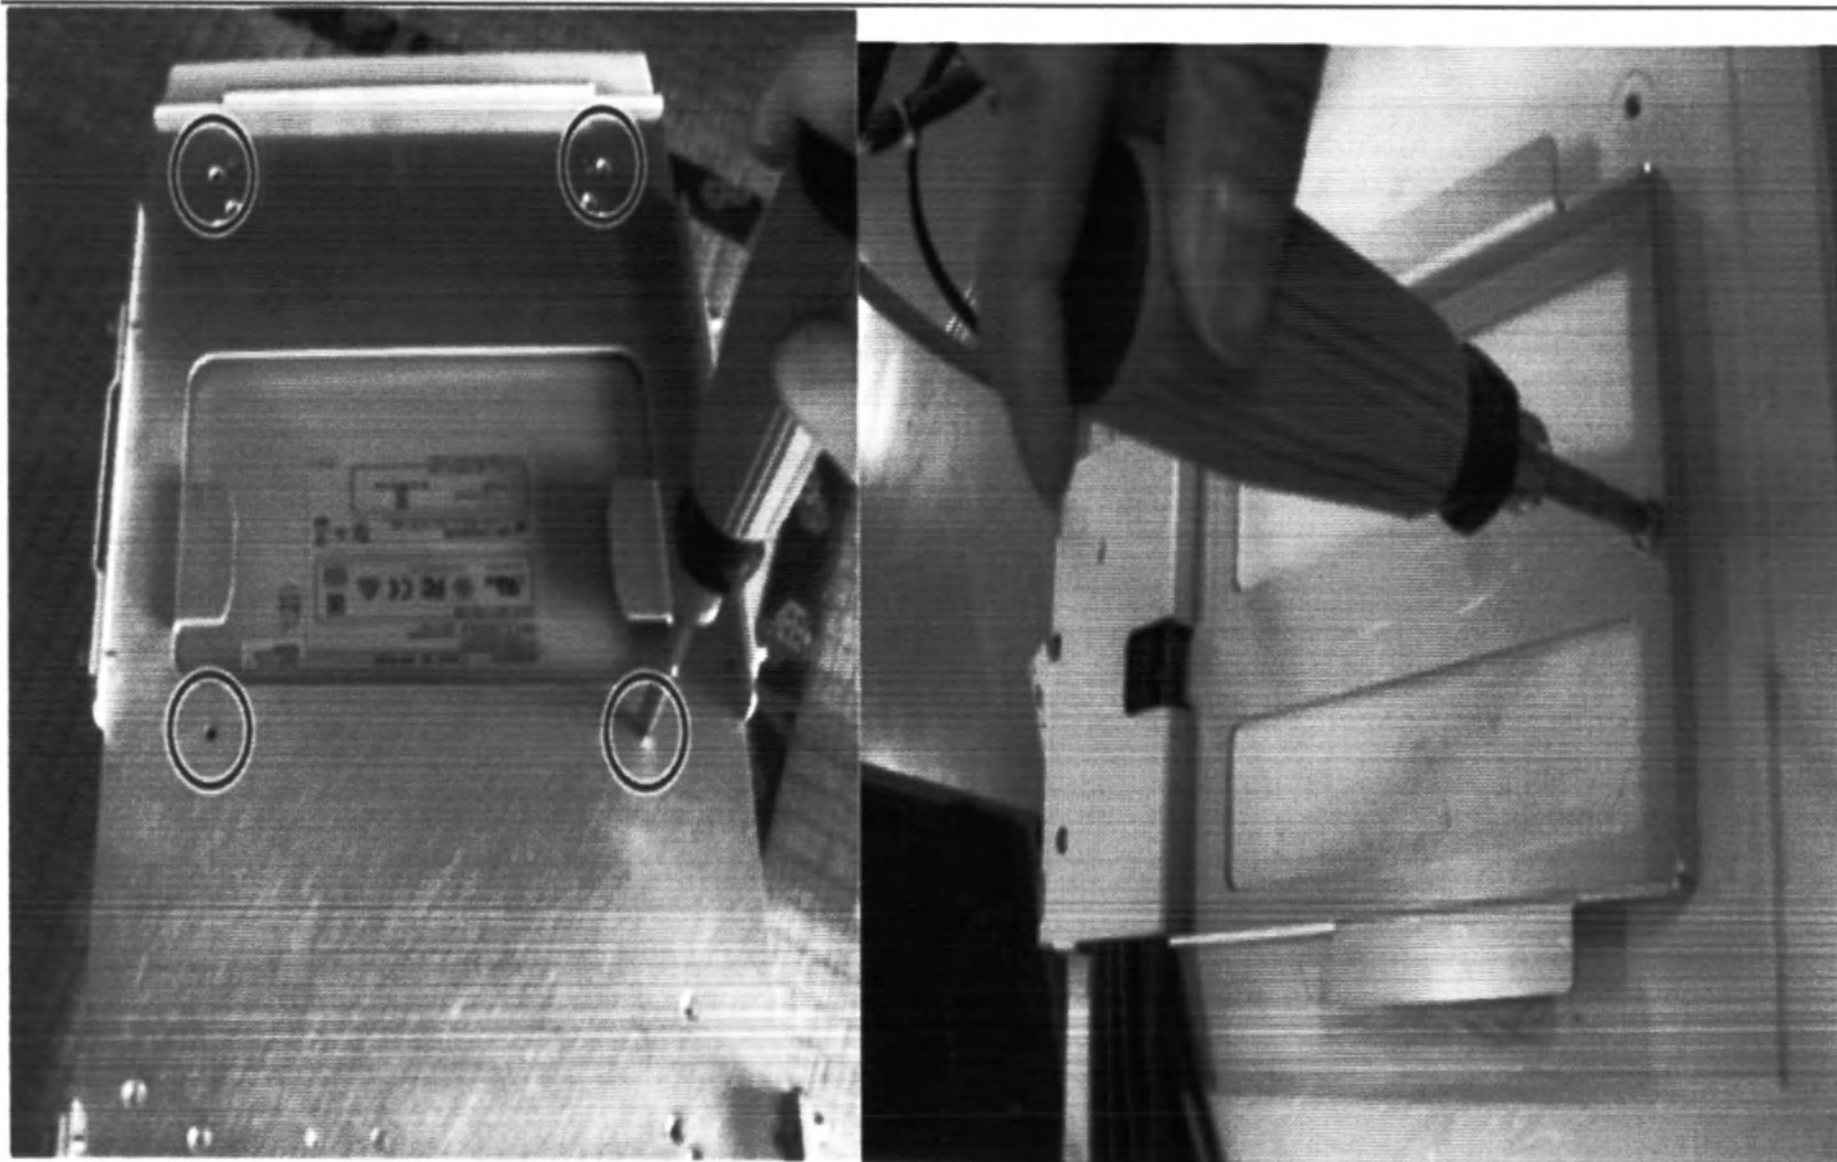


41. Комплект деталей для крепления цветного принтера и DVD-рекордера

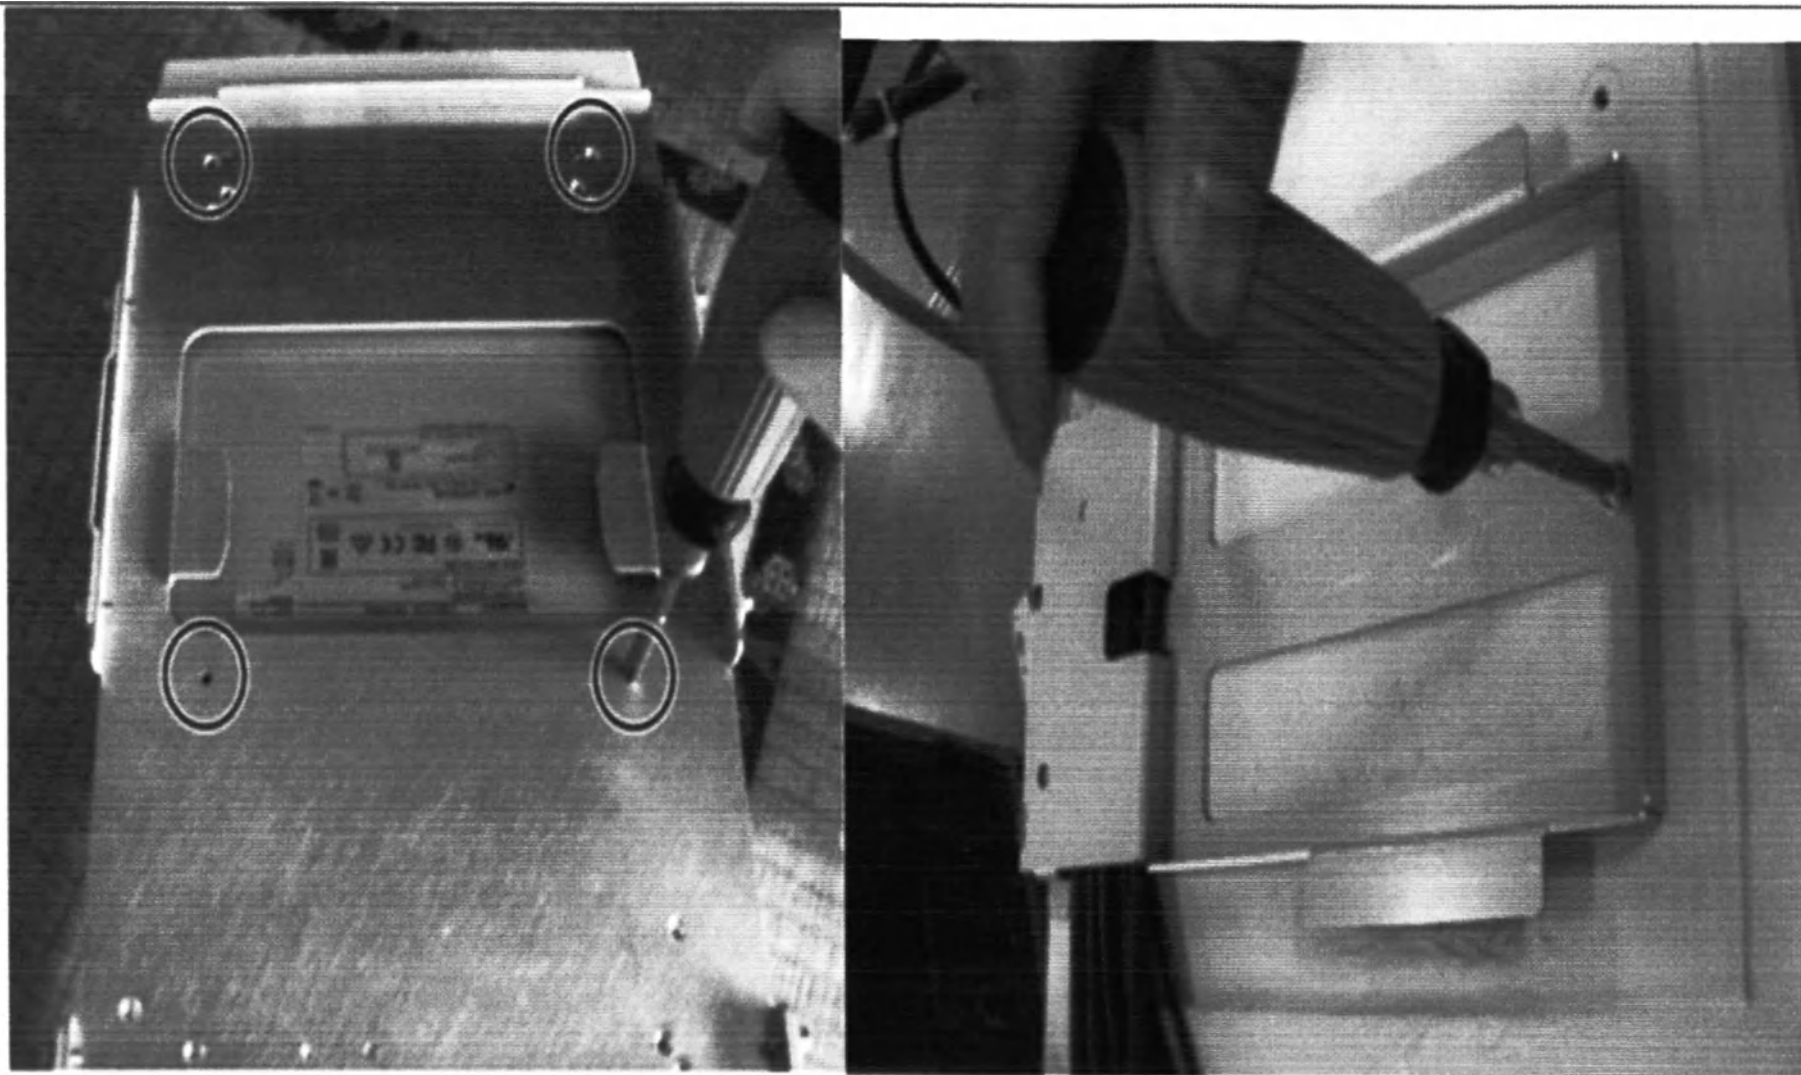

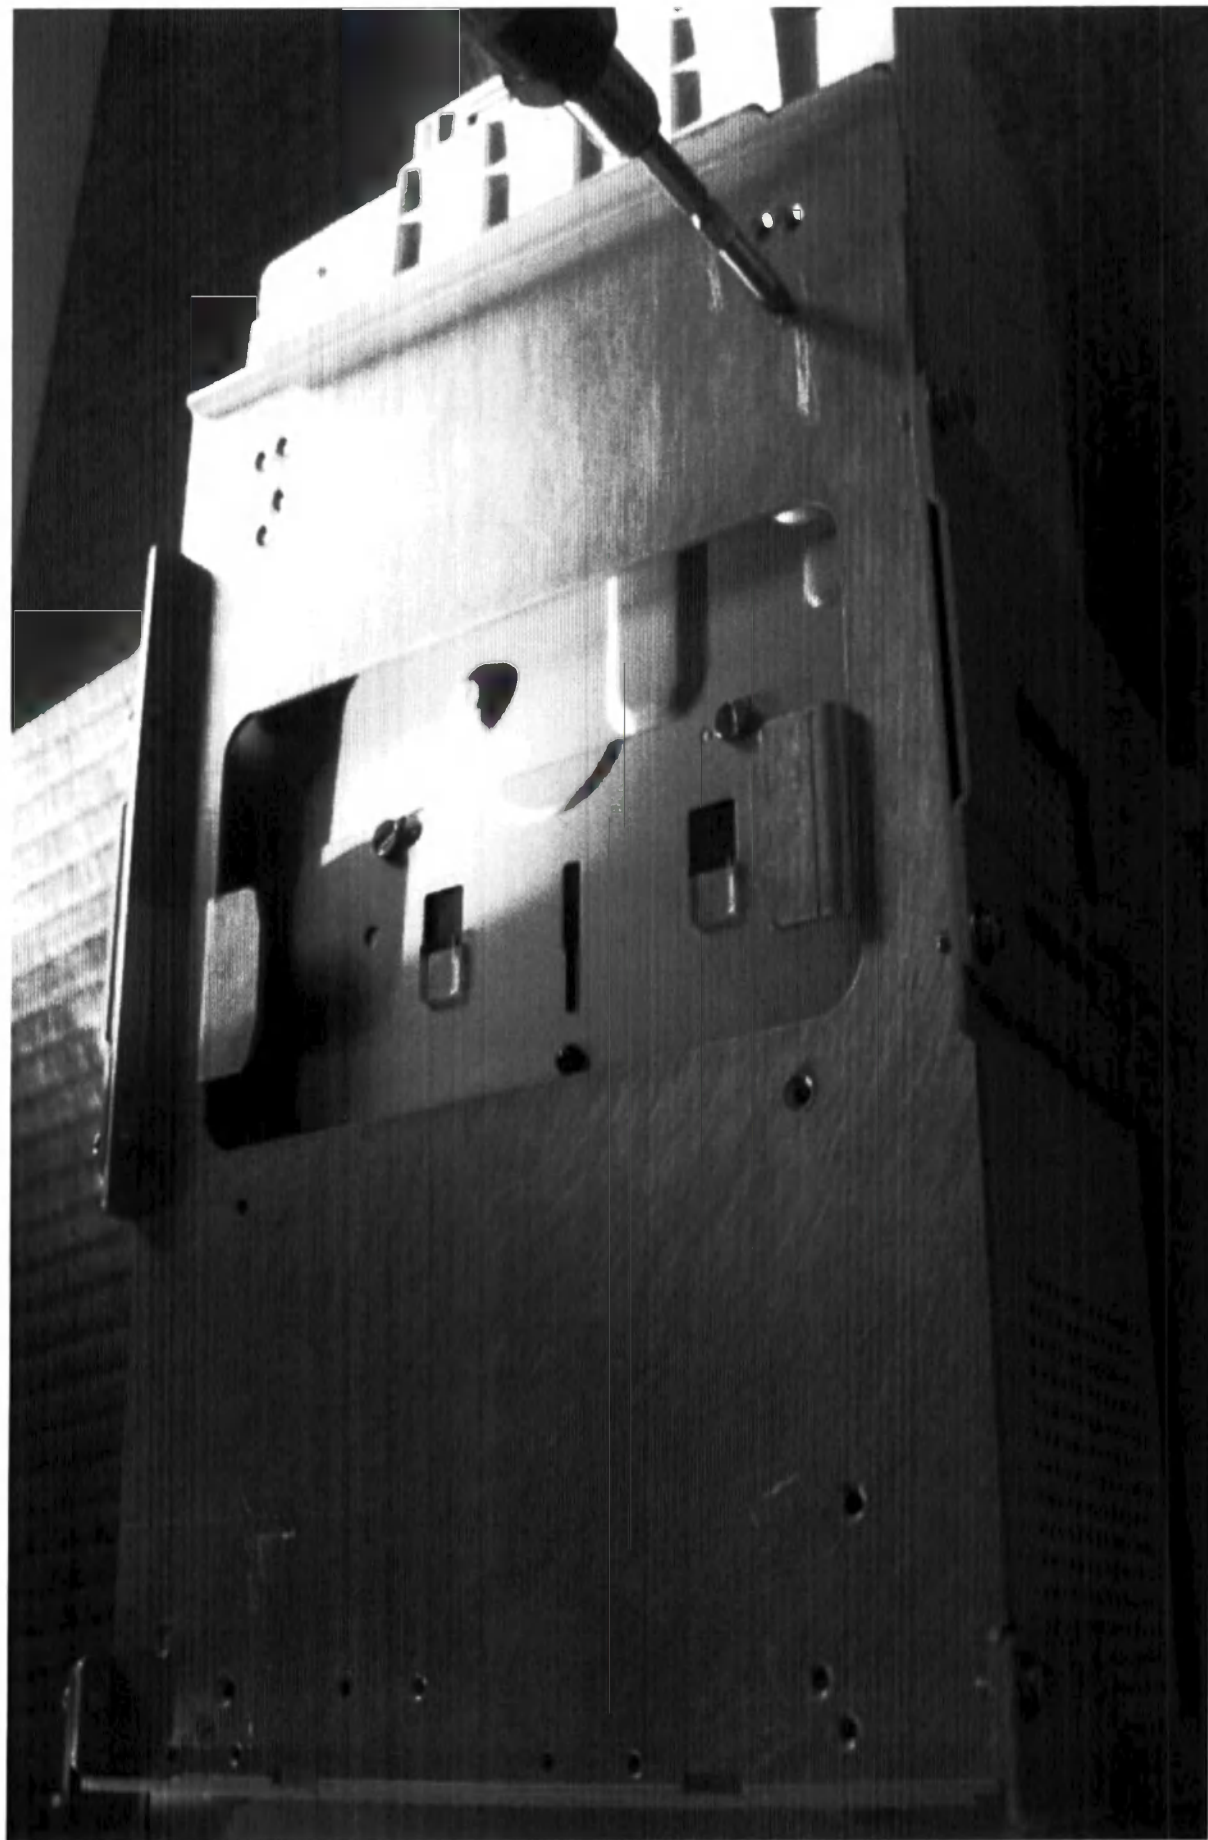

42. Комплект для установки черно-белого принтера, работающего от источника питания переменного тока

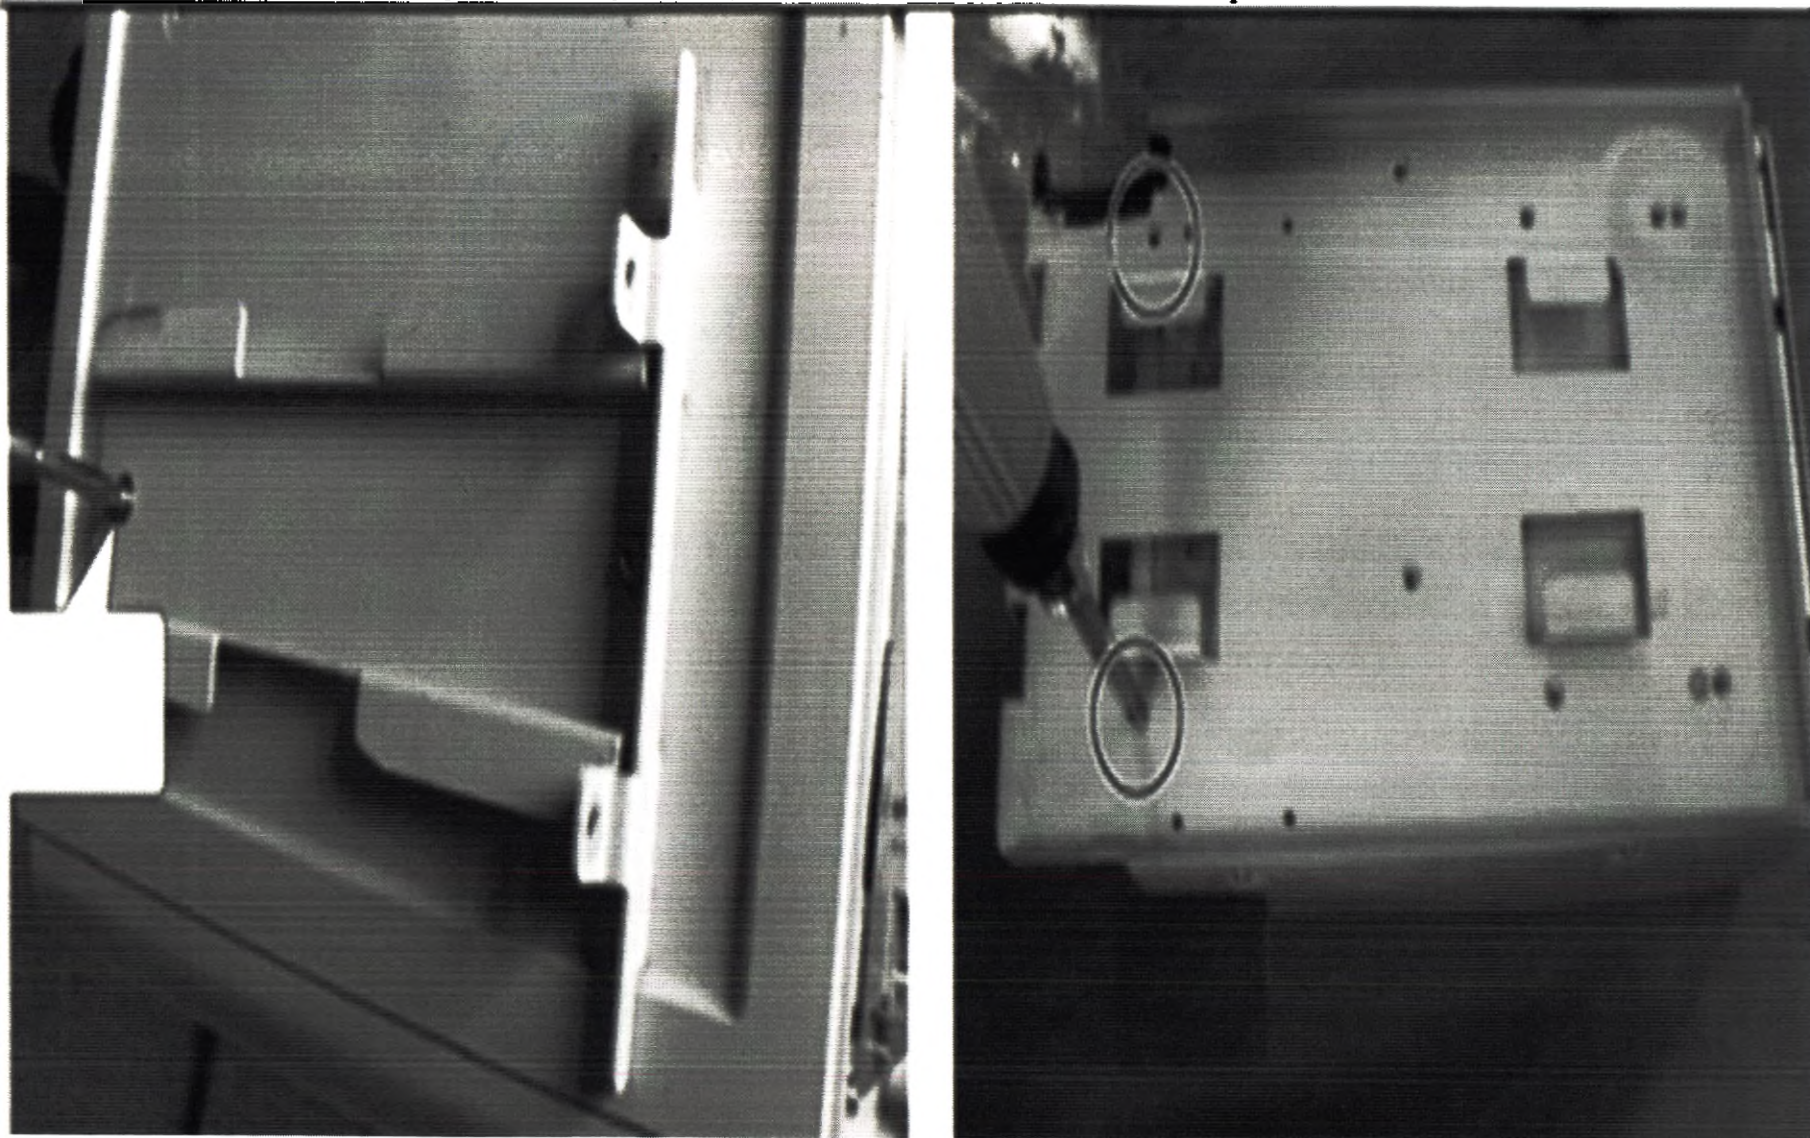

Всего прошито,
пронумеровано и скреплено
печатью 50 листов
Подпись _____

