


Реагенты и контрольные материалы для гематологических исследований in vitro:

Изотонический разбавитель Дилуэнт СД (Diluent CD)


Вариант 1, Внешний вид 1 (фасовка 20 л в жесткой канистре)

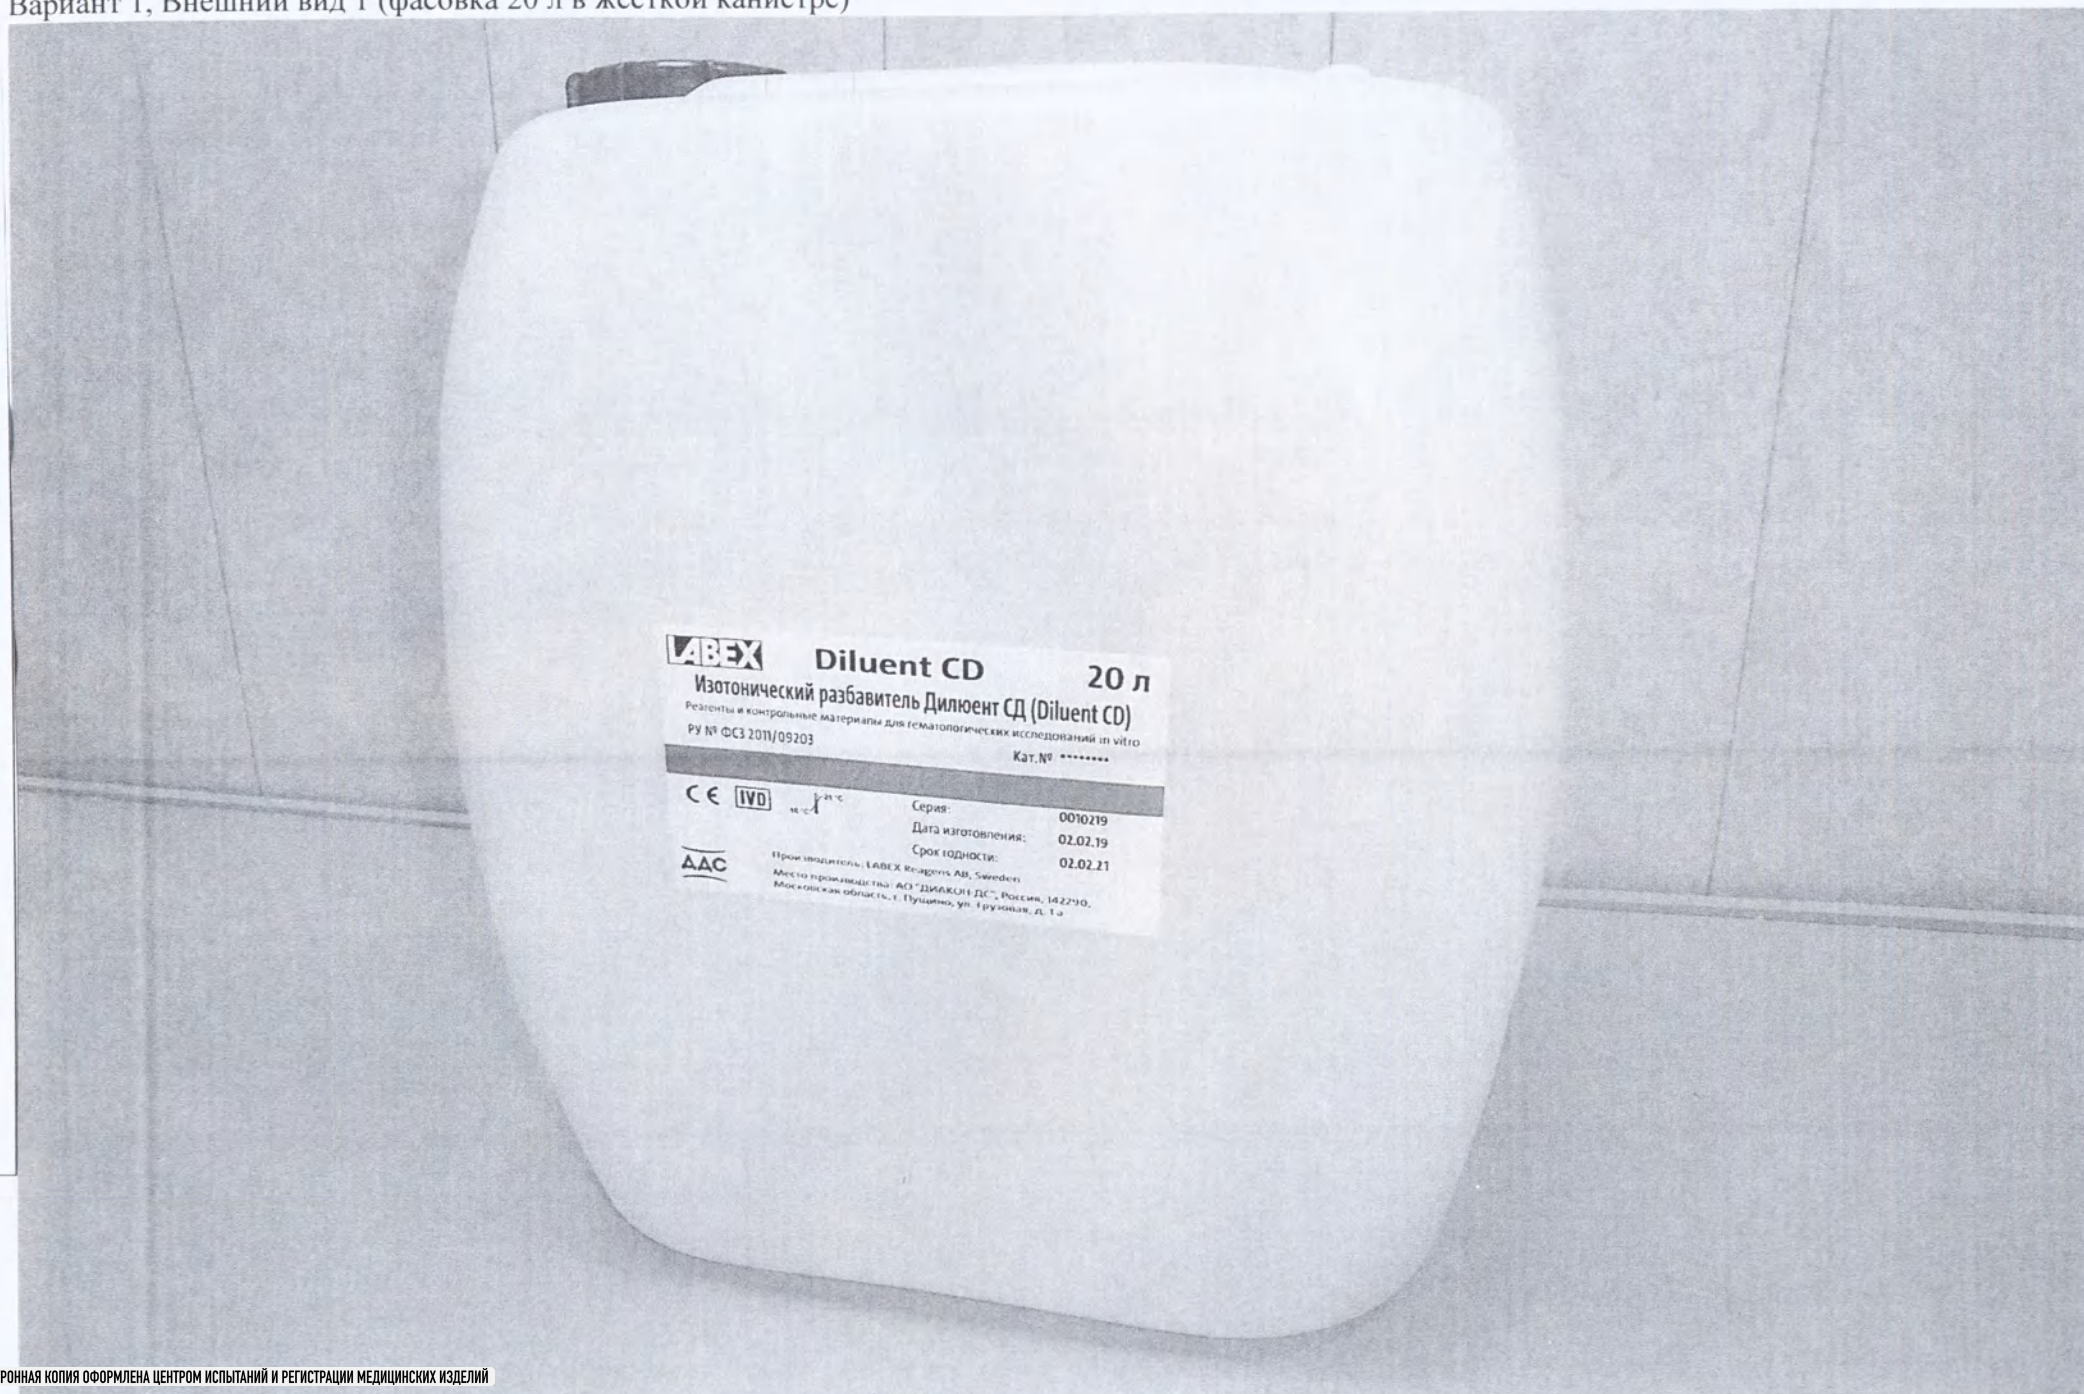

Реагенты и контрольные материалы для гематологических исследований in vitro:

Изотонический разбавитель Дилуент СД (Diluent CD)

Вариант 1, Внешний вид 2 (фасовка 20 л в кубитейнере)

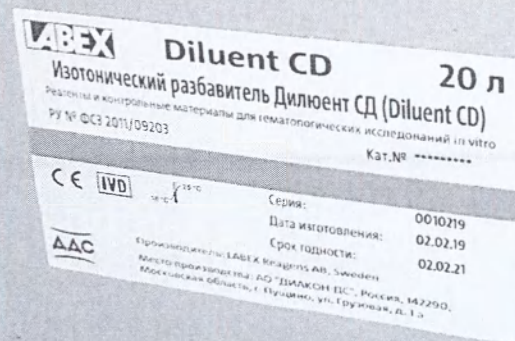

Реагенты и контрольные материалы для гематологических исследований in vitro:

Изотонический разбавитель Дилуэнт СД (Diluent CD)

Вариант 2, Внешний вид 1 (фасовка 20 л в жесткой канистре + карта идентификационная)

LABEX **Diluent CD** **20 л**
Изотонический разбавитель Дилуэнт СД (Diluent CD)
Реагенты и контрольные материалы для гематологических исследований in vitro
РУ № ФСЗ 2011/09203 Кат. №: *****

Изотонический разбавитель Дилуэнт СД (Diluent CD), 20 л	Серия:	0010219
Карта идентификационная	Дата изготовления:	02.02.19
	Срок годности:	02.02.21

CE IVD 10 °C

ААС Производитель: LABEX Kvarnbo AB, Sweden.
Место производства: АО "БИОАСН ЛС", Россия, 142290,
Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1а


Карта идентификационная
Изотонический разбавитель
Дилуэнт СД (Diluent CD)
20 л

Кат. №: ***** С. серия: 0010219

Реагенты и контрольные материалы для гематологических исследований in vitro:

Изотонический разбавитель Дилуэнт СД (Diluent CD)

Вариант 2, Внешний вид 2 (фасовка 20 л в кубитейнере + карта идентификационная)

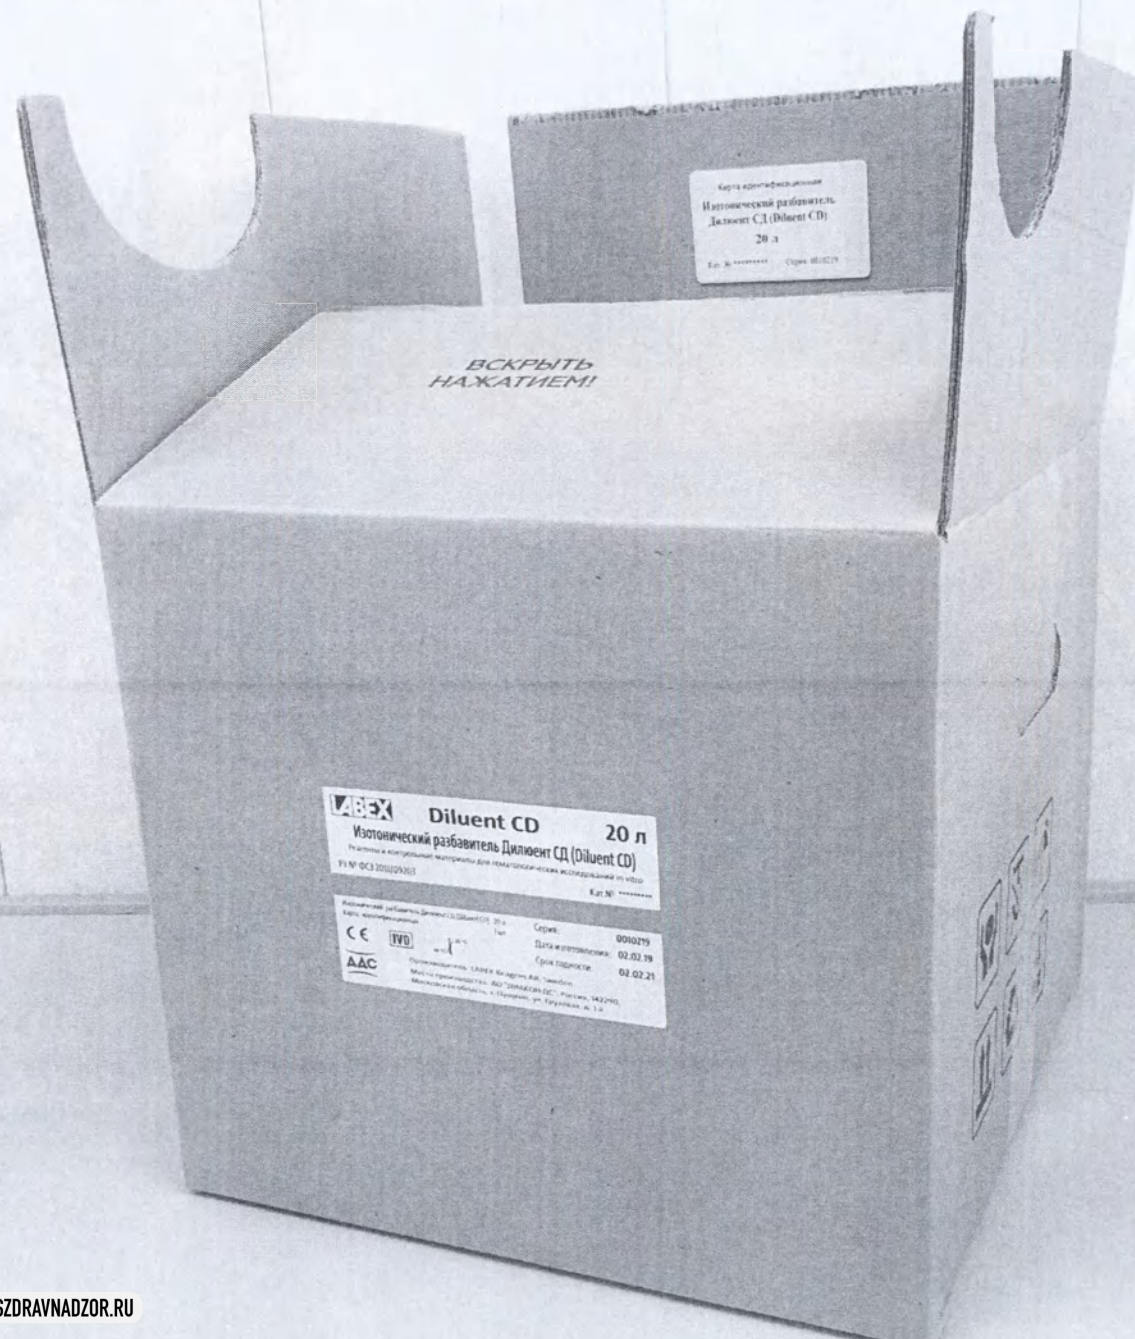

Прошито, пронумеровано и скреплено печатями 4

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС», Россия

В.В. Николаев

МП

«10»

09

20 19

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
«ЛАБЕКС Редженс АБ», Швеция

Герт Йоханссон

МП

LABEX

«10»


09

20 19

Реагенты и контрольные материалы для гематологических исследований in vitro:

Изотонический разбавитель Референт СД (Referent CD)

Вариант 1, Комплектация 1, Внешний вид 1 (фасовка 20 л в жесткой канистре)

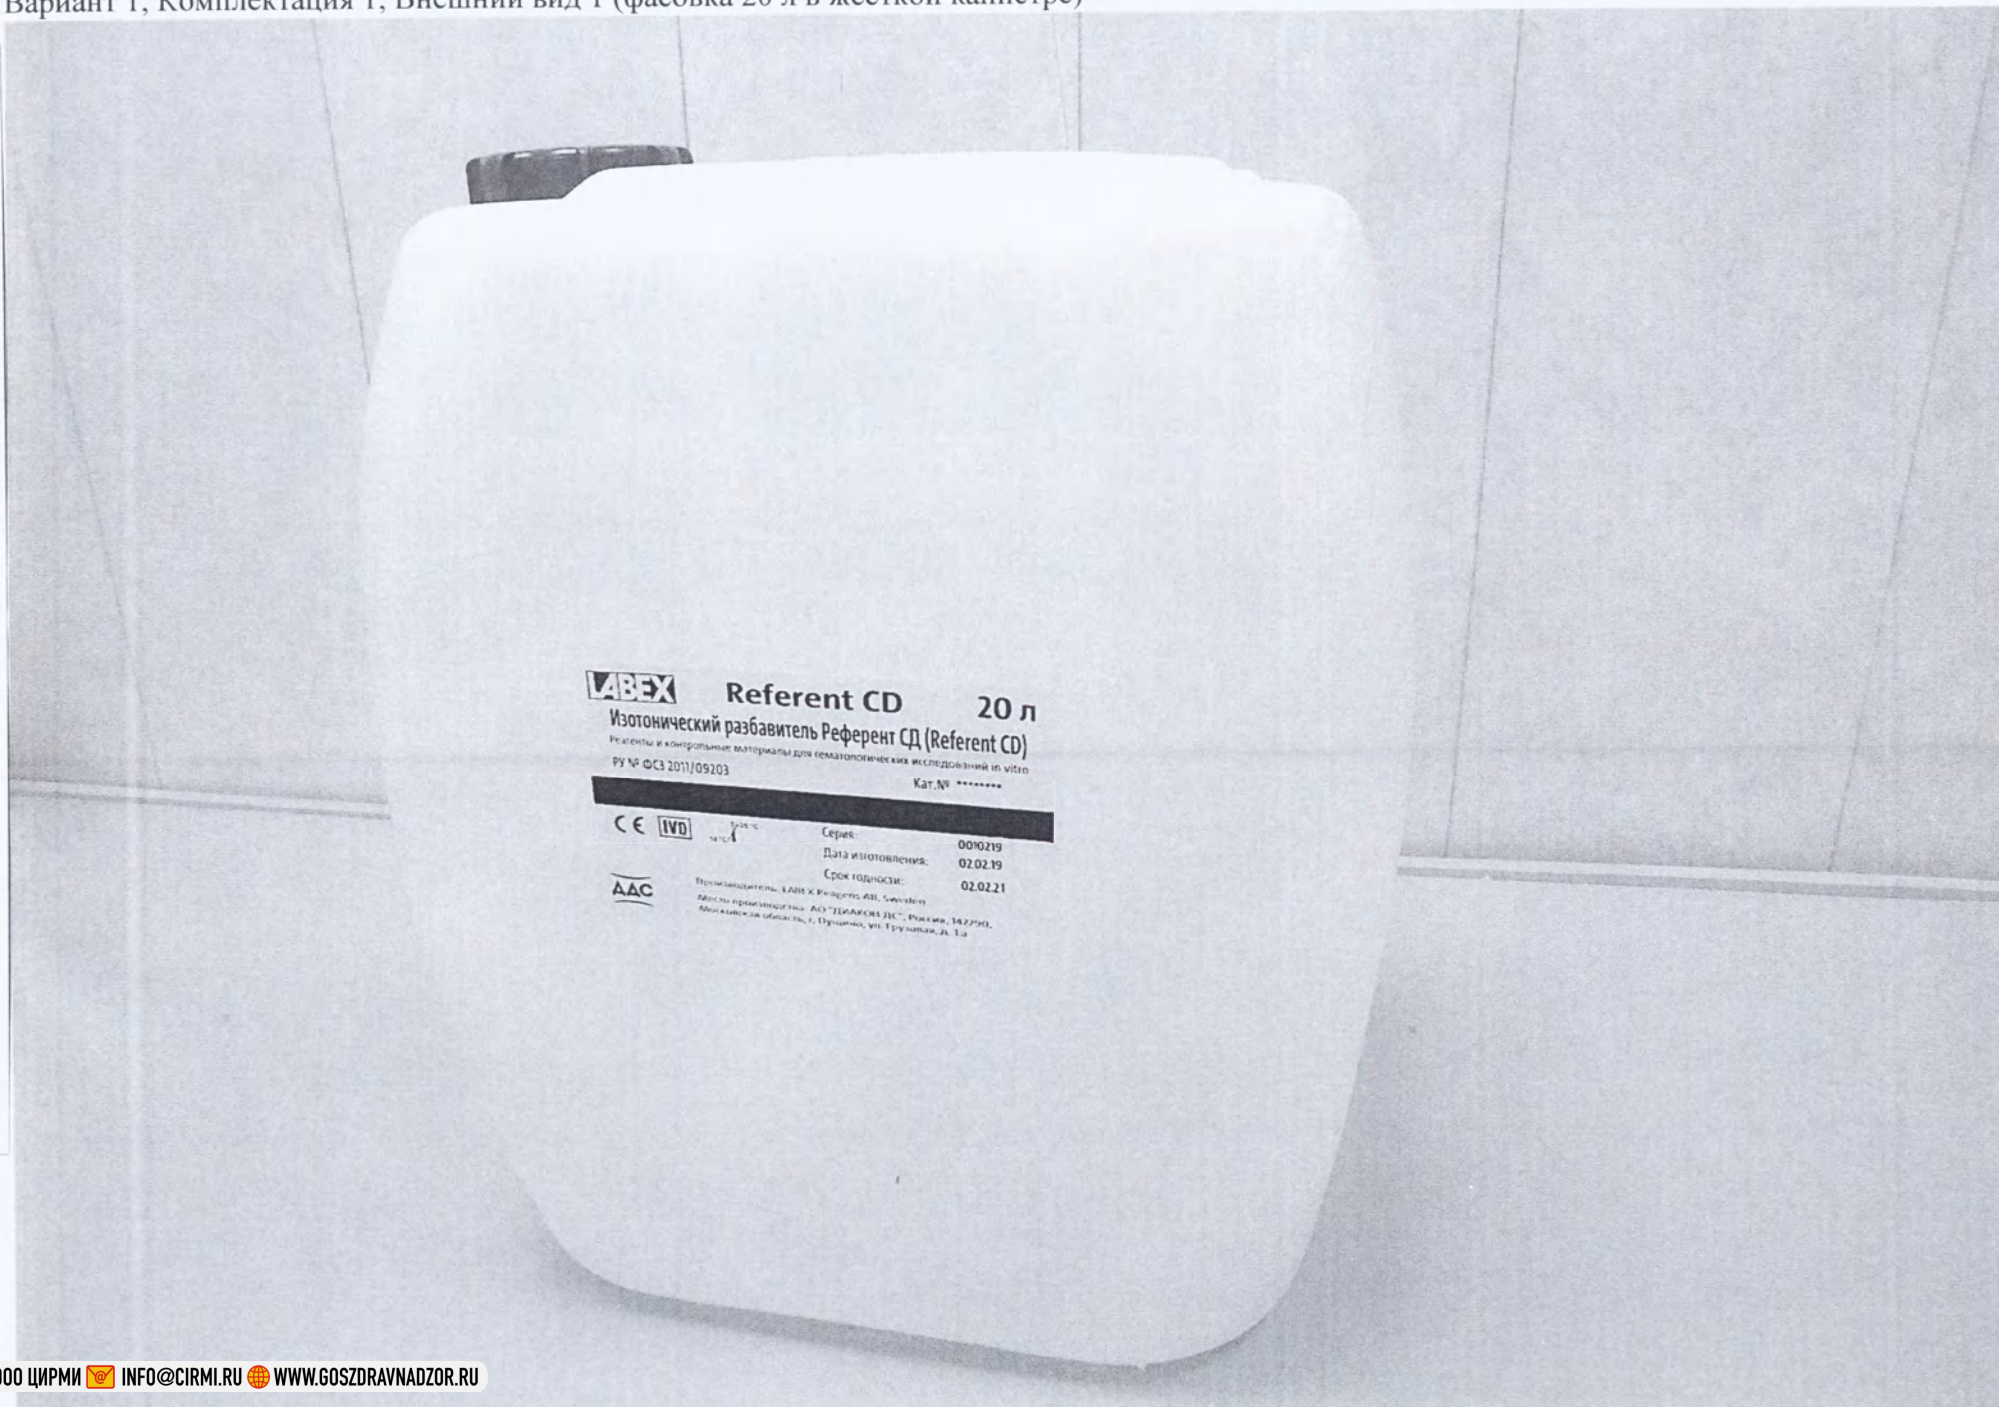

Реагенты и контрольные материалы для гематологических исследований in vitro:

Изотонический разбавитель Референт СД (Referent CD)

Вариант 1, Комплектация 1, Внешний вид 2 (фасовка 20 л в кубитейнере)



Реагенты и контрольные материалы для гематологических исследований in vitro:

Изотонический разбавитель Референт СД (Referent CD)

Вариант 1, Комплектация 2, Внешний вид 1 (фасовка 10 л в жесткой канистре)

LABEX Referent CD 10 л
Изотонический разбавитель Референт СД (Referent CD)
Реагенты и контрольные материалы для гематологических исследований in vitro
РУ № ФСЗ 2011/09203 Кат. №


Серия:	0010219
Дата изготовления:	02.02.19
Срок годности:	02.02.21

Производитель: LABEX Vardens AB, Sweden
Место производства: АО "ЦИРМИ ДС", Россия, 142290,
Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 3 а

Реагенты и контрольные материалы для гематологических исследований in vitro:

Изотонический разбавитель Референт СД (Referent CD)

Вариант 1, Комплектация 2, Внешний вид 2 (фасовка 10 л в кубитейнере)

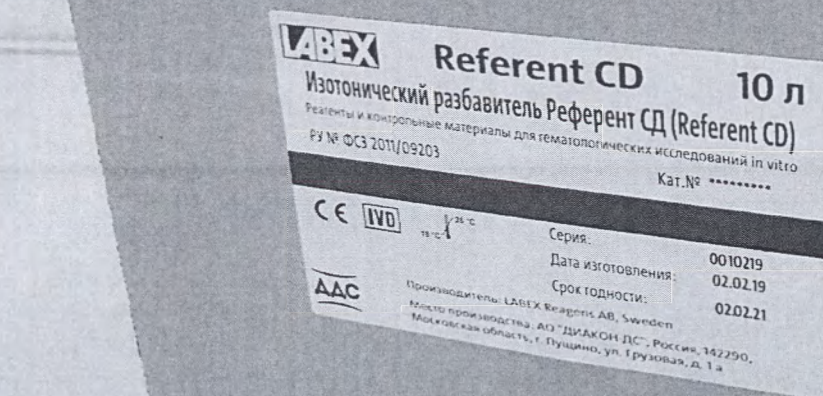

Реагенты и контрольные материалы для гематологических исследований in vitro:

Изотонический разбавитель Референт СД (Referent CD)

Вариант 2, Комплектация 1, Внешний вид 1 (фасовка 20 л в жесткой канистре + карта идентификационная)



LABEX Referent CD 20 л
Изотонический разбавитель Референт СД (Referent CD)
Реагенты и контрольные материалы для гематологических исследований in vitro
ПУ № ФС.2011/09/203 Кат. № *****

Изотонический разбавитель Референт СД (Referent CD) 20 л	Серия:	0010219
Карта идентификационная	Год	2019
Дата изготовления:	02.02.19	
Срок годности:	02.02.21	

CE IVD

AAC

Производитель: LABEX Reagents AB, Sweden
Адрес производства: АО "ДИАЛЭН БС", Россия, 142290,
Московская область, г. Пушкино, ул. Гуржова, д. 1-а

Карта идентификационная
Изотонический разбавитель
Референт СД (Referent CD)
20 л
Кат. № ***** Серия: 0010219

Реагенты и контрольные материалы для гематологических исследований in vitro:

Изотонический разбавитель Референт СД (Referent CD)

Вариант 2, Комплектация 1, Внешний вид 2 (фасовка 20 л в кубитейнере + карта идентификационная)



Реагенты и контрольные материалы для гематологических исследований in vitro:

Изотонический разбавитель Референт СД (Referent CD)

Вариант 2, Комплектация 2, Внешний вид 1 (фасовка 10 л в жесткой канистре + карта идентификационная)

LABEX Referent CD 10 л
Изотонический разбавитель Референт СД (Referent CD)
Реагенты и контрольные материалы для гематологических исследований in vitro

РУ № ФСЗ 2011/09203 Кат. № *****

Изотонический разбавитель Референт СД (Referent CD) 10 л	Серия:	0010219
Карта идентификационная	Дата изготовления:	02.02.19
	Срок годности:	02.02.21

CE IVD 14 °C 25 °C
ААС

Производитель: LABEX Reagents AB, Sweden
Место производства: АО "ДИАКОН-ДС", Россия, 142290,
Московская область, г. Пушкино, ул. Грузовая, д. 1-а

Карта идентификационная
**Изотонический разбавитель
Референт СД (Referent CD)**
10 л
Кат. № ***** Серия: 0010219

Реагенты и контрольные материалы для гематологических исследований in vitro:

Изотонический разбавитель Референт СД (Referent CD)

Вариант 2, Комплектация 2, Внешний вид 2 (фасовка 10 л в кубитейнере + карта идентификационная)



Прошито, пронумеровано и скреплено печатями 8

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС», Россия

В.В. Николаев

МП

«10» 09 2019



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
«ЛАБЕКС Редженс АБ», Швеция

Герт Йоханссон

МП


«10» 09 2019

LABEX

Реагенты и контрольные материалы для гематологических исследований in vitro:

Лизирующий реагент Аутолайз СД 3500 (Autolyse CD 3500)

Вариант 1, Комплектация 1, Внешний вид 1 (фасовка 5 л в жесткой канистре)

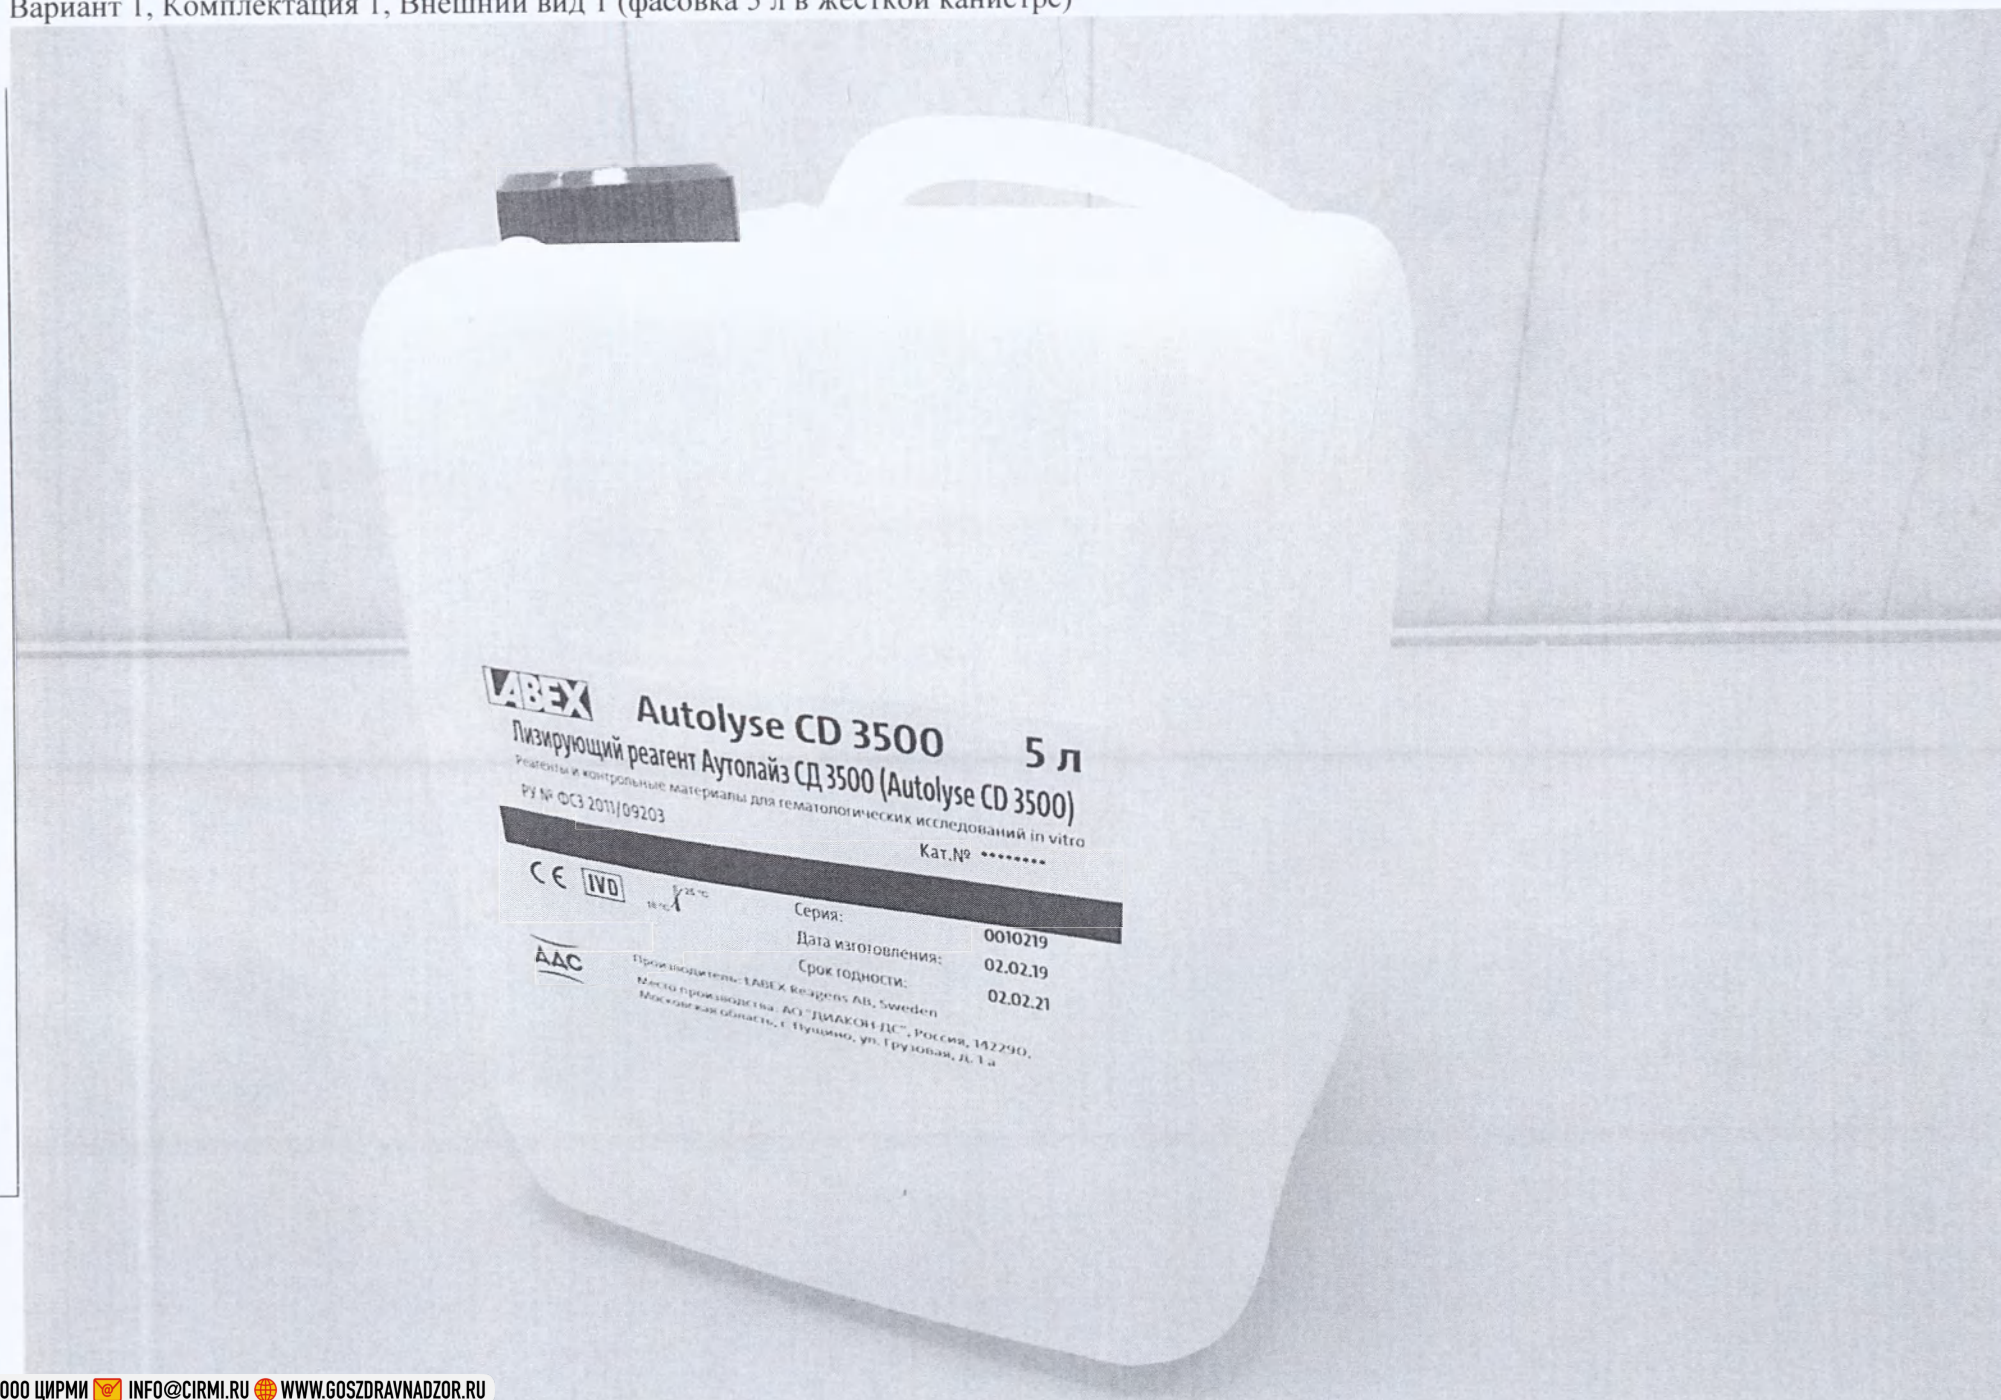

Реагенты и контрольные материалы для гематологических исследований in vitro:


Лизирующий реагент Аутолайз СД 3500 (Autolyse CD 3500)

Вариант 1, Комплектация 1, Внешний вид 2 (фасовка 5 л в кубитейнере)



Реагенты и контрольные материалы для гематологических исследований in vitro:
Лизирующий реагент Аутолайз СД 3500 (Autolyse CD 3500)

Вариант 1, Комплектация 2, Внешний вид 1 (фасовка 1 л во флаконе)

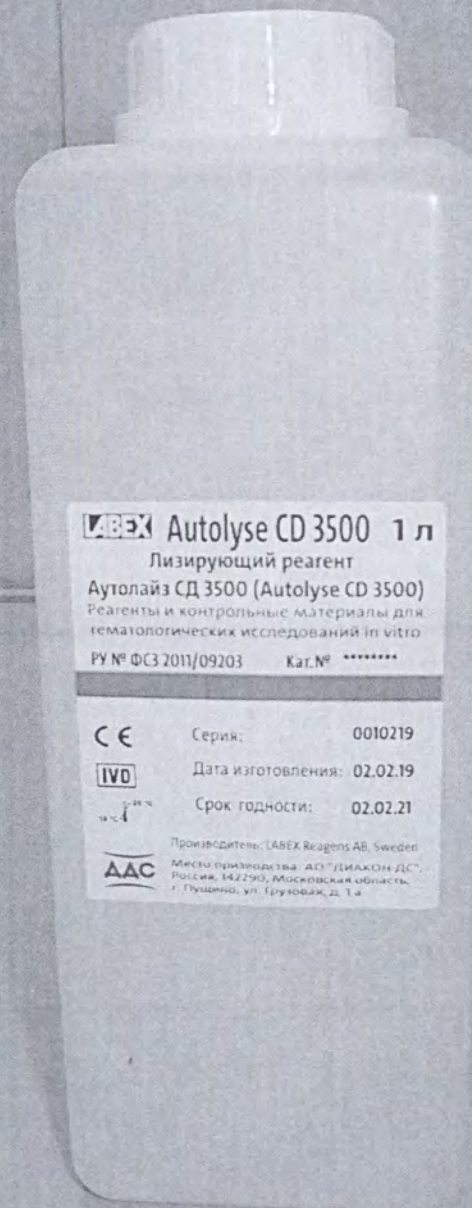

Реагенты и контрольные материалы для гематологических исследований in vitro:

Лизирующий реагент Аутолайз СД 3500 (Autolyse CD 3500)

Вариант 2, Комплектация 1, Внешний вид 1 (фасовка 5 л в жесткой канистре + карта идентификационная)

LABEX **Autolyse CD 3500** **5 л**
Лизирующий реагент Аутолайз СД 3500 (Autolyse CD 3500)
Реагенты и контрольные материалы для гематологических исследований in vitro
РУ № ФСЗ 2011/09203 Кат. № *****

Лизирующий реагент Аутолайз СД 3500 (Autolyse CD 3500) 5 л	Серия:	0010219
Карта идентификационная 1 шт	Дата изготовления:	02.02.19
	Срок годности:	02.02.21

CE IVD 18 °C 25 °C
ДАС

Производитель: LABEX Reagents AB, Sweden
Место производства: АО "ДИАКОН-ДС", Россия, 142290,
Московская область, г. Пущино, ул. Грузоприемная, д. 1А


Карта идентификационная
Лизирующий реагент Аутолайз
СД 3500 (Autolyse CD 3500)
5 л

Кат. № ***** Серия: 0010219

Реагенты и контрольные материалы для гематологических исследований in vitro:

Лизирующий реагент Аутолайз СД 3500 (Autolyse CD 3500)


Вариант 2, Комплектация 1, Внешний вид 2 (фасовка 5 л в кубитейнере + карта идентификационная)

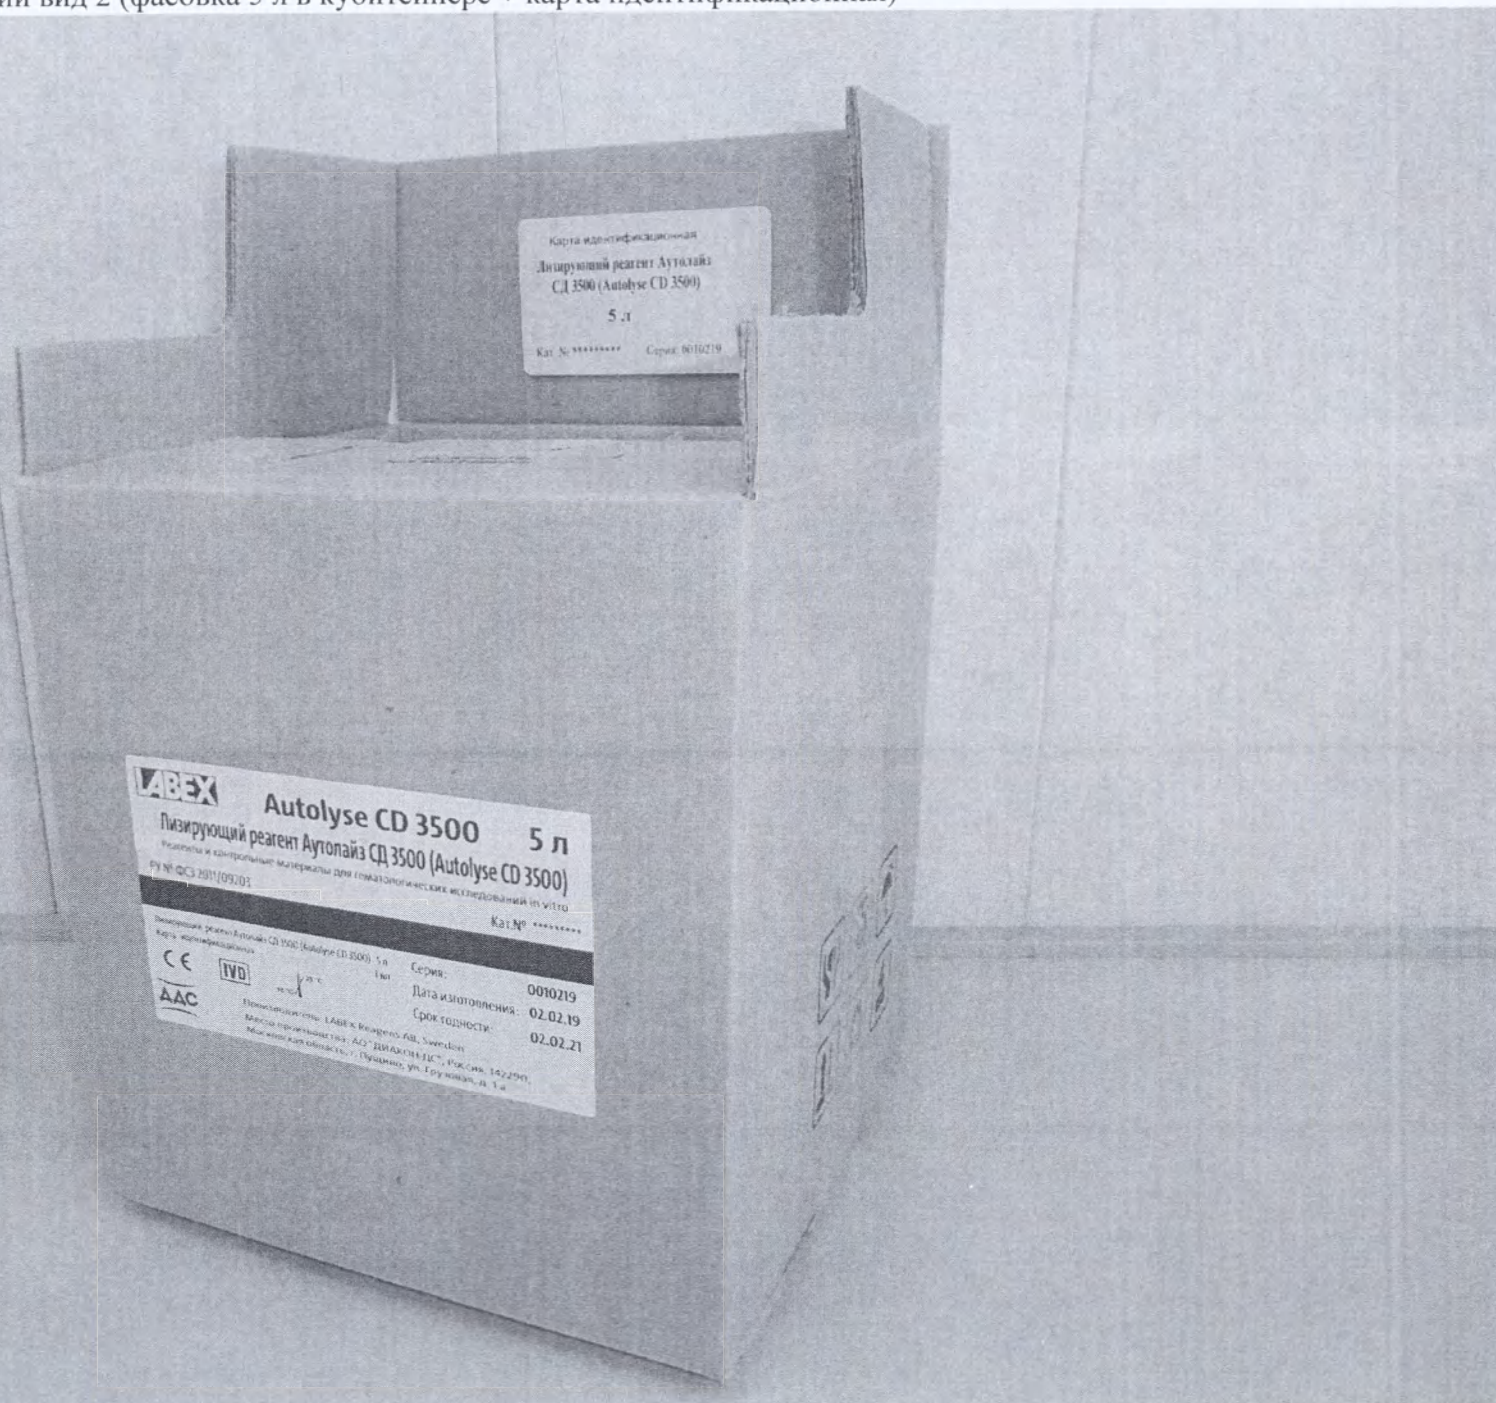

Реагенты и контрольные материалы для гематологических исследований in vitro:

Лизирующий реагент Аутолайз СД 3500 (Autolyse CD 3500)

Вариант 2, Комплектация 2, Внешний вид 1 (фасовка 1 л во флаконе в коробке + карта идентификационная)

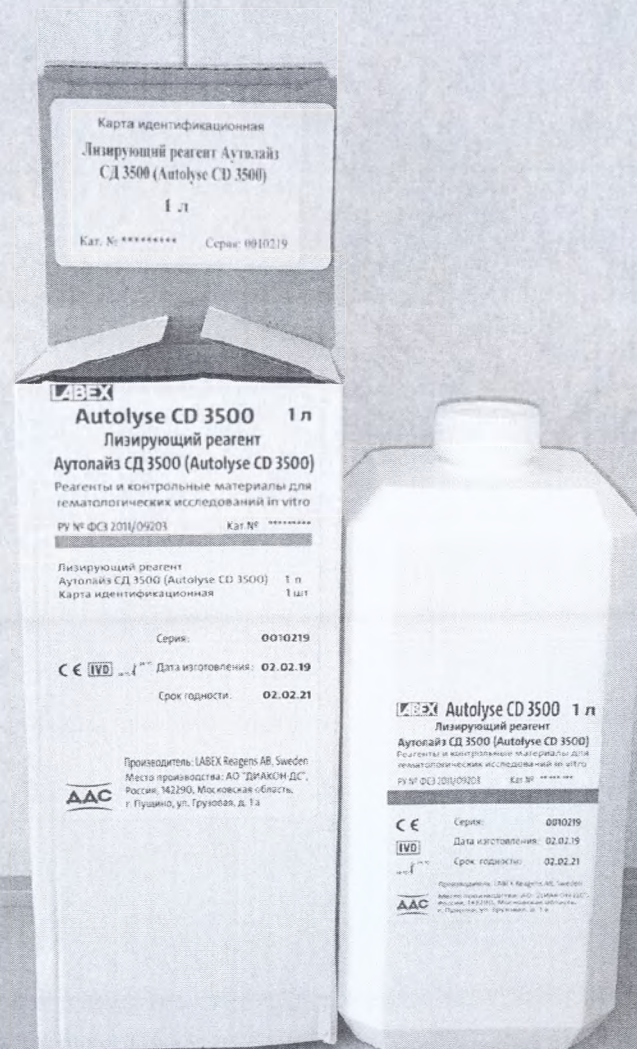

Прошито, пронумеровано и скреплено печатями 6

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС», Россия

В.В. Николаев

МП

« 10 »

09

20 19

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
«ЛАБЕКС Редженс АБ», Швеция

Герт Йоханссон

МП

« 10 »

09

20 19




Gert Johansson
LABEX

Реагенты и контрольные материалы для гематологических исследований in vitro:

Лизирующий реагент Шис СД (Sheath CD)

Вариант 1, Внешний вид 1 (фасовка 10 л в жесткой канистре)

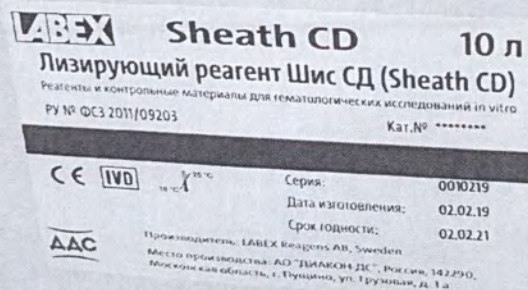

Реагенты и контрольные материалы для гематологических исследований in vitro:
Лизирующий реагент Шис СД (Sheath CD)

Вариант 1, Внешний вид 2 (фасовка 10 л в кубитейнере)



Реагенты и контрольные материалы для гематологических исследований in vitro:

Лизирующий реагент Шис СД (Sheath CD)

Вариант 2, Внешний вид 1 (фасовка 10 л в жесткой канистре + карта идентификационная)

LABEX **Sheath CD** **10 л**
Лизирующий реагент Шис СД (Sheath CD)
Реагенты и контрольные материалы для гематологических исследований in vitro
РУ № ФСЗ 2011/09203 Кат. № *****

Лизирующий реагент Шис СД (Sheath CD)	10 л	Серия:	0010219
Карта идентификационная	1 шт	Дата изготовления:	02.02.19
		Срок годности:	02.02.21

CE IVD 18-25 °C
AAC

Производитель: LABEX Reagents AB, Sweden
Место производства: АО "ДИАКОМ ДС", Россия, 142290,
Московская область, г. Пушкино, ул. Трудовая, д. 1а

Карта идентификационная
Лизирующий реагент Шис СД
(Sheath CD)


10 л

Кат. № ***** Серия: 0010219

Реагенты и контрольные материалы для гематологических исследований in vitro:

Лизирующий реагент Шис СД (Sheath CD)

Вариант 2, Внешний вид 2 (фасовка 10 л в кубитейнере + карта идентификационная)

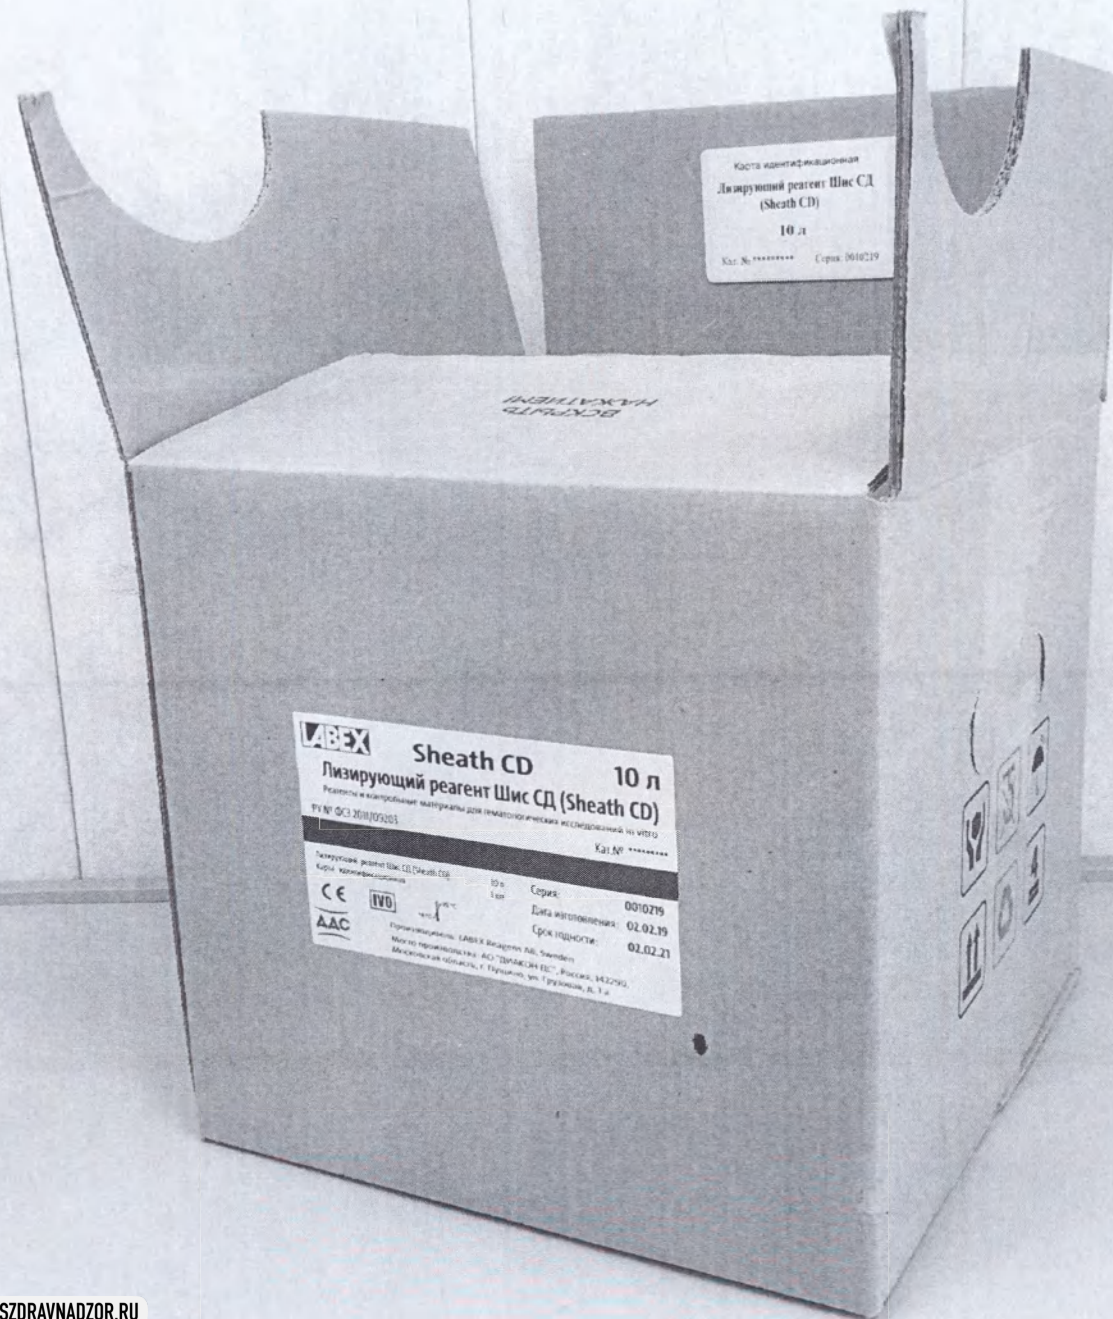

Прошито, пронумеровано и скреплено печатями 4

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС», Россия

В.В. Николаев

МП

«10» 09 2019

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
«ЛАБЕКС Редженс АБ», Швеция

Gert Johansson

Герт Йоханссон

МП

LABEX

«10» 09 2019

