

Приложение 2

Рис. 1



Рис. 2

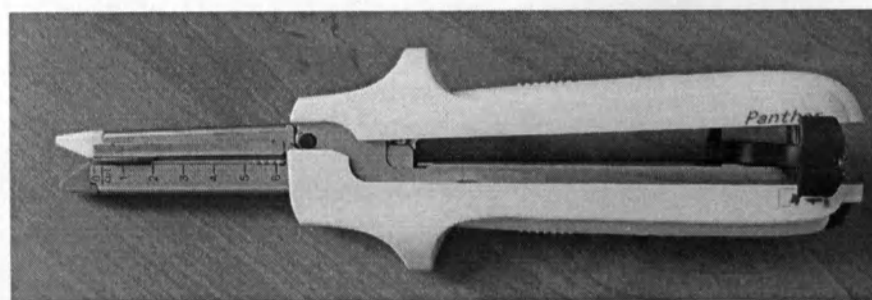


Рис. 3



Воспрещается полная либо частичная перепечатка настоящего Протокола, либо его копирование без разрешения испытательного центра медицинских изделий ФГБУ «ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздравсоцразвития России.