

Руководитель группы по регистрации продукции
для in vitro диагностики
Биохимия и портативные системы в диагностике
ООО «Сименс Здравоохранение»



Тышкунova Е.С.
«13» июля 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**«Реагент ДТТ/высвобождающий фолат для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Folate
DTT/Releasing Agent (Atellica IM Fol DTT/REL))»**

производства «Сименс Хелскеа Диагностикакс Инк.», Siemens Healthcare Diagnostics Inc., США



Рисунок 1. Реагент ДТТ/высвобождающий фолат для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Folate DTT/Releasing Agent (Atellica IM Fol DTT/REL)).
Общий вид

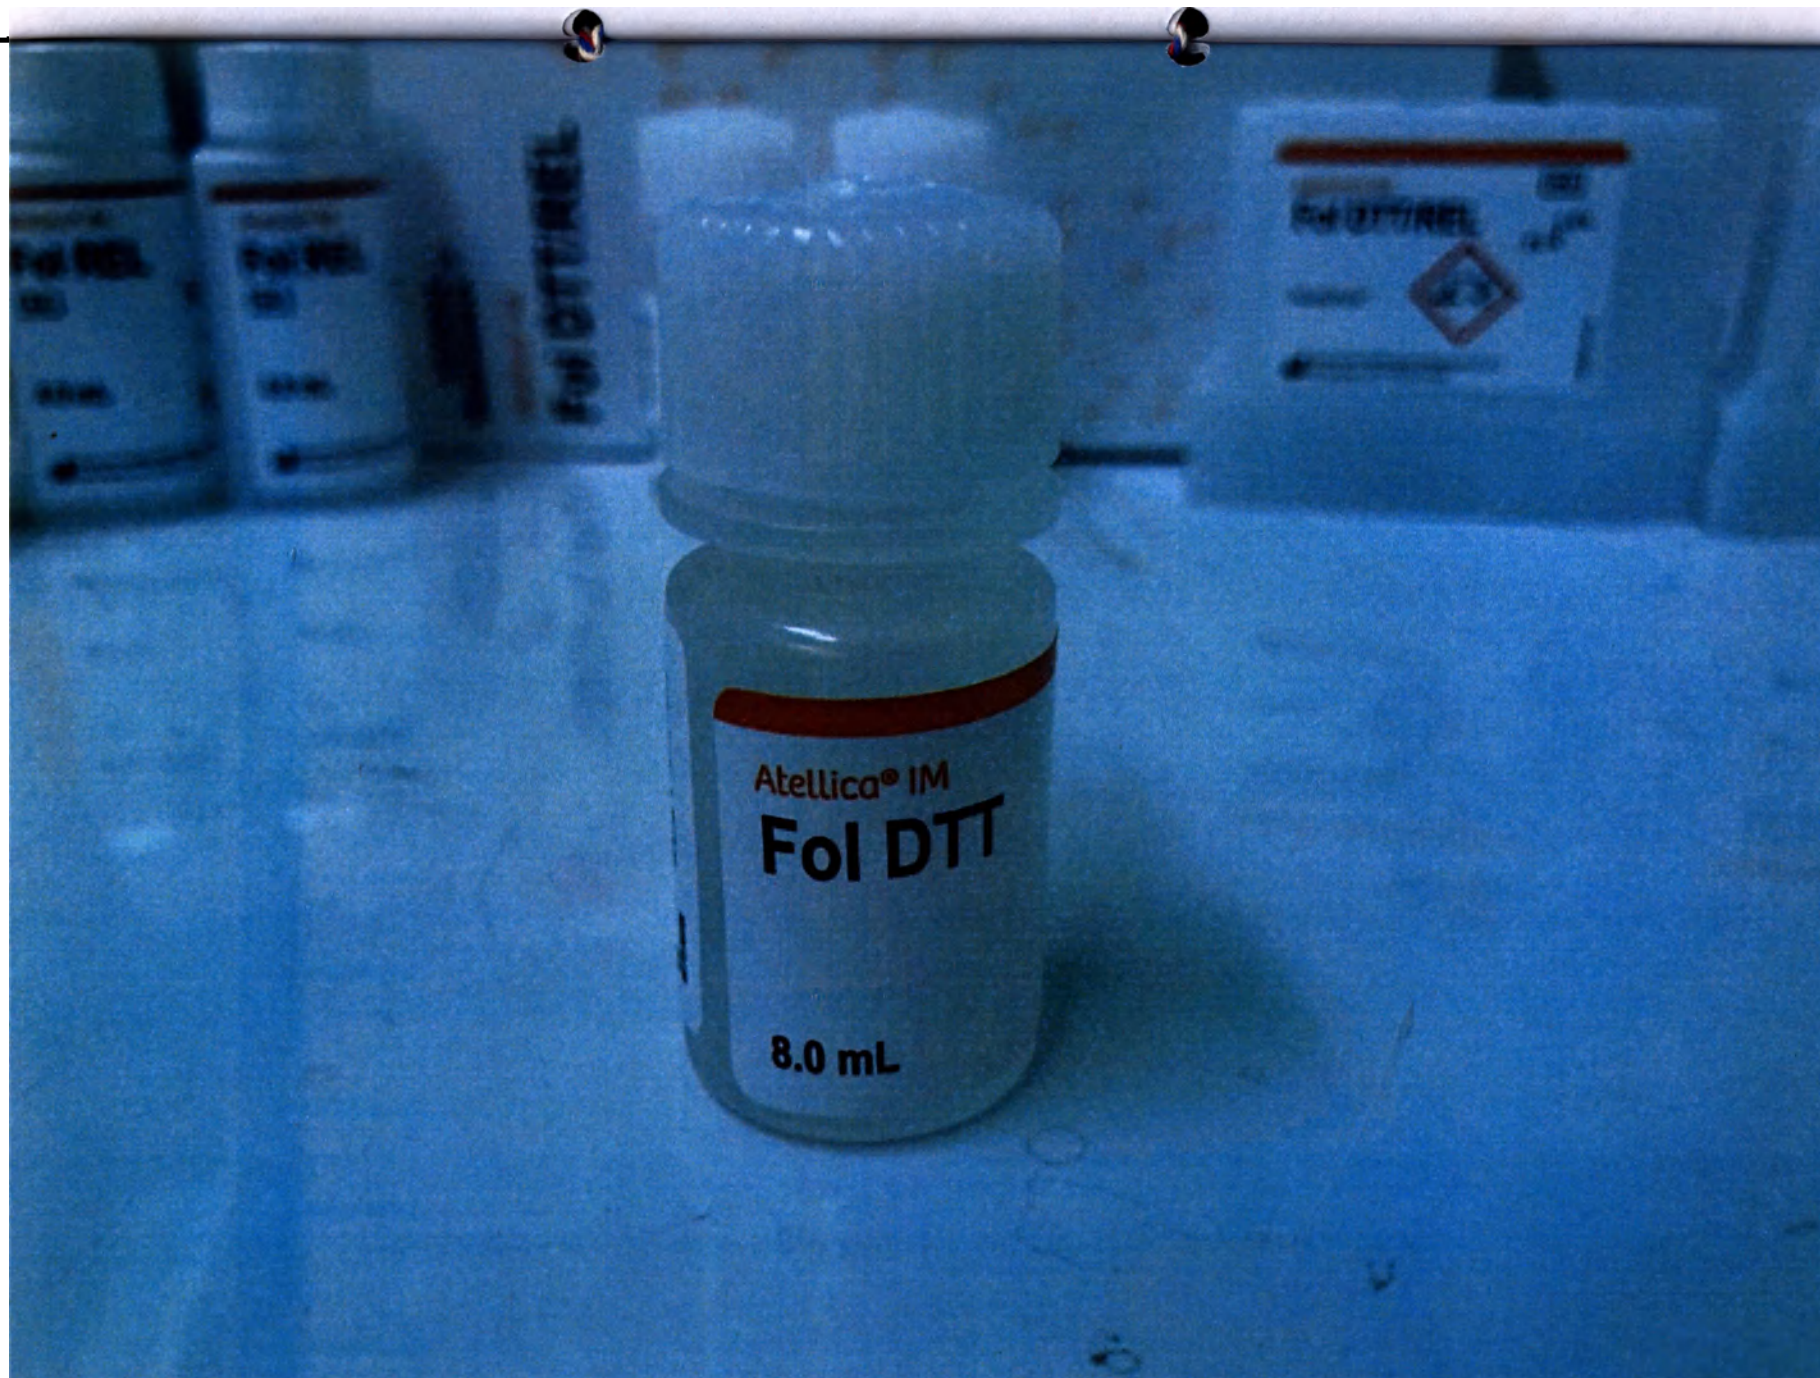


Рисунок 2. Реагент ДТТ/высвобождающий фолат для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Folate DTT/Releasing Agent (Atellica IM Fol DTT/REL)): Дитиотреитол (Atellica IM Fol DTT), 8,0 мл/флакон

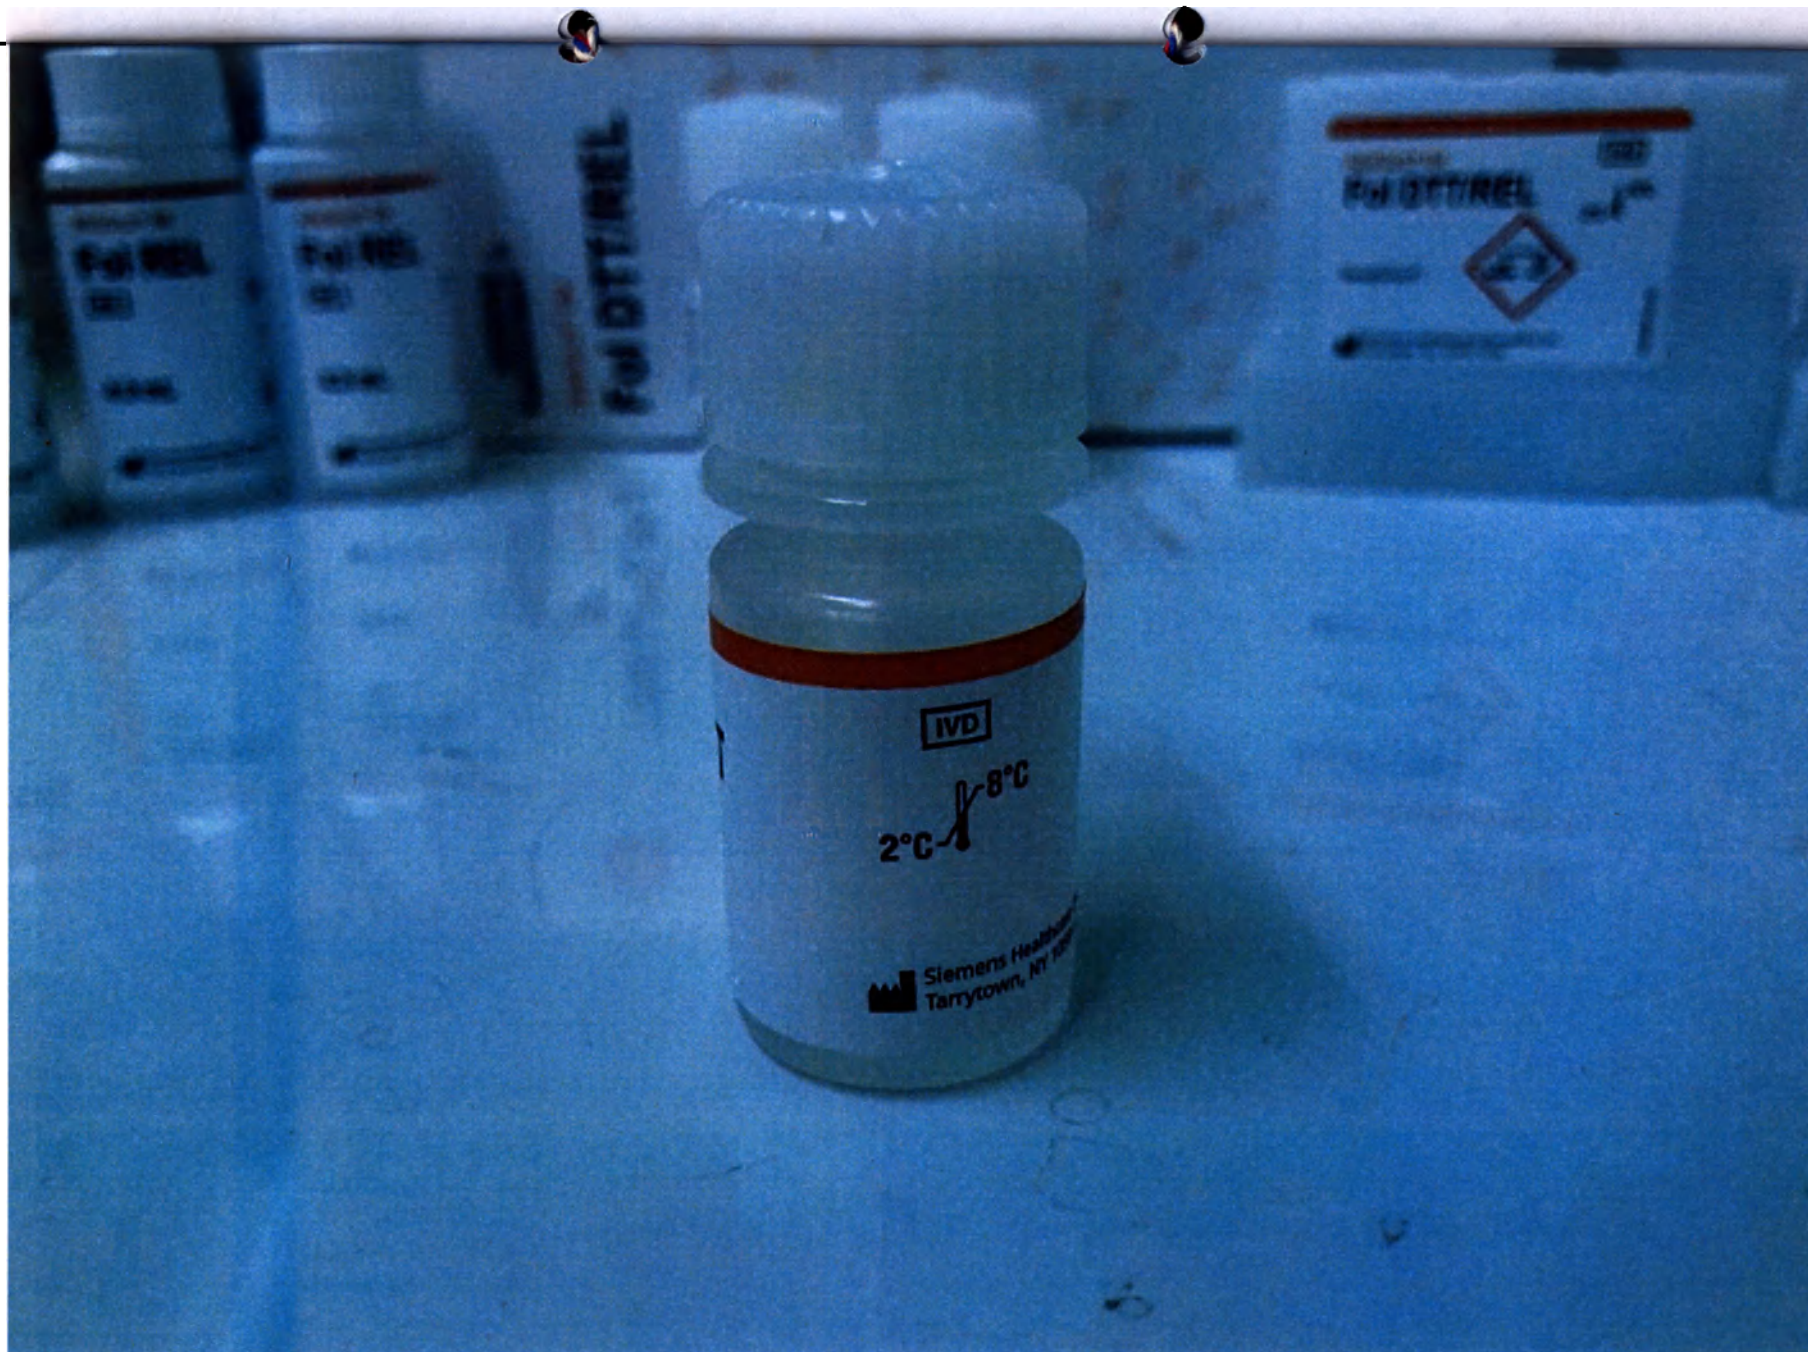
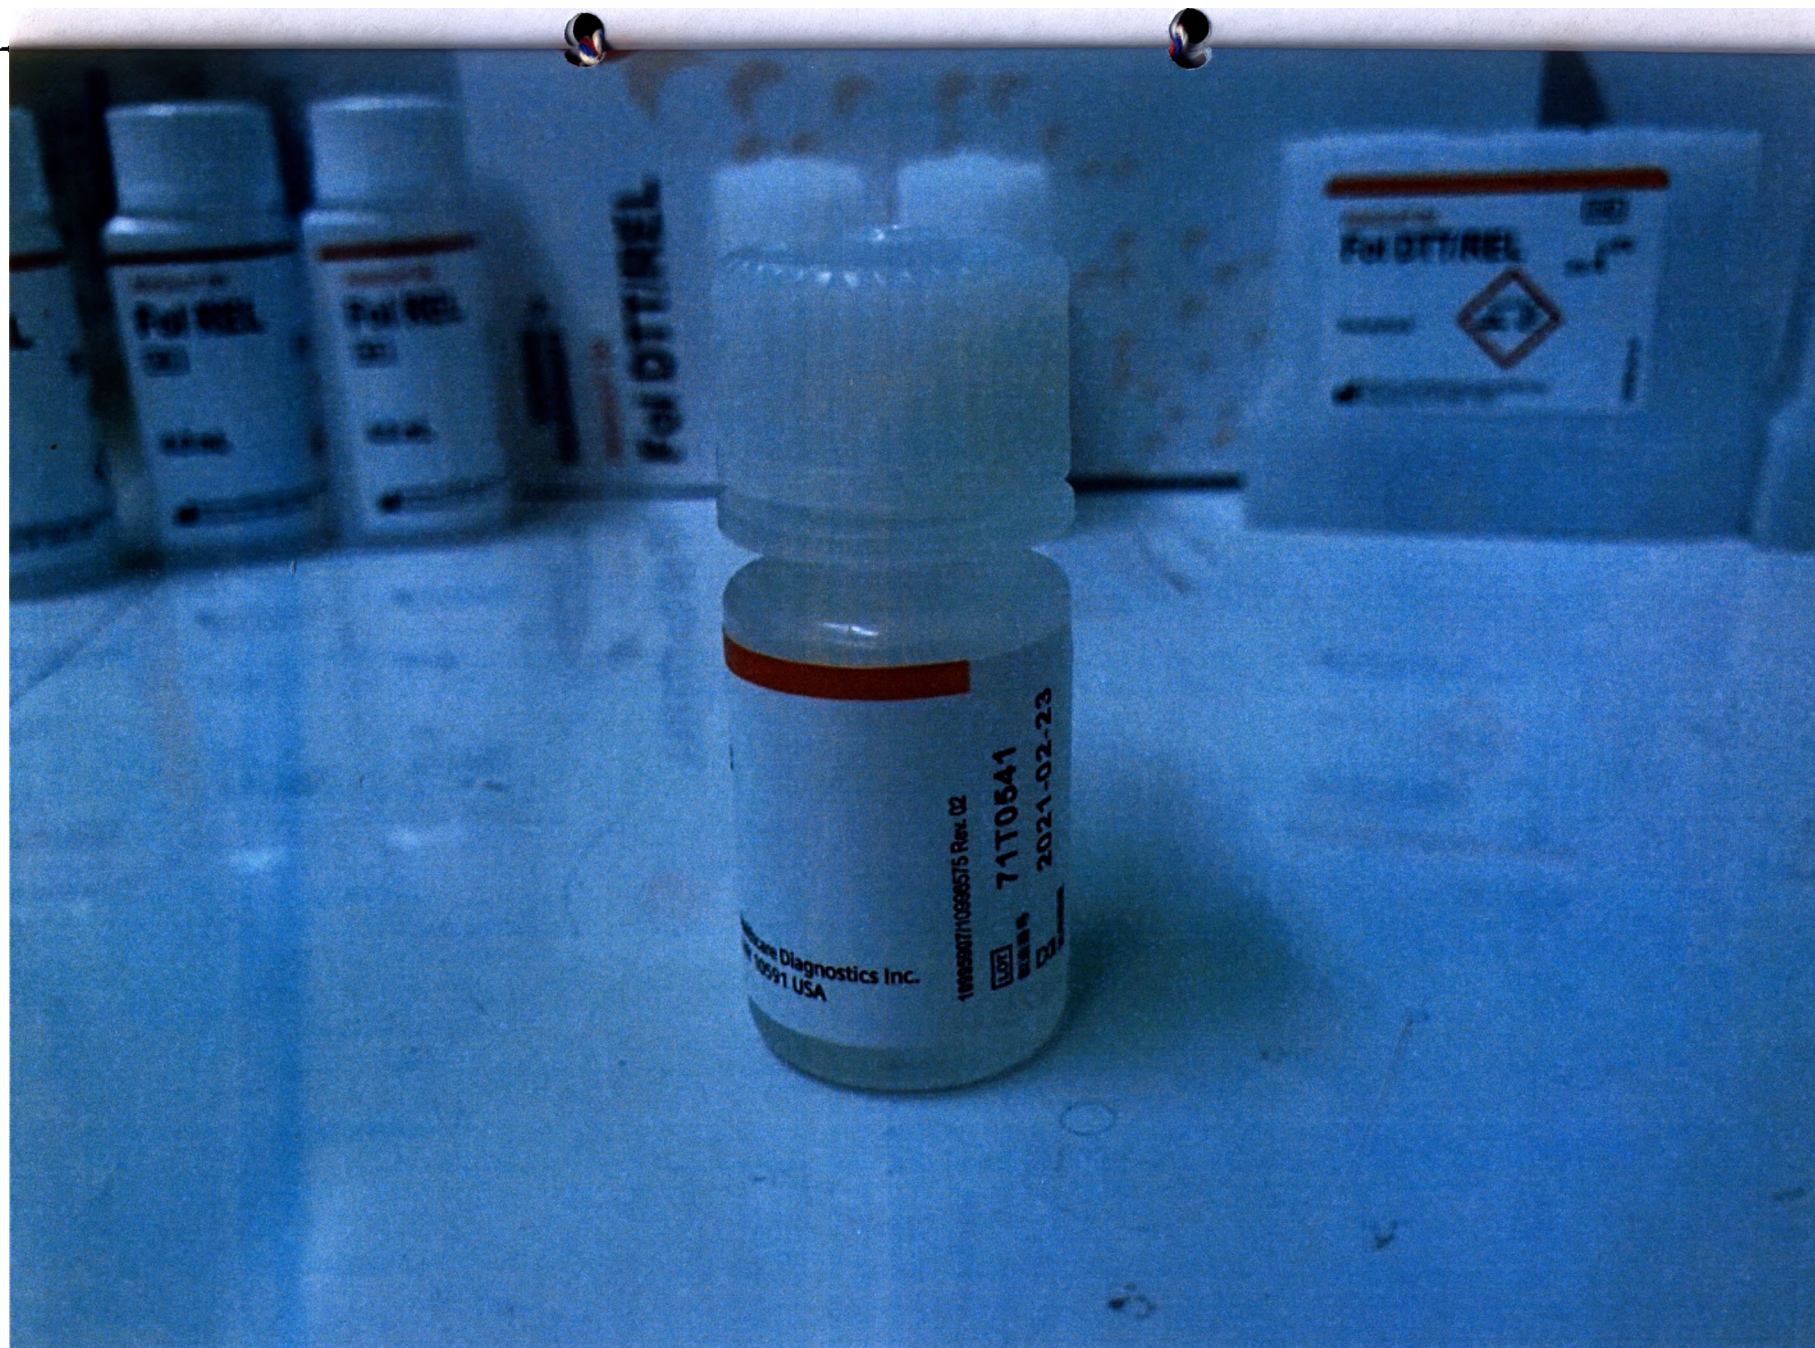


Рисунок 3. Реагент ДТТ/высвобождающий фолат для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Folate DTT/Releasing Agent (Atellica IM Fol DTT/REL)); Дитиотреитол (Atellica IM Fol DTT), 8,0 мл/флакон



**Рисунок 4. Реагент ДТТ/высвобождающий фолат для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Folate DTT/Releasing Agent (Atellica IM Fol DTT/REL)):
Дитиотреитол (Atellica IM Fol DTT), 8,0 мл/флакон**



Рисунок 5. Реагент ДТТ/высвобождающий фолат для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Folate DTT/Releasing Agent (Atellica IM Fol DTT/REL)): Разделительный агент (Atellica IM Fol REL), 4,0 мл/флакон. Вариант 1

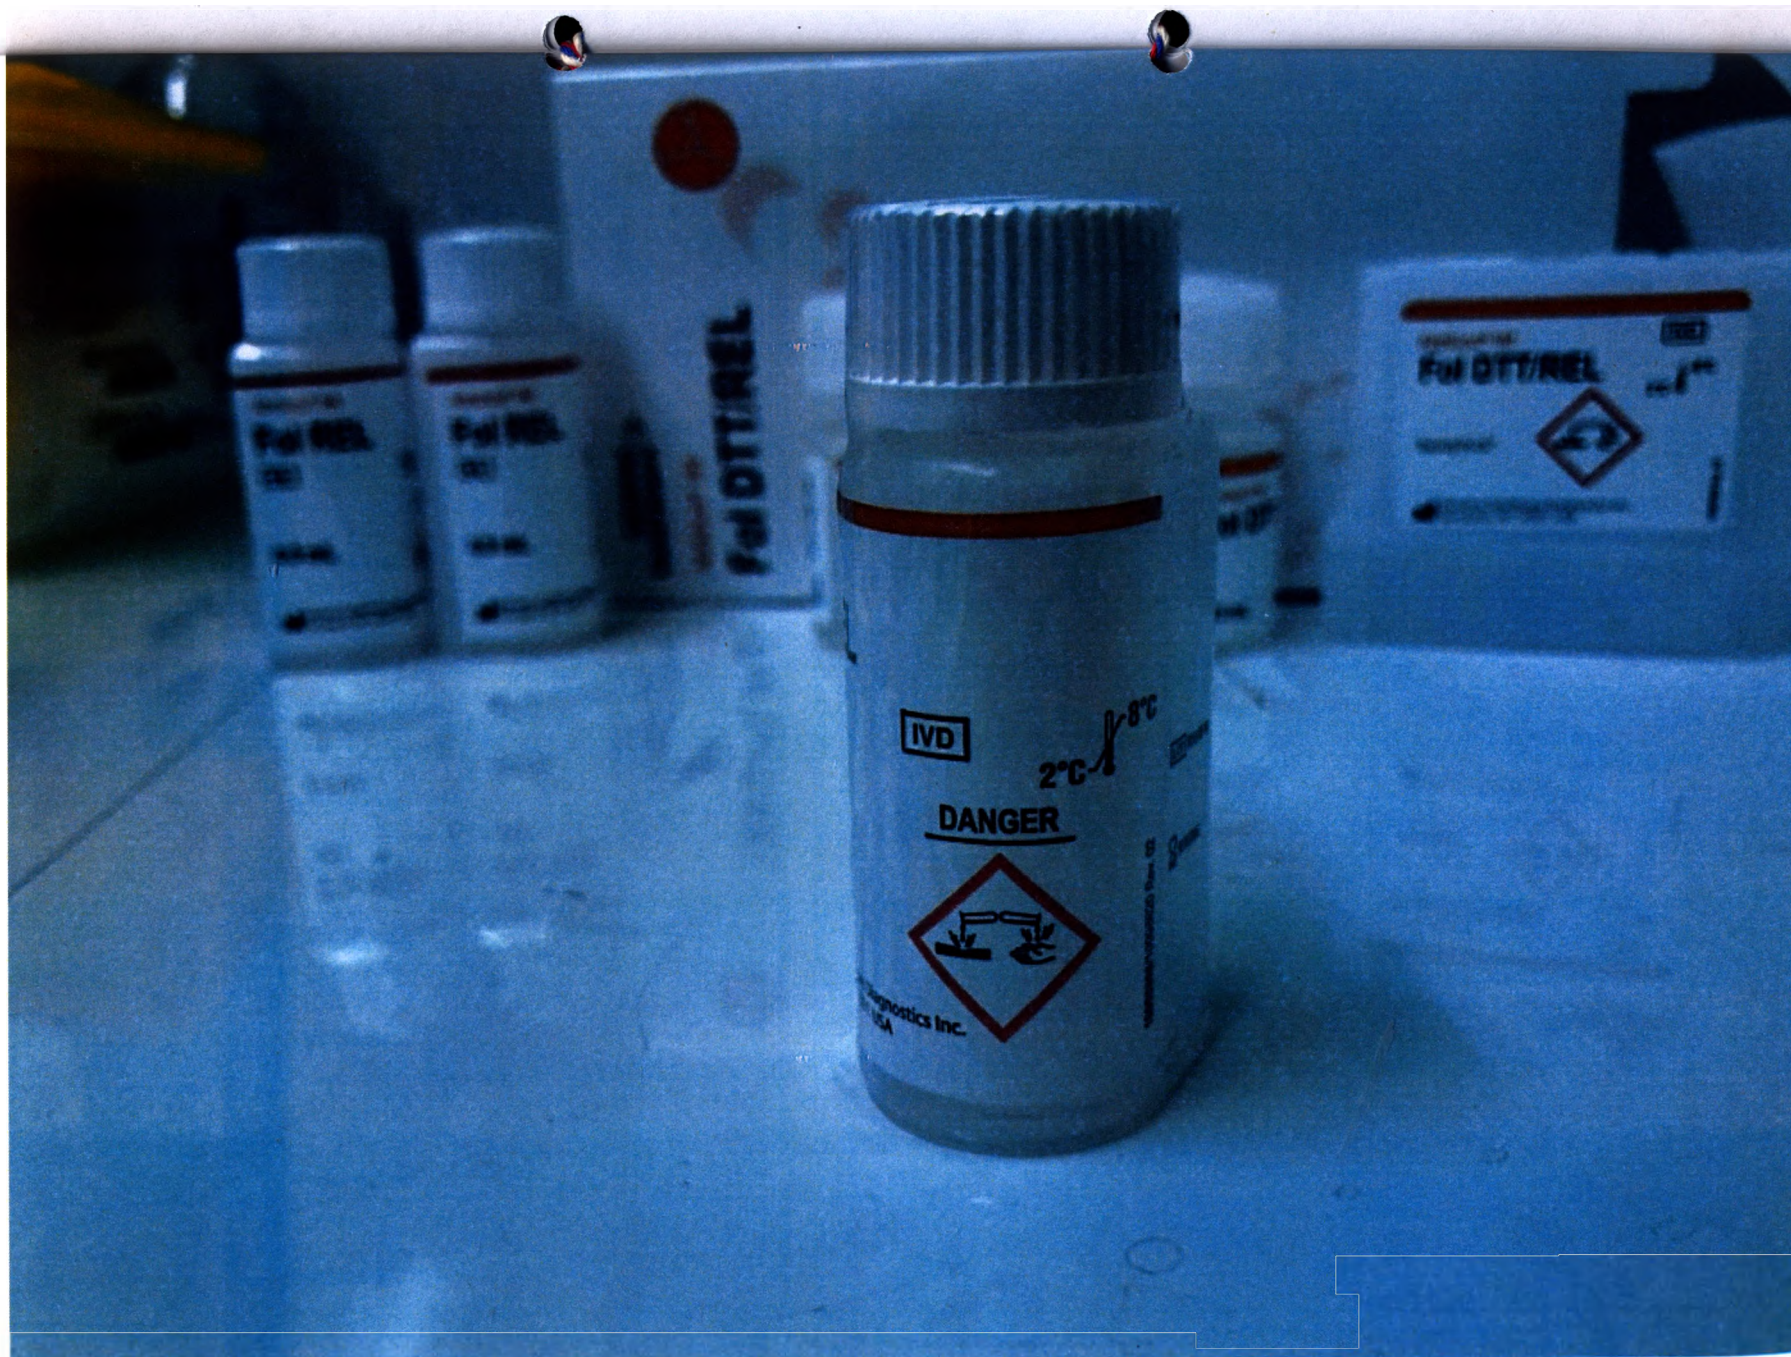


Рисунок 6. Реагент ДТТ/высвобождающий фолат для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Folate DTT/Releasing Agent (Atellica IM Fol DTT/REL)): Разделительный агент (Atellica IM Fol REL), 4,0 мл/флакон. Вариант 1.

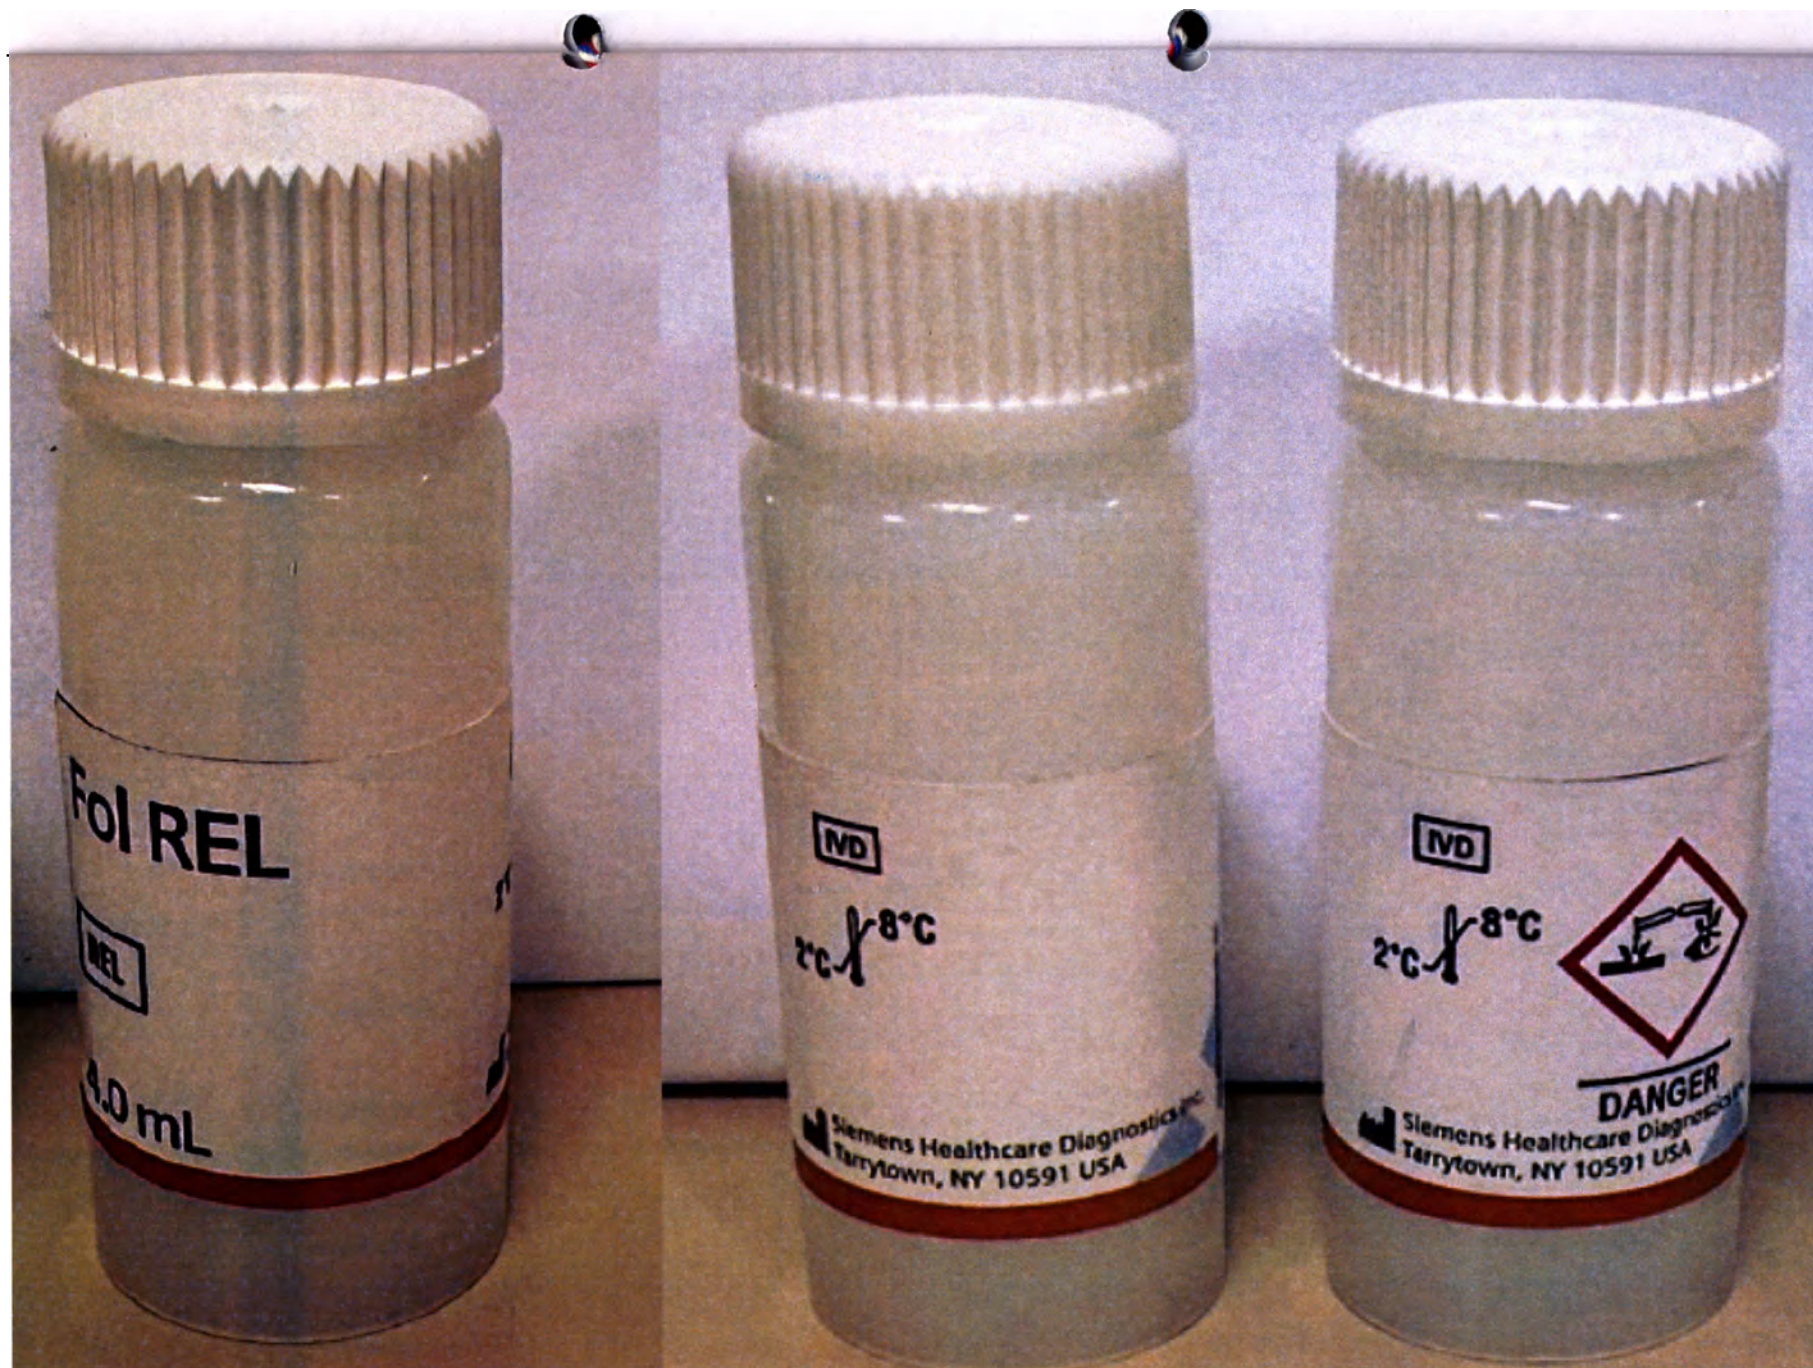


Рисунок 7. Реагент ДТТ/высвобождающий фолат для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Folate DTT/Releasing Agent (Atellica IM Fol DTT/REL)): Разделительный агент (Atellica IM Fol REL), 4,0 мл/флакон. Вариант 2.

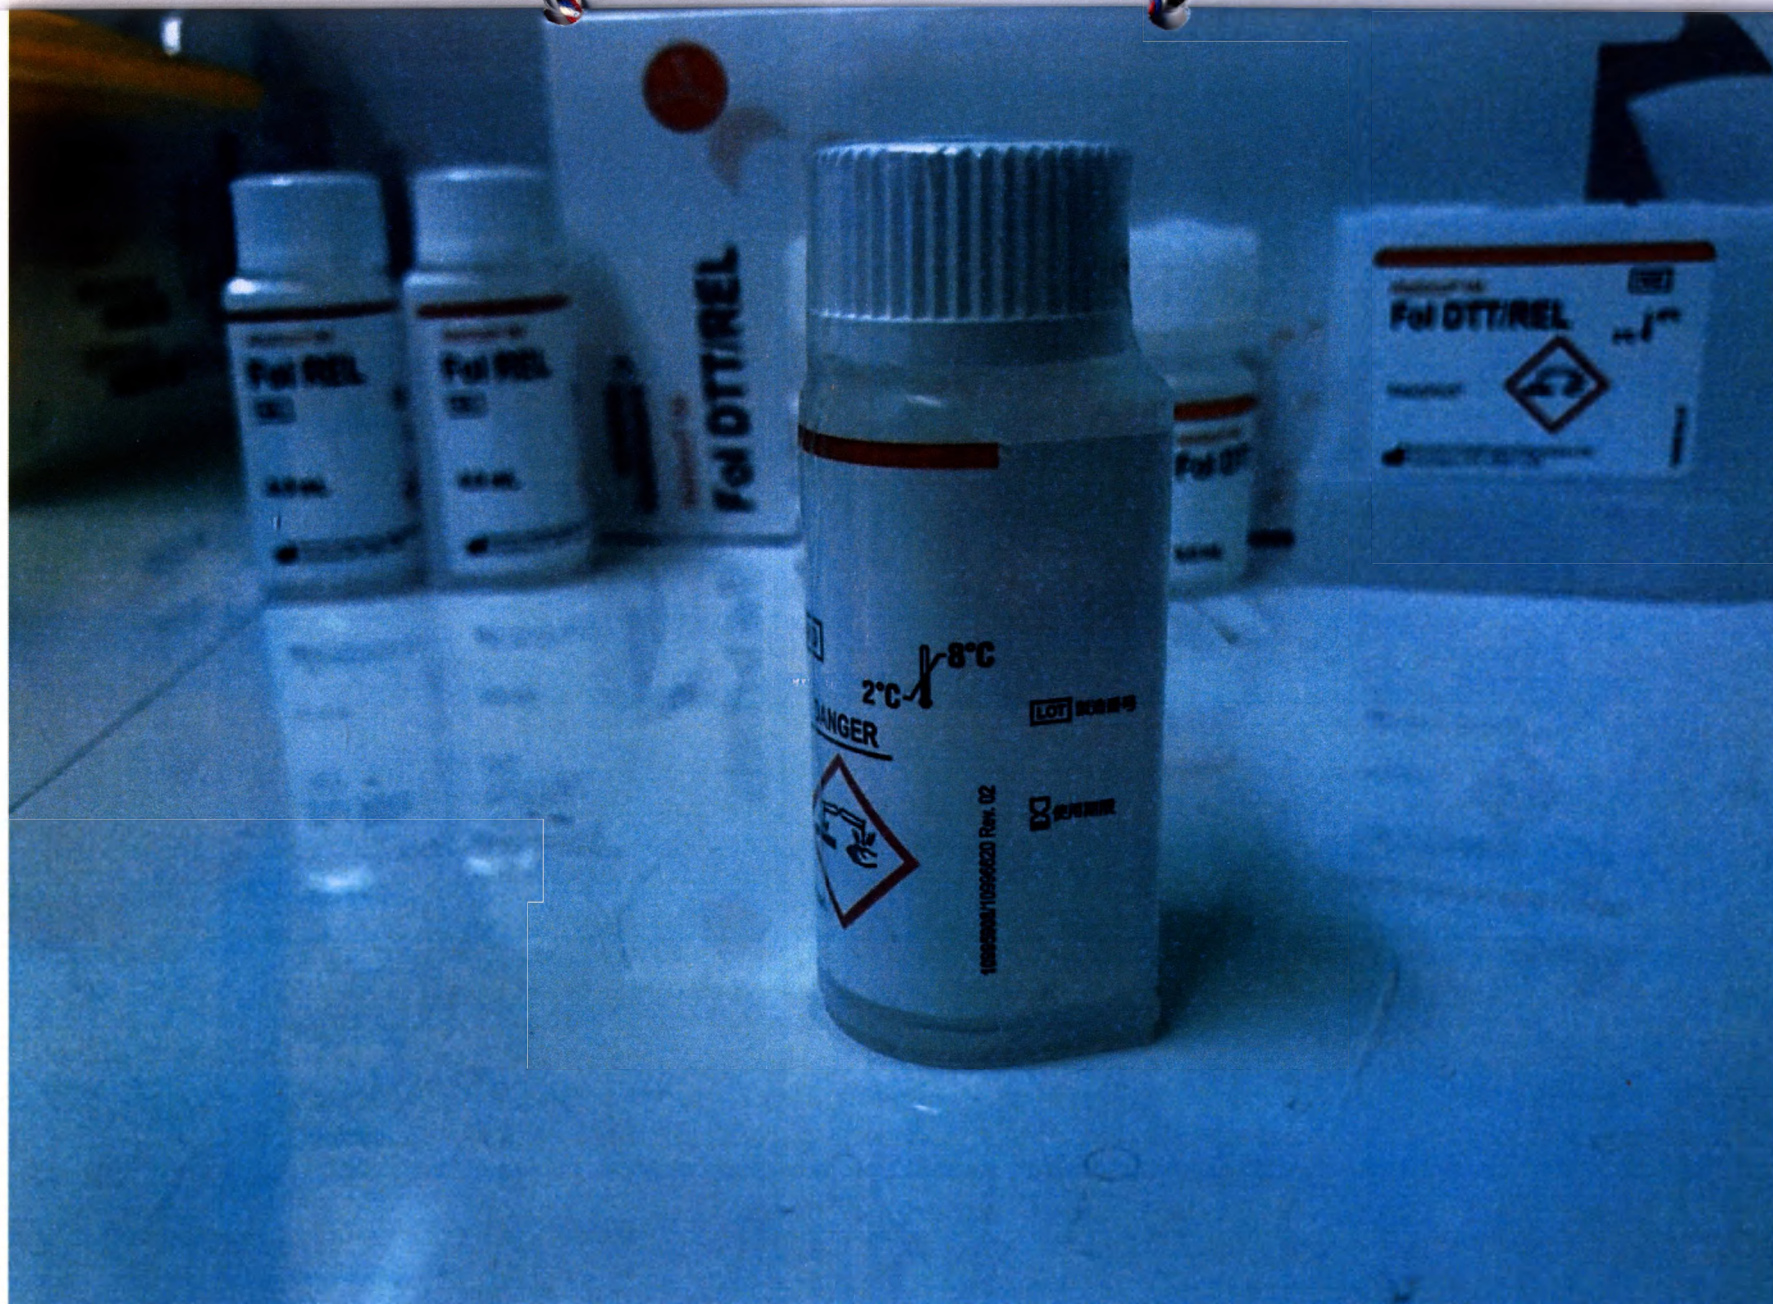


Рисунок 8. Реагент ДТТ/высвобождающий фолат для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Folate DTT/Releasing Agent (Atellica IM Fol DTT/REL)); Разделительный агент (Atellica IM Fol REL), 4,0 мл/флакон



Рисунок 9. Реагент ДТТ/высвобождающий фолат для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Folate DTT/Releasing Agent (Atellica IM Fol DTT/REL)): Дополнительный реагент ReadyPack

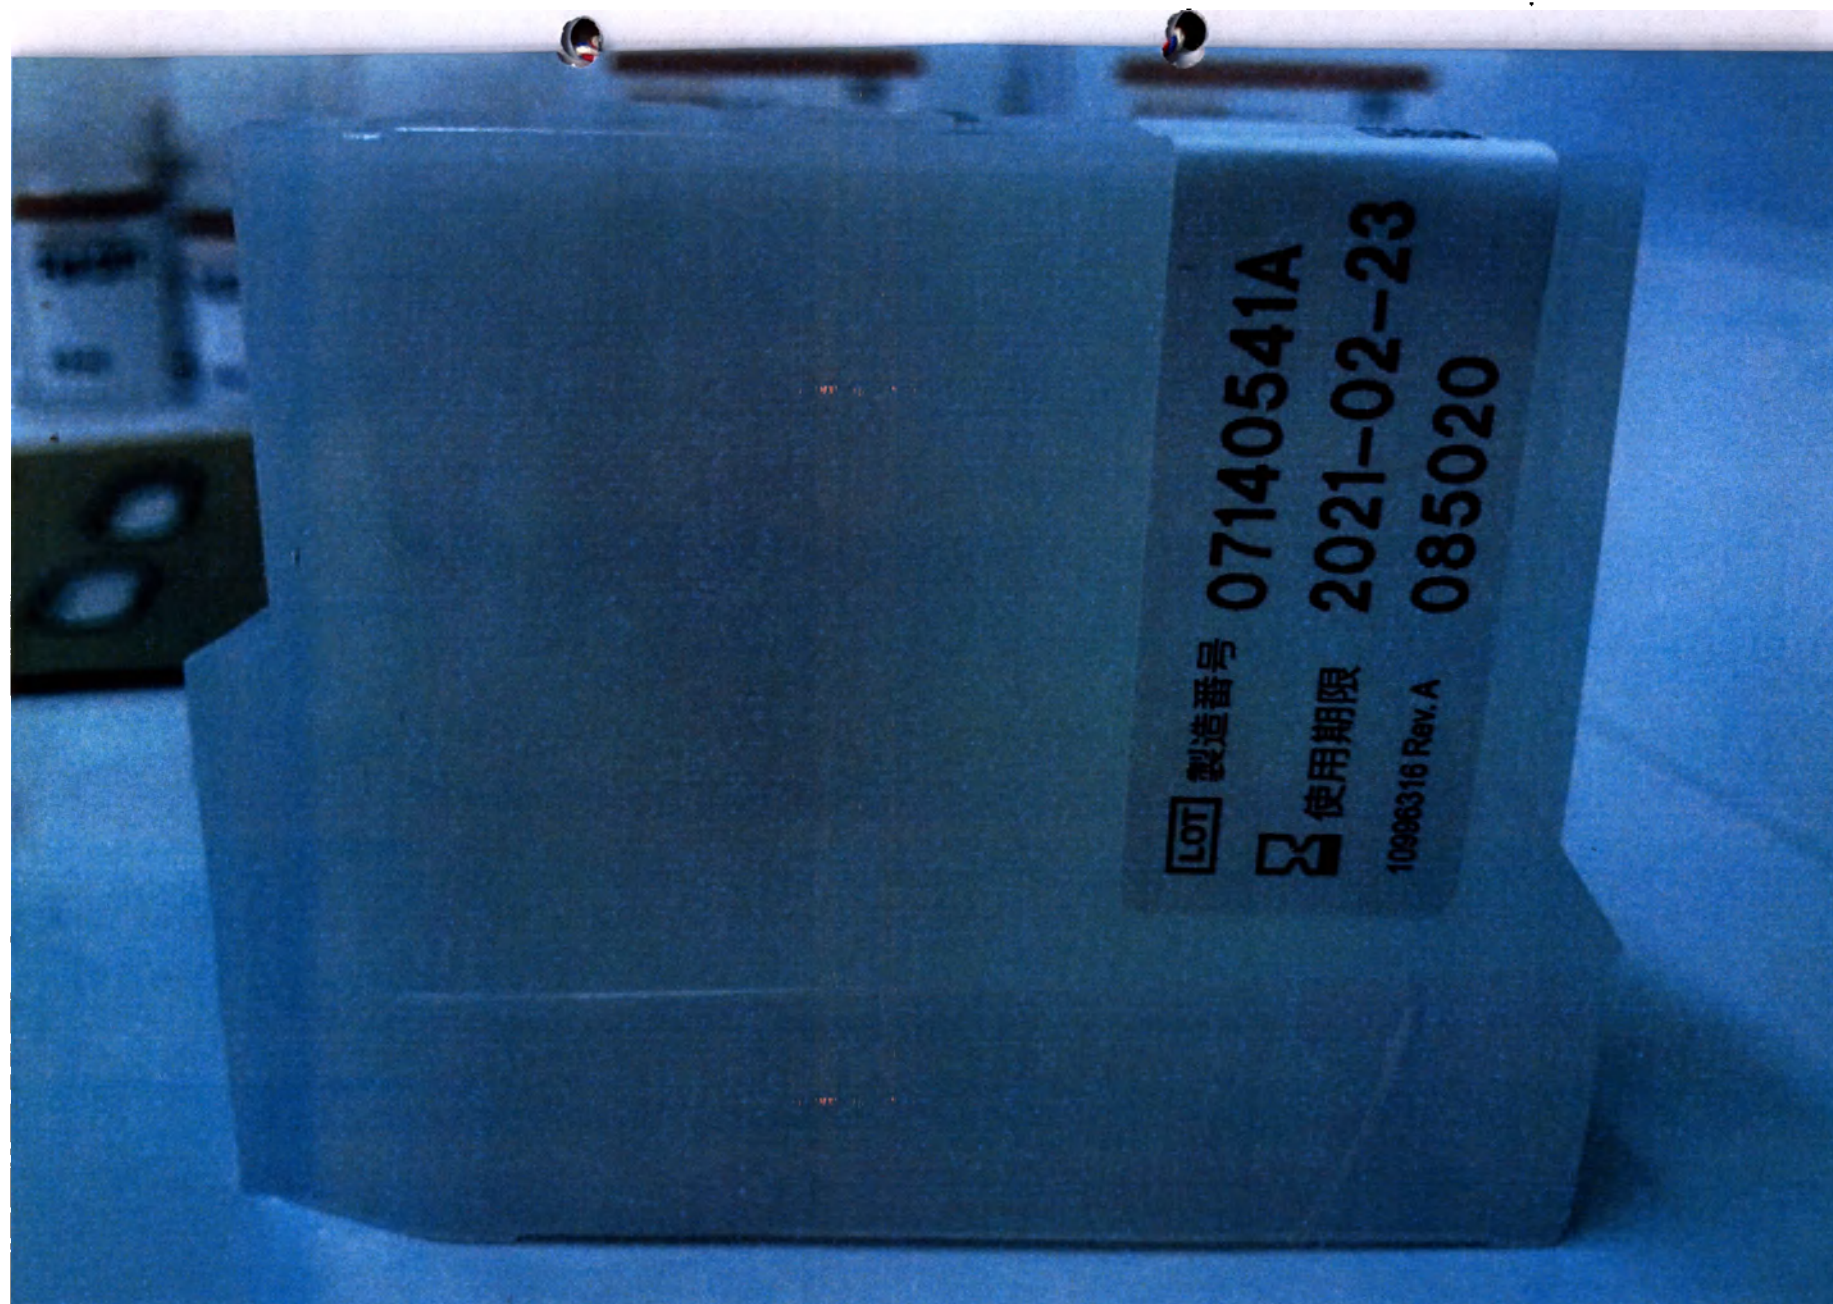


Рисунок 10. Реагент ДТТ/высвобождающий фолат для анализаторов иммунохимических серии Atellica (Atellica IM Folate DTT/Releasing Agent (Atellica IM Fol DTT/REL)): Дополнительный реагент ReadyPack

Всего прошито и пронумеровано
11 листа (ов).
ООО «Сименс Здравоохранение»

