



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ”
 серия 1

Генеральный директор
 АО «Вектор-Бест» *М.Д. Хусанов*
 “30” *сф* 2021 г.

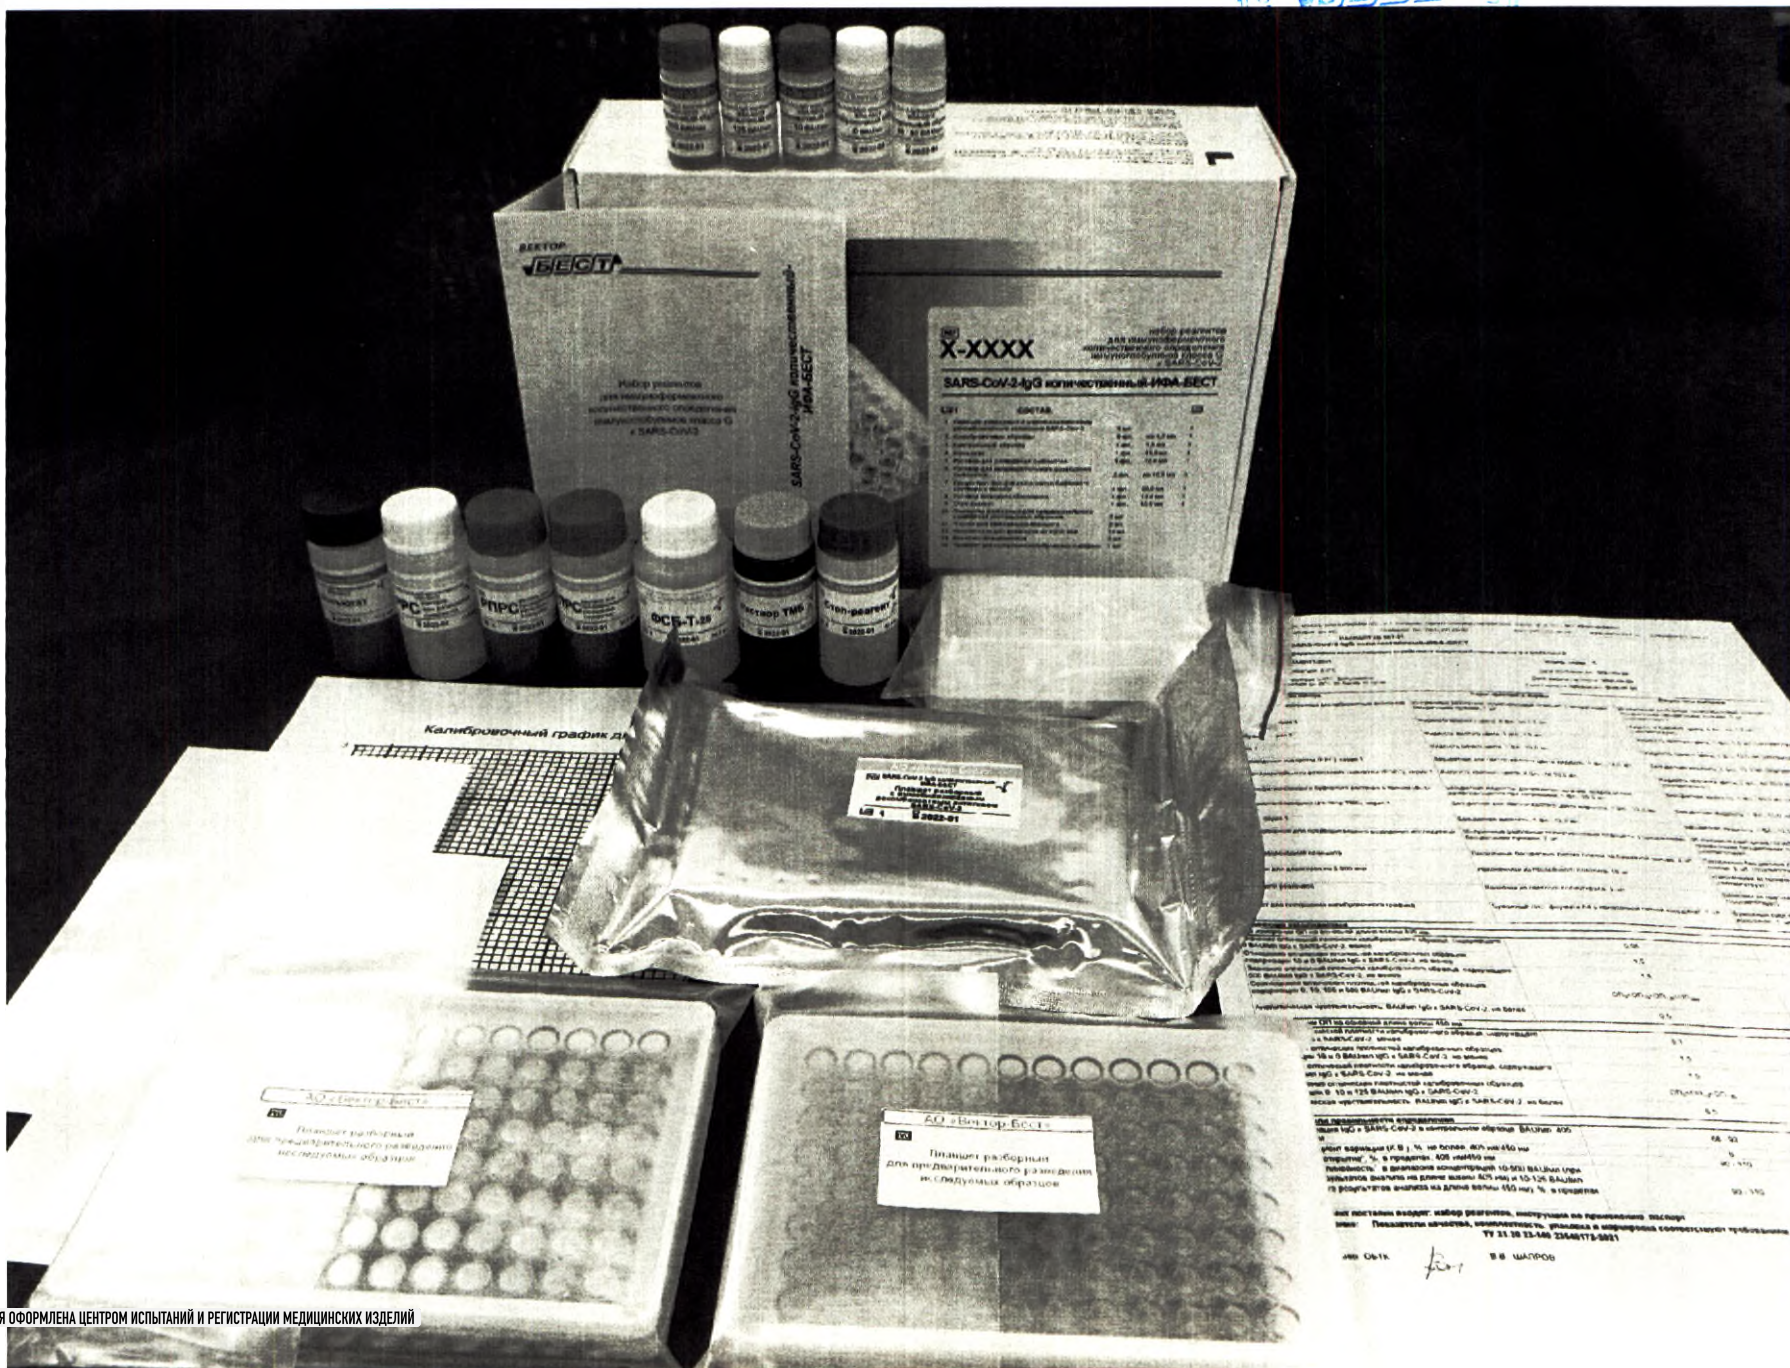


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ" № 1
серия 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»


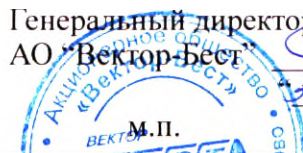


М.Д. Хусаинов
2021 г.


М.П.

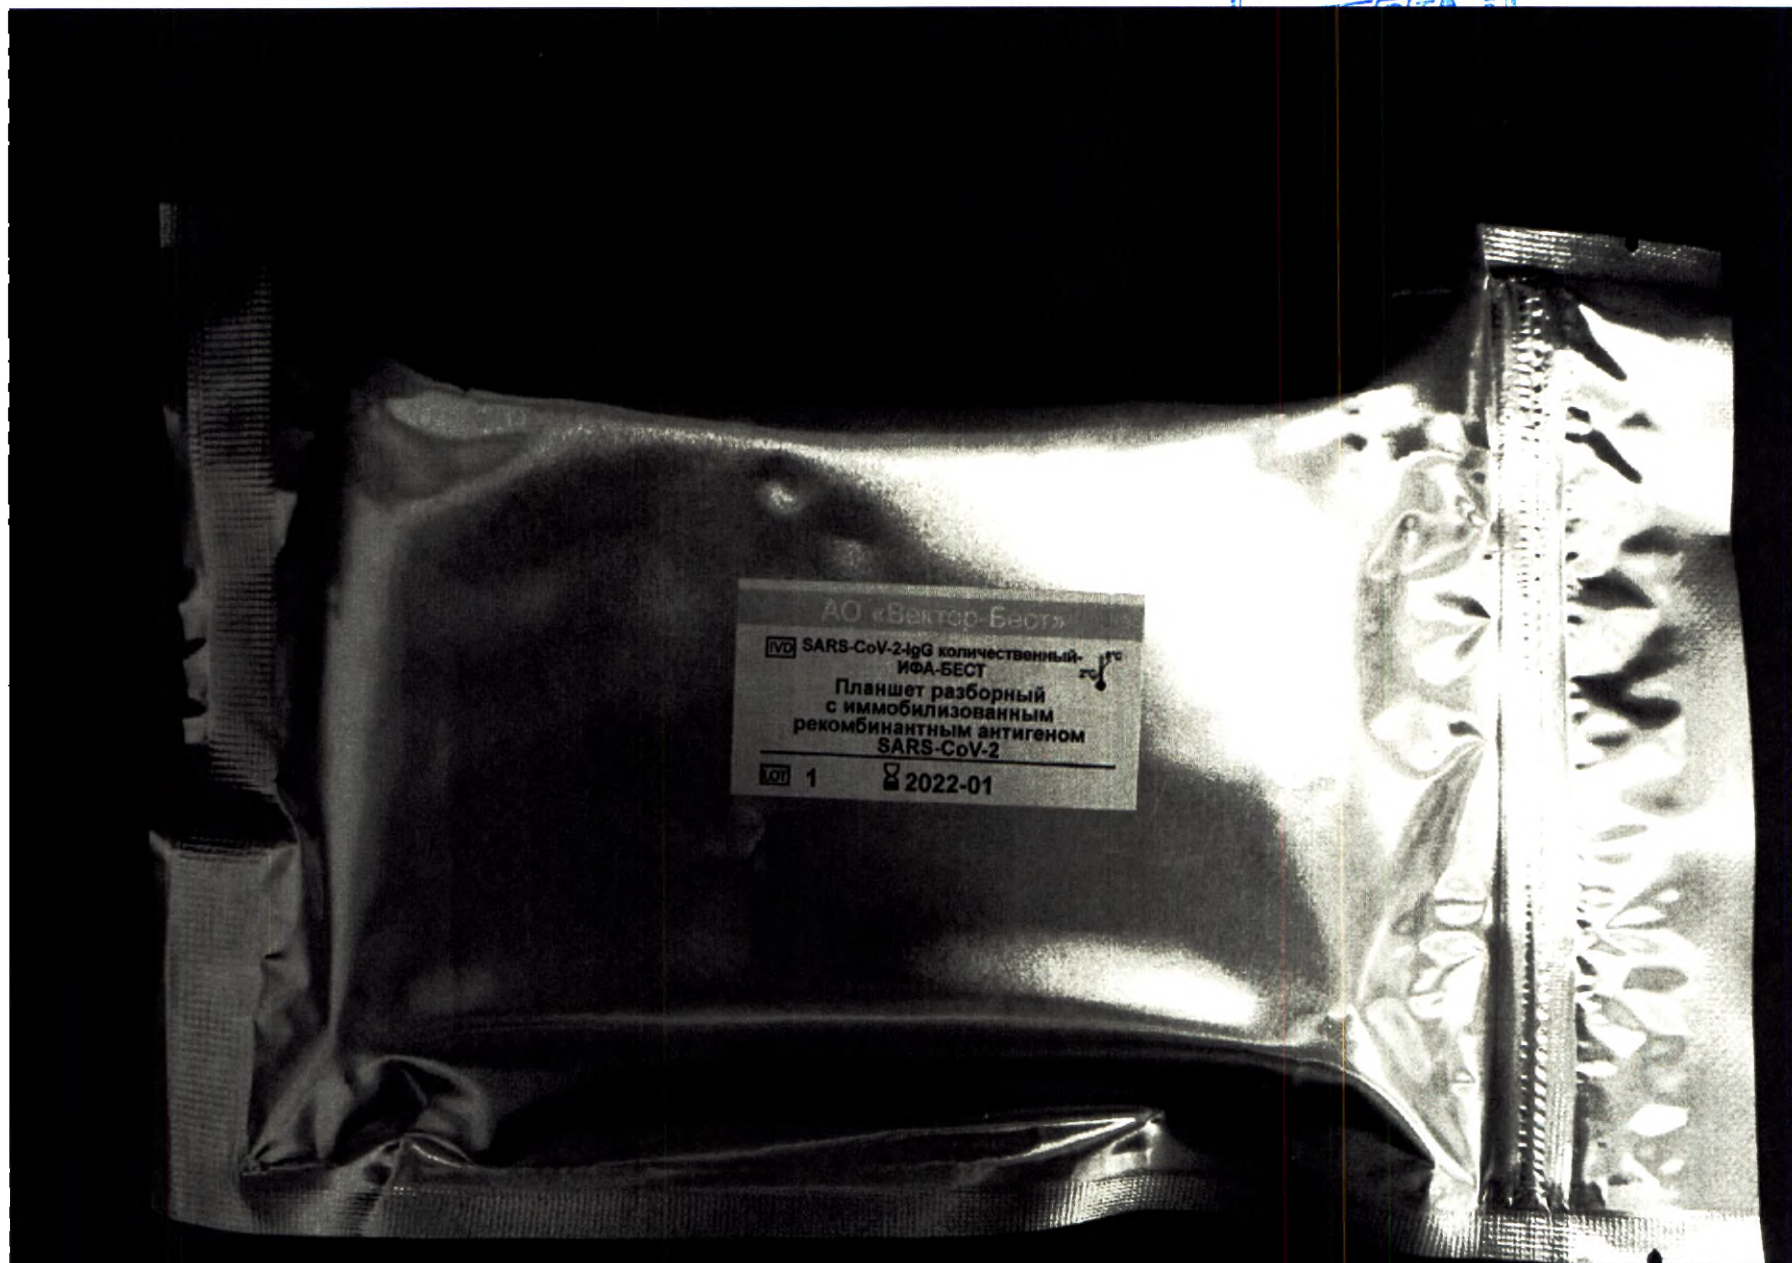




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ” № 2
серия 1


Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»  М.Д. Хусаинов
“30”  2021 г.









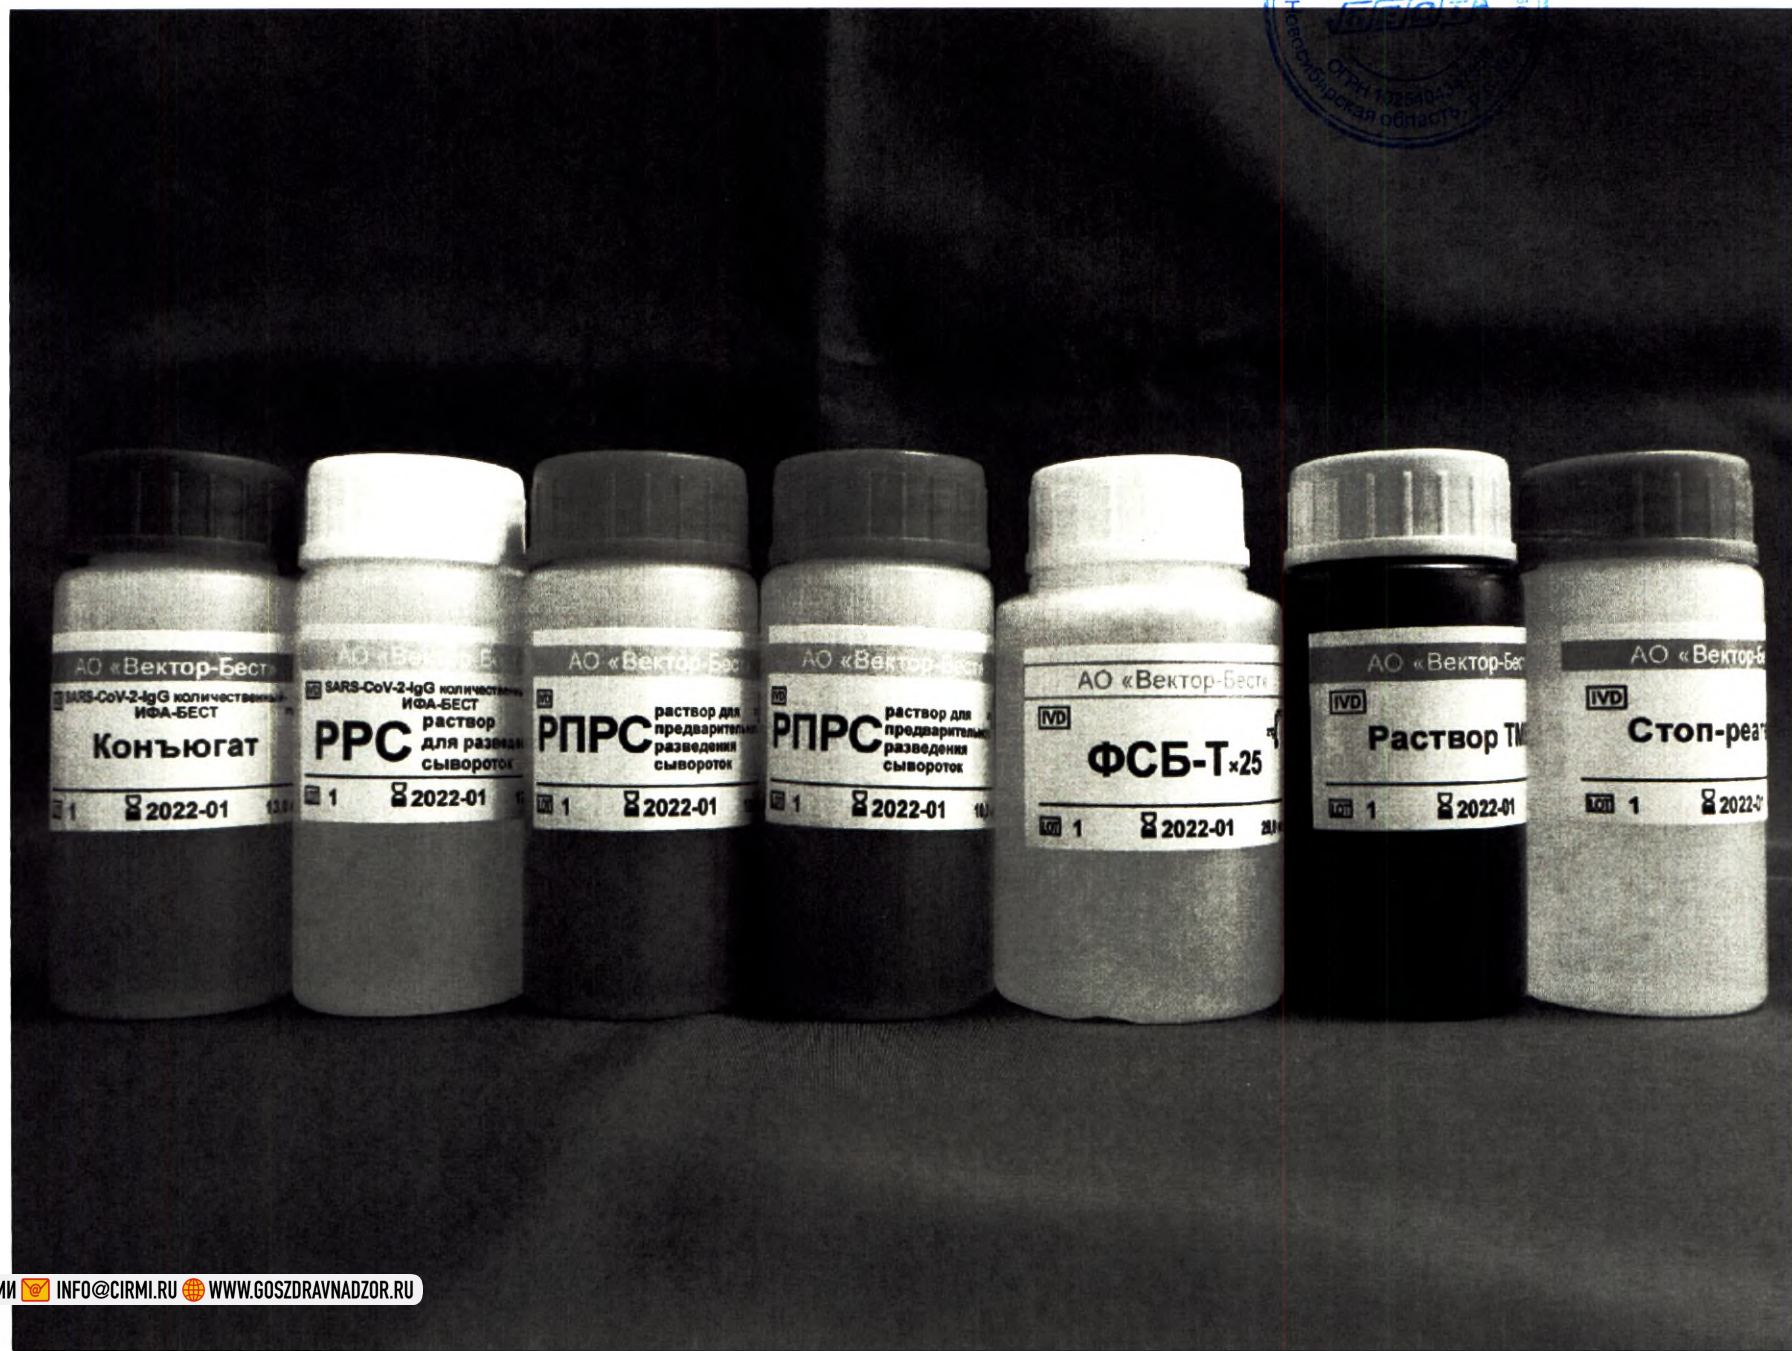

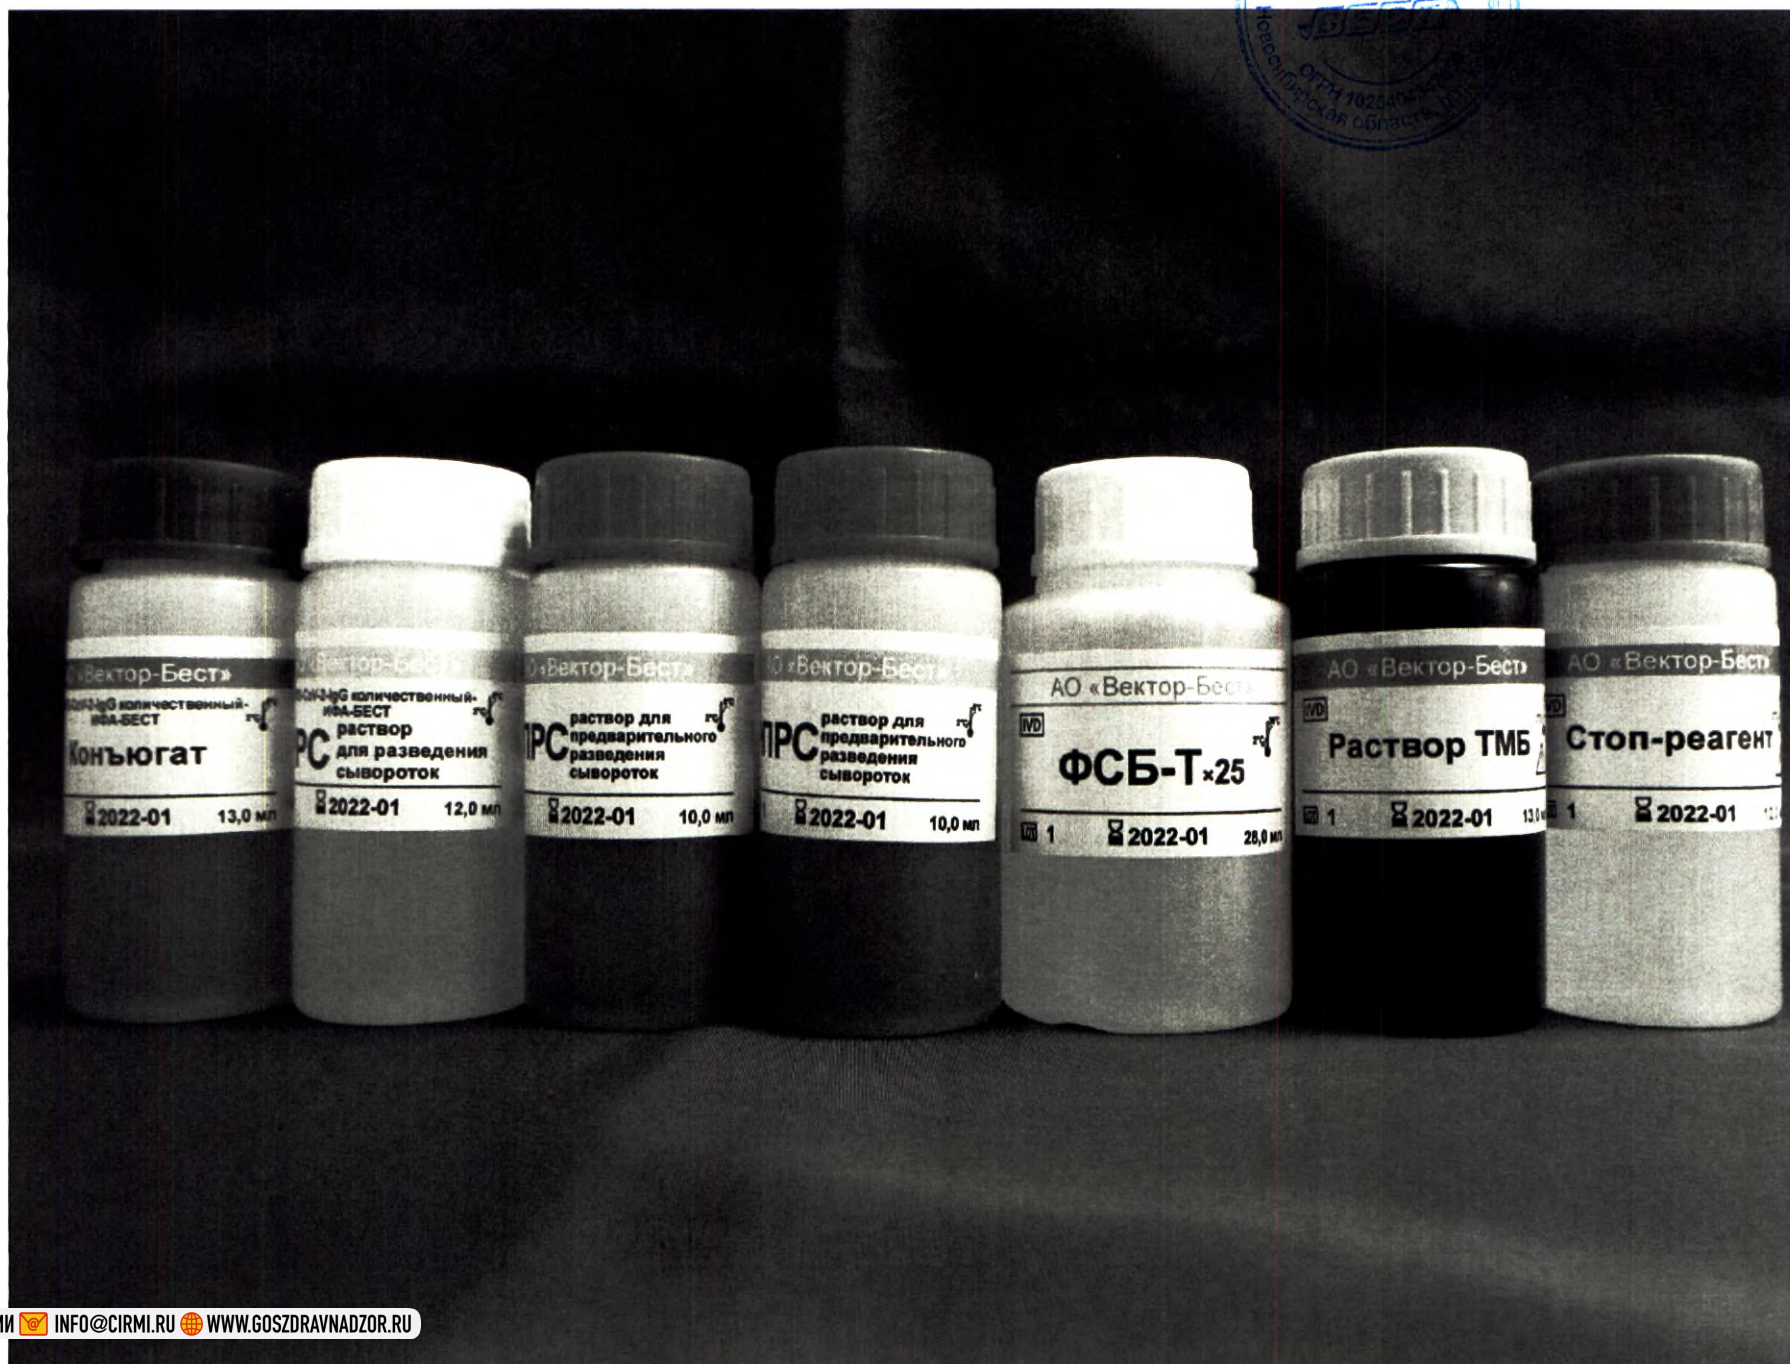


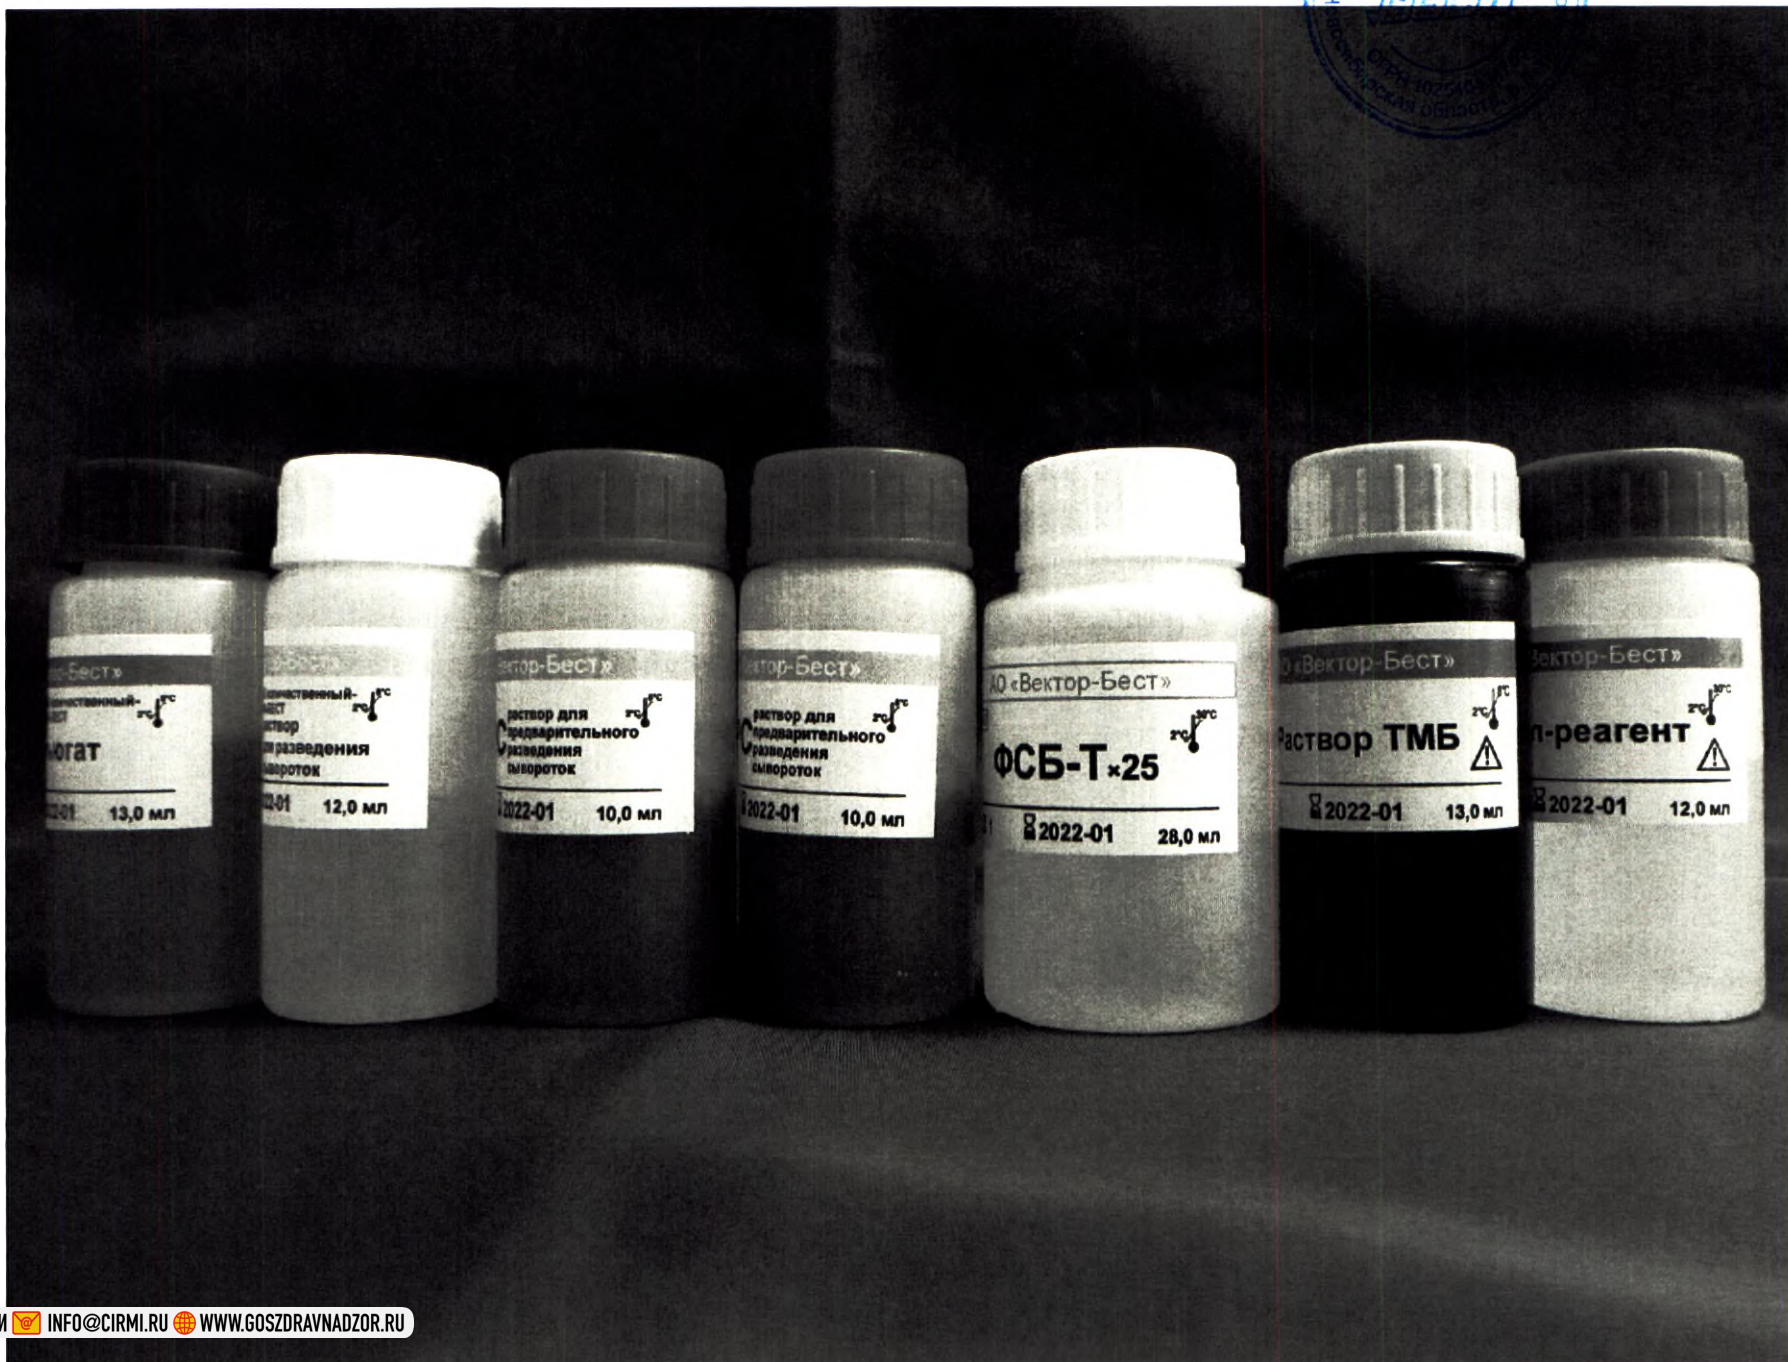

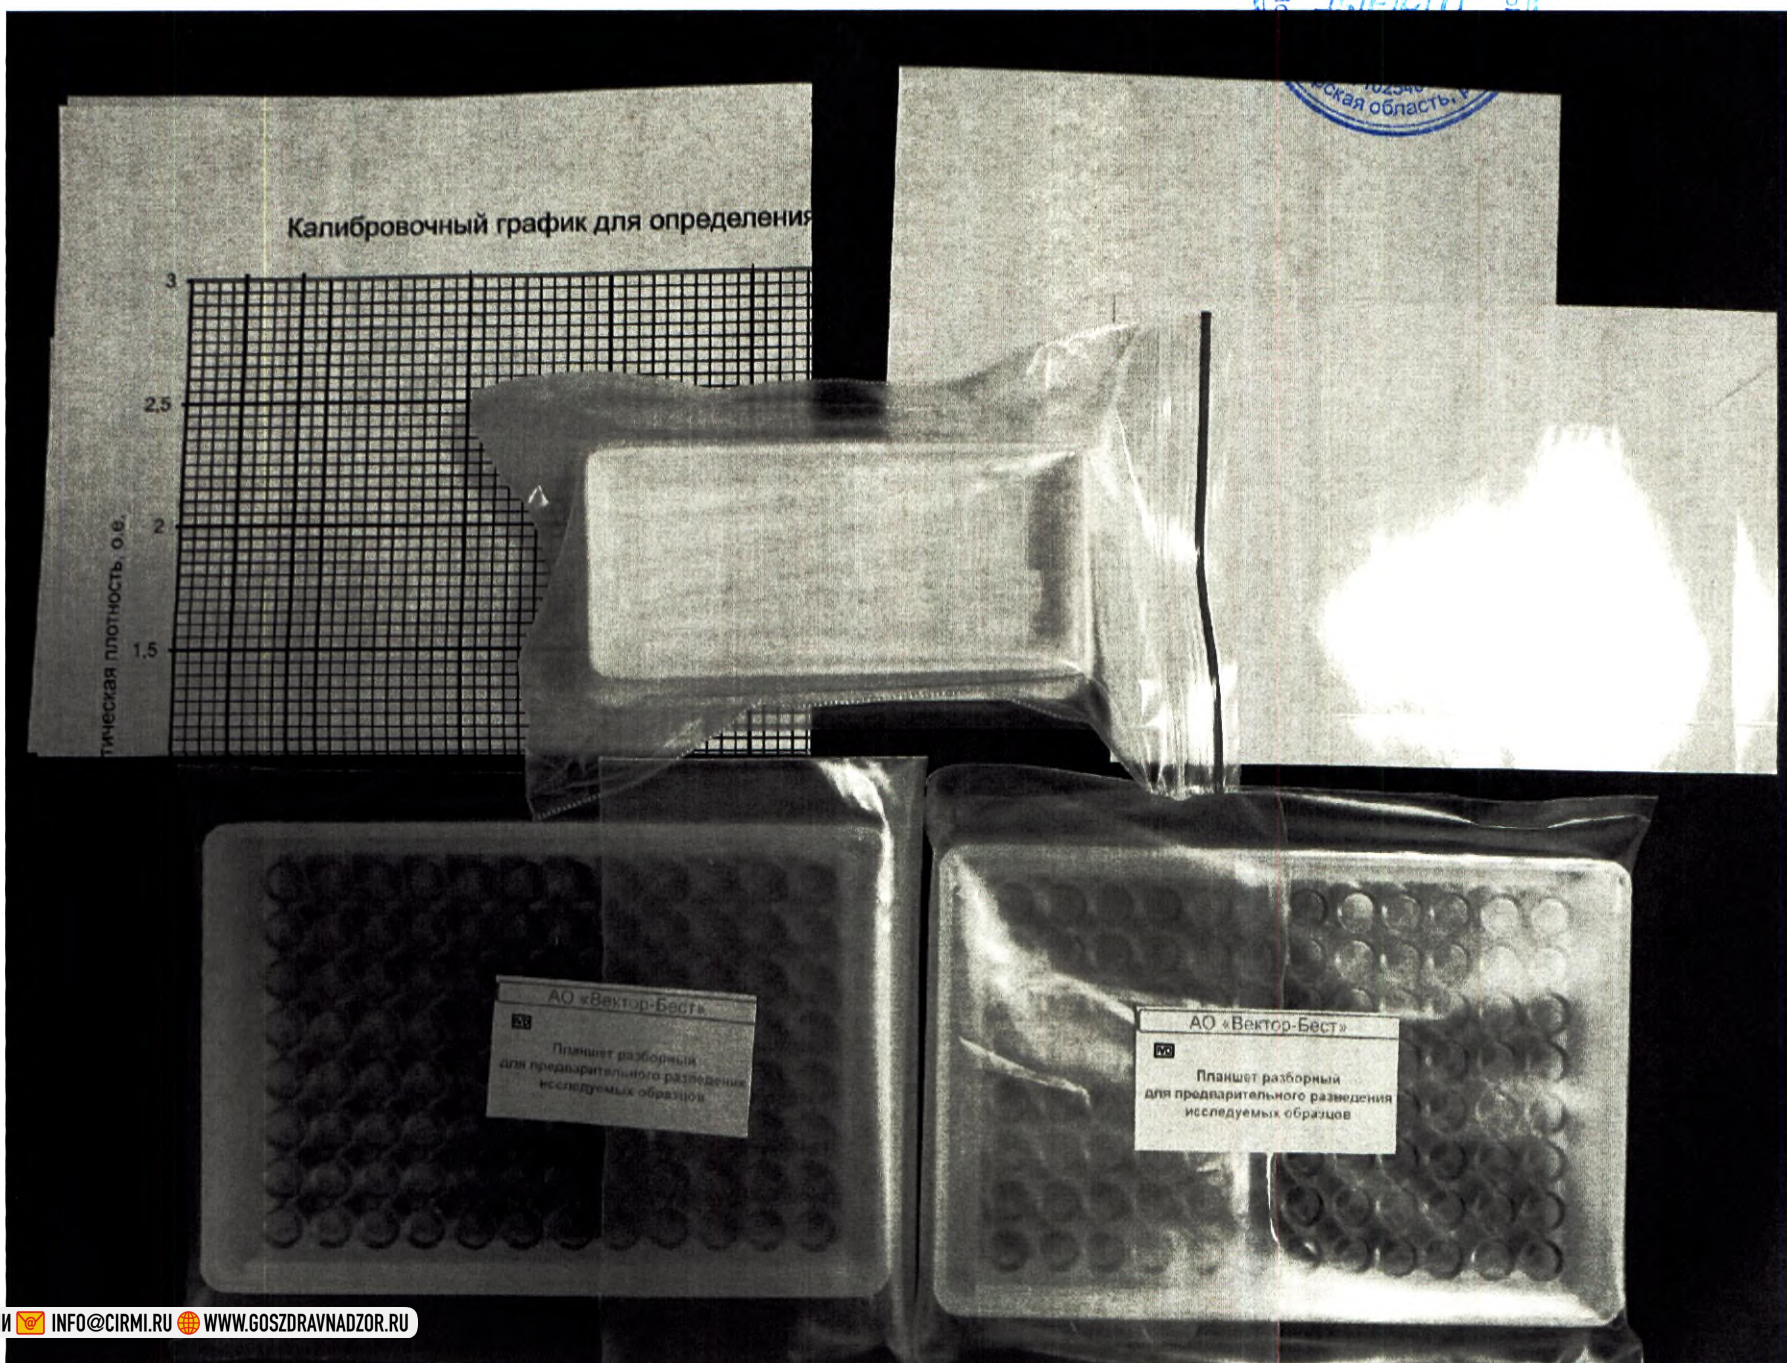

ВЕКТОР

БЕСТ

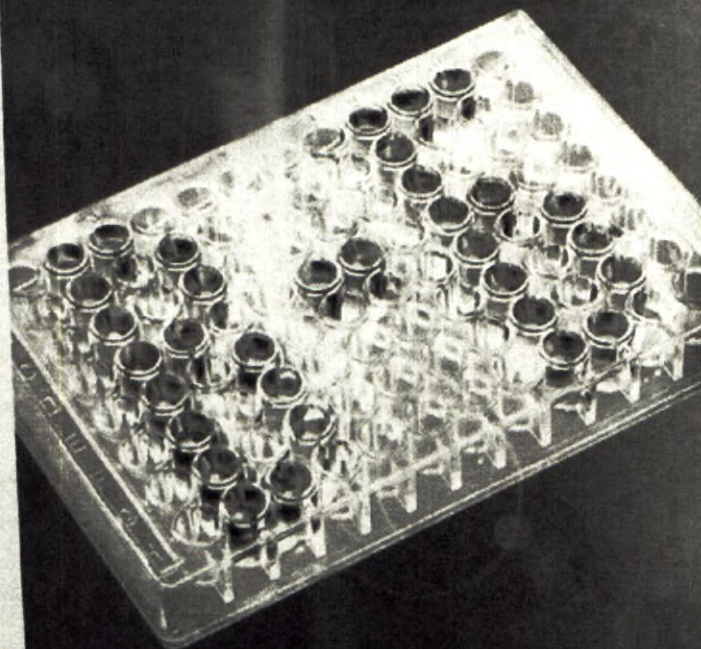

REF

X-XXXX

набор реагентов
для иммуноферментного
количественного определения
иммуноглобулинов класса G
к SARS-CoV-2

SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ

LOT 1

СОСТАВ:

LOT


1. Планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном SARS-CoV-2	1 шт.		1
2. Калибровочные образцы	4 фл.	по 1,5 мл	1
3. Контрольный образец	1 фл.	1,5 мл	1
4. Конъюгат	1 фл.	13,0 мл	1
5. Раствор для разведения сывороток	1 фл.	12,0 мл	1
6. Раствор для предварительного разведения сывороток	2 фл.	по 10,0 мл	1
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твинем	1 фл.	28,0 мл	1
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл.	13,0 мл	1
9. Стоп-реагент	1 фл.	12,0 мл	1
10. Планшеты разборные для предварительного разведения исследуемых образцов	2 шт.		
11. Пленки для заклеивания планшета	2 шт.		
12. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	16 шт.		
13. Ванночки для реагентов	2 шт.		
14. Трафарет для построения калибровочного графика	1 шт.		

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ" № 2
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"30" "04" 2021 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ” № 3
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”  М.Д. Хусаинов
“30” “04” 2021 г.
 М.П.



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: vbmarket@vector-best.ru


www.vector-best.ru


Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"  М.Д. Хусаинов
"30"  2021 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ” № 1
серия 2


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2021 г.
М.П. ВЕКТОР

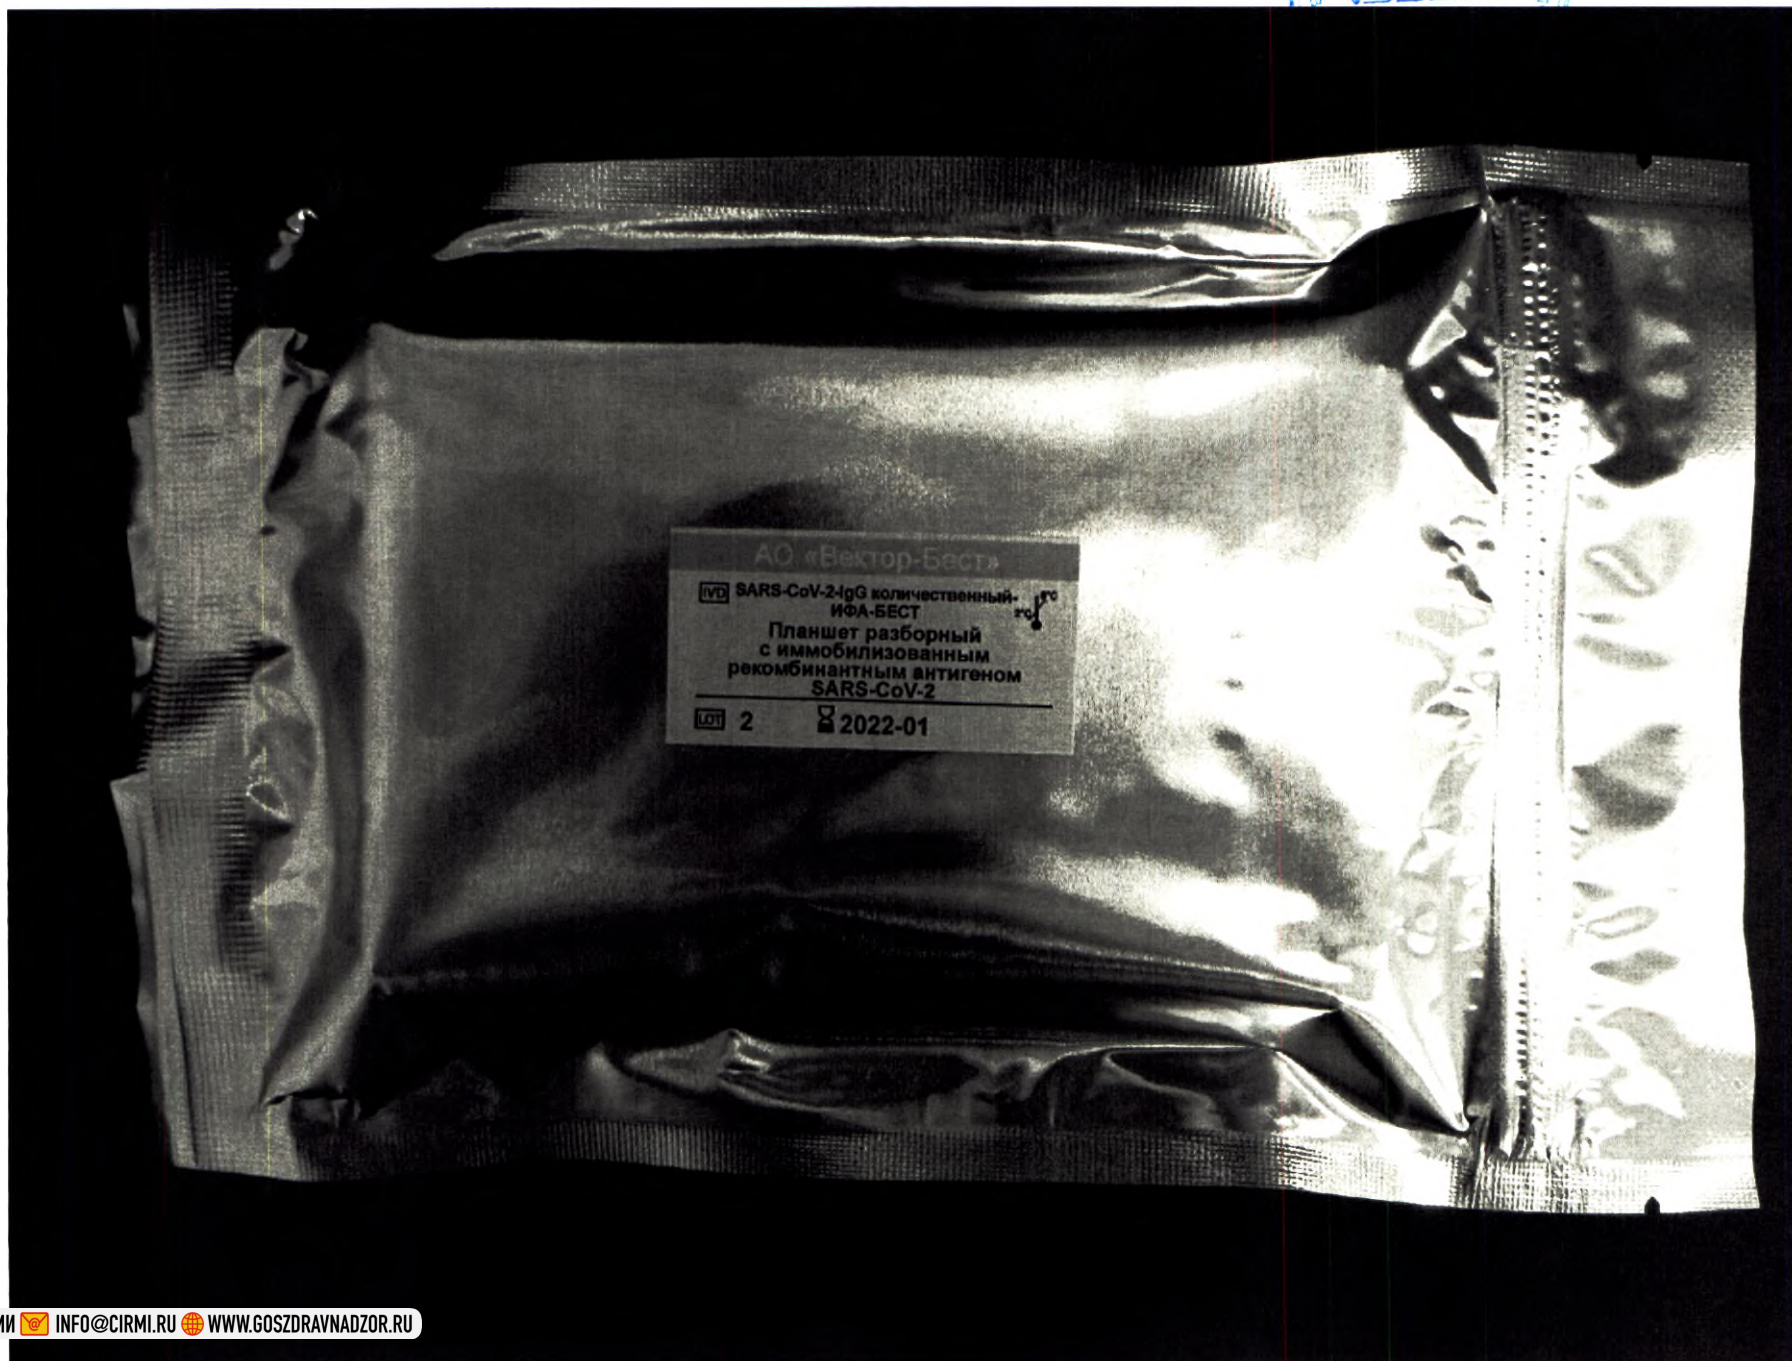



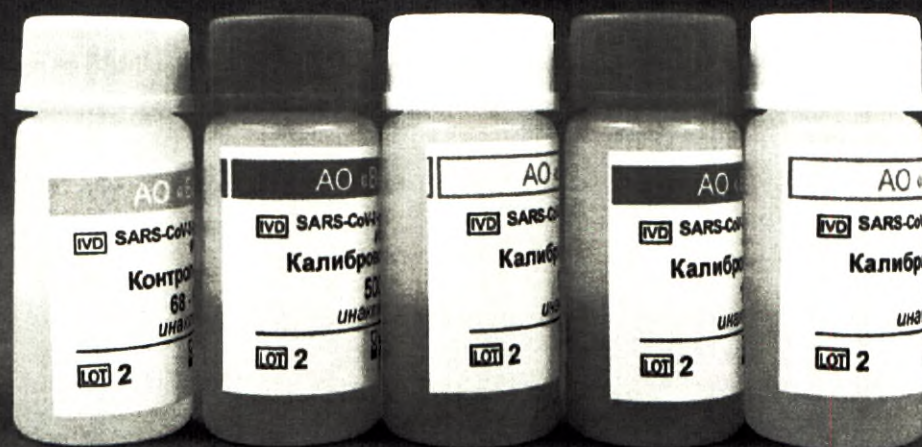



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ” № 3
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”  М.Д. Хусаинов
“30” 04/2021 г.
М.П. 

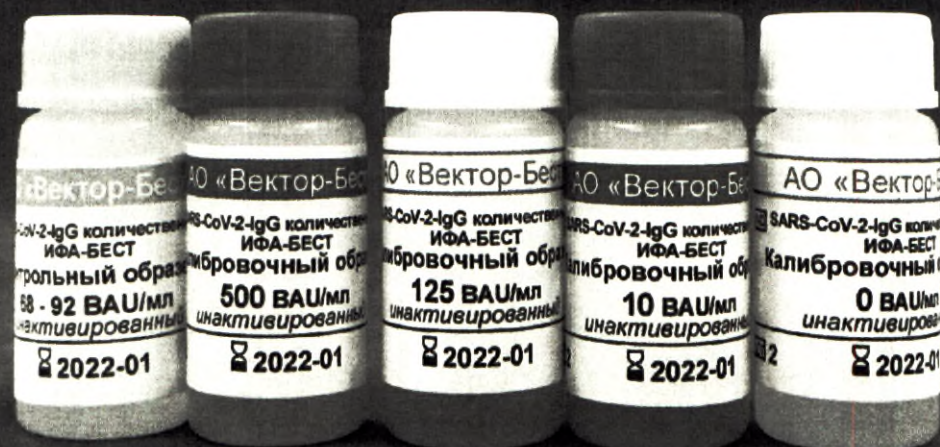


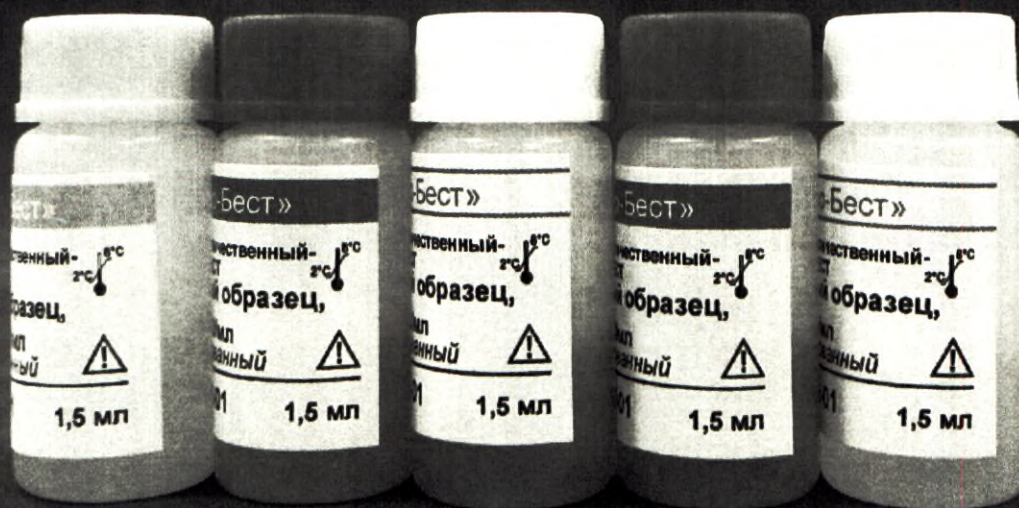


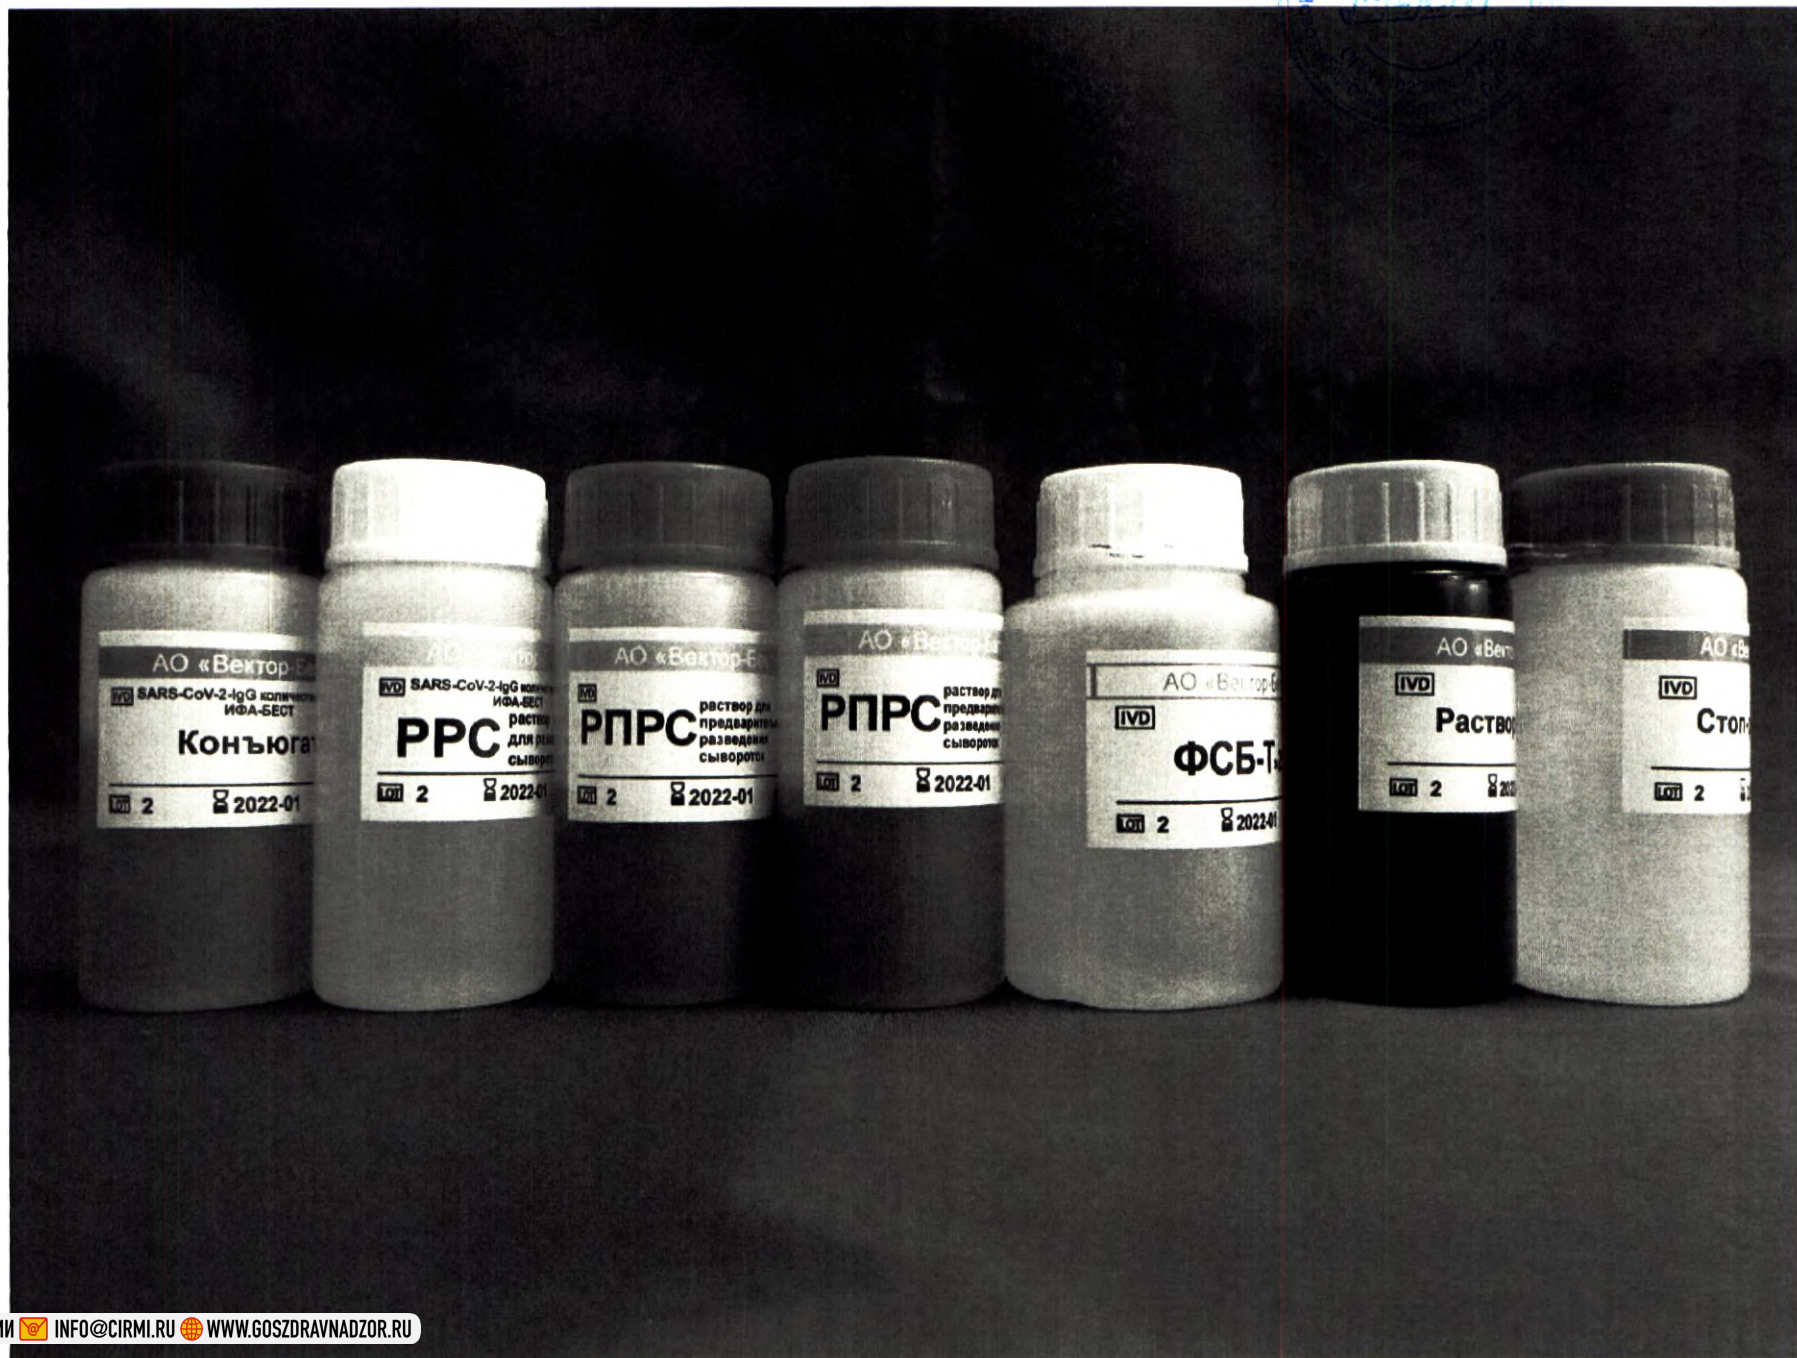

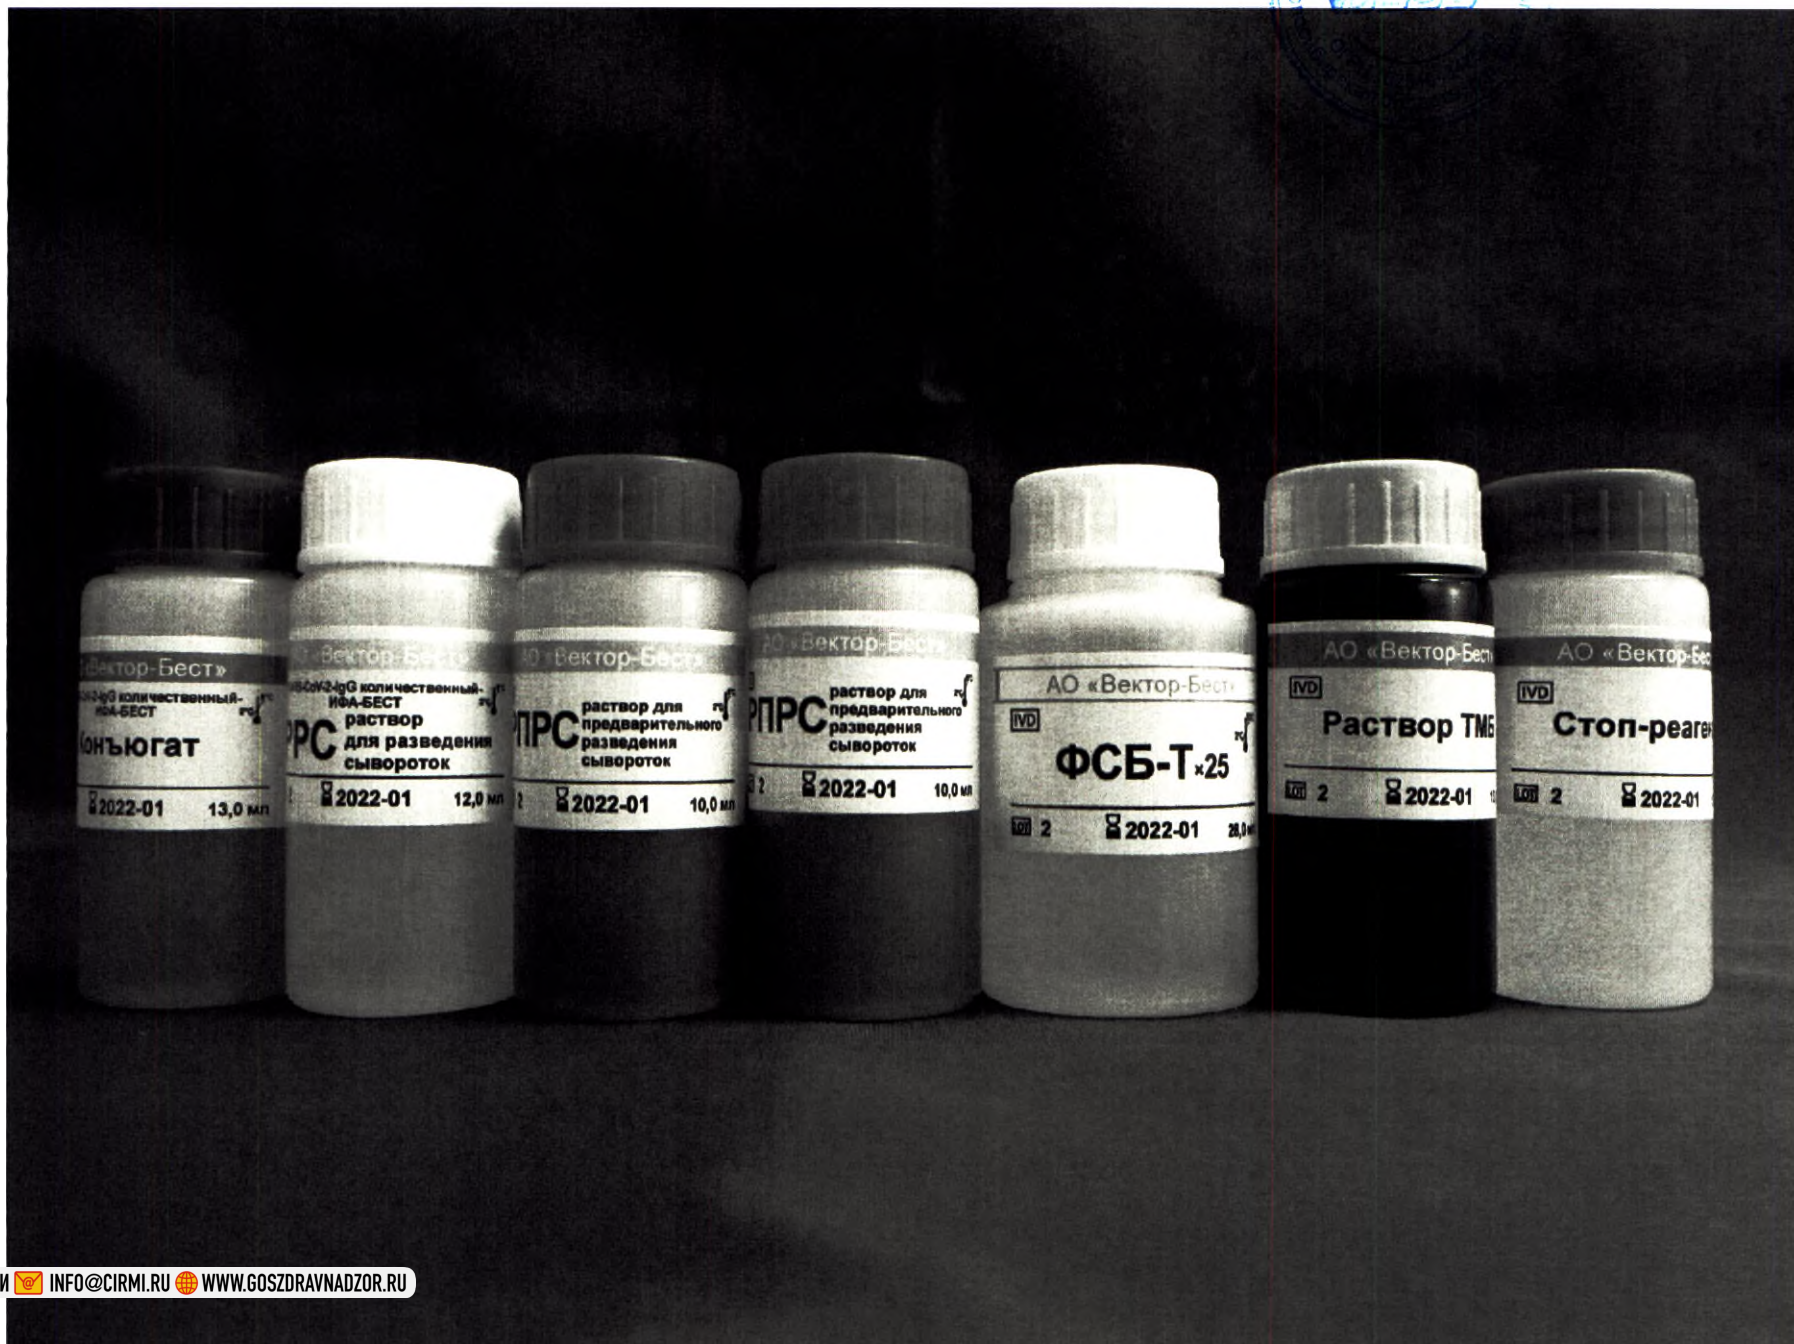



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ” № 7
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”  М.Д. Хусаинов
“ ” 2021 г.
М.П. 

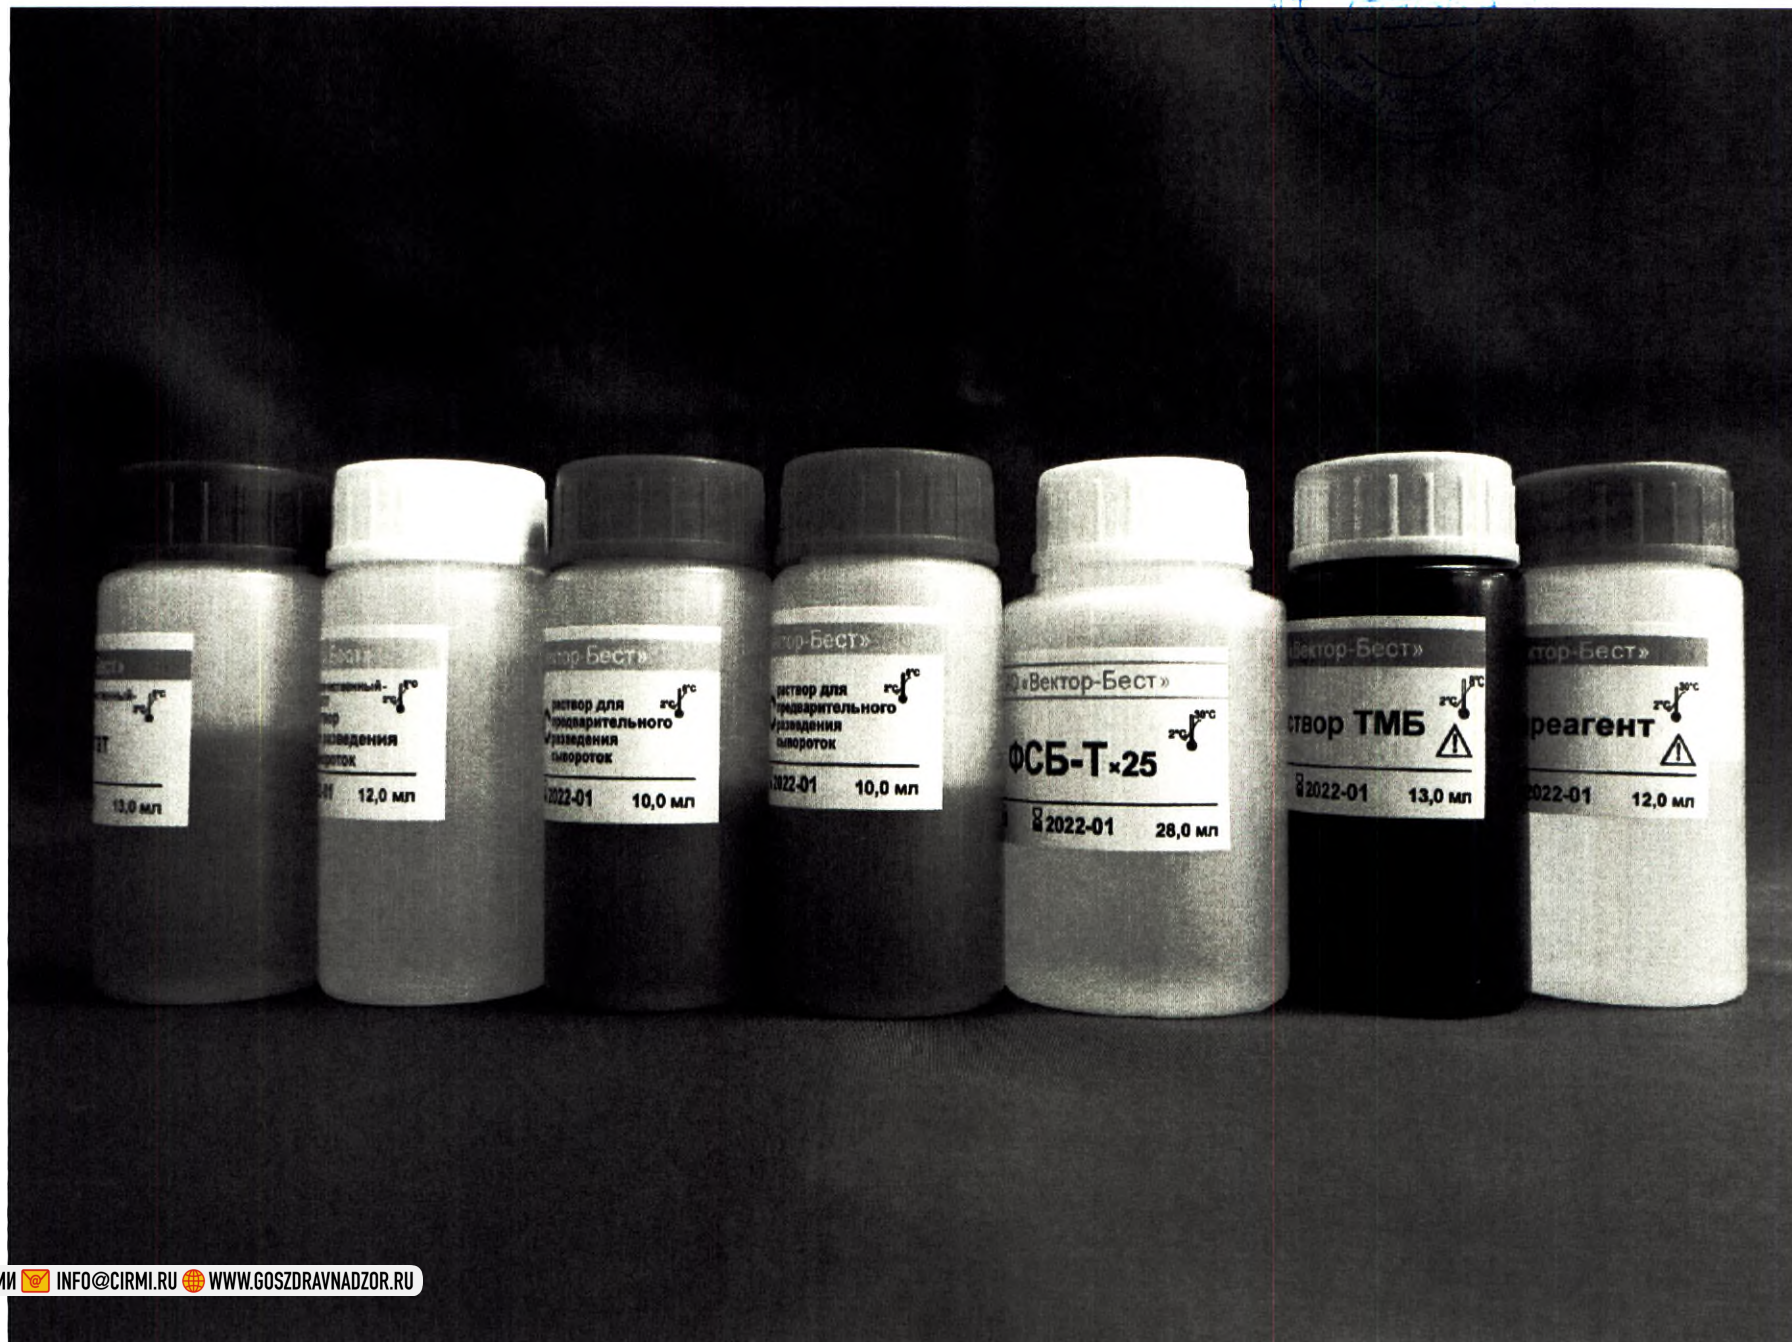

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ" № 8
серия 2


Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"  М.Д. Хусаинов
"20" 04/2021 г.
М.П.

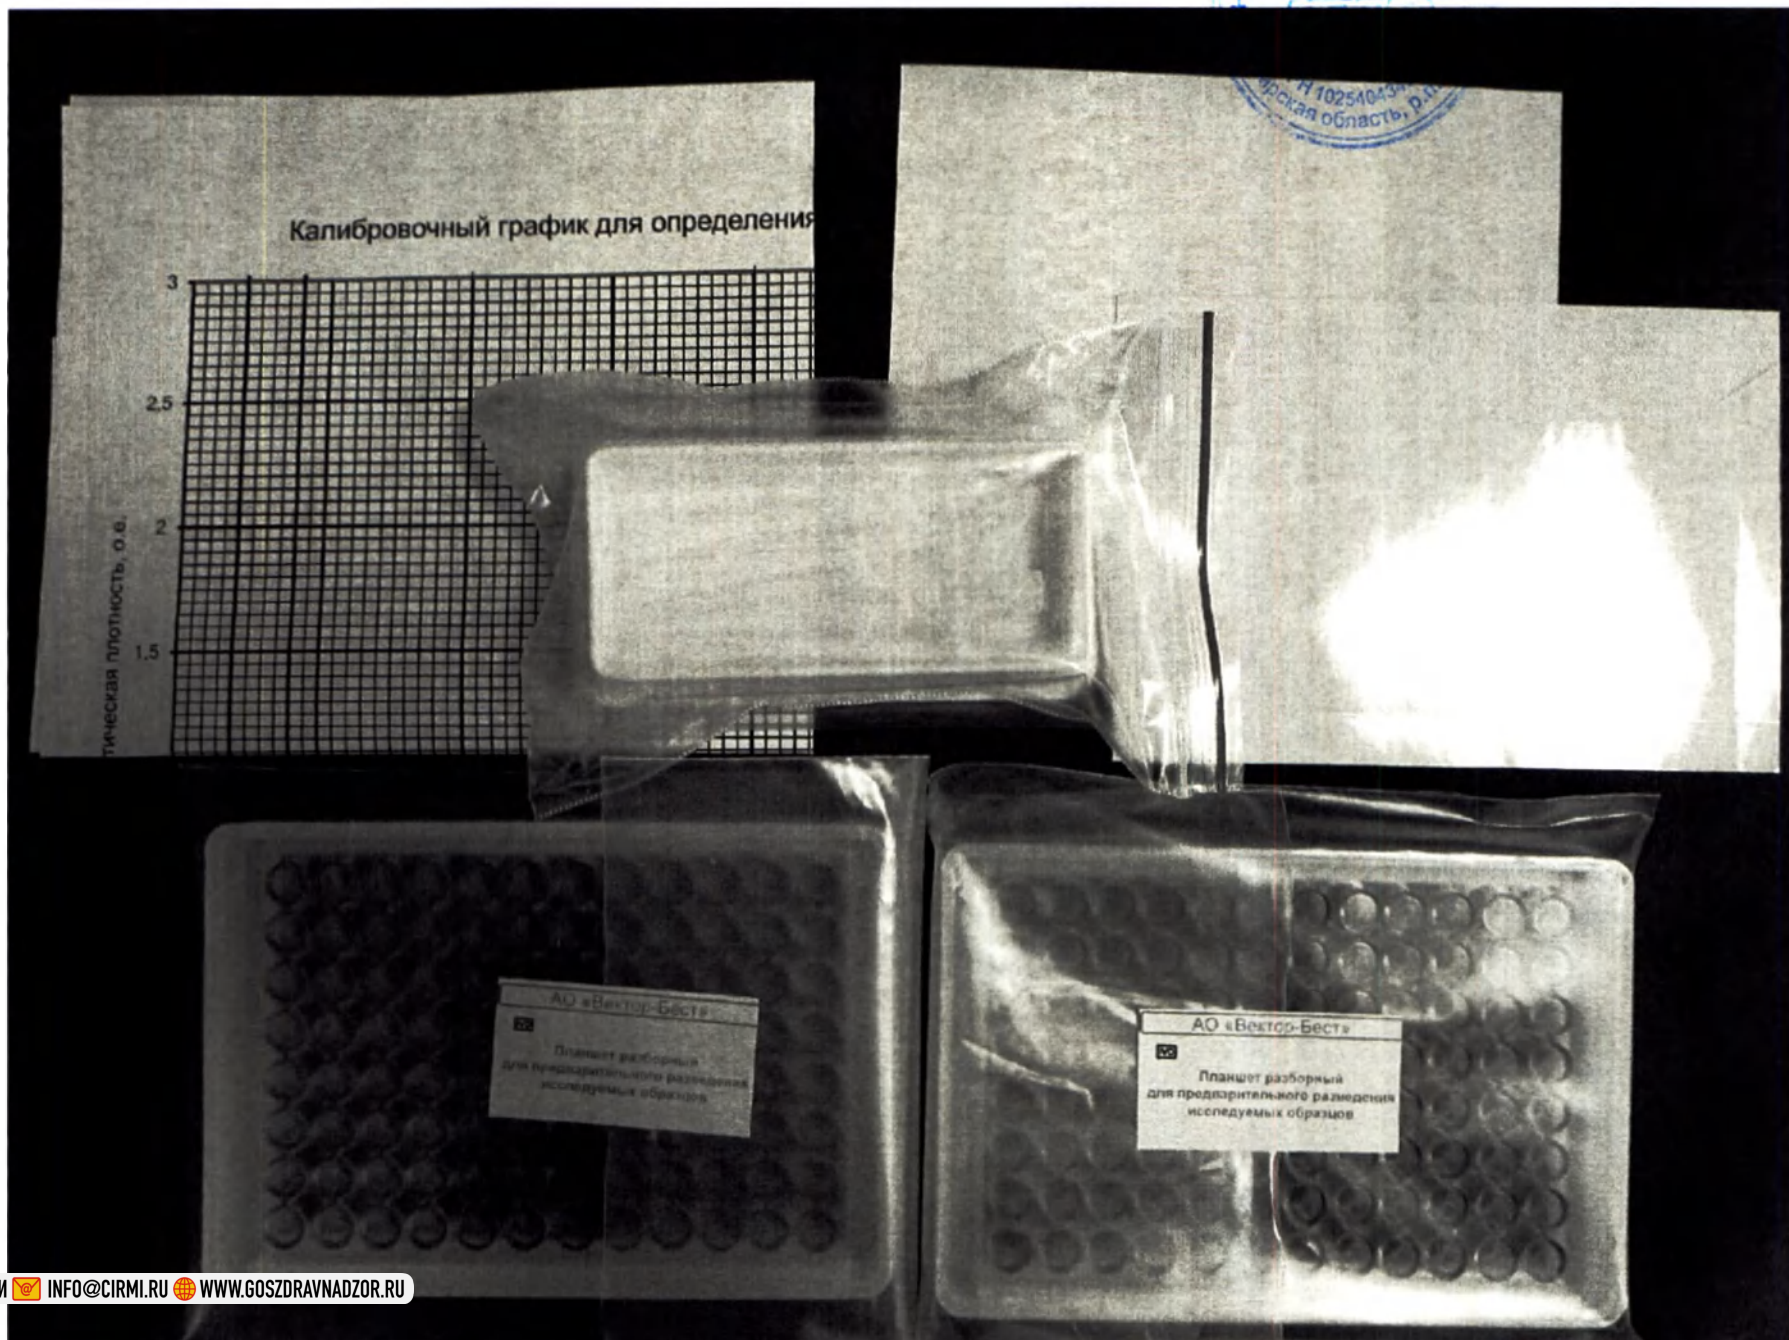

М.Д.

ВЕКТОР

БЕСТ

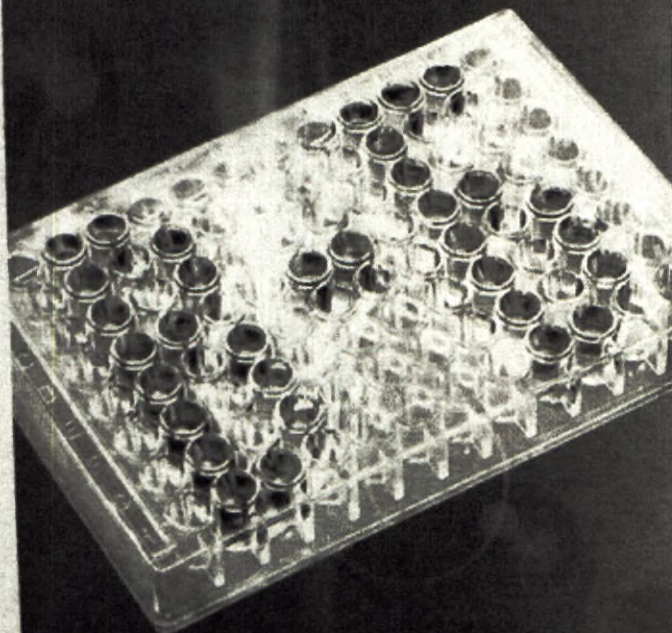

REF
X-XXXX

набор реагентов
для иммуноферментного
количественного определения
иммуноглобулинов класса G
к SARS-CoV-2

SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ


LOT 2

СОСТАВ:

LOT

1. Планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном SARS-CoV-2	1 шт.	2
2. Калибровочные образцы	4 фл. по 1,5 мл	2
3. Контрольный образец	1 фл. 1,5 мл	2
4. Конъюгат	1 фл. 13,0 мл	2
5. Раствор для разведения сывороток	1 фл. 12,0 мл	2
6. Раствор для предварительного разведения сывороток	2 фл. по 10,0 мл	2
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл. 28,0 мл	2
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл. 13,0 мл	2
9. Стоп-реагент	1 фл. 12,0 мл	2
10. Планшеты разборные для предварительного разведения исследуемых образцов	2 шт.	
11. Пленки для заклеивания планшета	2 шт.	
12. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	16 шт.	
13. Ванночки для реагентов	2 шт.	
14. Трафарет для построения калибровочного графика	1 шт.	



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ" № 2
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"  М.Д. Хусаинов
"30"  2021 г.

М.П.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"SARS-CoV-2-IgG количественный-ИФА-БЕСТ" № 3
серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"  М.Д. Хусаинов
"28"  2021 г.
М.П.



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52
E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru