



Фотографические изображения медицинского изделия «Щит спинальный с карбоновой рамкой WSX-S».


1. Щит спинальный с карбоновой рамкой WSX-S в сборе с держателем головы WSX-H1 и комплектом фиксирующих ремней.

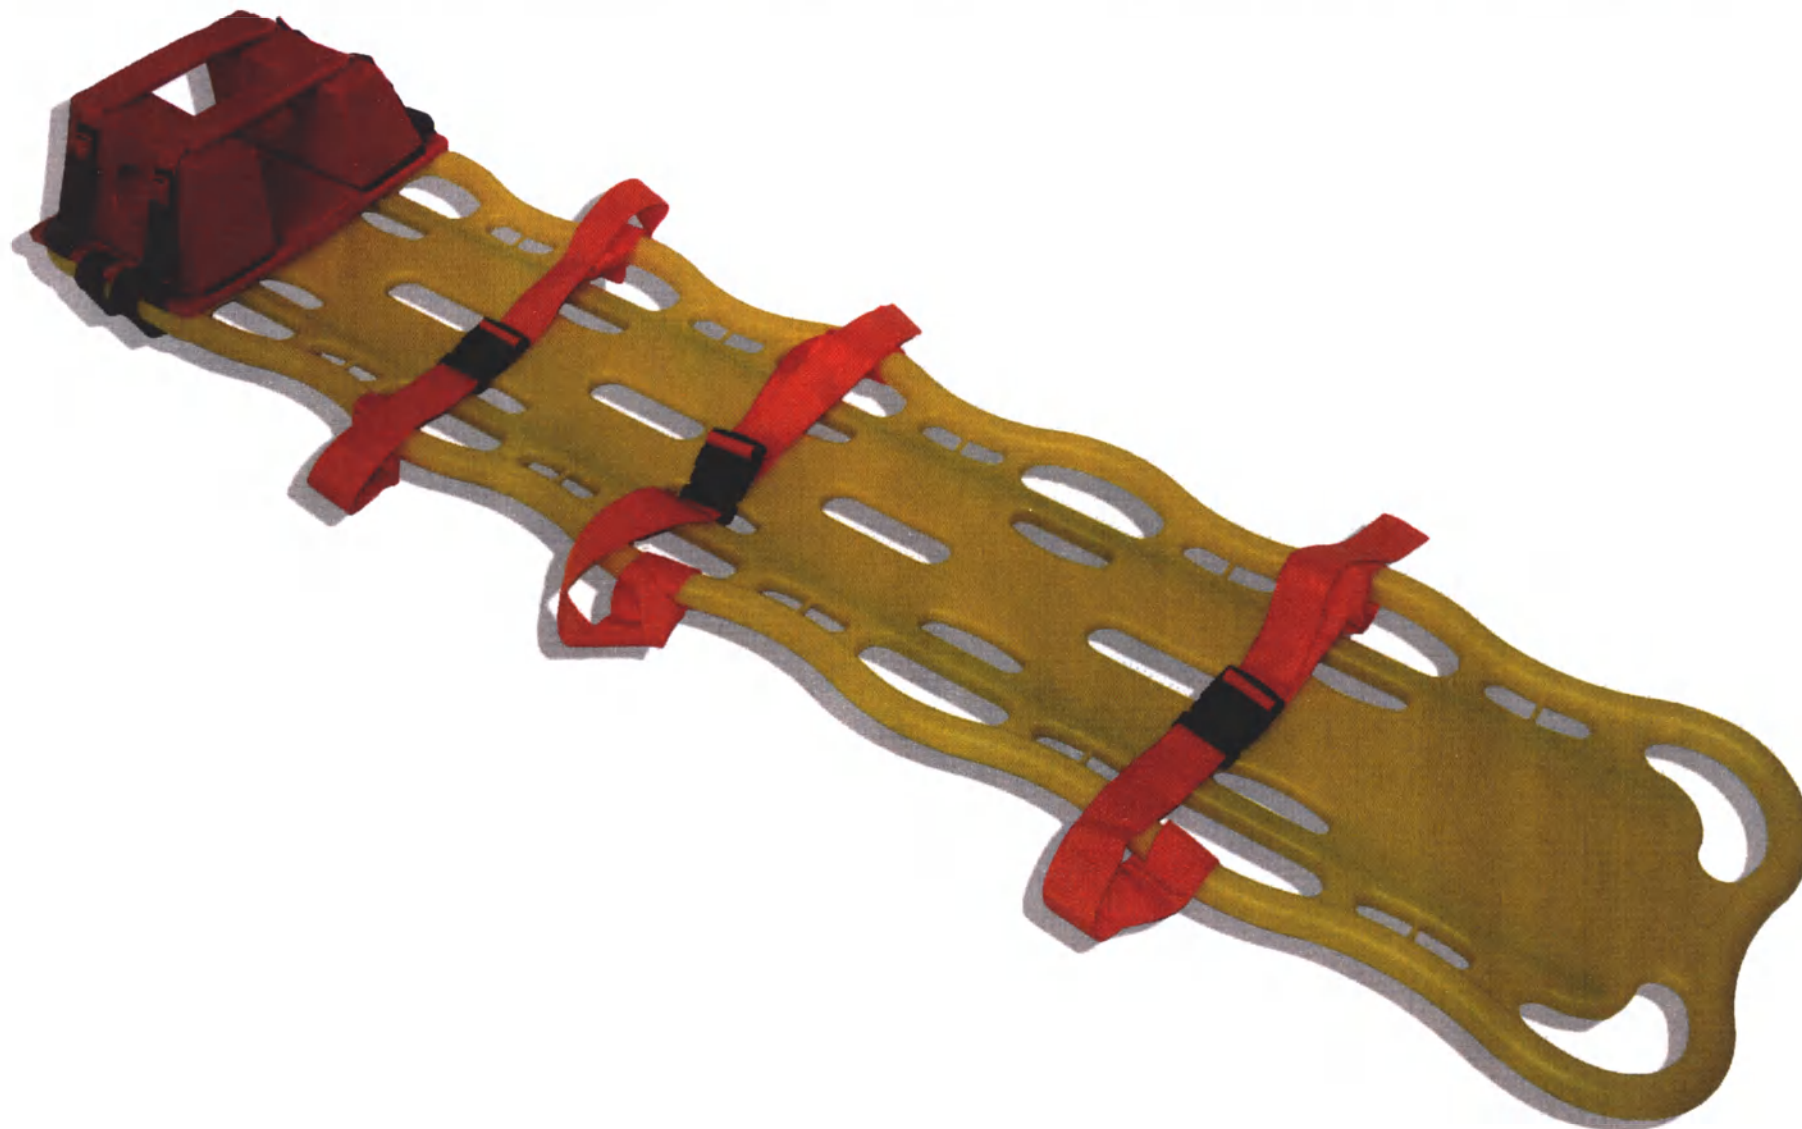

2. Щит спинальный с карбоновой рамкой WSX-S в сборе с держателем головы WSX-H1 и ременной системой.

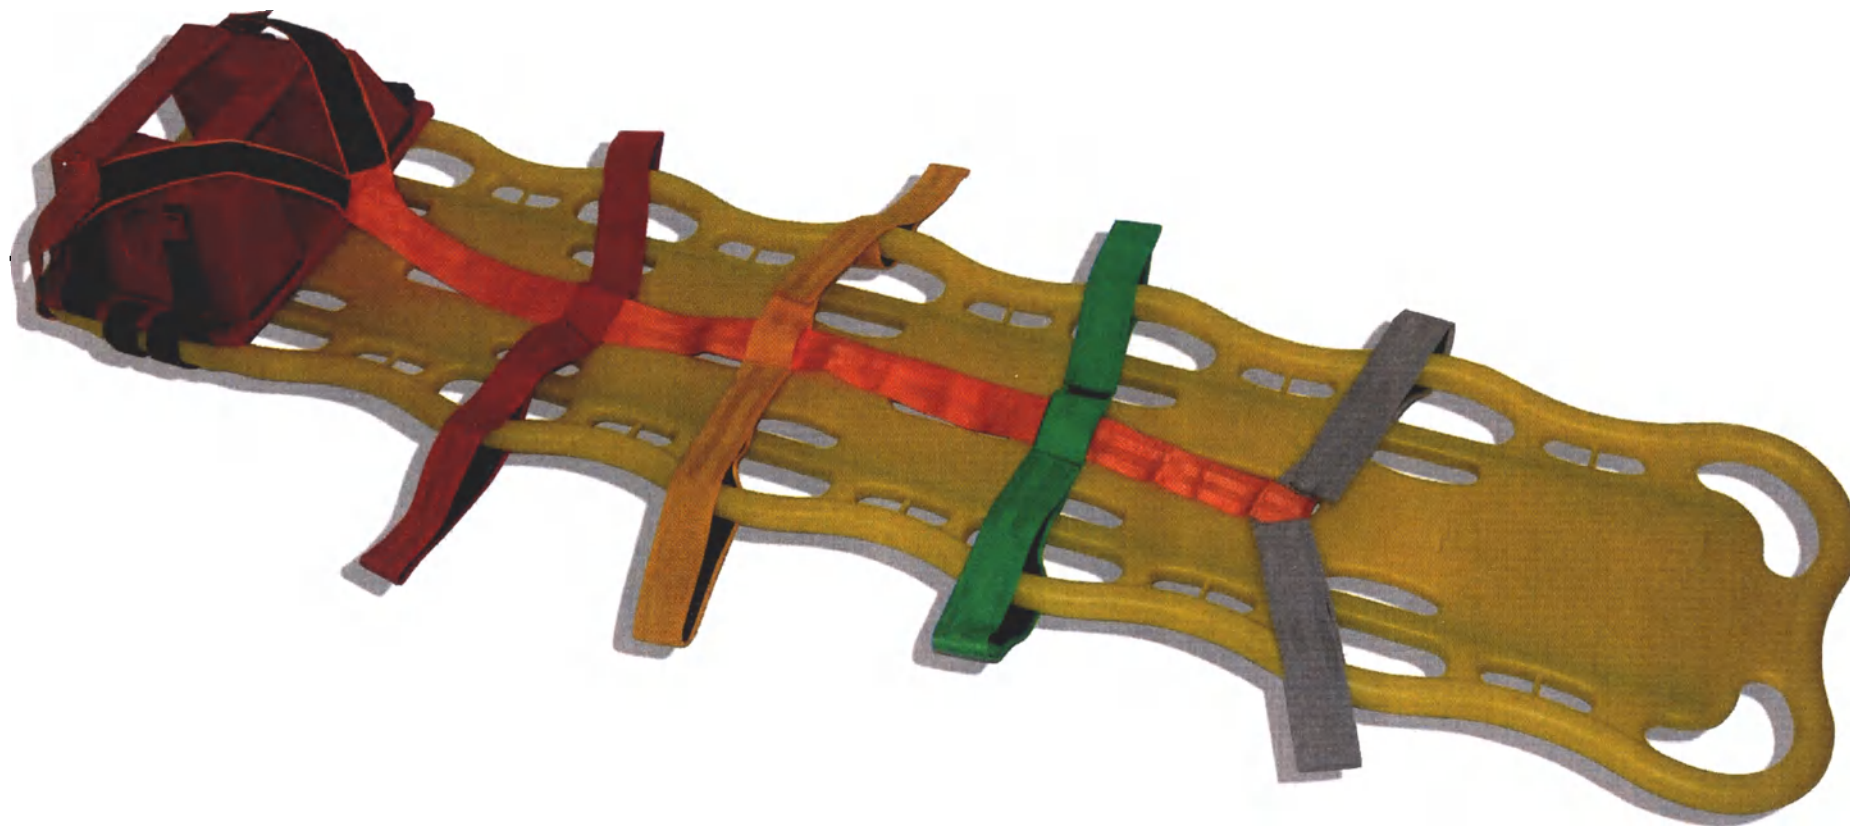

3. Максимальная комплектация щита спинального.

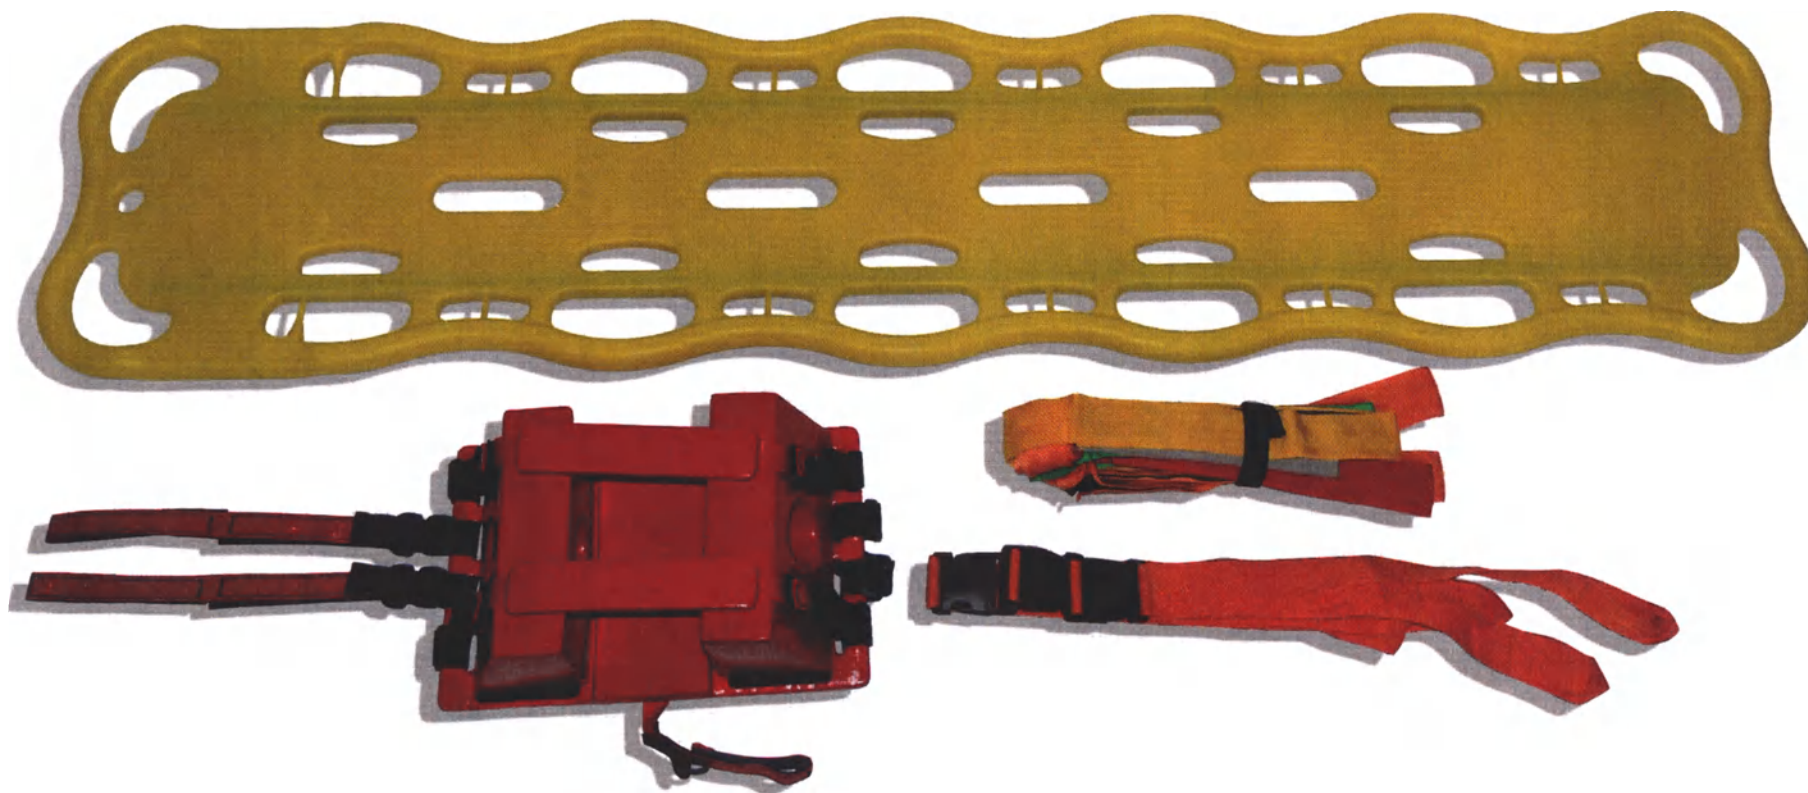

4. Фото маркировки на щите спинальном с



5. Фото маркировки держателя головы WSX-H1.



4. Фото маркировки на щите спинальном с карбоновой рамкой WSX-S.




5. Фото маркировки держателя головы WSX-H1.




6. Фото маркировки ременной системы.



7. Фото маркировки комплекта фиксирующих ремней.

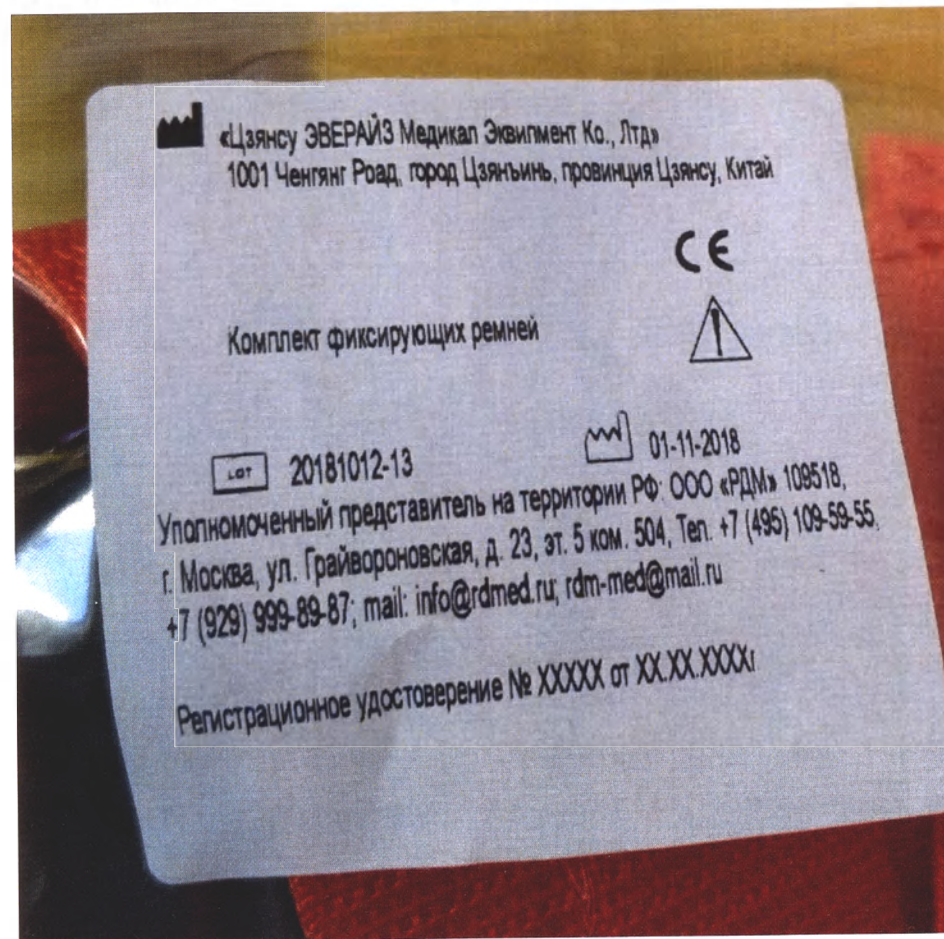


8. Фото маркировки упаковки Щита спинального с карбоновой рамкой WSX-S.

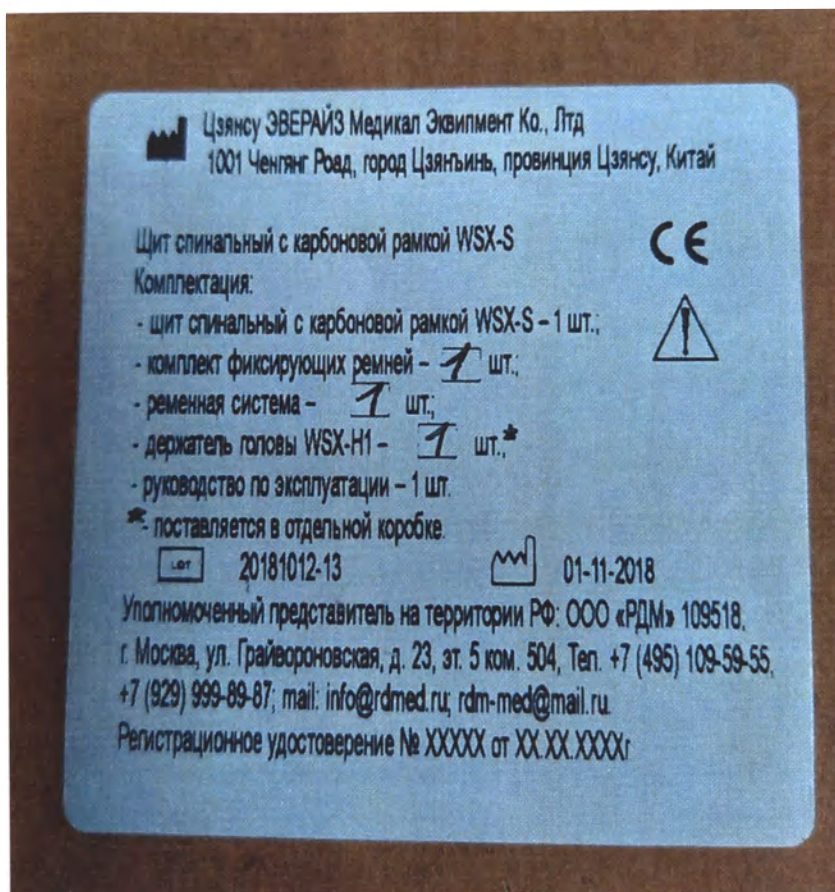

Генеральный директор

9. Фото маркировки упаковки держателя головы WSX-H1.

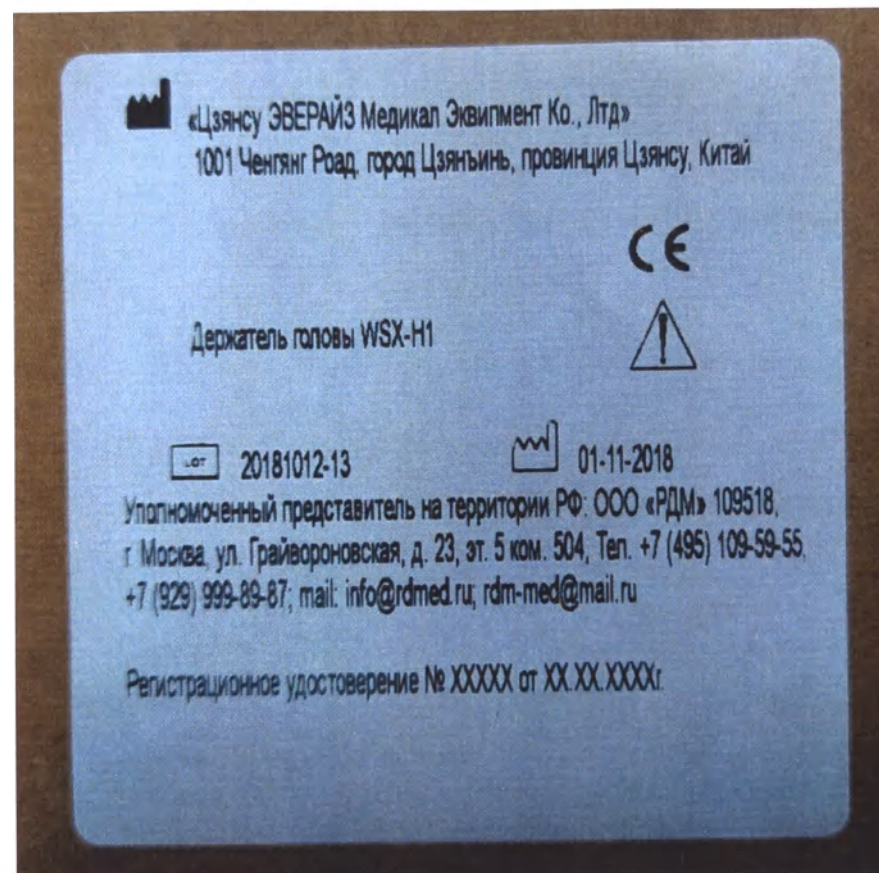

Лихачева Е.Г.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

цифрами прописью

Должность **ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

Подпись **«ООО ЦПМИ»**

«**20**» **ИЮНЯ** 20**20** г. **Е. Г.** М.П.

