

Фотографические изображения

Система для автоматического выделения и очистки нуклеиновых кислот из биологических образцов человека Auto-Pure 96

Система для автоматического выделения и очистки нуклеиновых кислот из биологических образцов человека Auto-Pure 96 (русская язычная маркировка внешней упаковки)



Система для автоматического выделения и очистки нуклеиновых кислот из биологических образцов человека Auto-Pure 96 (русская язычная маркировка внешней упаковки)

Система для автоматического выделения и очистки нуклеиновых кислот из биологических образцов человека Auto-Pure 96

Состав:

1. Система для автоматического выделения и очистки нуклеиновых кислот из биологических образцов человека Auto-Pure 96 – 1 шт.;
2. Кабель питания – 1 шт.;
3. Компьютерная мышь – 1 шт.;
4. Упаковочный лист – 1 шт.;
5. Сертификат соответствия – 1 шт.;
6. Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
7. Руководство по быстрому запуску – 1 шт.;
8. Отчет о проверке – 1 шт.;
9. USB-карта – 1 шт.;
10. Внутренний шестигранный ключ 2 мм – 1 шт.;
11. Внутренний шестигранный ключ 1,5 мм – 1 шт.



Hangzhou Allsheng Instruments Co., Ltd.
Building 9 №7 of Zhuantang,
Science and Technology Economic Zone,
Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang, China



Дек. 2020




№ PV XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX

Уполномоченный представитель (дистрибьютор) в

РФ: ООО «Компания Хеликон»

119619 Москва, Новомосковский проезд,

дом №9, стр. 1, комн. 11



10°C


33°C




Allsheng-AS-17060-Dx




180-16168-20120001



Система для автоматического выделения и очистки нуклеиновых кислот из биологических образцов человека Auto-Pure 96 (вид спереди)

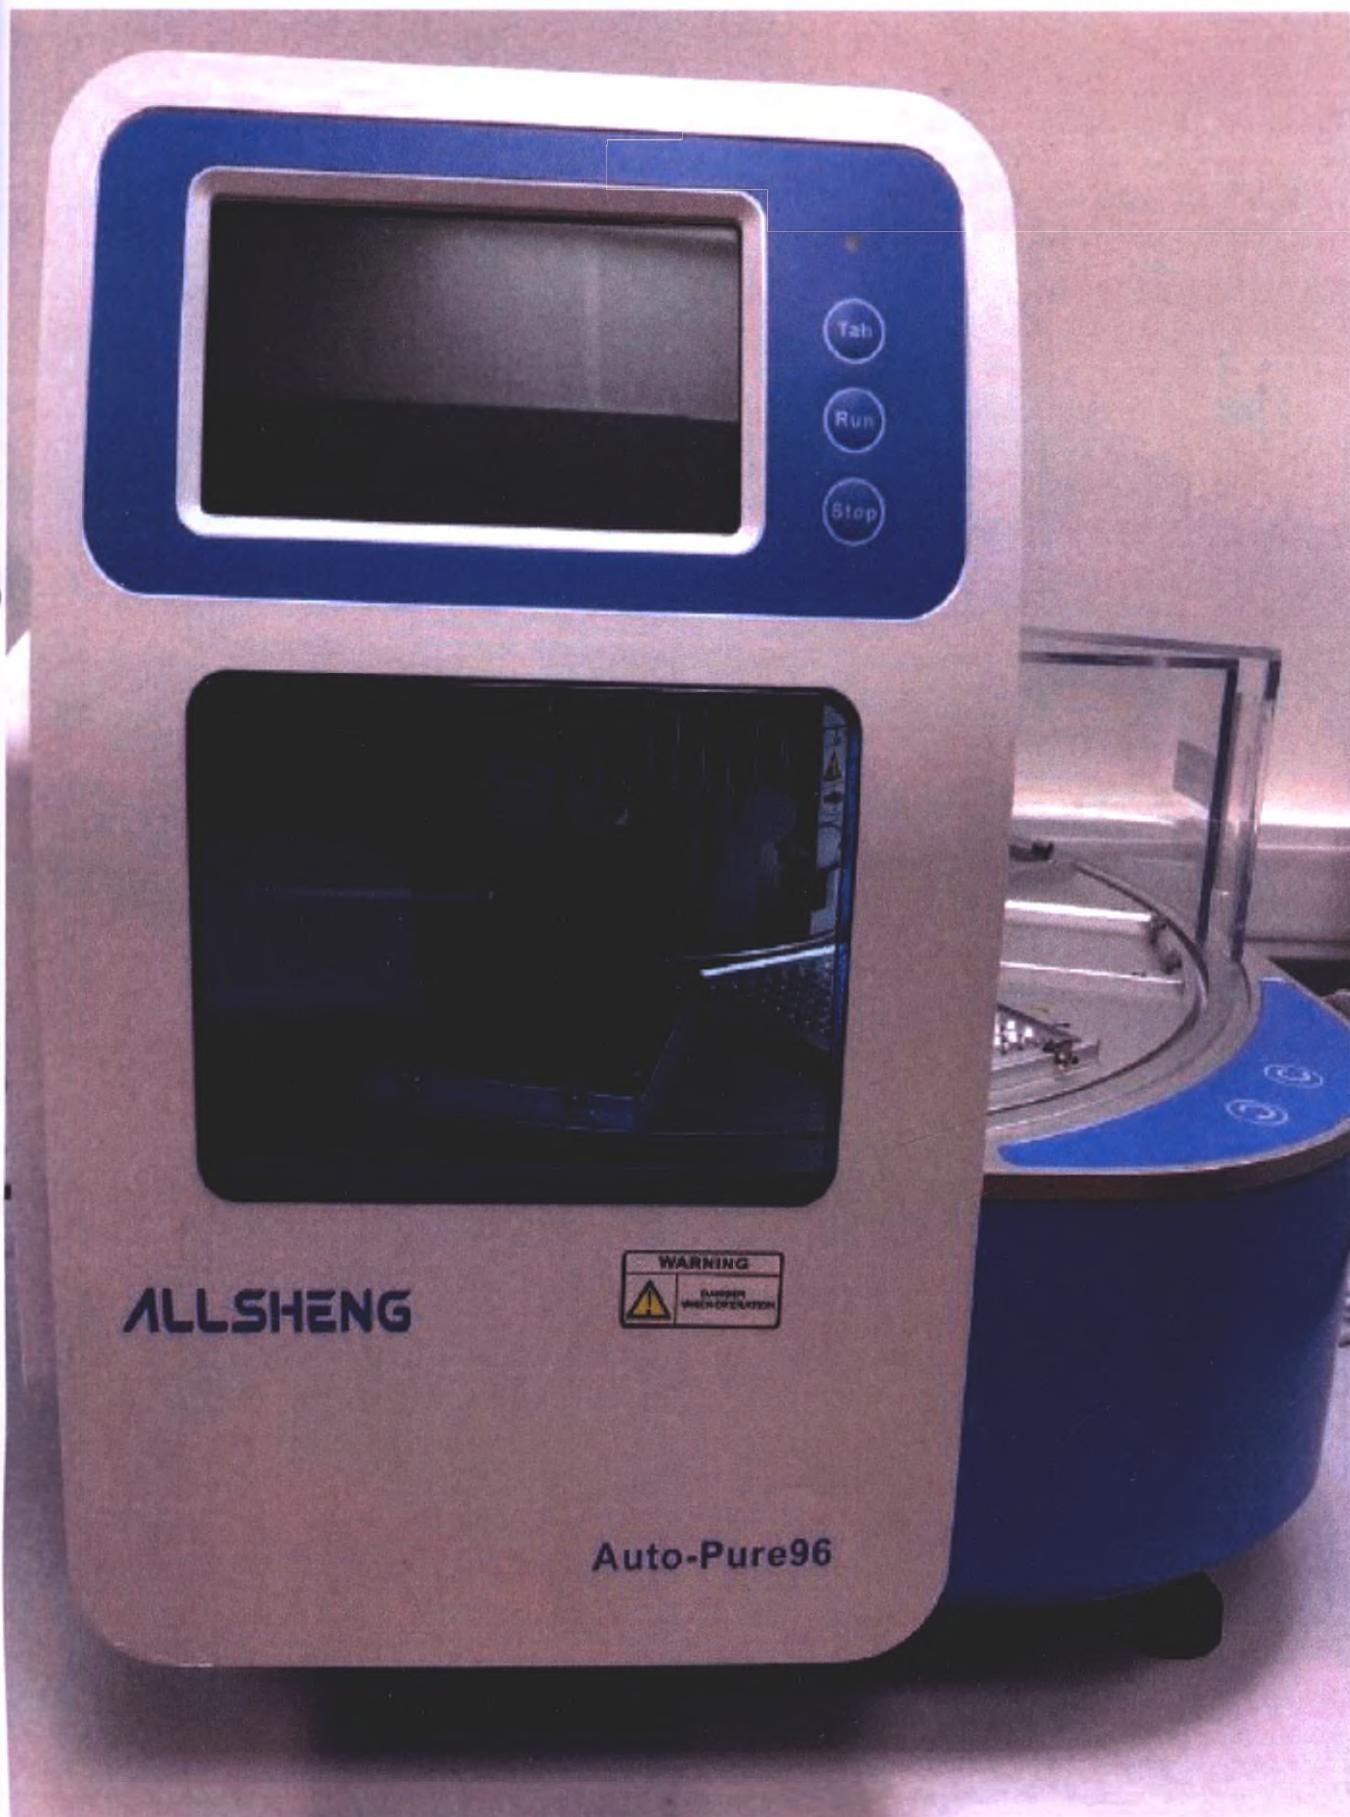


Система для автоматического выделения и очистки нуклеиновых кислот из биологических образцов человека Auto-Pure 96 (вид слева)

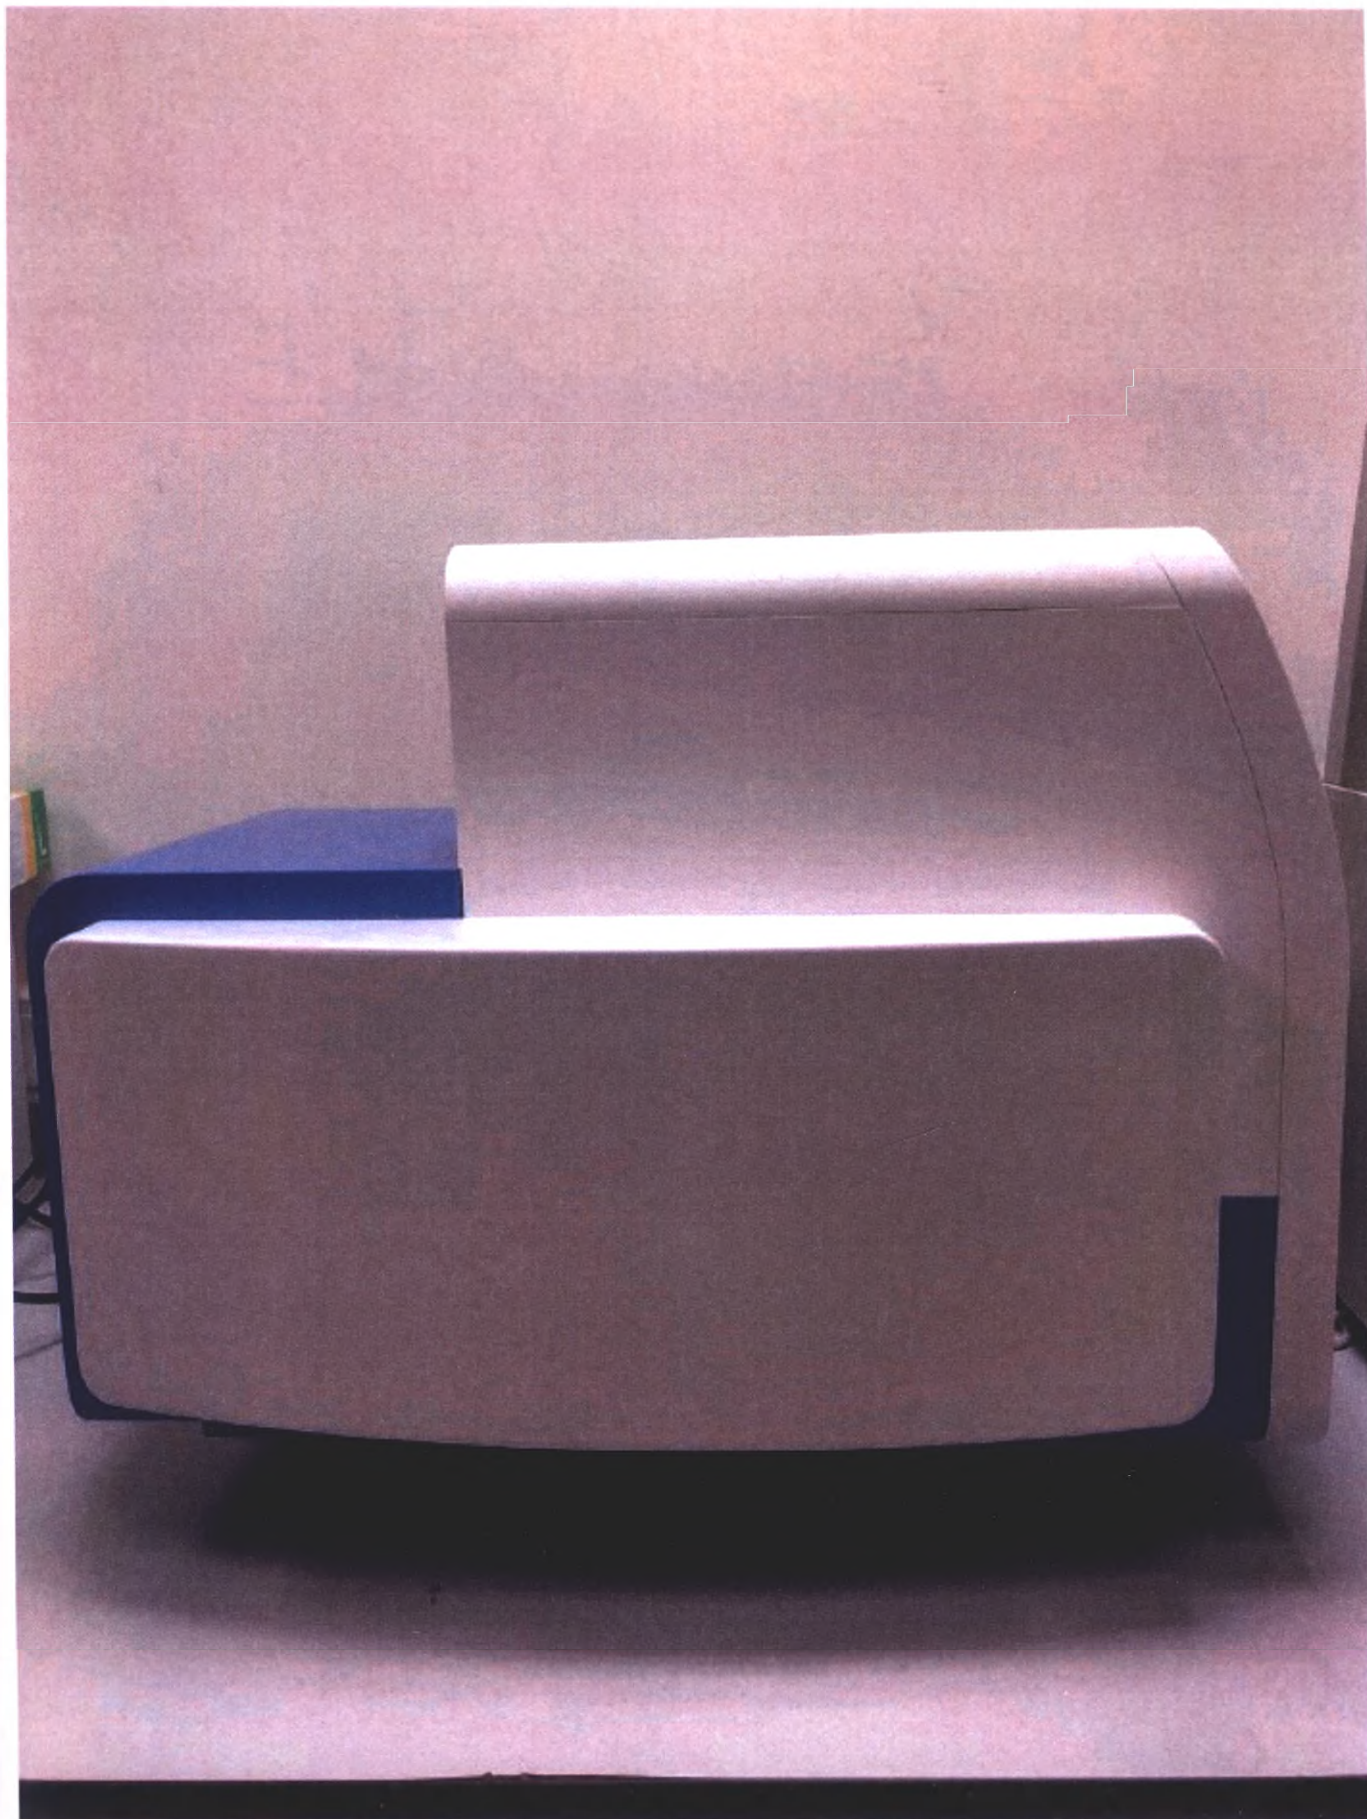

Система для автоматического выделения и очистки нуклеиновых кислот из биологических образцов человека Auto-Pure 96 (вид справа)



Система для автоматического выделения и очистки нуклеиновых кислот из биологических образцов человека Auto-Pure 96 (рабочая часть внутри)

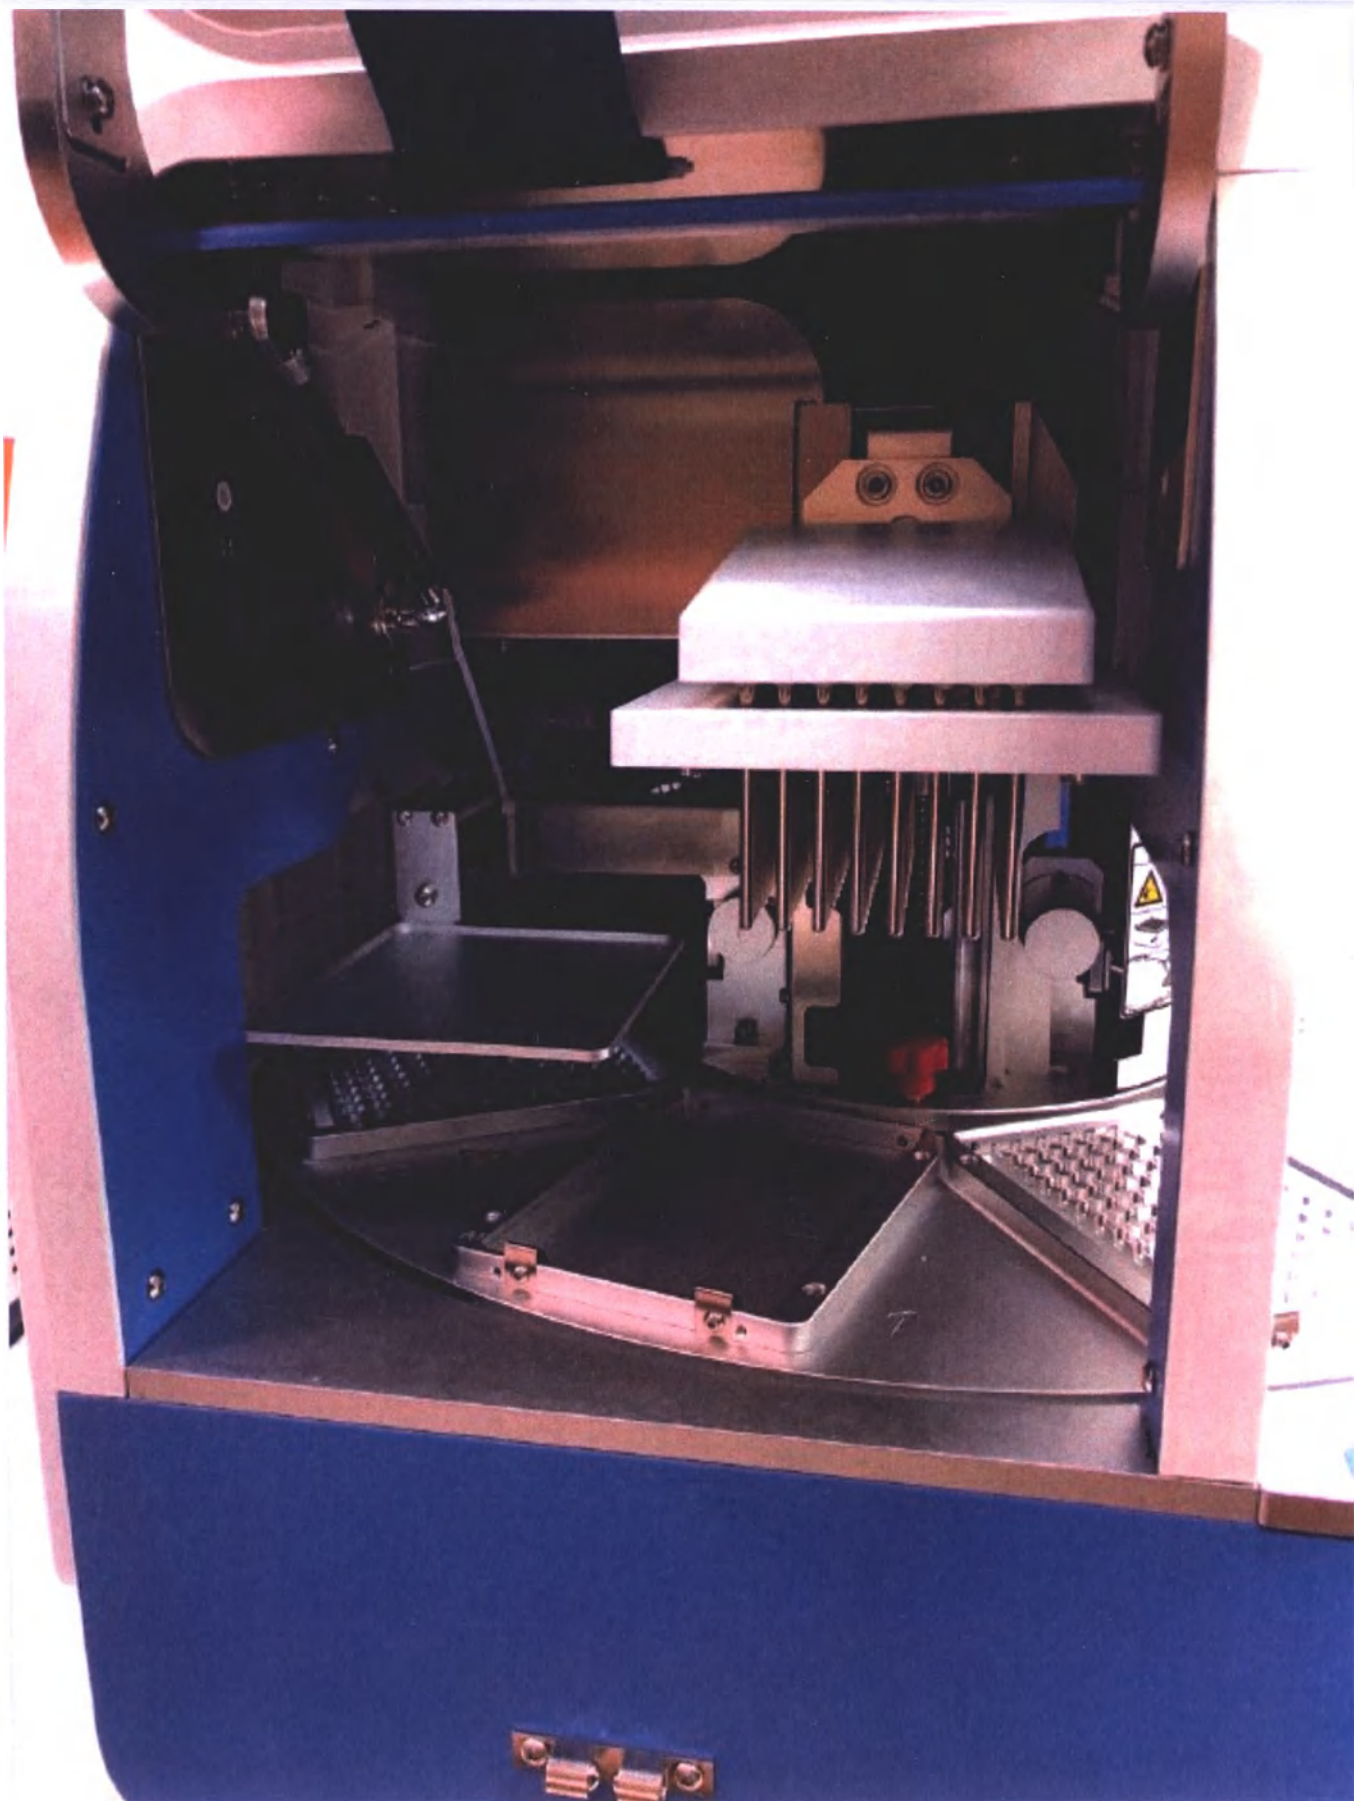

Система для автоматического выделения и очистки нуклеиновых кислот из биологических образцов человека Auto-Pure 96 (вид сзади)



HANGZHOU ALLSHENG INSTRUMENTS CO., LTD.

ALLSHENG **www.allsheng.com**

Nucleic Acid Purification System

MODEL: Auto-Pure96



INPUT: 100-240V ~ 50-60Hz 250VA


SERIAL NO.: 180-16168-20120001

MANUFACTURE DATE: Dec. 2020

Made In China

Система для автоматического выделения и очистки нуклеиновых кислот из биологических образцов человека Auto-Pure 96 (шильдик)

Система для автоматического выделения и очистки нуклеиновых кислот из биологических образцов человека Auto-Pure 96 (русская маркировка на изделии)

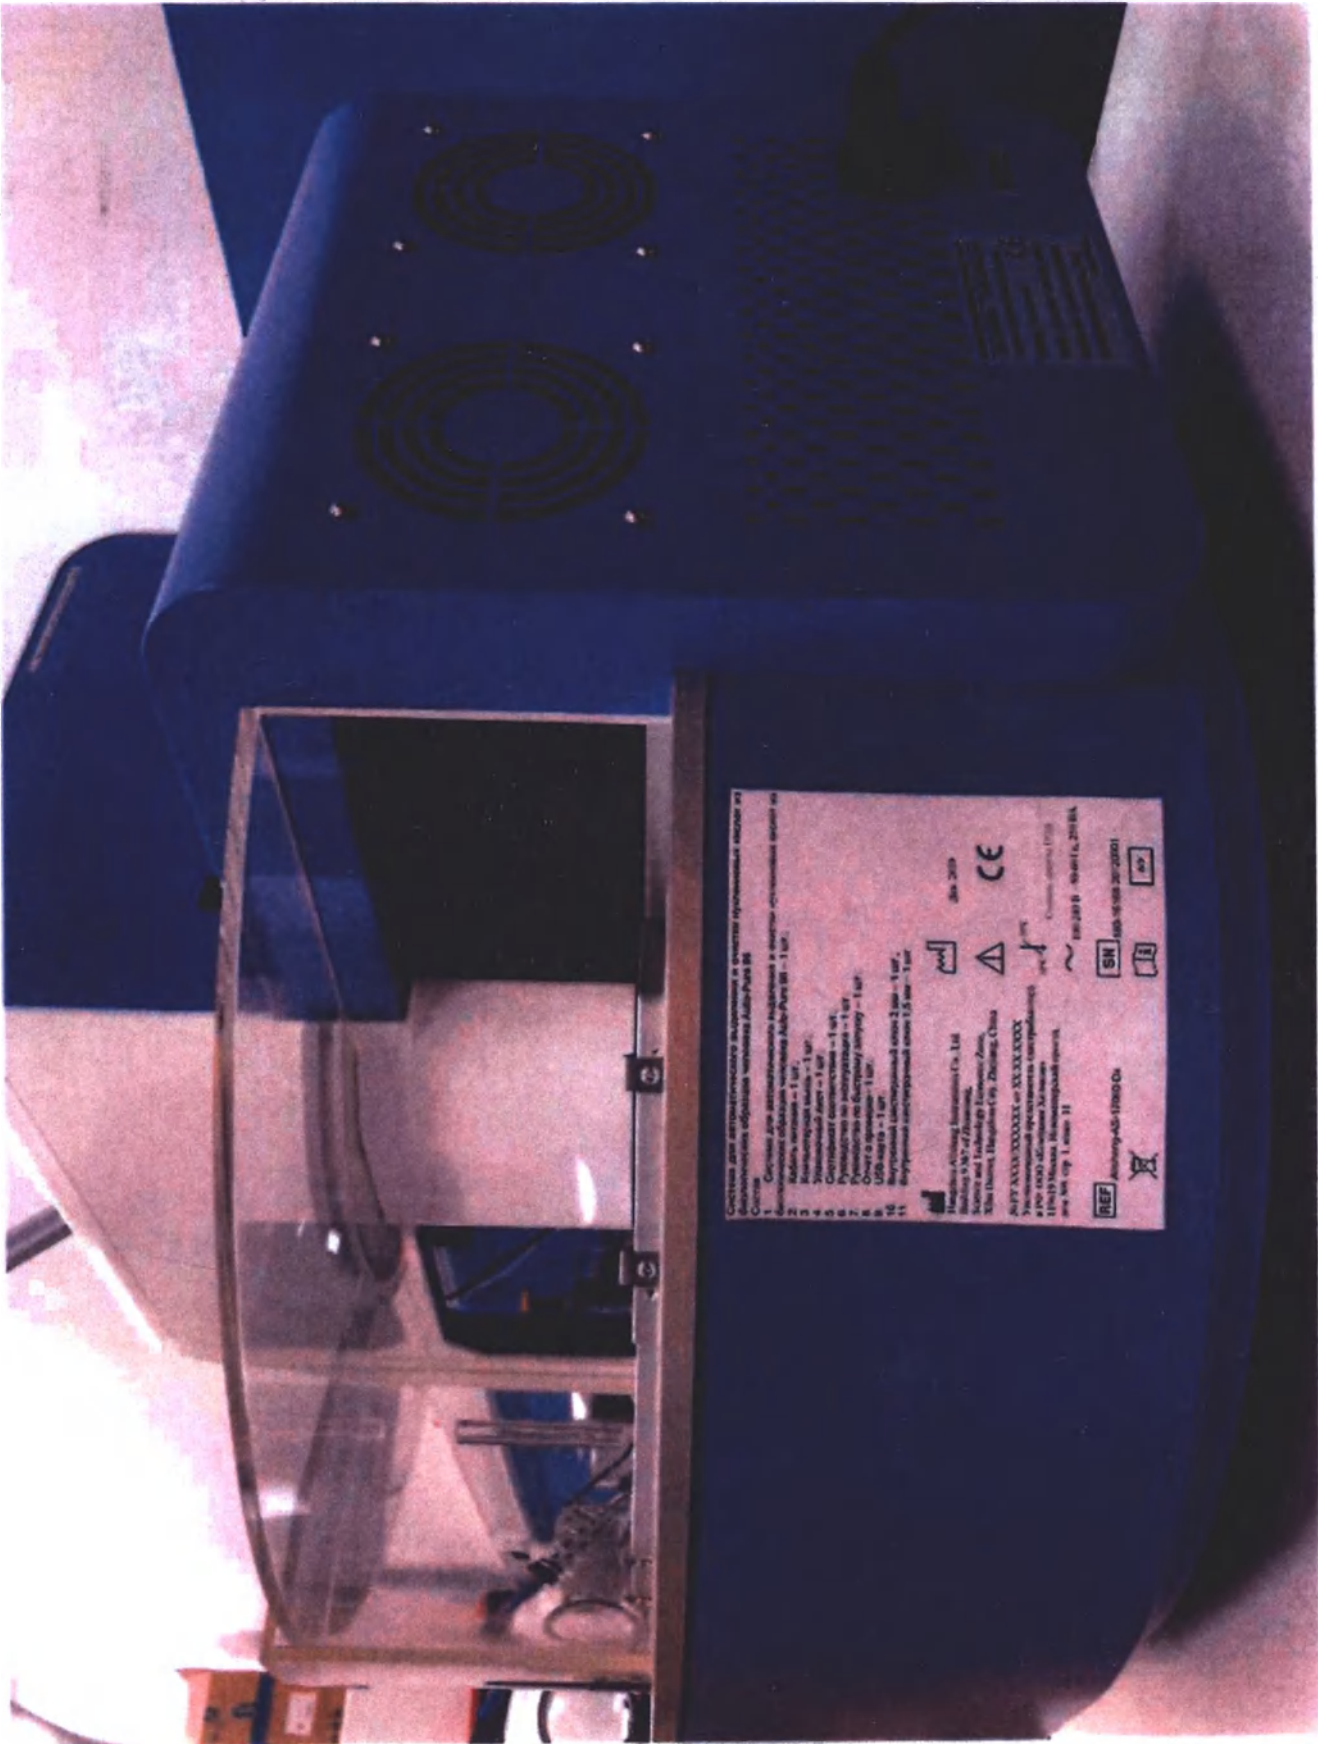

Система для автоматического выделения и очистки нуклеиновых кислот из биологических образцов человека Auto-Pure 96 (русскаяязычная маркировка на изделии)

Система для автоматического выделения и очистки нуклеиновых кислот из биологических образцов человека Auto-Pure 96

Состав:

1. Система для автоматического выделения и очистки нуклеиновых кислот из биологических образцов человека Auto-Pure 96 – 1 шт.;
2. Кабель питания – 1 шт.;
3. Компьютерная мышь – 1 шт.;
4. Упаковочный лист – 1 шт.;
5. Сертификат соответствия – 1 шт.;
6. Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
7. Руководство по быстрому запуску – 1 шт.;
8. Отчет о проверке – 1 шт.;
9. USB-карта – 1 шт.;
10. Внутренний шестигранный ключ 2 мм – 1 шт.;
11. Внутренний шестигранный ключ 1,5 мм – 1 шт.




Hangzhou Allsheng Instruments Co., Ltd.
Building 9 №7 of Zhuantang,
Science and Technology Economic Zone,
Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang, China

№ РУ XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX
Уполномоченный представитель (дистрибьютор)
в РФ: ООО «Компания Хеликон»
119619 Москва, Новомещерский проезд,
дом №9, стр. 1, комн. 11



Дек. 2020



Степень защиты IPX0




100-240 В ~ 50-60 Гц, 250 ВА



Allsheng-AS-17060-Dx




180-16168-20120001



Система для автоматического выделения и очистки нуклеиновых кислот из биологических образцов человека Auto-Pure 96 (вид сзади с разъемами)





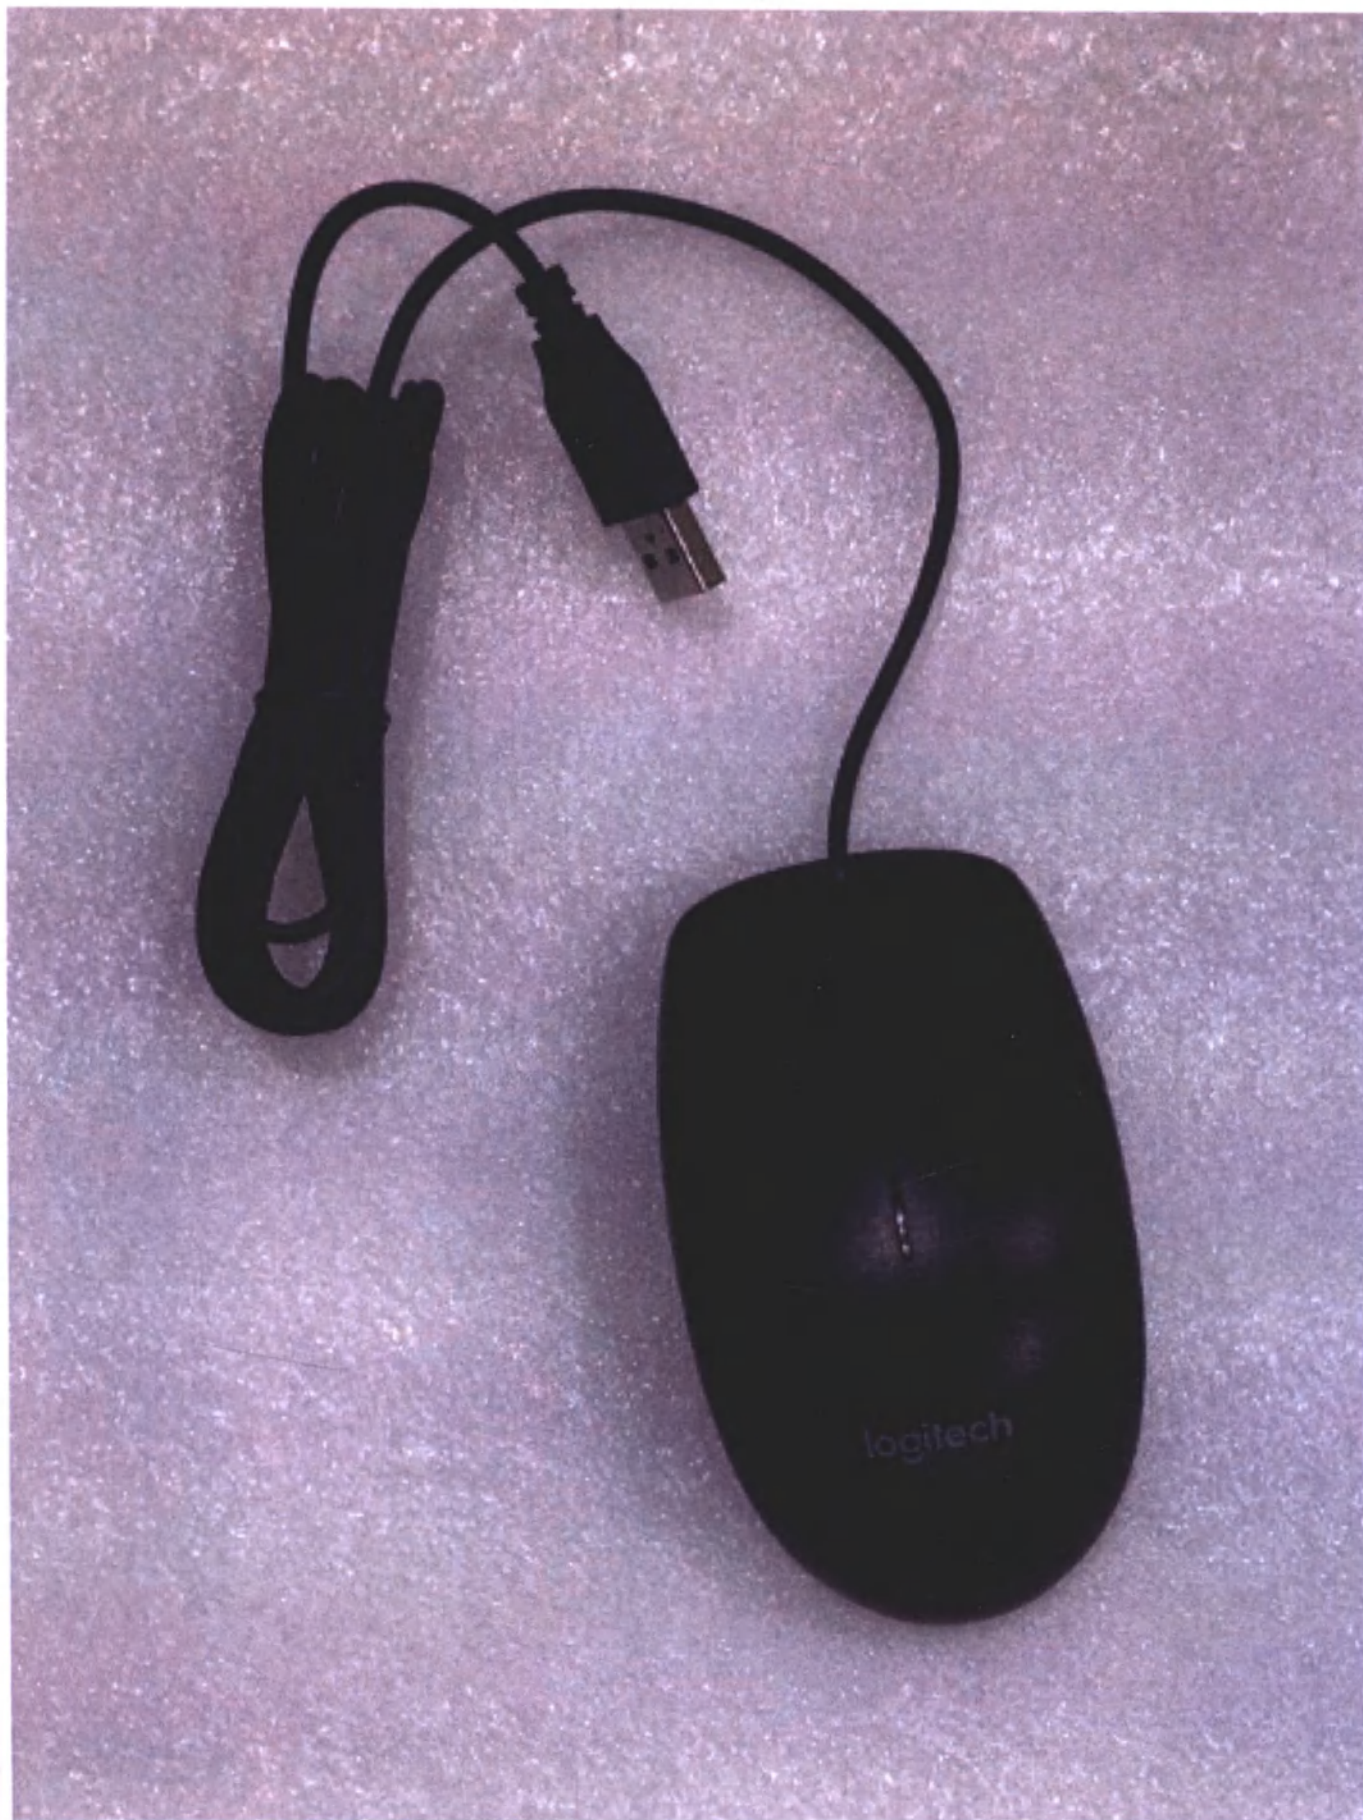

Папка с документами: Упаковочный лист, Сертификат соответствия, Руководство по эксплуатации, Руководство по быстрому запуску, Отчет о проверке, Внутренний шестигранный ключ 2 мм, Внутренний шестигранный ключ 1,5 мм.

Performance Test Statement

Name	Nucleic Acid Purification System		Type	☐ Auto-Pure 24 ☐ Auto-Pure 48 ☒ Auto-Pure 96	
Test Date	20th Nov 2018		Production NO.	188-16165-2809808	
No.	Test Content	Test Process	Standard	Test Results	Conclusion
1	Temp. Accuracy	Equilibrator	100±1°C	100.3°C	Q1 Qualified
2		Stopper	57min	5' 28"	Q1 Qualified
		Reagent	54%	2.54%	Q1 Qualified
		Reagent	250%	25.2%	Q1 Qualified
		Operation	Valid	ok	Q1 Qualified
		Safety	Ground resistance: < 15Ω Leakage current: 0.5mA High voltage: 1500V	ok	Q1 Qualified
			Valid	ok	Q1 Qualified
			Valid	ok	Q1 Qualified
Test Results					
Remarks:					
Tested by:			Confirmed by:		



ALIXING Hangzhou Alixing Instruments Co., Ltd

Version NO.: C/6
List NO.: AS/QR10-000-40

Packing list

[illegible]

Packed by:

Date of packing: 29th Sep. 2020






CERTIFICATION
PASS

Hangzhou Allsheng Instruments CO.,LTD.

Руководство по эксплуатации на медицинское изделие

Система для автоматического выделения и очистки нуклеиновых
кислот из биологических образцов человека Auto-Pure 96

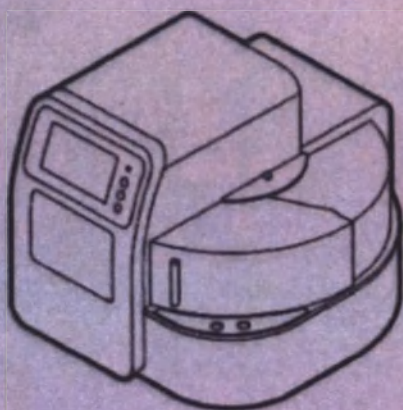

«УТВЕРЖДАЮ» / «APPROVE»

Генеральный директор / CEO
(должность/position)

~~杭州奥盛仪器有限公司~~ Liao Zhiheng
HANGZHOU ALLSHENG INSTRUMENTS CO., LTD

(подпись/signature)

路志恒 Stamp

ALLSHENG

Производитель:

Ханчжоу Аошэнг Инструментс Ко., Лтд.
Здание 9 № 7 Чжуантана,
научно - техническая экономическая зона,
район Сиху, город Ханчжоу, Чжэцзян, Китай

Hangzhou Allsheng Instruments Co., Ltd.
Building 9 №7 of Zhuantang,
Science and Technology Economic Zone,
Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang, China

Уполномоченный представитель (Дистрибьютор) компании в Российской Федерации:

ООО «Компания Хеликон»
119619 Москва, Новомещерский проезд,
дом №9, стр. 1, комн. 11

Для обращения на территории РФ



HANGZHOU ALLSHENG INSTRUMENTS CO., LTD.

Руководство по быстрому запуску

Система для автоматического выделения и очистки нуклеиновых кислот из биологических образцов человека Auto-Pure 96

- ◆ Данное руководство не может быть использовано вместо руководства по эксплуатации. Перед использованием необходимо изучить руководство по эксплуатации.
- ◆ Удостоверьтесь в том, что соблюдены требования по электрическим характеристикам.

1. Распаковка


- ① Освободите устройство от транспортной упаковки и уберите ленту с прозрачного окна.



- ② Откройте прозрачное окно, чтобы убрать красный стопорный винт.



- ③ Откройте дверцу камеры и с помощью ножниц перережьте стяжку на перегородке.

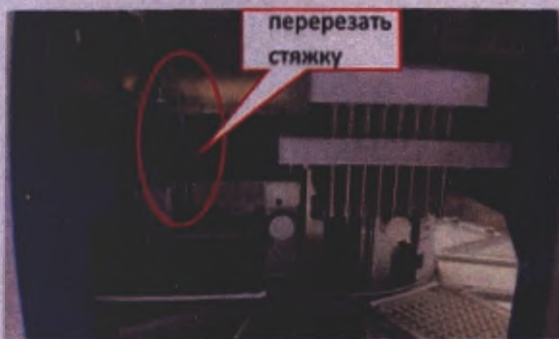

Внимание: Будьте осторожны в процессе работы, в противном случае магнитный стержень может быть поврежден.



HANGZHOU ALLSHENG INSTRUMENTS CO., LTD.

2. Подключение питания

Подключите один конец шнура питания к розетке на задней панели прибора, а другой - к розетке переменного тока (AC 100-240 В), затем включите выключатель питания.

3. Установка гребенки наконечников магнитных стержней и планшетов для реагентов

Откройте прозрачную крышку и поместите планшет с магнитным наконечником стержня на поворотную платформу. Устройство автоматически установит наконечник магнитного стержня после запуска программы. (Процедурный шаг "Load" - это установка наконечников для магнитных стержней. Шаг "Unload" - это сбрасывание наконечников для магнитных стержней)



① Установка гребенки наконечников для магнитов.

Гребенка наконечника магнитного стержня должна быть расположена ровно, как показано на рисунке ниже, иначе это может привести к невозможности автоматической установки и повреждению прибора.



② Установка планшетов.

Во-первых, поместите край планшета на дно отсека. Во-вторых, надавите сверху на другой край планшета, чтобы закрепить его в отсеке, как показано на рисунке ниже. Убедитесь, что дно планшета установлено ровно и находится в нужном месте, иначе это приведет к ошибке работы устройства.



4. Эксплуатация

Что касается деталей работы, настройки и эксплуатации, пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации.

Performance Test Statement

Name	Nucleic Acid Purification System		Type	☐ Auto-Pure 24 ☐ Auto-Pure 48 ☒ Auto-Pure 96	
Test Date	28th. Sep. 2020		Production NO.	188-16168-20090005	

No.	Test Content	Test Methods	Standard	Test Results	Conclusion
1	Temp. Accuracy	Thermistor	100±1℃	100.3℃	☒ Qualified
2	Heating time	Stopwatch	≤7min	5' 20"	☒ Qualified
3	Stability	Reagent	≤4%	2.99%	☒ Qualified
4	DNA efficiency Collection	Reagent	≥80%	89.3%	☒ Qualified
5	Basic function	Operation	Valid	ok	☒ Qualified
6	Security	Safety tester	Ground resistance: ≤100mΩ Leakage current: ≤0.8mA High-voltage: 1500V	ok	☒ Qualified
7	Appearance	Visualization	Valid	ok	☒ Qualified
8	Outer Marks	Visualization	Valid	ok	☒ Qualified

Test Results	
Remark:	
Tested by:	Confirmed by:
	





Внутренний шестигранный ключ 1,5 мм



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 24 листов
Генеральный директор
ООО «Компания Хеликон»

В.А. Кириллов

