



ПОДТВЕРЖДАЮ

Руководитель группы регистрации

Горшкова Н.А.

«30» марта 2021 г.

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов для определения гликозилированного гемоглобина (HbA1c) на биохимических анализаторах серии Dimension® (Dimension® A1C kit)

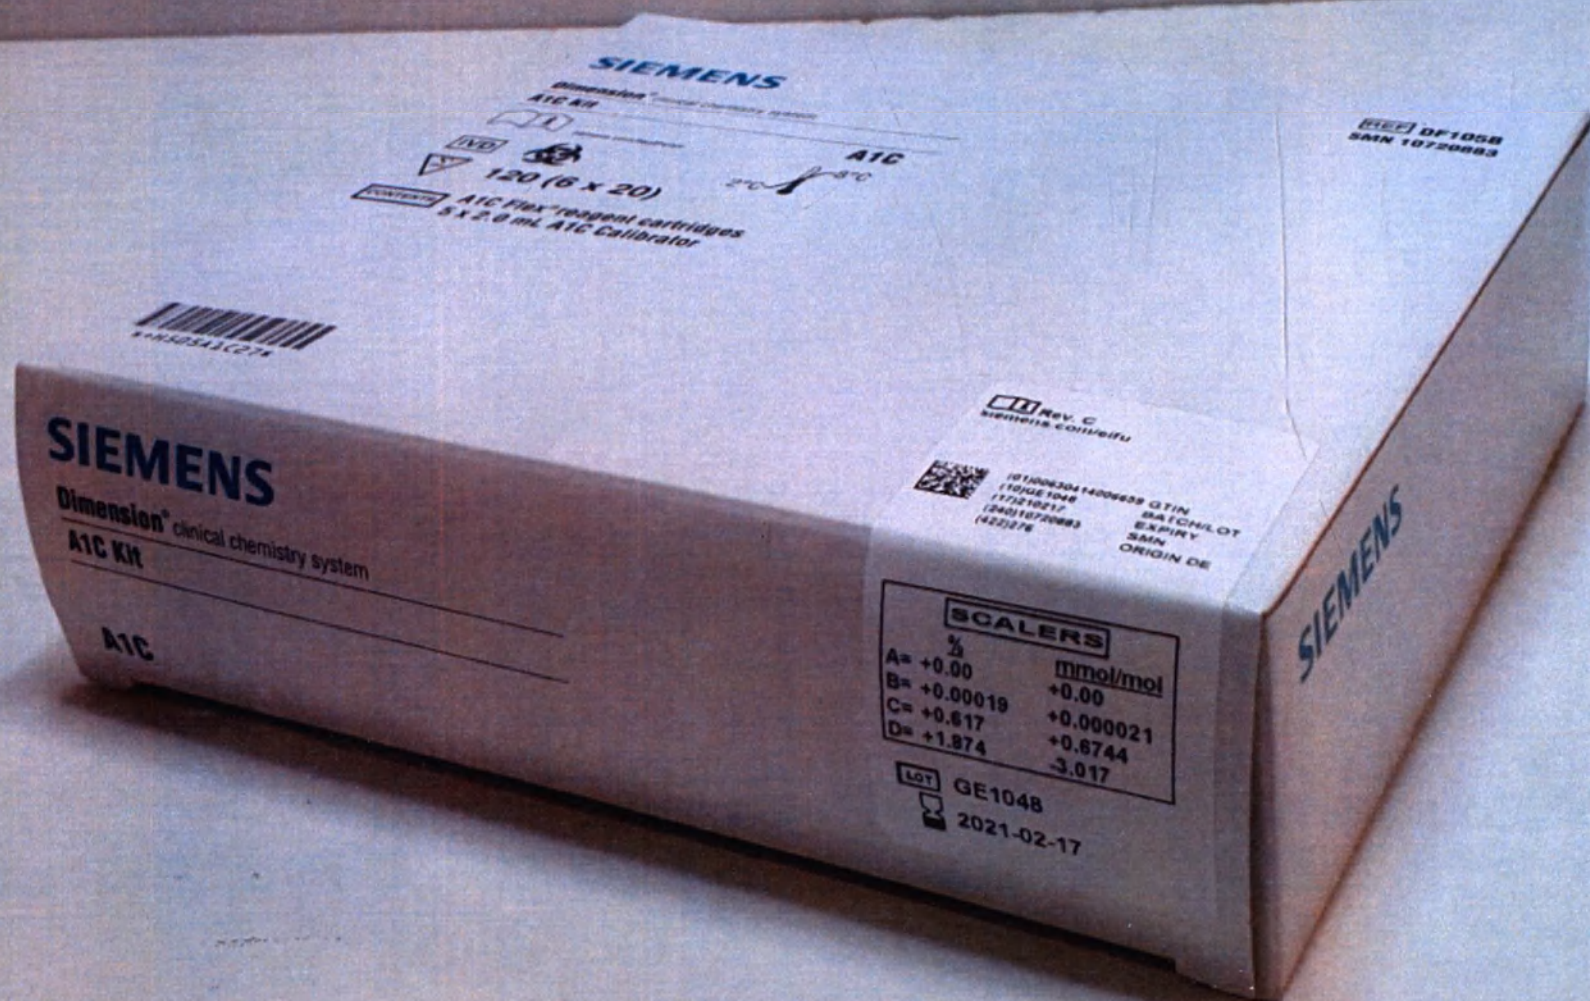


Рисунок 1. Набор реагентов для определения гликозилированного гемоглобина (HbA1c) на биохимических анализаторах серии Dimension® (Dimension® A1C kit): упаковка изделия

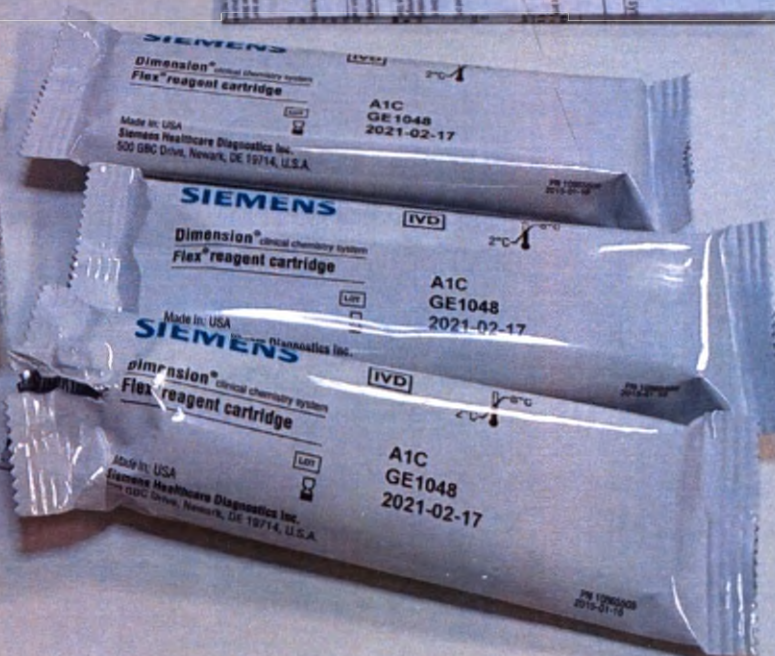


Рисунок 2. Набор реагентов для определения гликозилированного гемоглобина (HbA1c) на биохимических анализаторах серии Dimension® (Dimension® A1C kit): общий вид изделия

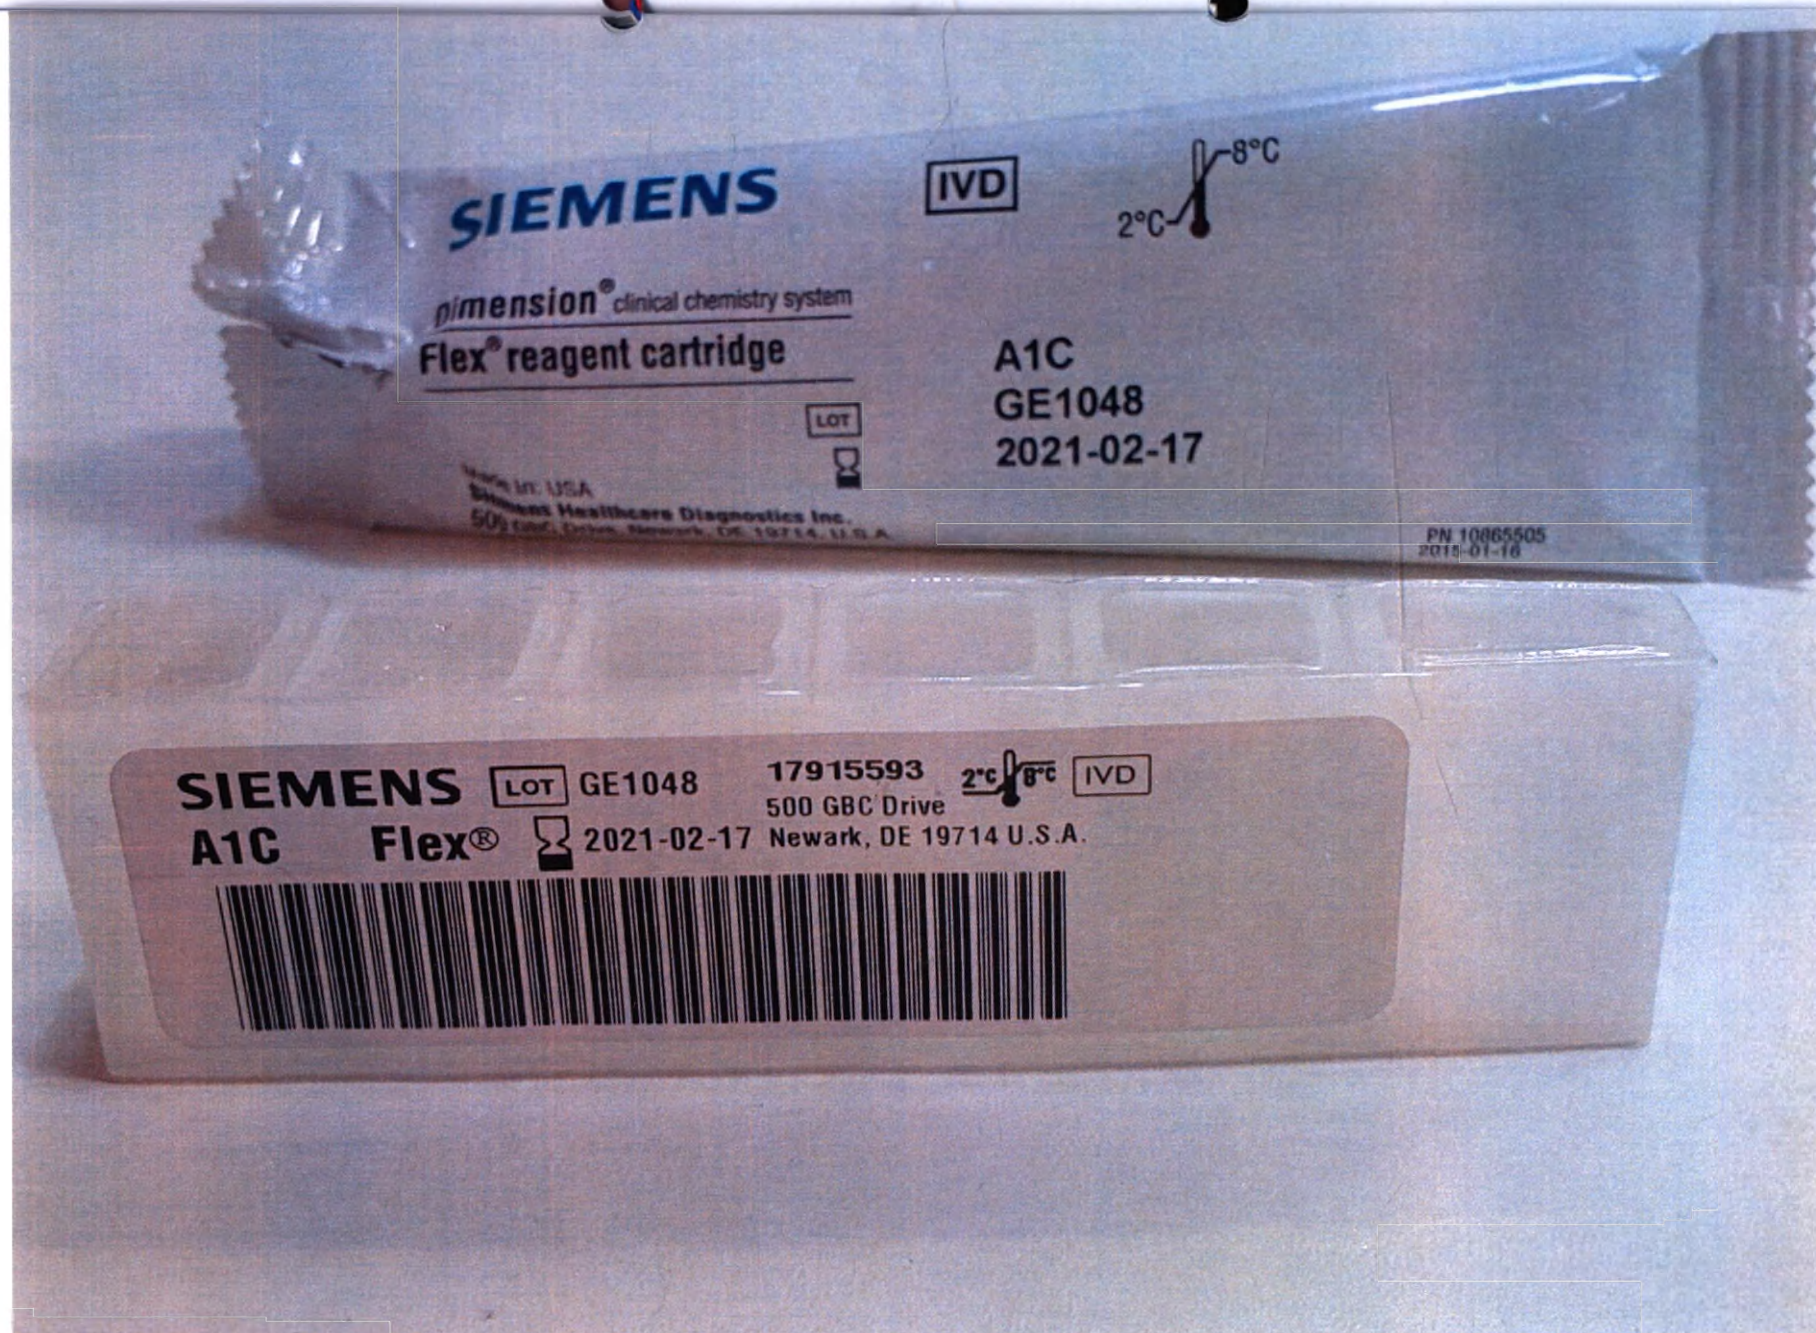


Рисунок 3. Набор реагентов для определения гликозилированного гемоглобина (HbA1c) на биохимических анализаторах серии Dimension® (Dimension® A1C kit): Картридж с реагентами Dimension® A1C Flex reagent cartridge



Рисунок 4 Набор реагентов для определения гликозилированного гемоглобина (HbA1c) на биохимических анализаторах серии Dimension® (Dimension® A1C kit): Калибраторы гликозилированного гемоглобина Dimension® A1C Calibrator: (флаконы слева направо) – Калибратор уровня 1 Dimension® A1C Calibrator 1, 2,0 мл – 1 флакон; – Калибратор уровня 2 Dimension® A1C Calibrator 2, 2,0 мл – 1 флакон; – Калибратор уровня 3 Dimension® A1C Calibrator 3, 2,0 мл – 1 флакон; – Калибратор уровня 4 Dimension® A1C Calibrator 4, 2,0 мл – 1 флакон; – Калибратор уровня 5 Dimension® A1C Calibrator 5, 2,0 мл – 1 флакон.

Всего прошито и пронумеровано
5 листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»

