

Раздел 2. Фотографии анализатора и принадлежностей.
Фото 2-1. Комплект поставки анализатора.





Фото 2-2. Анализатор. Общий вид.

Фото 2-3. Анализатор. Вид сзади.



Фото 2-4. Адаптер сетевой (AC adapter), в комплекте.



Фото 2-5. Адаптер сетевой (AC adapter).



Фото 2-6. Кабель адаптера (Adapter cord).

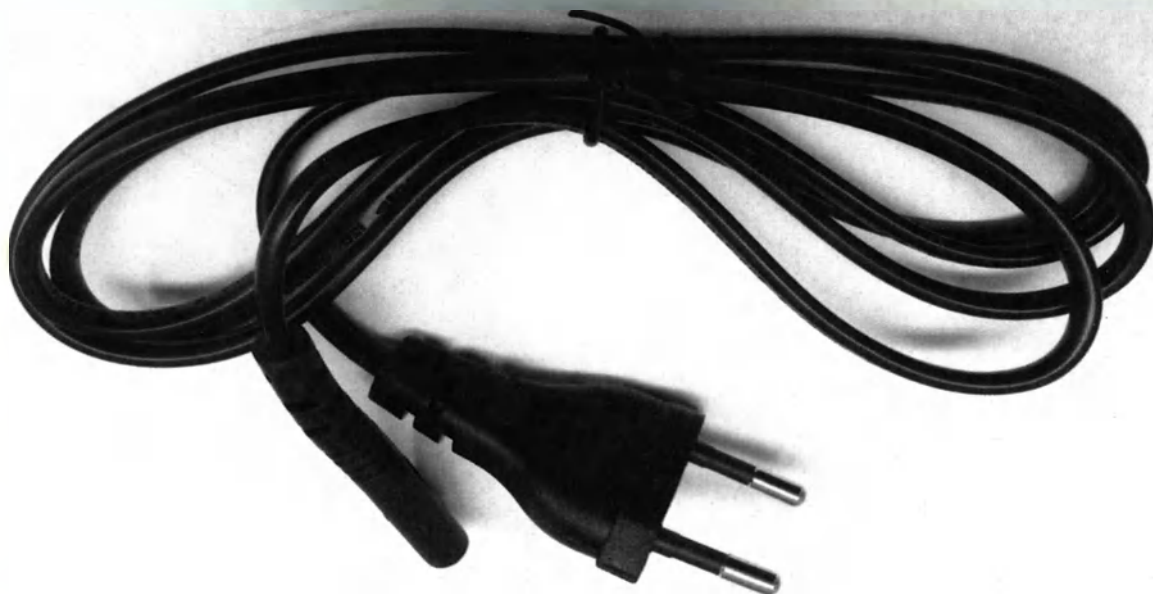


Фото 2-7. Держатель кассет (Device holder).

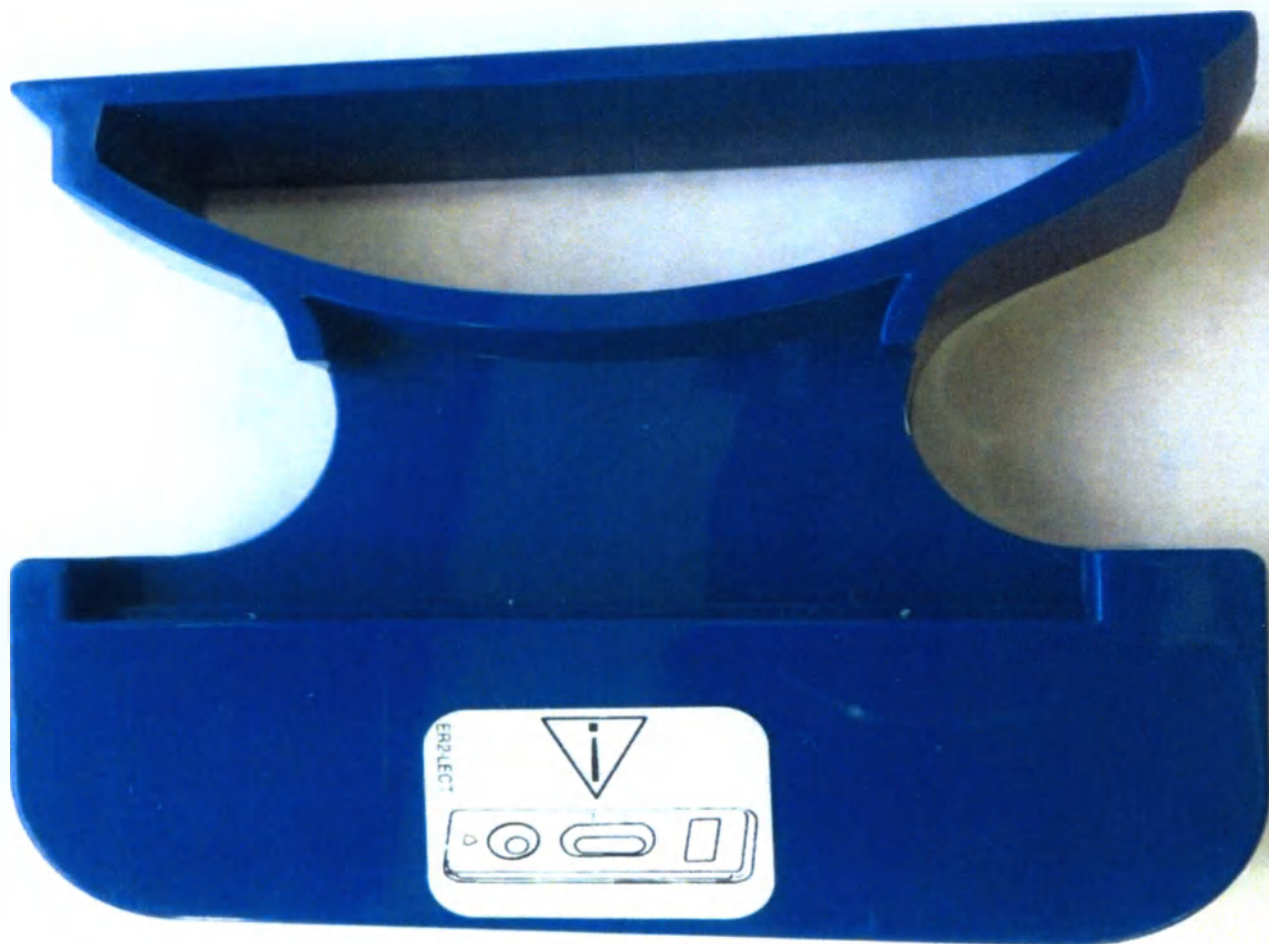


Фото 2-8. Термобумага (Thermal paper roll).



Фото 2-9. Калибровочная кассета (Calibration device).




Фото 2-10. Бланк-кассета (Blank device).



Фото 2-11. Руководство пользователя на компакт-диске (CD Operator's manual).



Фото 2-12. Руководство пользователя краткое (Quick start guide).

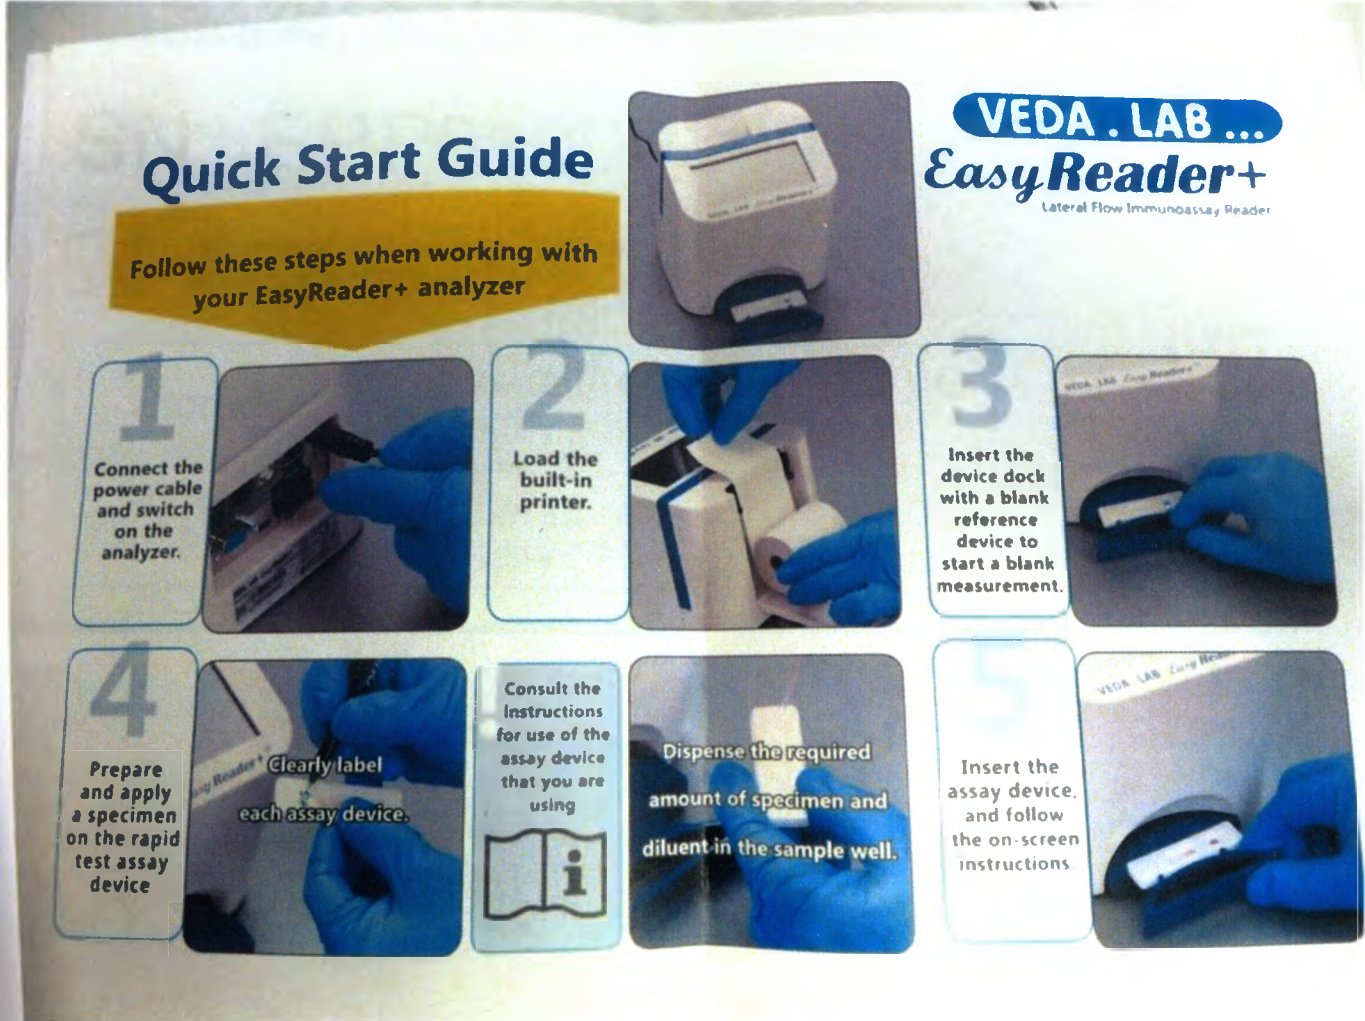

Раздел 3. Фотографии этикеток.
Фото 3-1. Заводской шильдик анализатора.

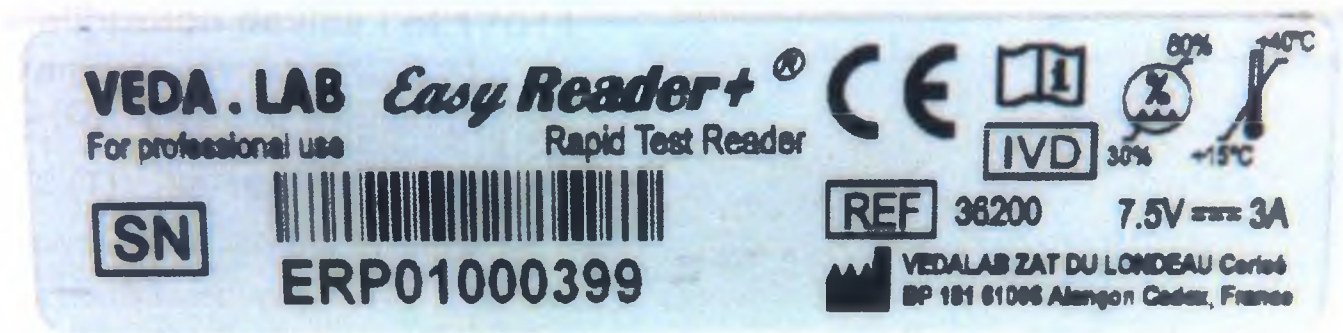


Фото 3-2. Этикетка на внешней упаковке комплекта поставки анализатора.

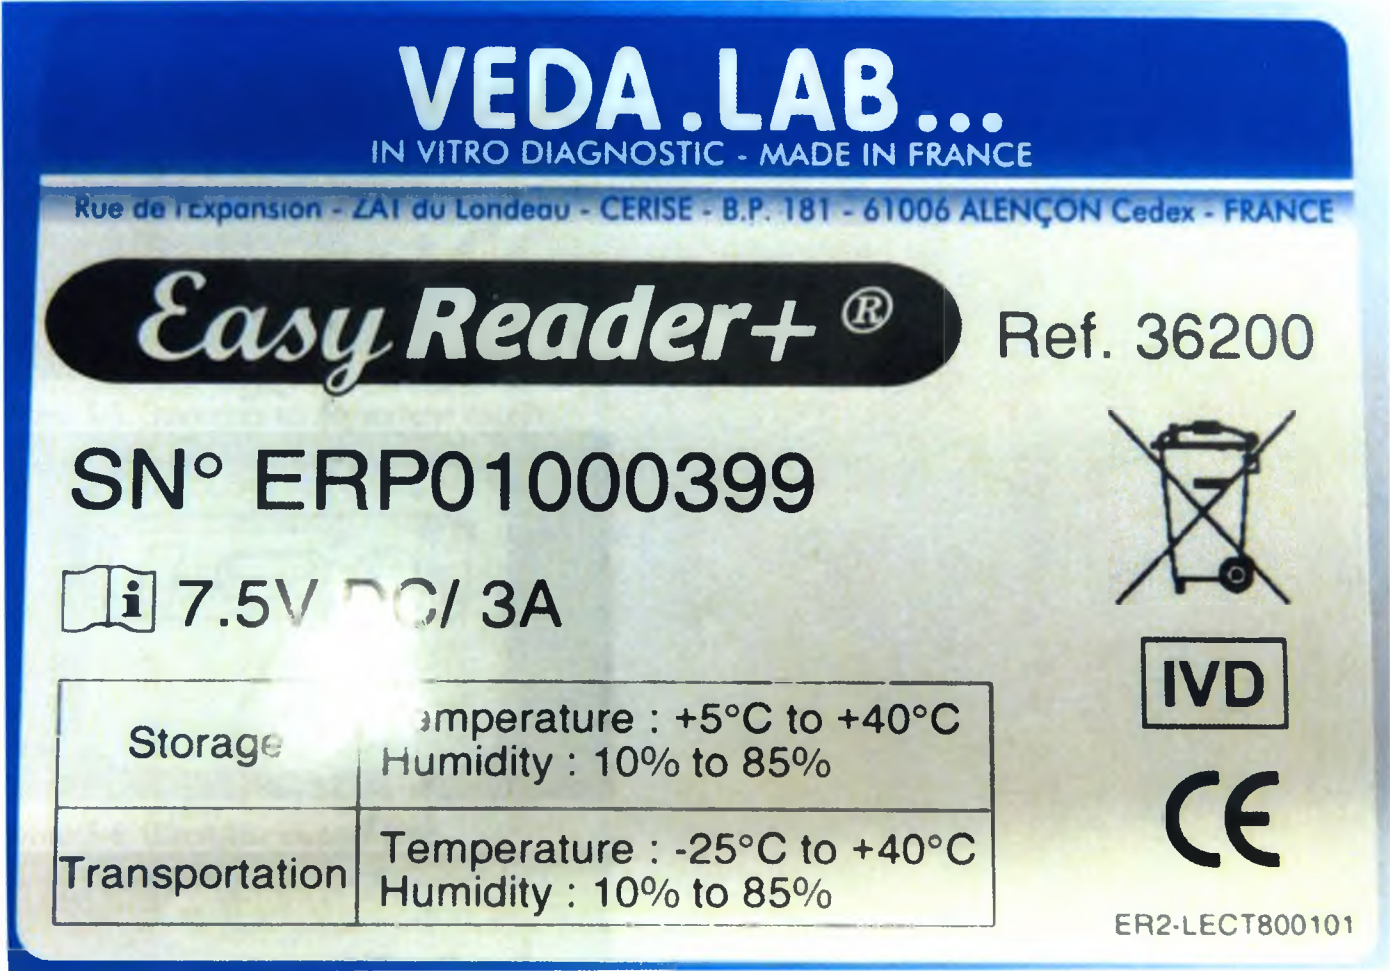


Фото 3-3. Заводская этикетка упаковки калибровочной кассеты.



Фото 3-4. Заводская этикетка упаковки бланк-кассеты.



Фото 3-5. Этикетка на держателе кассет.

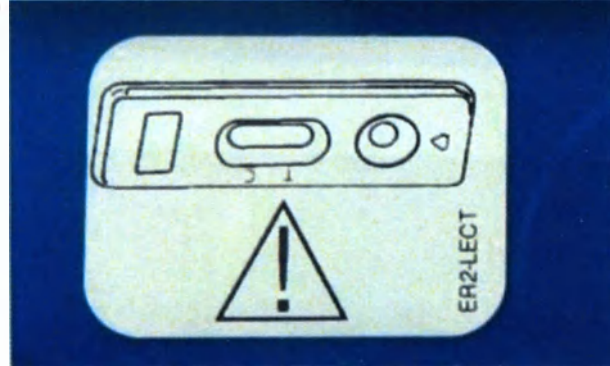


Фото 3-6. Шильдик на адаптере.



Раздел 4. Фотографии и маркировка упаковки.

Фото 4-1. Упаковочная коробка с этикеткой. Вид сверху.



Фото 4-2. Упаковочная коробка. Вид изнутри.



Фото 4-3. Упаковочная коробка адаптера.


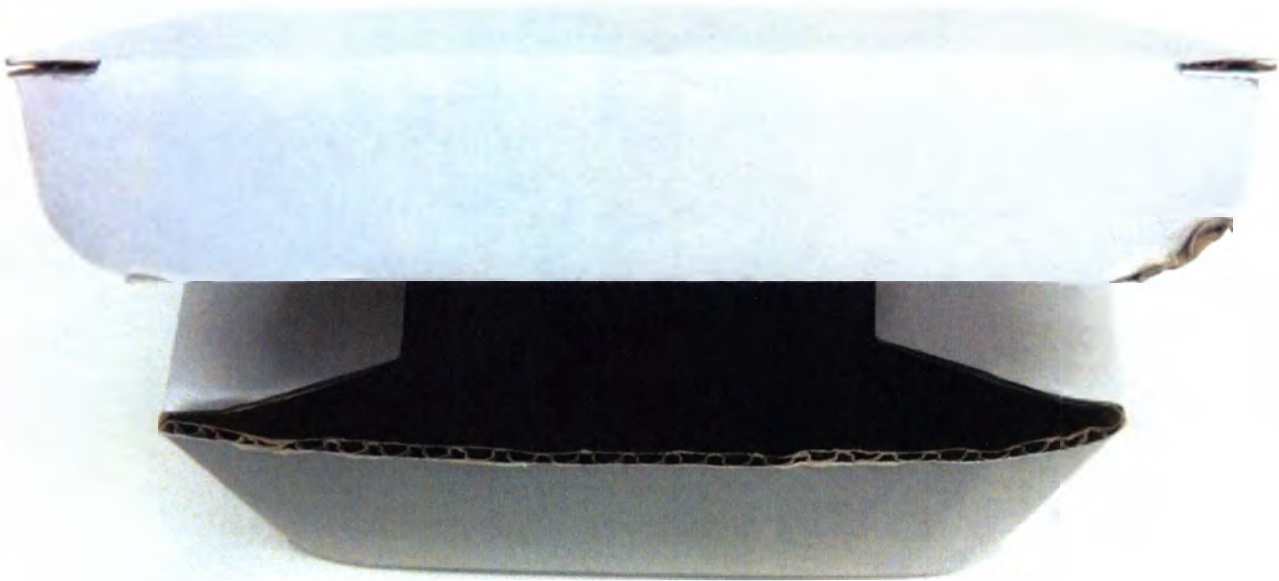


Фото 4-4. Маркировка для перевозчиков на упаковочной коробке (боковая поверхность).



В настоящем документе пронумеровано,
прошито и скреплено печатью
15 (пятнадцать) листов
Генеральный директор
АО «ДИАКОН» Карпова И.Е.

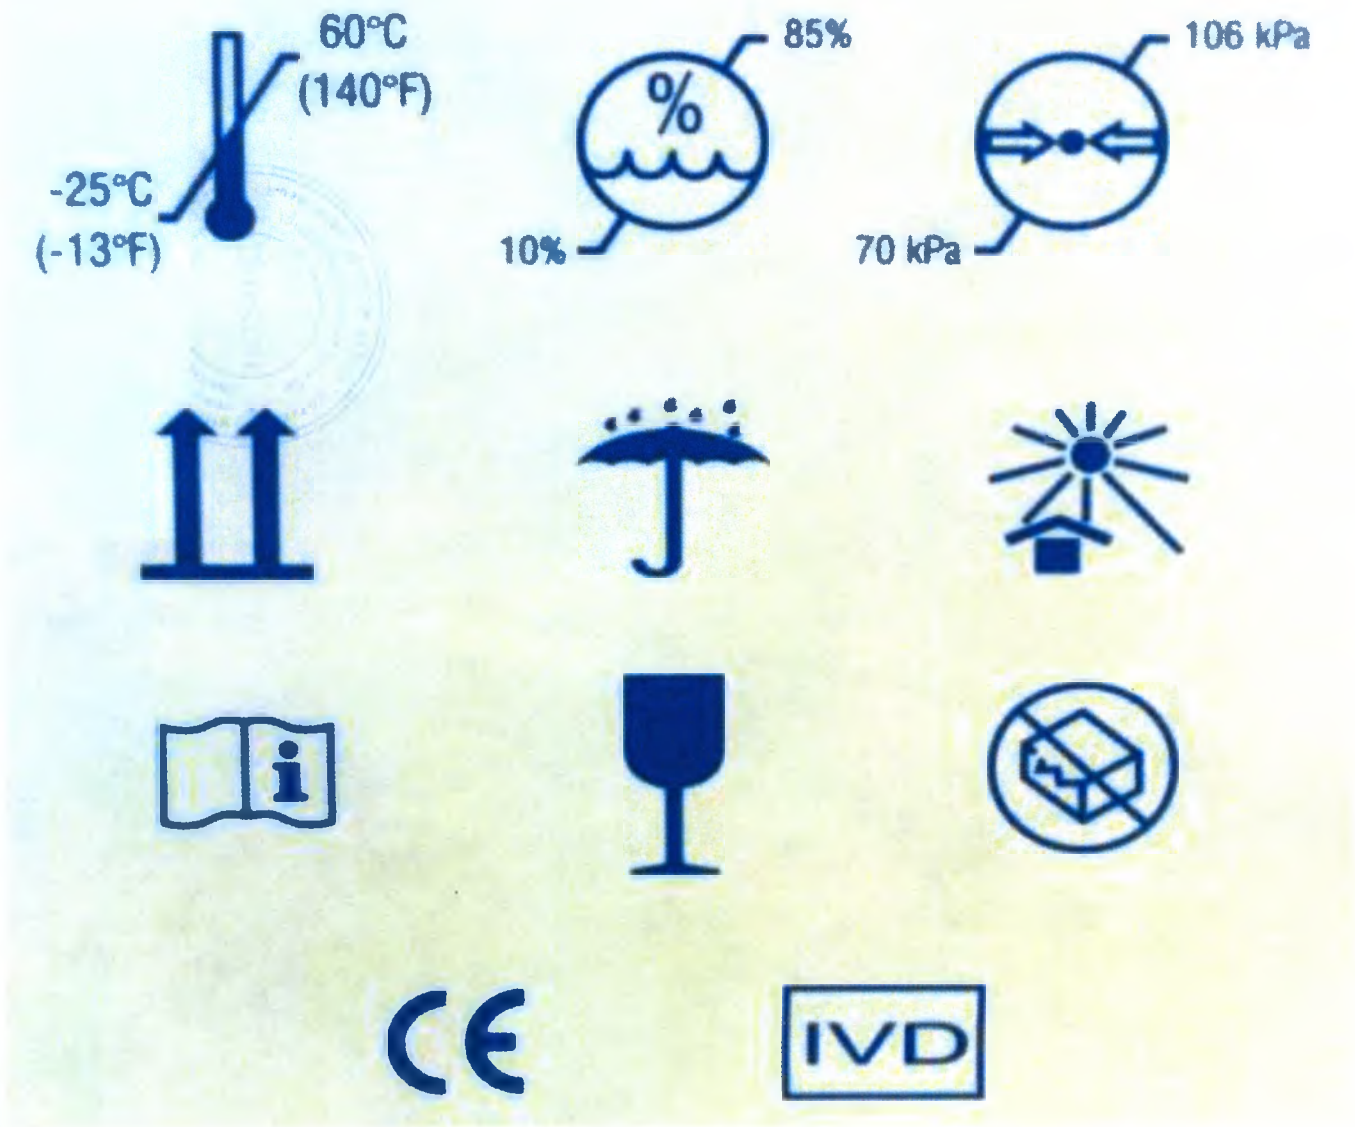