

Общество с ограниченной ответственностью КАРЛ ШТОРЦ – Эндоскопы ВОСТОК (ООО КШТЭ ВОСТОК)
Россия, 115114, Москва, Дербеневская наб. 7, стр. 4

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Видеоцистoureтроскоп гибкий HD-VIEW в вариантах исполнения

Генеральный директор
ООО КШТЭ ВОСТОК


Мартин Пьер Колас

М.П.



Видеоцистоуретроскоп гибкий HD-VIEW в вариантах исполнения: Вариант исполнения 1. Видеоцистоуретроскоп HD-VIEW в составе:

1. Видеоцистоуретроскоп гибкий HD-VIEW (Набор 11272 VHK):

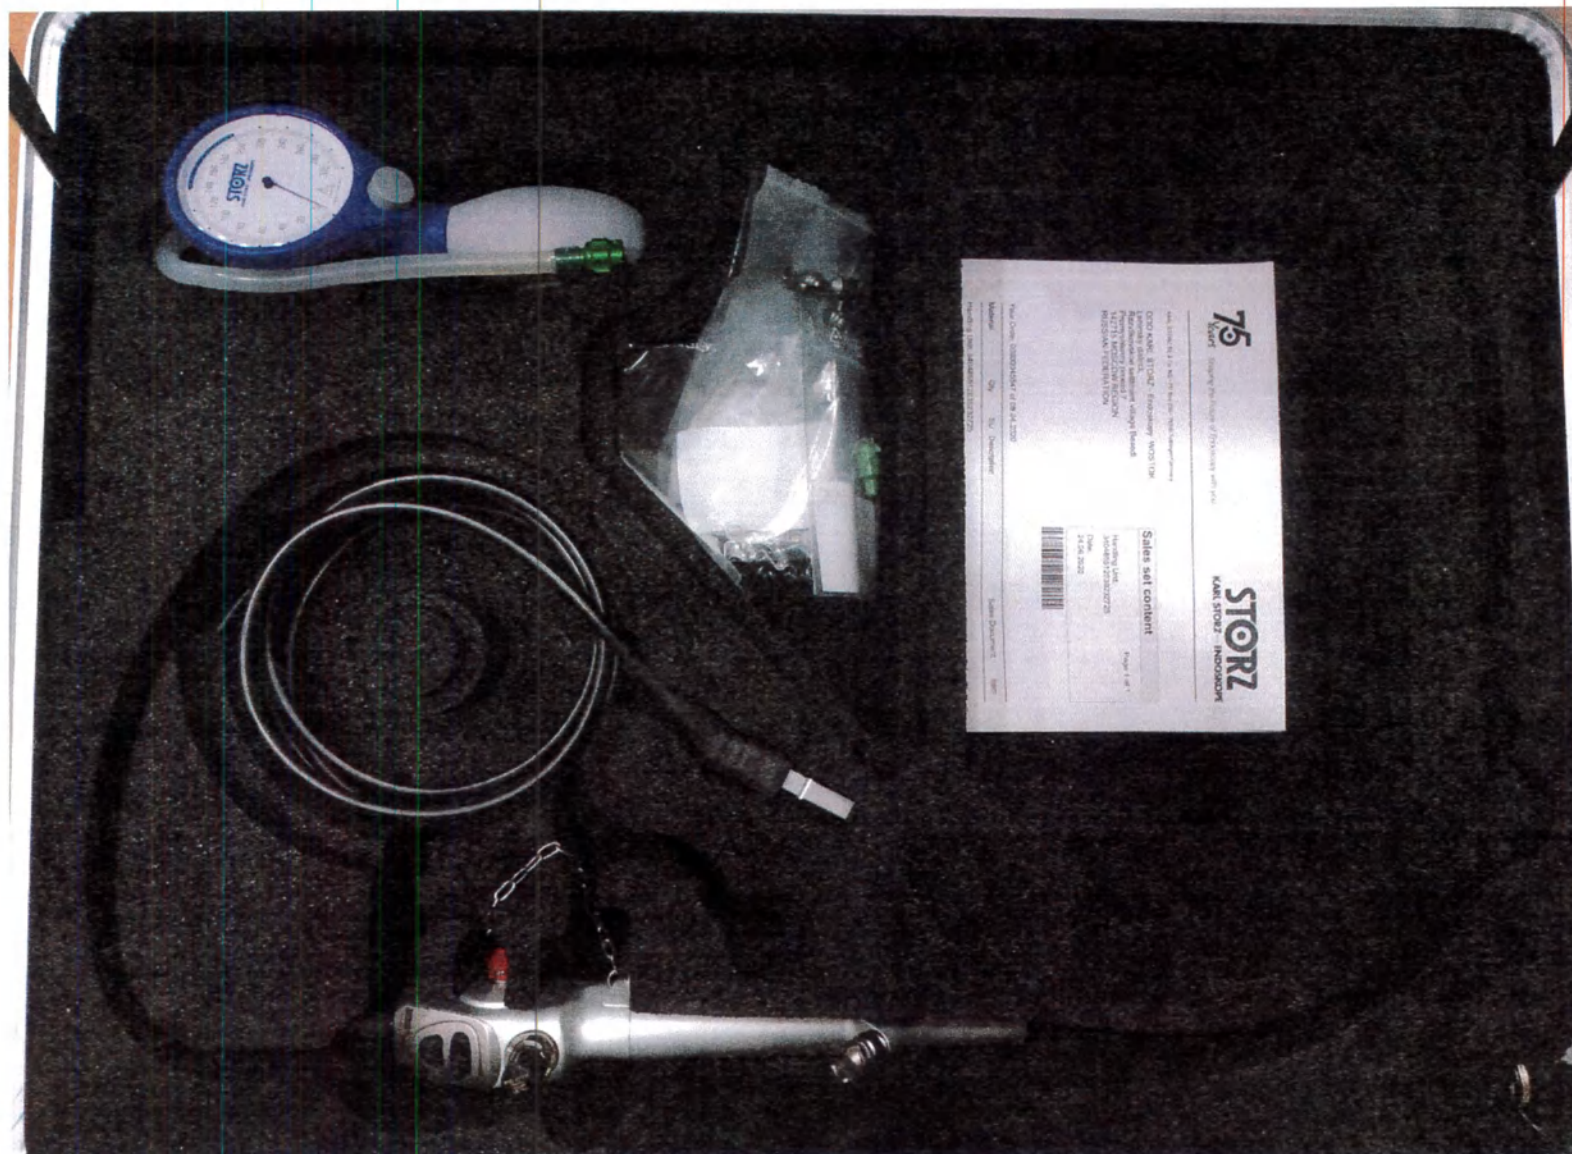

1.1. Видеоцистоскоп гибкий HD-VIEW - 1 шт.



1.1. Видеоцистоуретроскоп гибкий HD-VIEW - 1 шт. (маркировка)



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany


STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

REF 11272VH

Flexibles Video-Cystoskop HD-VIEW
Flexible Video Cystoscope HD-VIEW
Cystoscope vidéo flexible HD-VIEW
Video-cistoscopio flessibile HD-VIEW
Videocistoscopio flexible HD-VIEW
Videocistoscópio HD flexível HD-VIEW

SN 67166

QTY 1

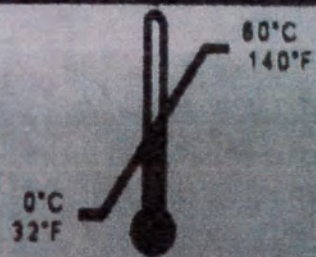

0°C
32°F

80°C
140°F





RxONLY

CE 0123

(01)04048551423226(240)11272VH(21)67166

1.2. Переходник LUER с кранами– 1 шт.



1.2. Переходник LUER с кранами– 1 шт.



1.2. Переходник LUER с кранами– 1 шт. (маркировка)



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE

REF 11014L

LOT PP03
QTY 1



LUER-Einlauf mit Hähnen
LUER Port with Stopcocks
Raccord LUER avec robinets
Attacco LUER con rubinetti
Conexión LUER con llaves de paso
Conexão LUER com torneiras



RxONLY


CE 0123

(01)040485514226*8(240)11014L(10)PP03

1.3. Адаптер для чистки рабочего канала – 1 шт.



1.3. Адаптер для чистки рабочего канала – 1 шт.

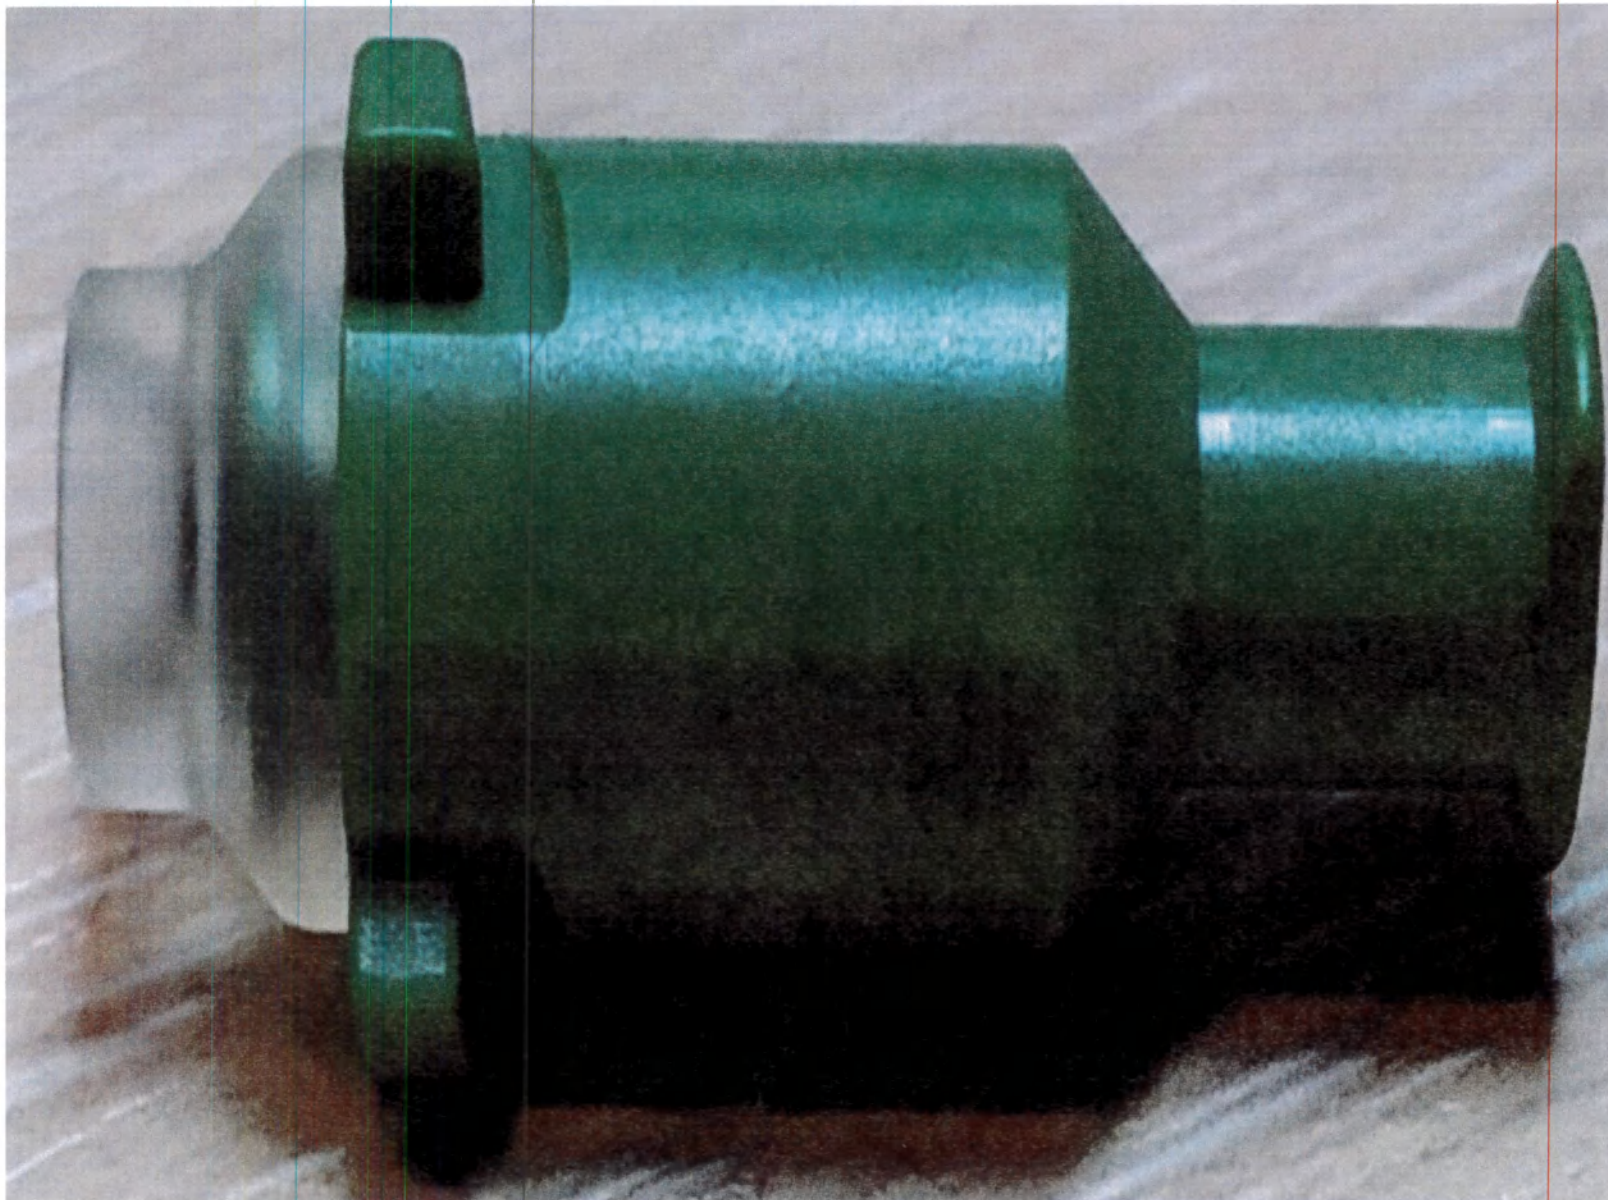

1.3. Адаптер для чистки рабочего канала – 1 шт. (маркировка)



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

REF 11014RA

LOT OP01

QTY 1

Reinigungsadapter für Arbeitskanal

Cleaning Adaptor for Working Channel

Adaptateur nettoyage canal opérateur

Adattatore di pulizia per canale op.

Adaptador de limpieza, canal de trabajo

Adaptador de limpeza p/ canal de trab.




RxONLY




(01)04048551423240(240)11014RA(10)OP01

1.4. Уплотнитель для рабочего канала коннектора – 10 шт./уп

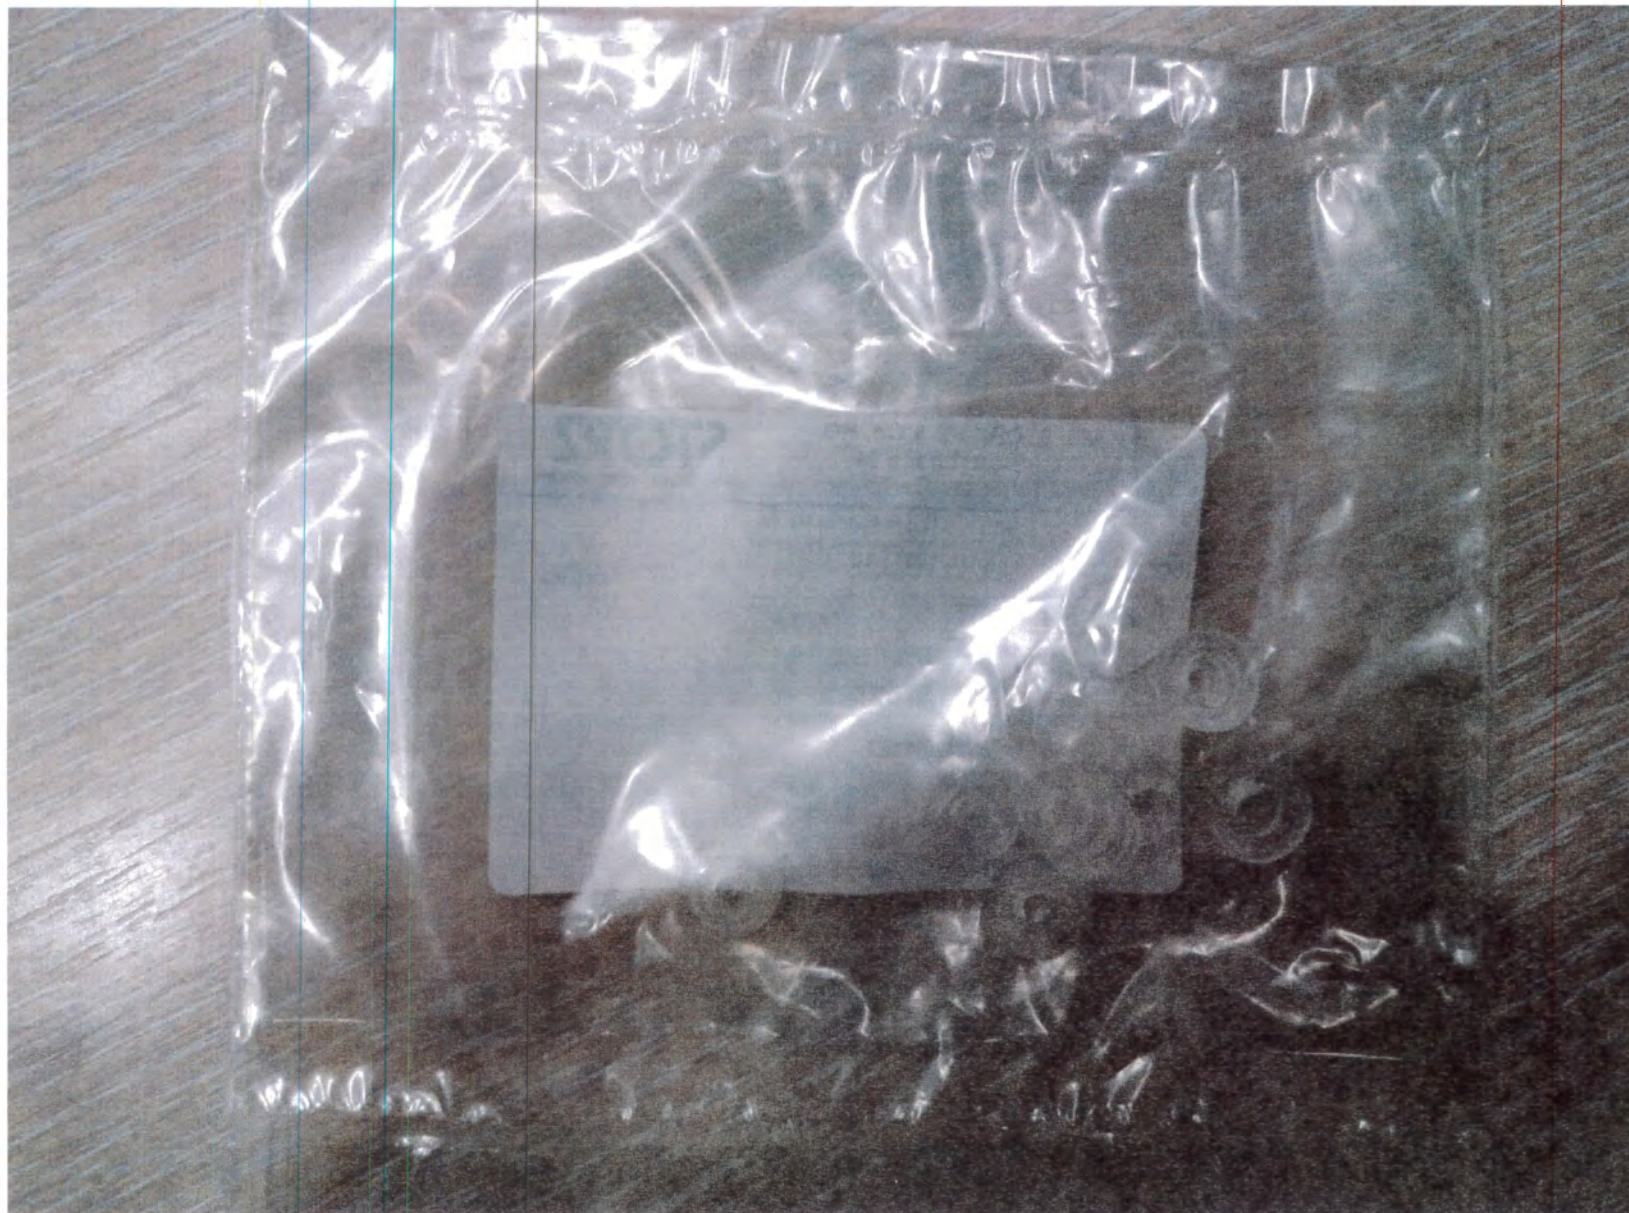

1.4. Уплотнитель для рабочего канала коннектора – 10 шт./уп

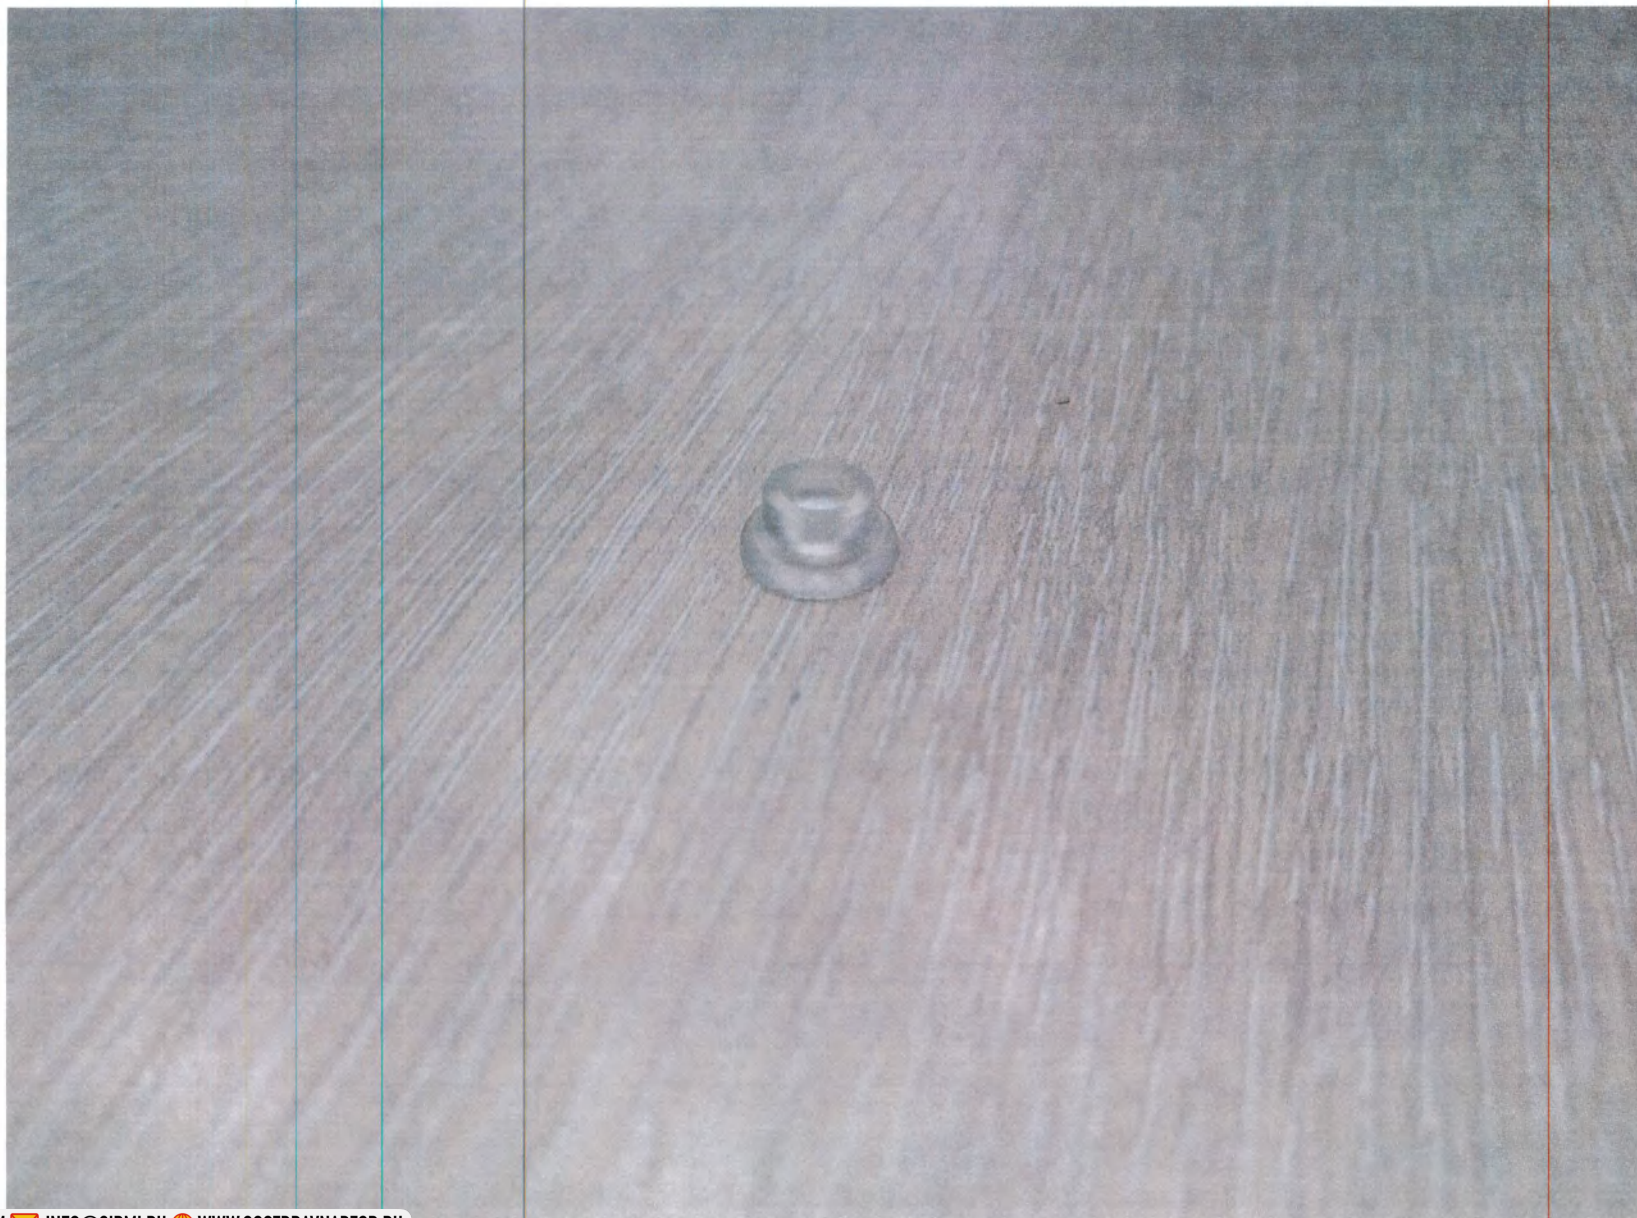

1.4. Уплотнитель для рабочего канала коннектора – 10 шт./уп. (маркировка)

 **KARL STORZ SE & Co. KG**
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ ENDOSCOPE

REF 11014DS

LOT 98883+99164

QTY 10

Dichtung Arbeitskanal Konnektor
Seal Working Channel Connector
Joint pour raccord au canal opérateur
Guarnizione canale operativo, connettore
Junta para canal de trabajo, conector
Vedação p/ conector de canal de trabalho




(01)04048551423202(240)11014DS(10)98883+99164

1.5. Адаптер для чистки – 1 шт.



1.5. Адаптер для чистки – 1 шт.

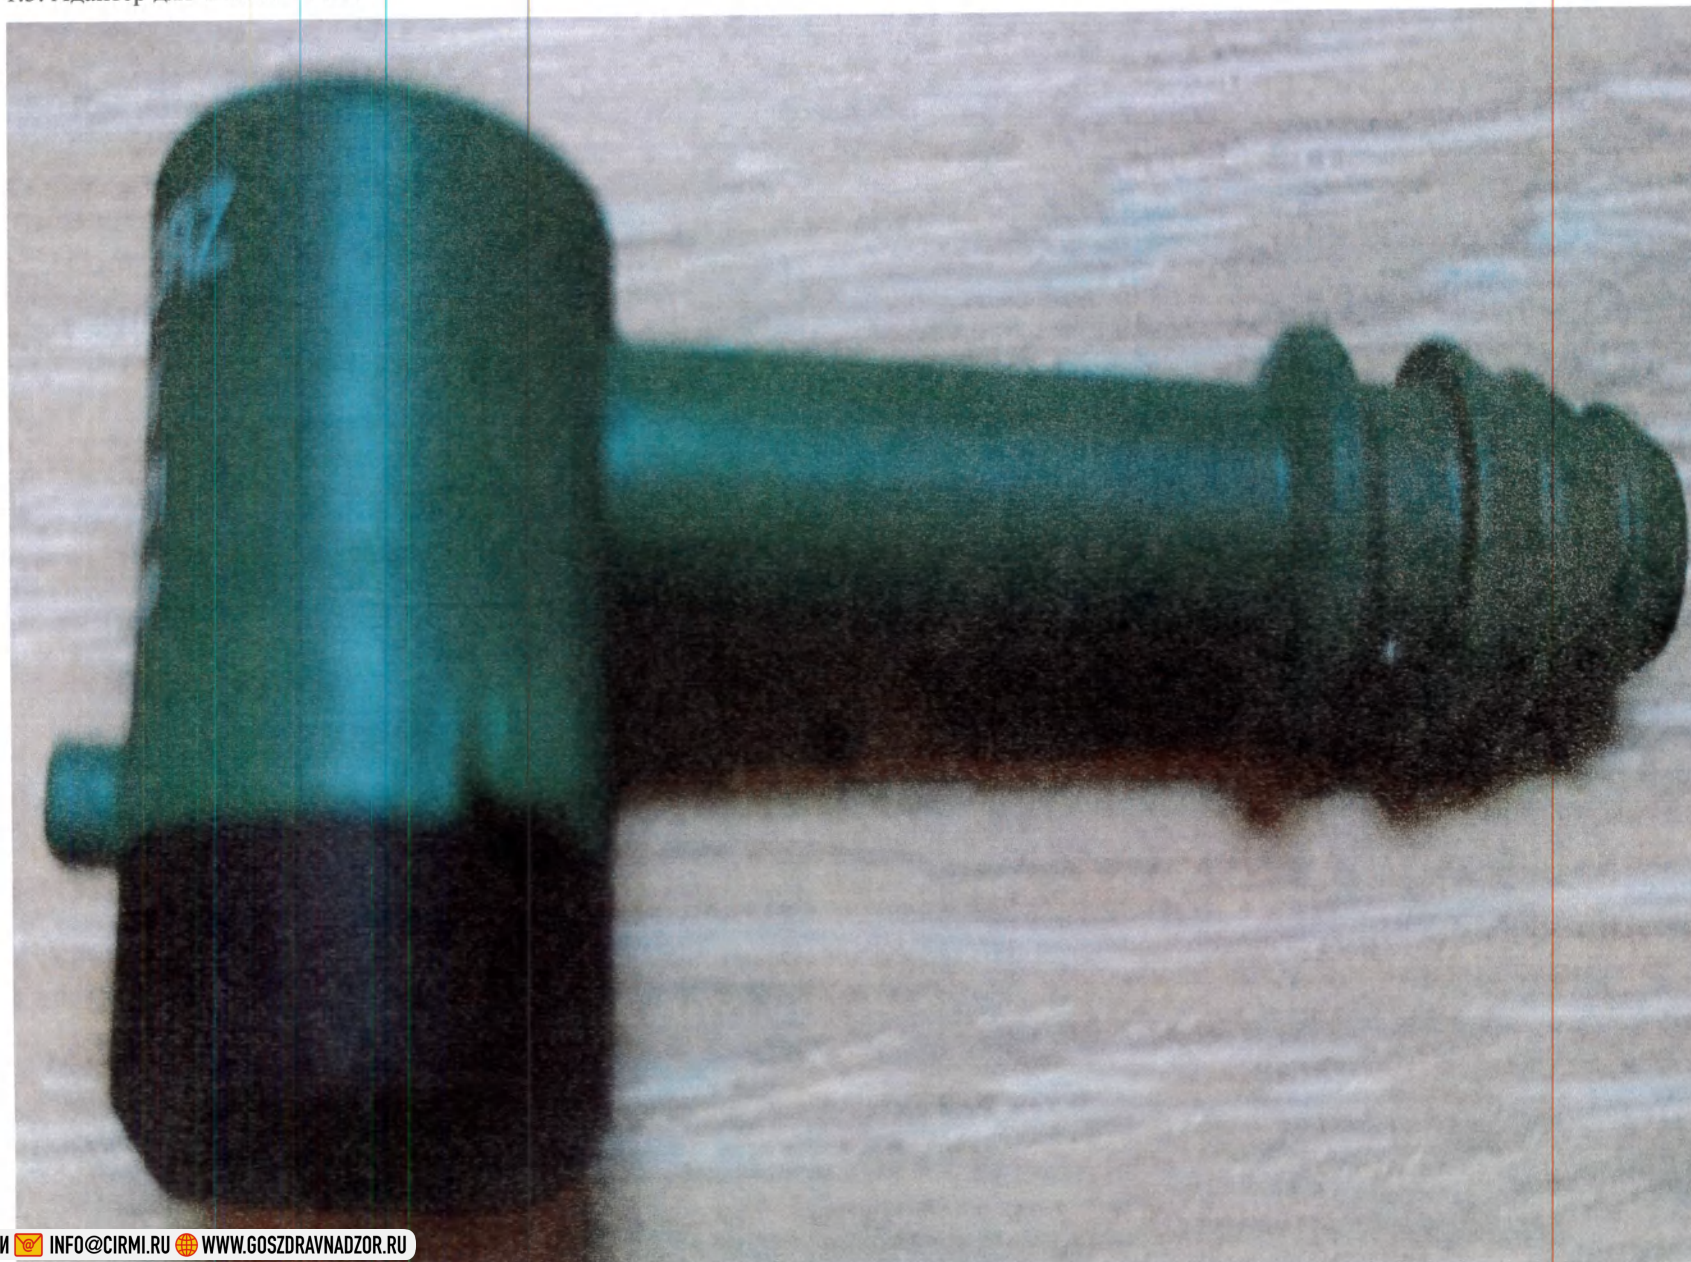

1.5. Адаптер для чистки – 1 шт. (маркировка)



1.6. Чемодан жесткий для видеоэндоскопа – 1 шт.



1.7. Прибор проверки герметичности– 1 шт.




1.8. Клапан выравнивания давления— 1 шт.



Druckausgleich-Kappe 11025 E


Anbringen vor

1. Gas-/Plasma Sterilisation
2. Entlüftung
3. Versand

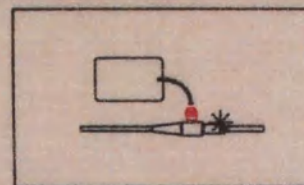

Entfernen vor

1. Gebrauch am Patienten
2. Einlegen in Reinigungslösung

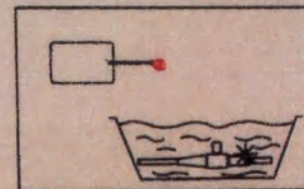

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPIE

1.9. Уплотнитель для седла аспирационного клапана – 1 шт.



1.10. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.



2. Видеоцистоуретроскоп гибкий HD- VIEW 11272 VH (при необходимости) – не более 5 шт.



3. Щипцы захватывающие (при необходимости) – не более 100 шт.



3. Щипцы захватывающие (при необходимости) – не более 100 шт. (маркировка)



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE

REF 27023FE

LOT PP02
QTY 1

Fasszange, 5 Charr., 73 cm

Grasping Forceps, 5 Fr., 73 cm

Pince à préhension, 5 Charr., 73 cm


Pinza da presa, 5 Charr., 73 cm

Pinzas de agarre, 5 Charr., 73 cm

Pinça de apreensão, 5 Fr., 73 cm




(01)04048551073667(240)27023FE(10)PP02



CE

4. Щипцы биопсийные (при необходимости) – не более 100 шт.

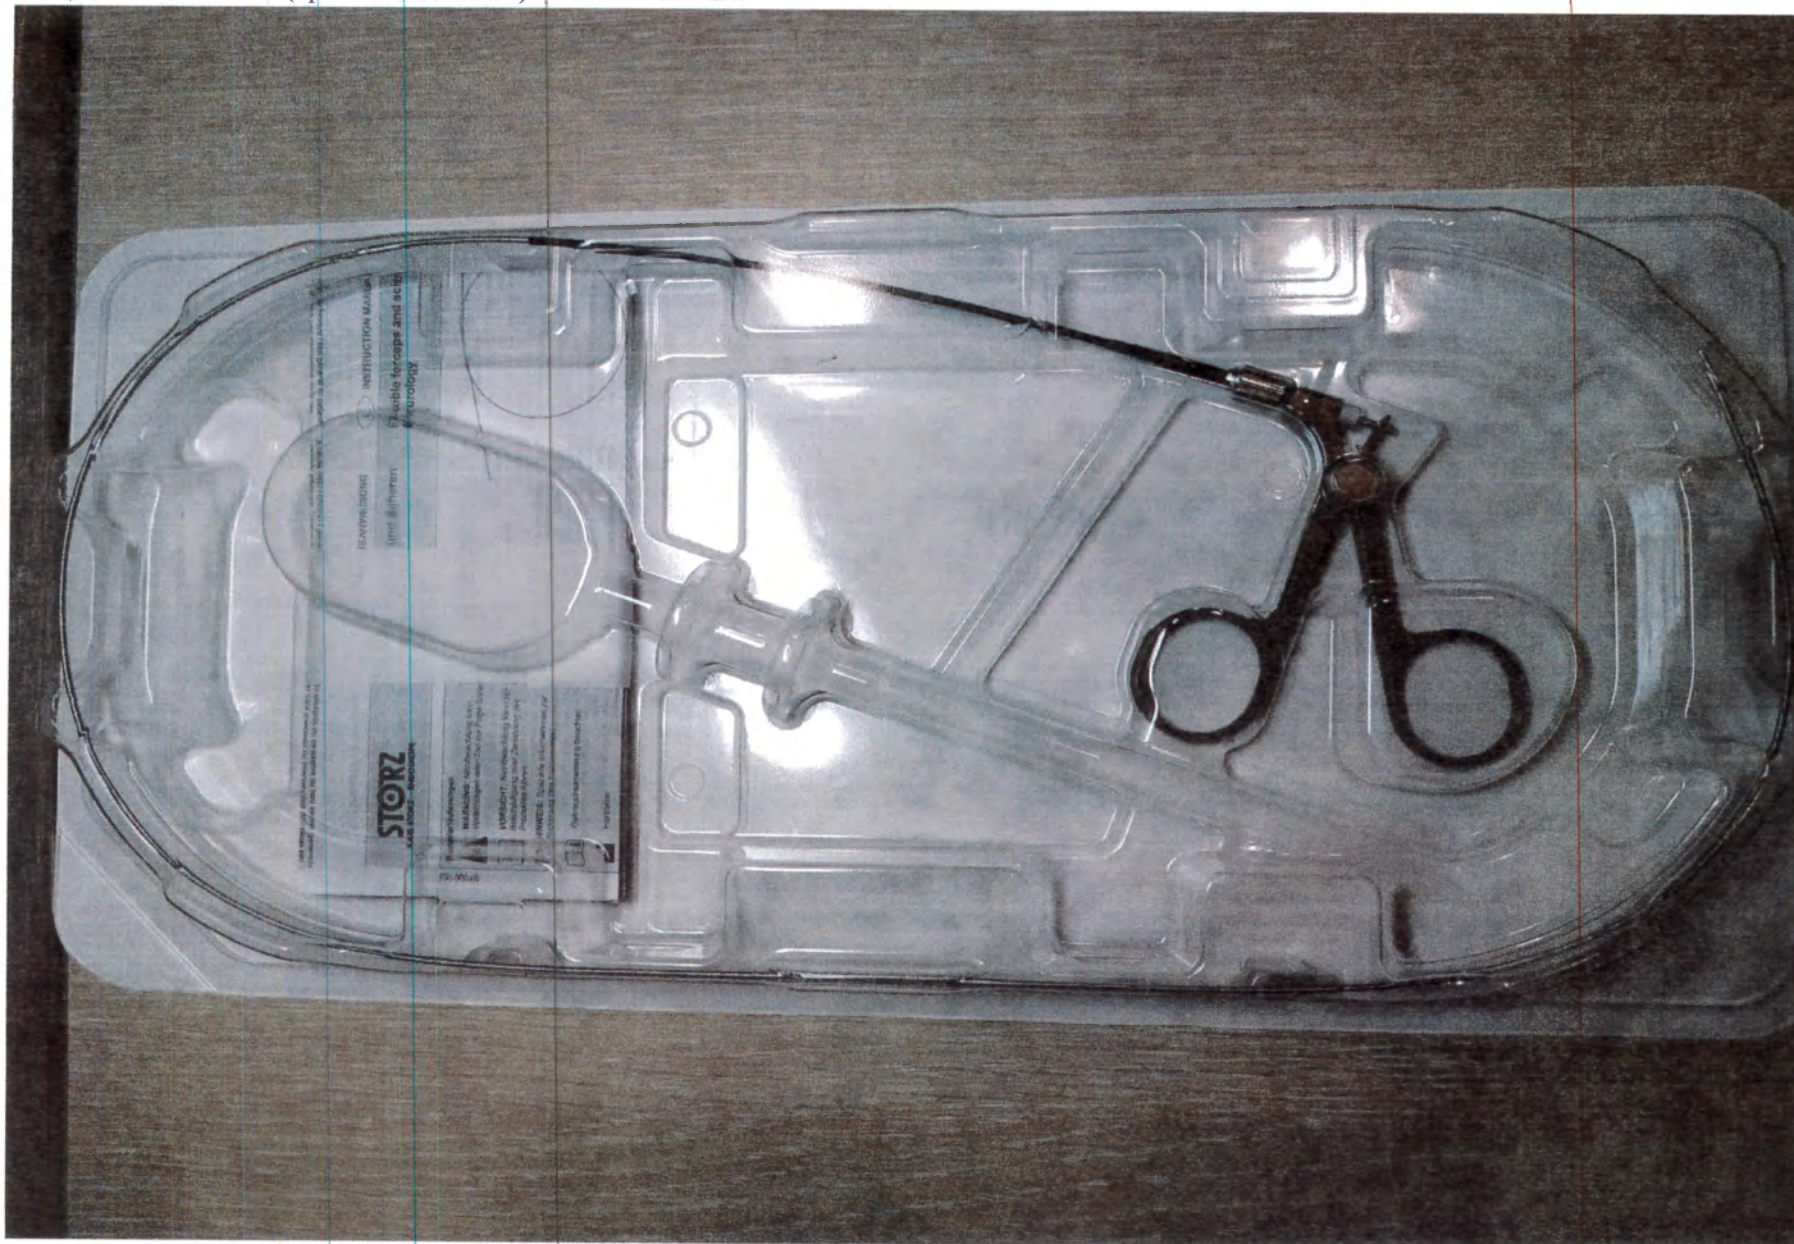

4. Щипцы биопсийные (при необходимости) – не более 100 шт. (маркировка)



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

REF 27023ZE	LOT OP02
	QTY 1

Zange z. Probeexcision, 5 Charr., 73 cm
Biopsy Forceps, 5 Fr., 73 cm
Pince à biopsie, 5 Charr., 73 cm
Pinza da biopsia, 5 Charr., 73 cm
Pinzas para biopsia, 5 Charr., 73 cm
Pinça de biopsia, 5 Fr., 73 cm



(01)04048551074008(240)27023ZE(10)OP02

5. Переходник двойной LUER (при необходимости) – не более 100 шт.



5. Переходник двойной LUER (при необходимости) – не более 100 шт.



5. Переходник двойной LUER (при необходимости) – не более 100 шт. (маркировка)



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE

REF 11014LU

Doppel LUER-Einlauf
Double LUER Port
Raccord LUER double
Attacco LUER doppio
Conexión LUER doble
Conexão LUER dupla

LOT TP01

QTY 1



RxONLY

CE 0123

(01)04048551422601(240)11014LU(10)TP01

6. Переходник LUER с кранами (при необходимости) – не более 100 шт.



6. Переходник LUER с кранами (при необходимости) – не более 100 шт.




6. Переходник LUER с кранами (при необходимости) – не более 100 шт. (маркировка)



7. Клапан аспирационный, одноразовый - 20 шт./уп. (при необходимости) – не более 100 шт.



7. Клапан аспирационный, одноразовый - 20шт./уп. (при необходимости) – не более 100 шт.;

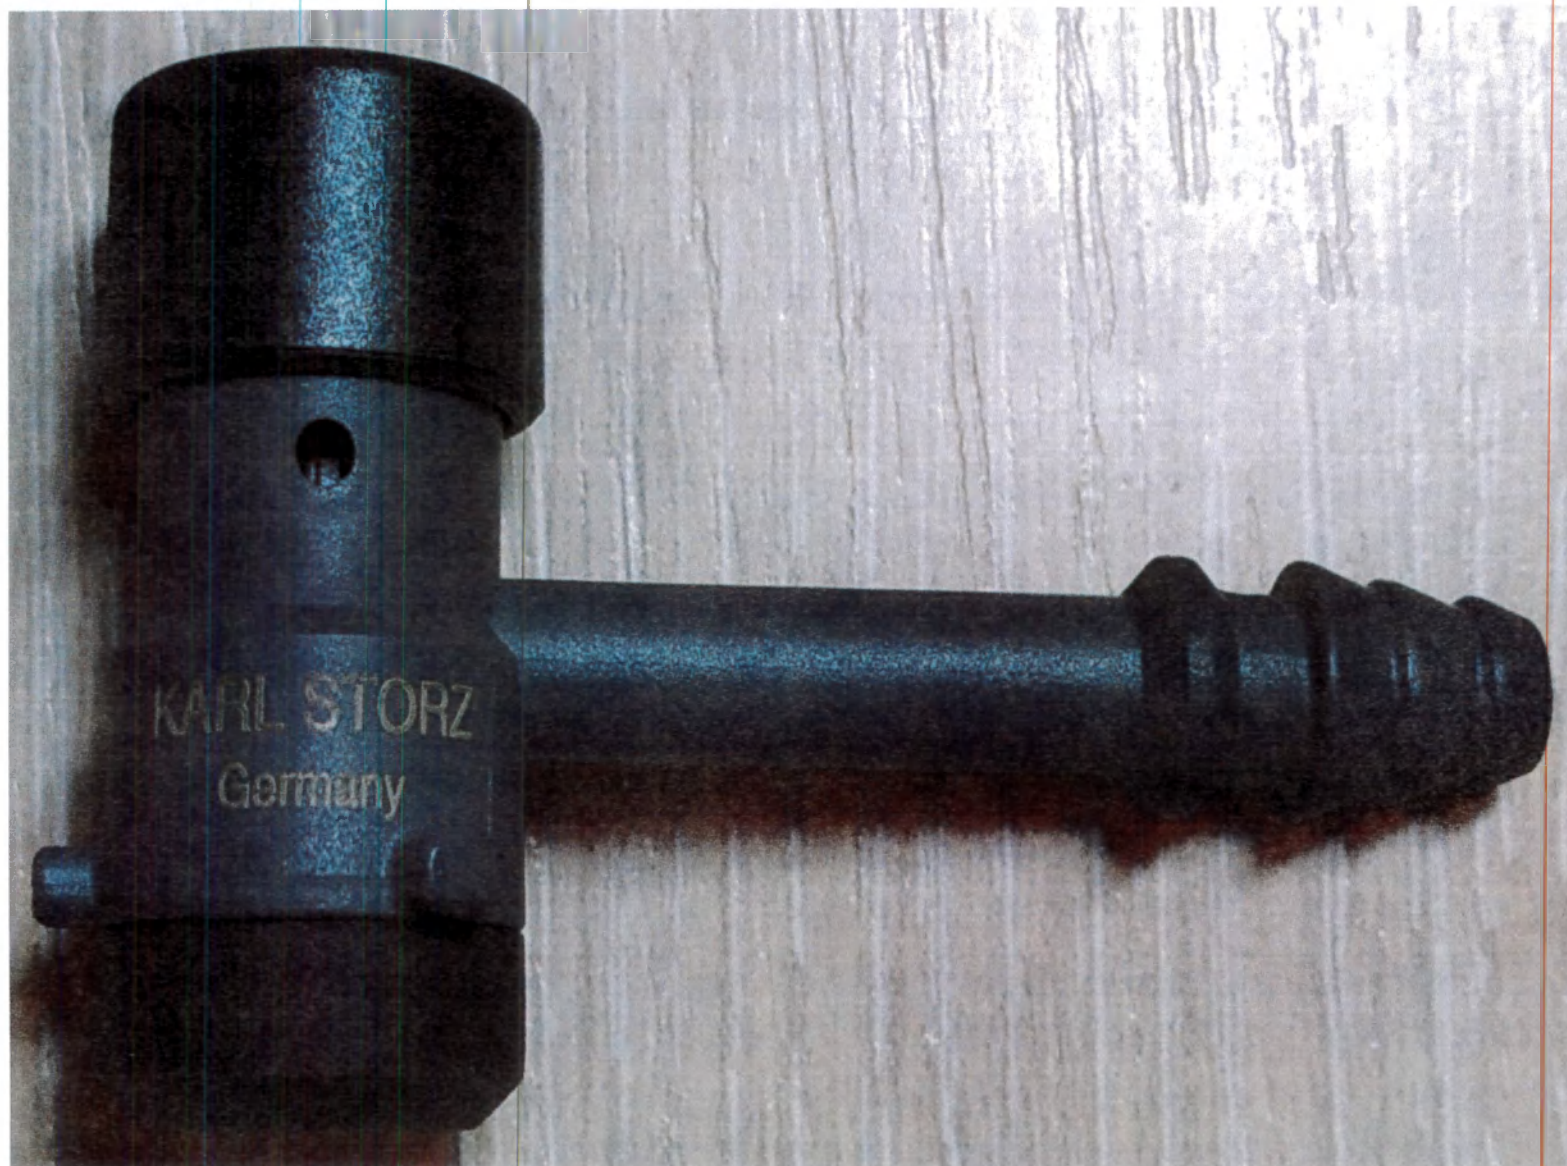

7. Клапан аспирационный, одноразовый - 20 шт./уп. (при необходимости) – не более 100 шт. (маркировка)



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE

REF 11301CE1

LOT	RP
QTY	20

Absaugventil, zum Einmalgebrauch, 20x
Suction Valve, for single use, 20x
Valve aspirat., usage unique, paq. 20
Valvola per aspirazione, monouso, 20x
Válvula de aspiración, un solo uso, 20x
Válvula de aspiração, descartável, 20x



CE 0123

(01)04048551314830(240)11301CE1(10)RP

8. Клапан аспирационный, многоразовый (при необходимости) – не более 100 шт.



8. Клапан аспирационный, многоразовый (при необходимости) – не более 100 шт.



8. Клапан аспирационный, многоразовый (при необходимости) — не более 100 шт. (маркировка)



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

REF	11301CB1	LOT	NP
		QTY	1

Absaugventil, wiederverwendbar
Suction Valve, reusable
Valve d'aspiration, réutilisable
Valvola per aspirazione, riutilizzabile
Válvula de aspiración, reutilizable
Válvula de aspiração, reutilizável



CE 0123

10104048551314623(240)11301CB1(10)NP

9. Захват корзинчатый для камней, одноразовый (при необходимости) – не более 100 шт.





KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

Ø 12 mm, 70 cm
straight/tipless

REF 27023KF

LOT 20408

QTY 1


Steinfangkörbchen, 3,0 Charr.
Stone Basket, 3.0 Fr.

Panier extracteur de calculs, 3,0 Ch.

Cestello per calcoli, 3,0 Charr.

Cestilla para extracción de cálculos, 3,0 Charr.

Cesto coletor de cálculos, 3,0 Fr.



2024-10-28



V1710

STERILE **EO**

RxONLY



0123

(01)04048551360160(240)27023KF(17)241028(10)20408

REF 27023KF

QTY 1 **LOT** 20408

CE 0123



STERILE **EO**

RxONLY

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE



2024-10-28

REF 27023KF

QTY 1 **LOT** 20408

CE 0123



STERILE **EO**

RxONLY

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE



2024-10-28

REF 27023KF

QTY 1 **LOT** 20408

CE 0123



STERILE **EO**

RxONLY

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE



2024-10-28


Rev 1: Date: 2017-12-20

9. Захват корзинчатый для камней, одноразовый (при необходимости) — не более 100 шт. (маркировка)


10. Фиксатор лазерного волокна (при необходимости) – не более 100 шт.



10. Фиксатор лазерного волокна (при необходимости) – не более 100 шт.

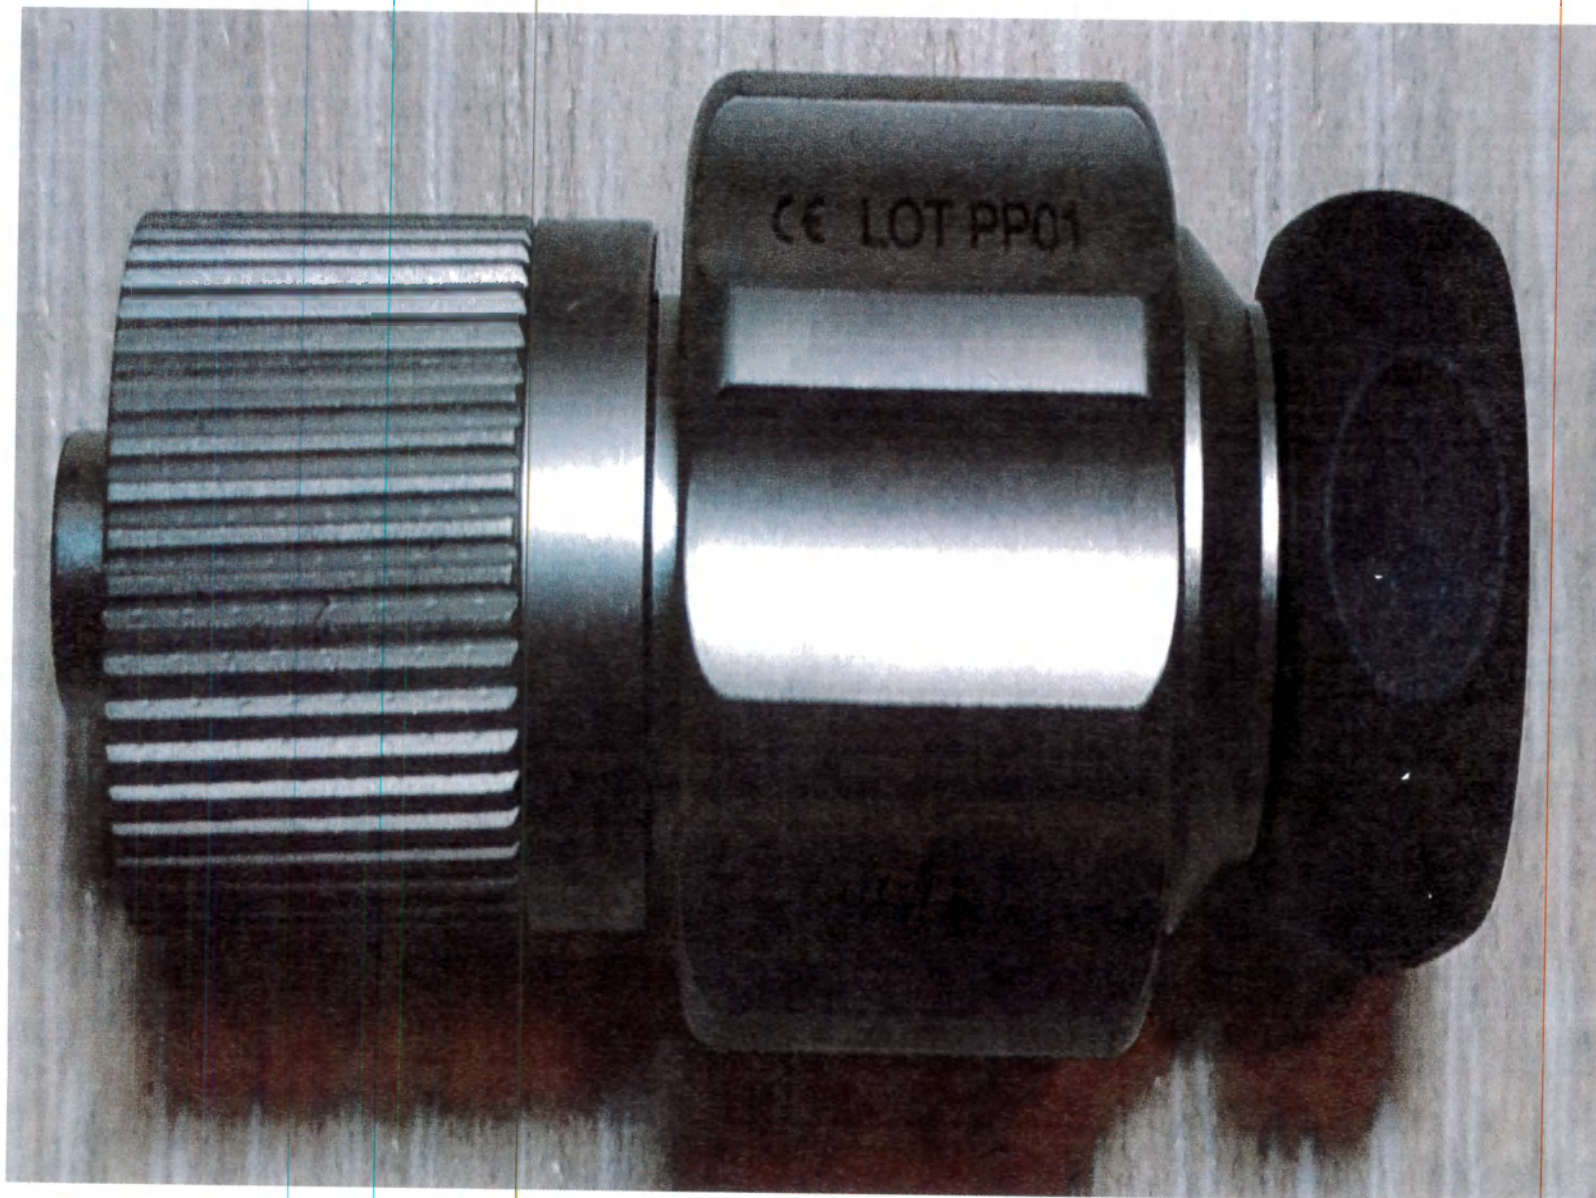


10. Фиксатор лазерного волокна (при необходимости) – не более 100 шт. (маркировка)

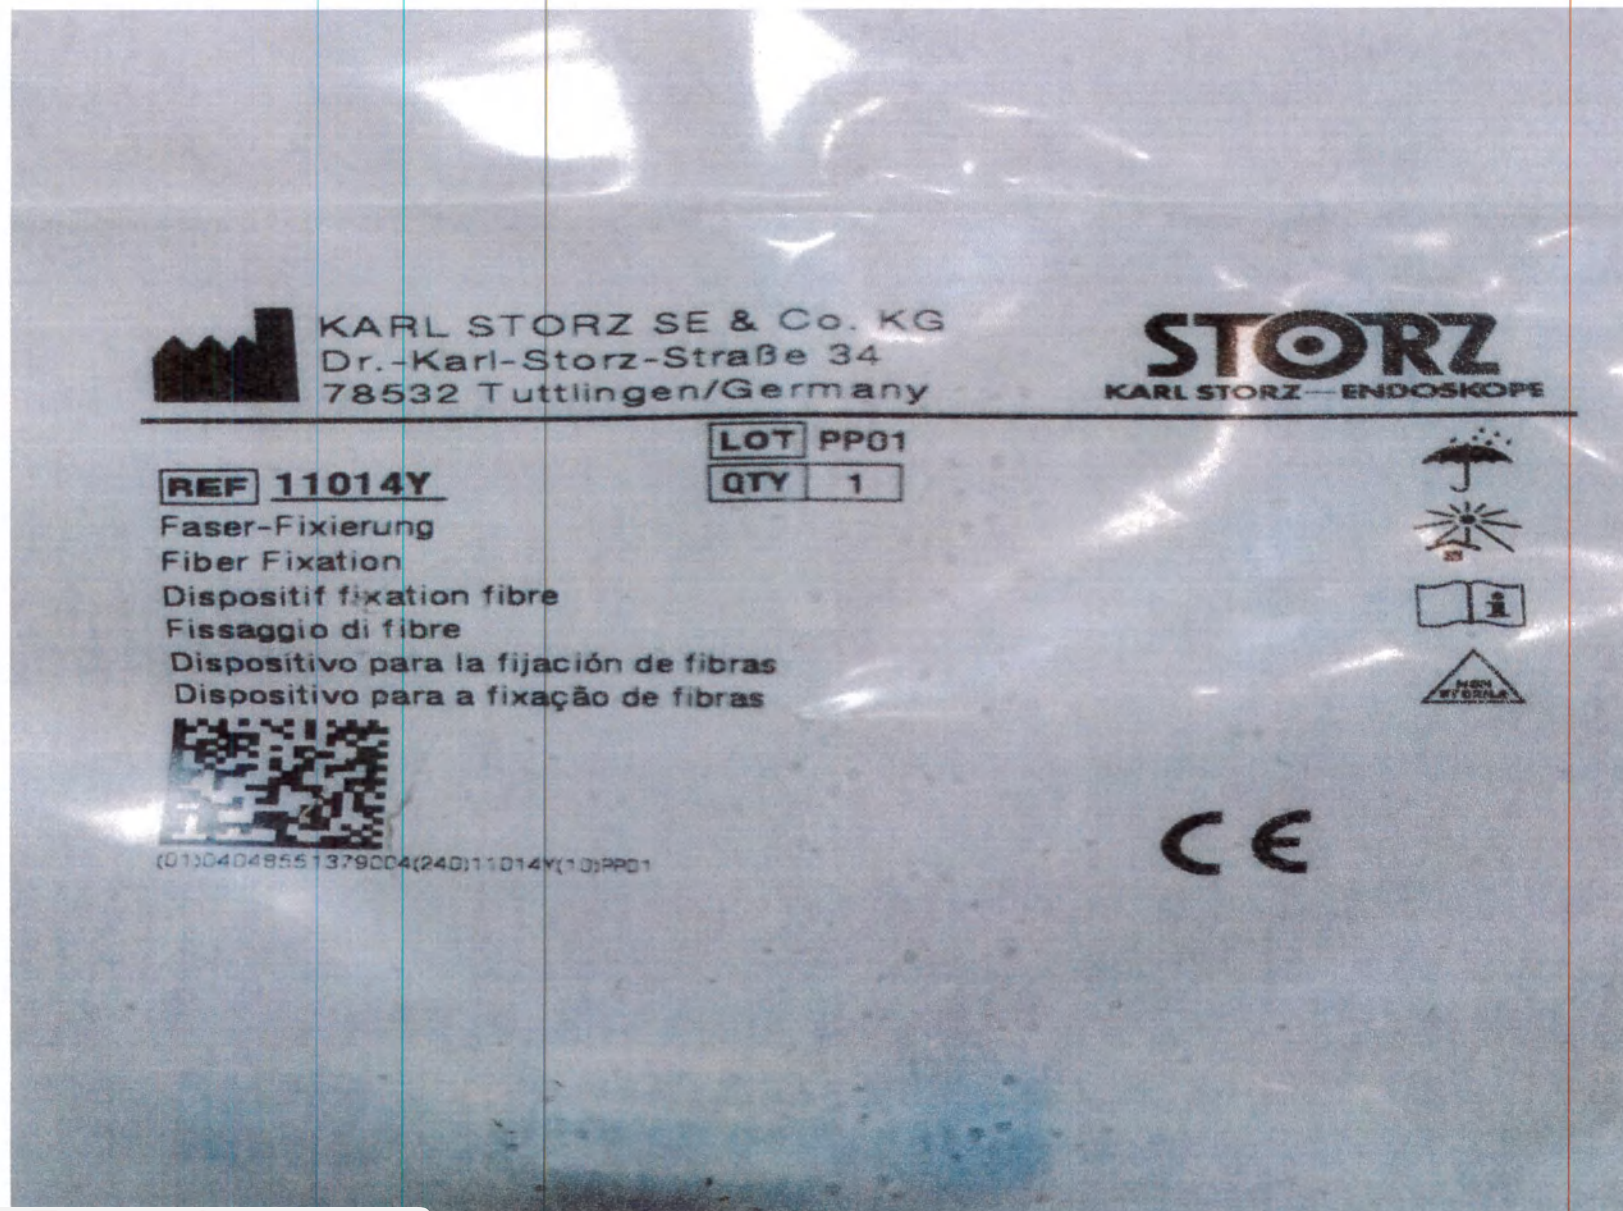

11. Адаптер для чистки инструментальных портов (при необходимости) – не более 100 шт.




11. Адаптер для чистки инструментальных портов (при необходимости) – не более 100 шт.

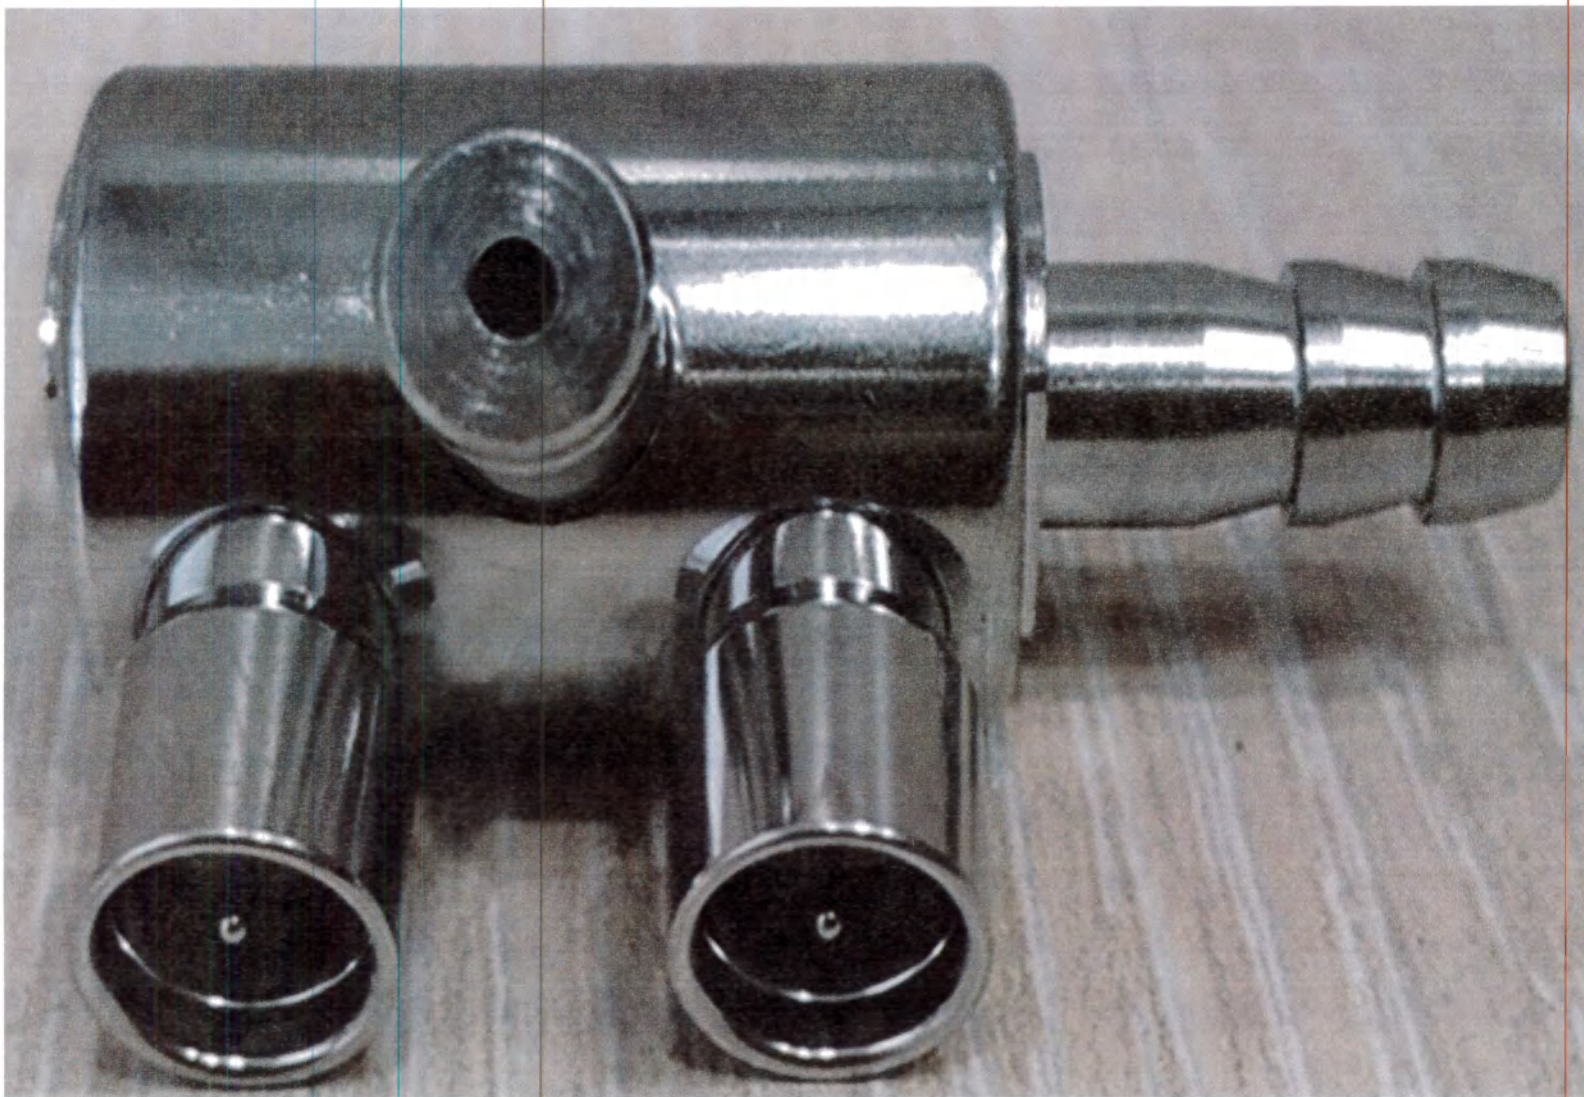

11. Адаптер для чистки инструментальных портов (при необходимости) – не более 100 шт. (маркировка)



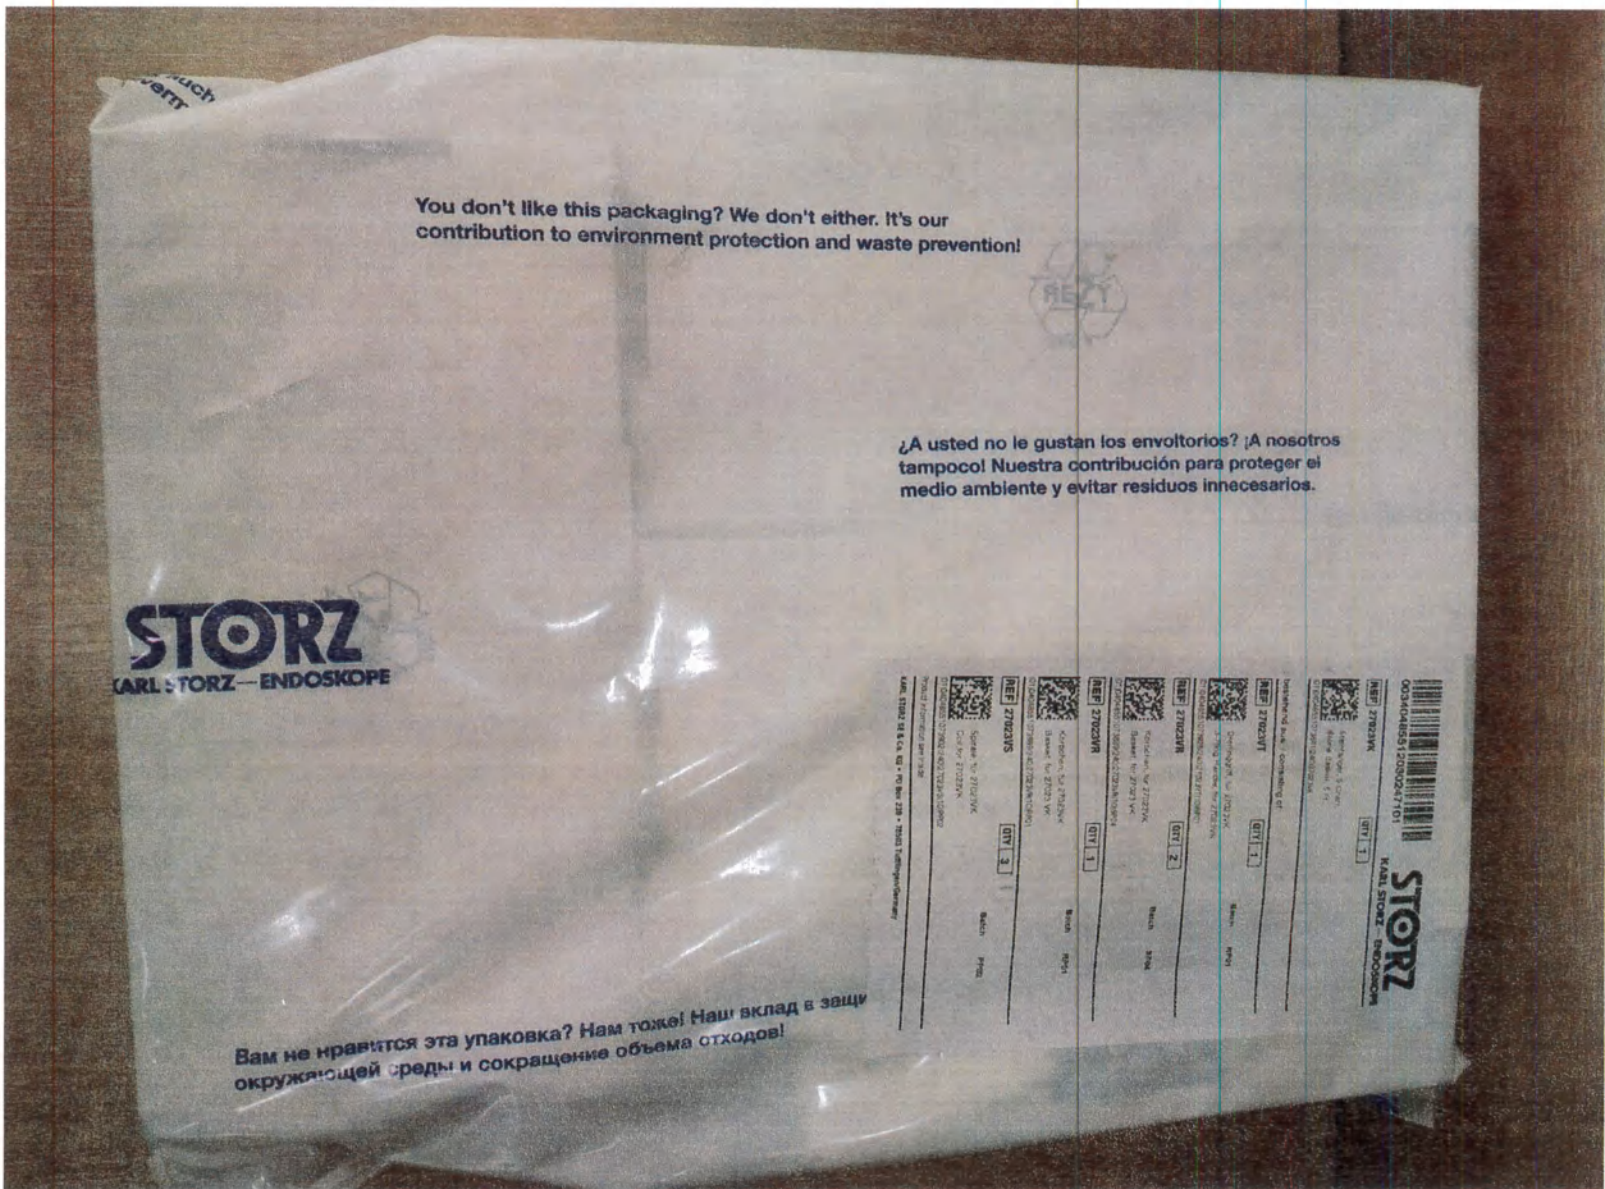

12. Захват корзинчатый для камней, многоразовый (при необходимости) – не более 100 шт.



00340485512030247224

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

REF 27023VK

QTY 1



Steinfänger, 5 Charr.
Stone Basket, 5 Fr.

(01)04048551073841(240)27023VK

bestehend aus: / consisting of:

REF 27023VT

QTY 1



Dreiringgriff, für 27023VK
3-Ring Handle, for 27023VK

(01)04048551073926(240)27023VT(10)RP01

Batch RP01

REF 27023VR

QTY 3



Körbchen, für 27023VK
Basket, for 27023 VK

(01)04048551073889(240)27023VR(10)RP01

Batch RP01

REF 27023VS

QTY 3



Spirale, für 27023VK
Coil, for 27023VK

(01)04048551073902(240)27023VS(10)PP02


Batch PP02

Product information see inside

KARL STORZ SE & Co. KG • PO Box 230 • 78503 Tuttlingen/Germany

12. Захват корзинчатый для камней, многообразовый (маркировка)

12.1 Рукоятка (при необходимости) – не более 100 шт.

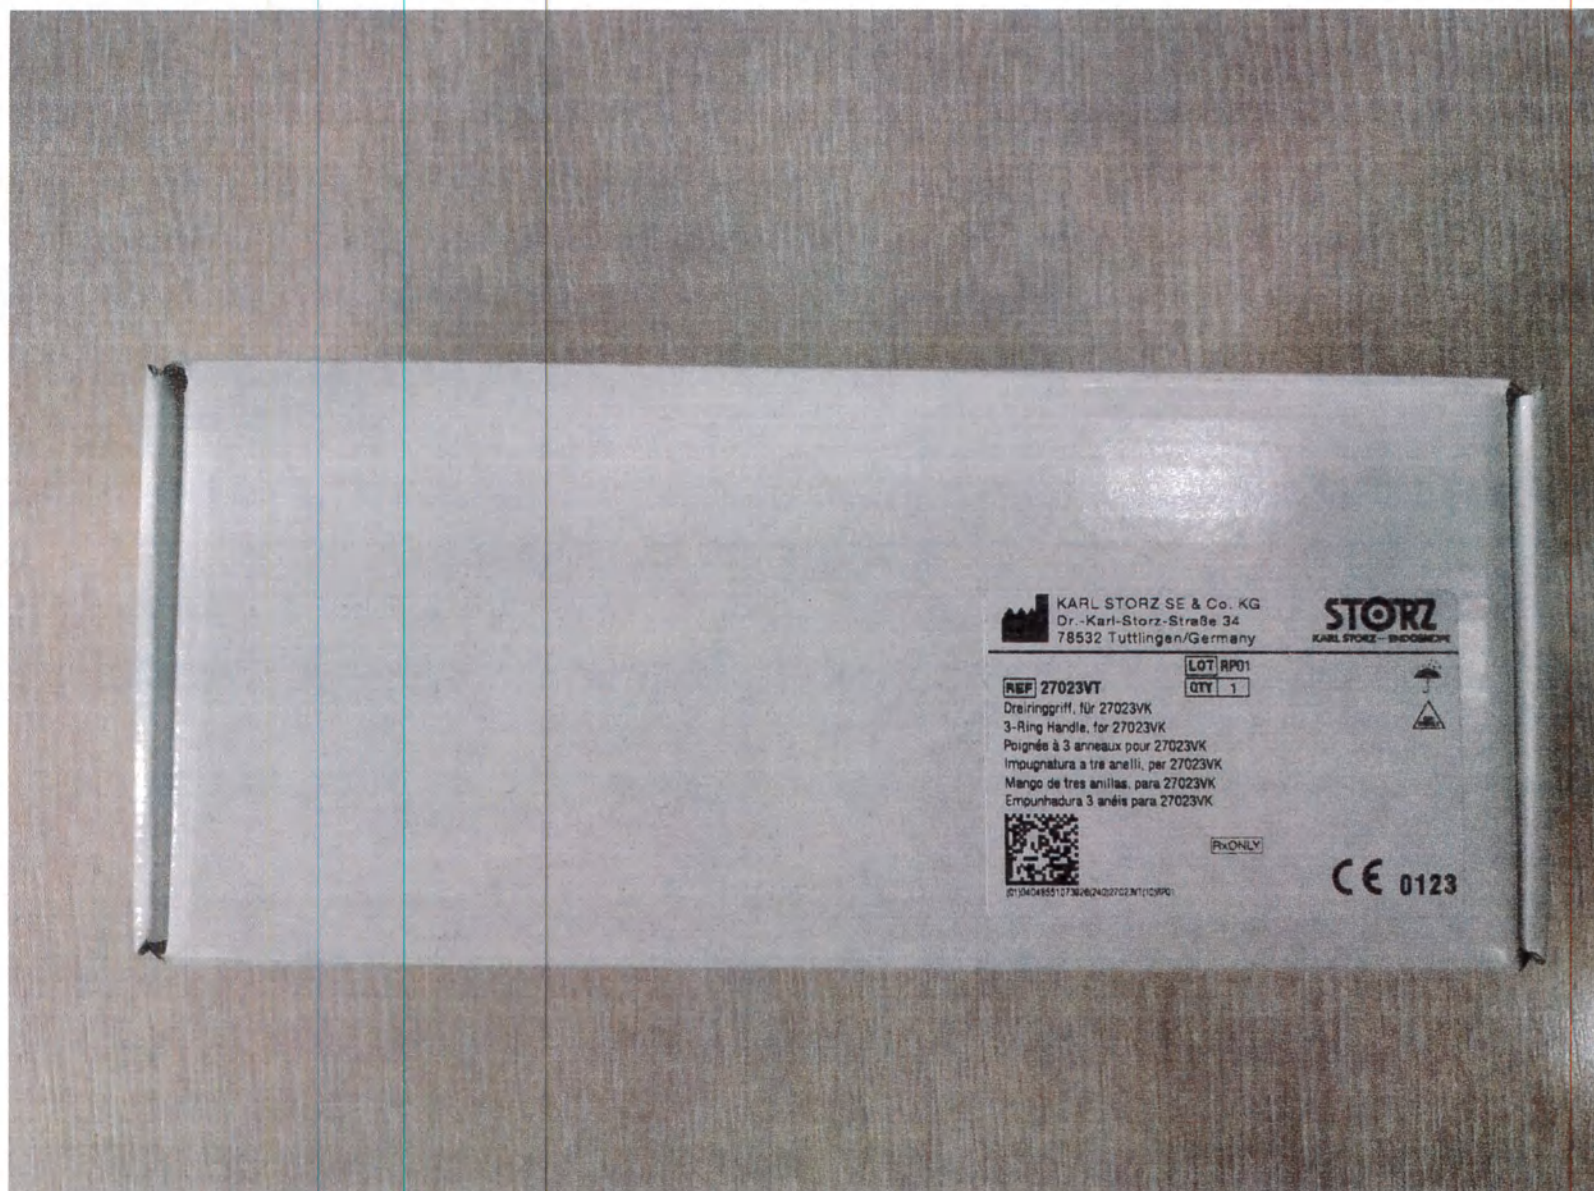

12.1 Рукоятка (при необходимости) – не более 100 шт.



12.1 Рукоятка (при необходимости) – не более 100 шт.




12.1 Рукоятка (при необходимости) – не более 100 шт. (маркировка)

	KARL STORZ SE & Co. KG Dr.-Karl-Storz-Straße 34 78532 Tuttlingen/Germany	STORZ KARL STORZ — ENDOSKOPE
REF 27023VT	LOT RP01	 
	QTY 1	
Dreiringgriff, für 27023VK 3-Ring Handle, for 27023VK Poignée à 3 anneaux pour 27023VK Impugnatura a tre anelli, per 27023VK Mango de tres anillas, para 27023VK Empunhadura 3 anéis para 27023VK		
	RxONLY	CE 0123
(01)04048551073026(240)27023VT(10)RP01		


12.2 Корзинка (при необходимости) – не более 100 шт.



12.2 Корзинка (при необходимости) – не более 100 шт.

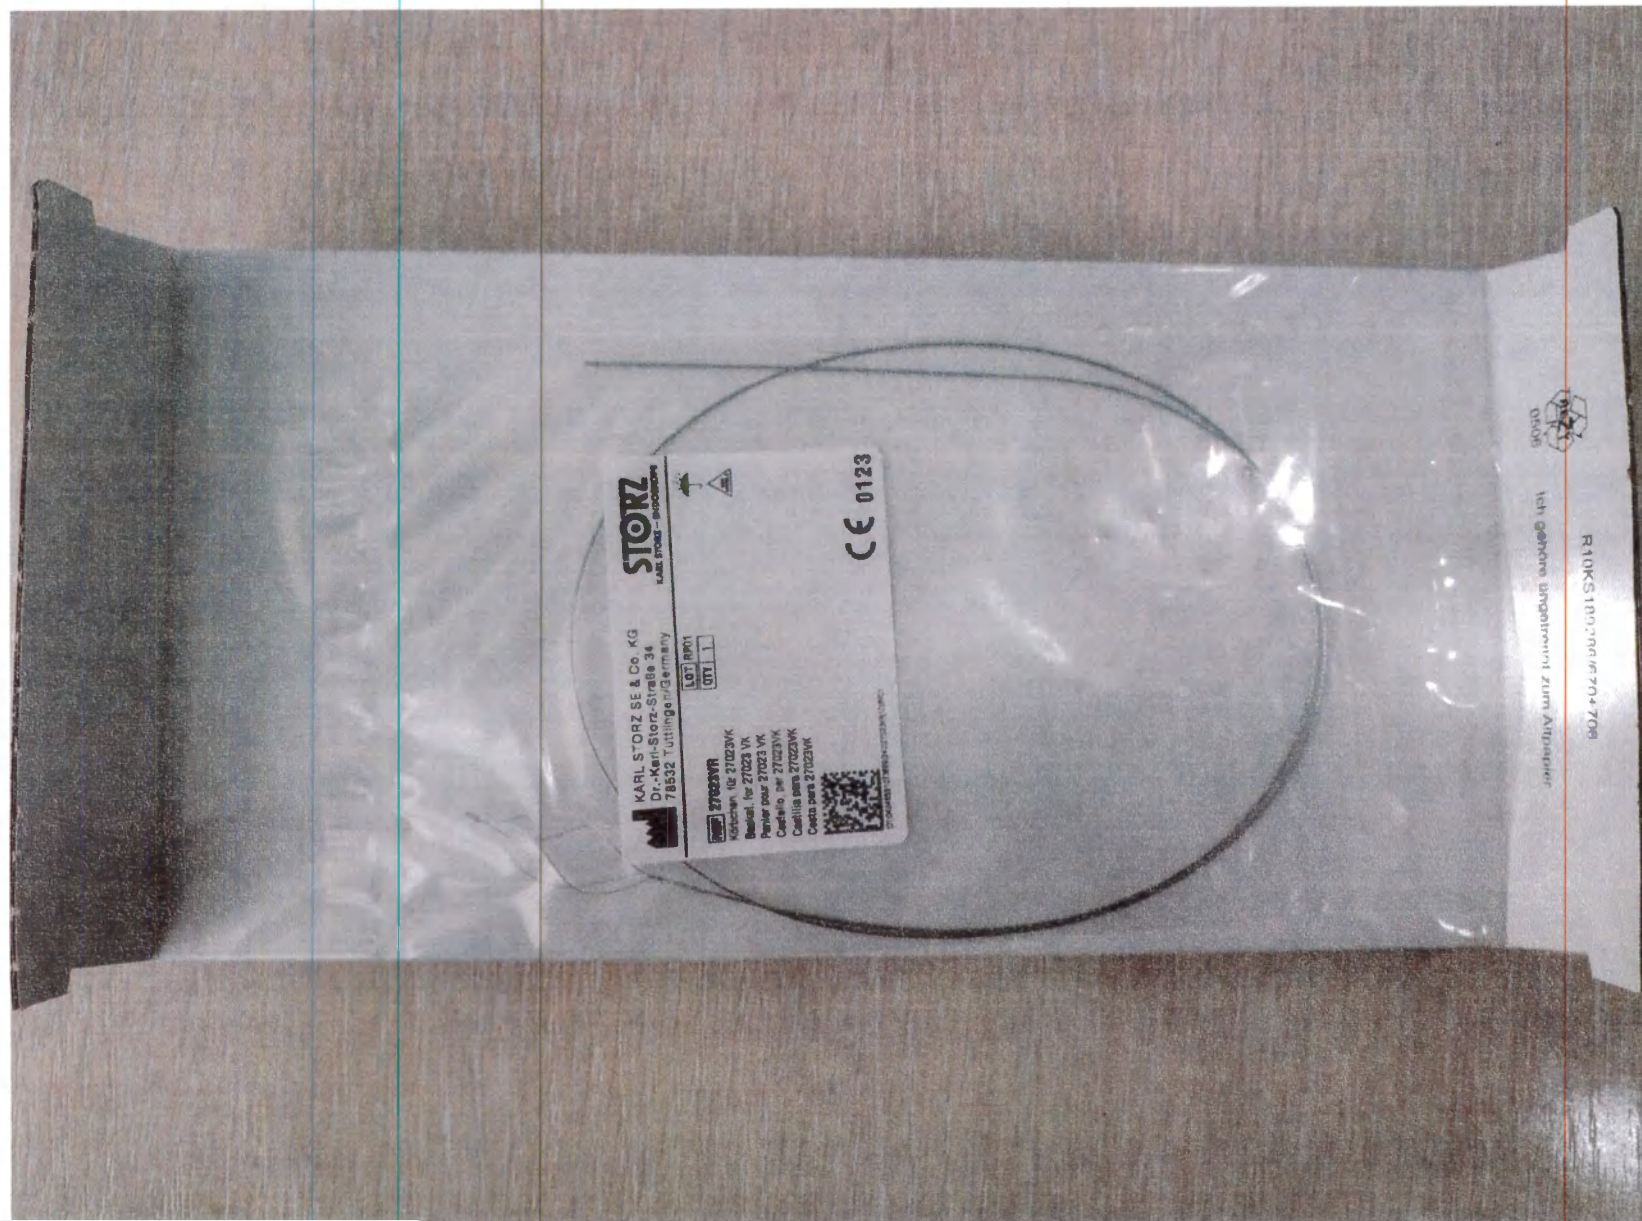

12.2 Корзинка (при необходимости) – не более 100 шт.

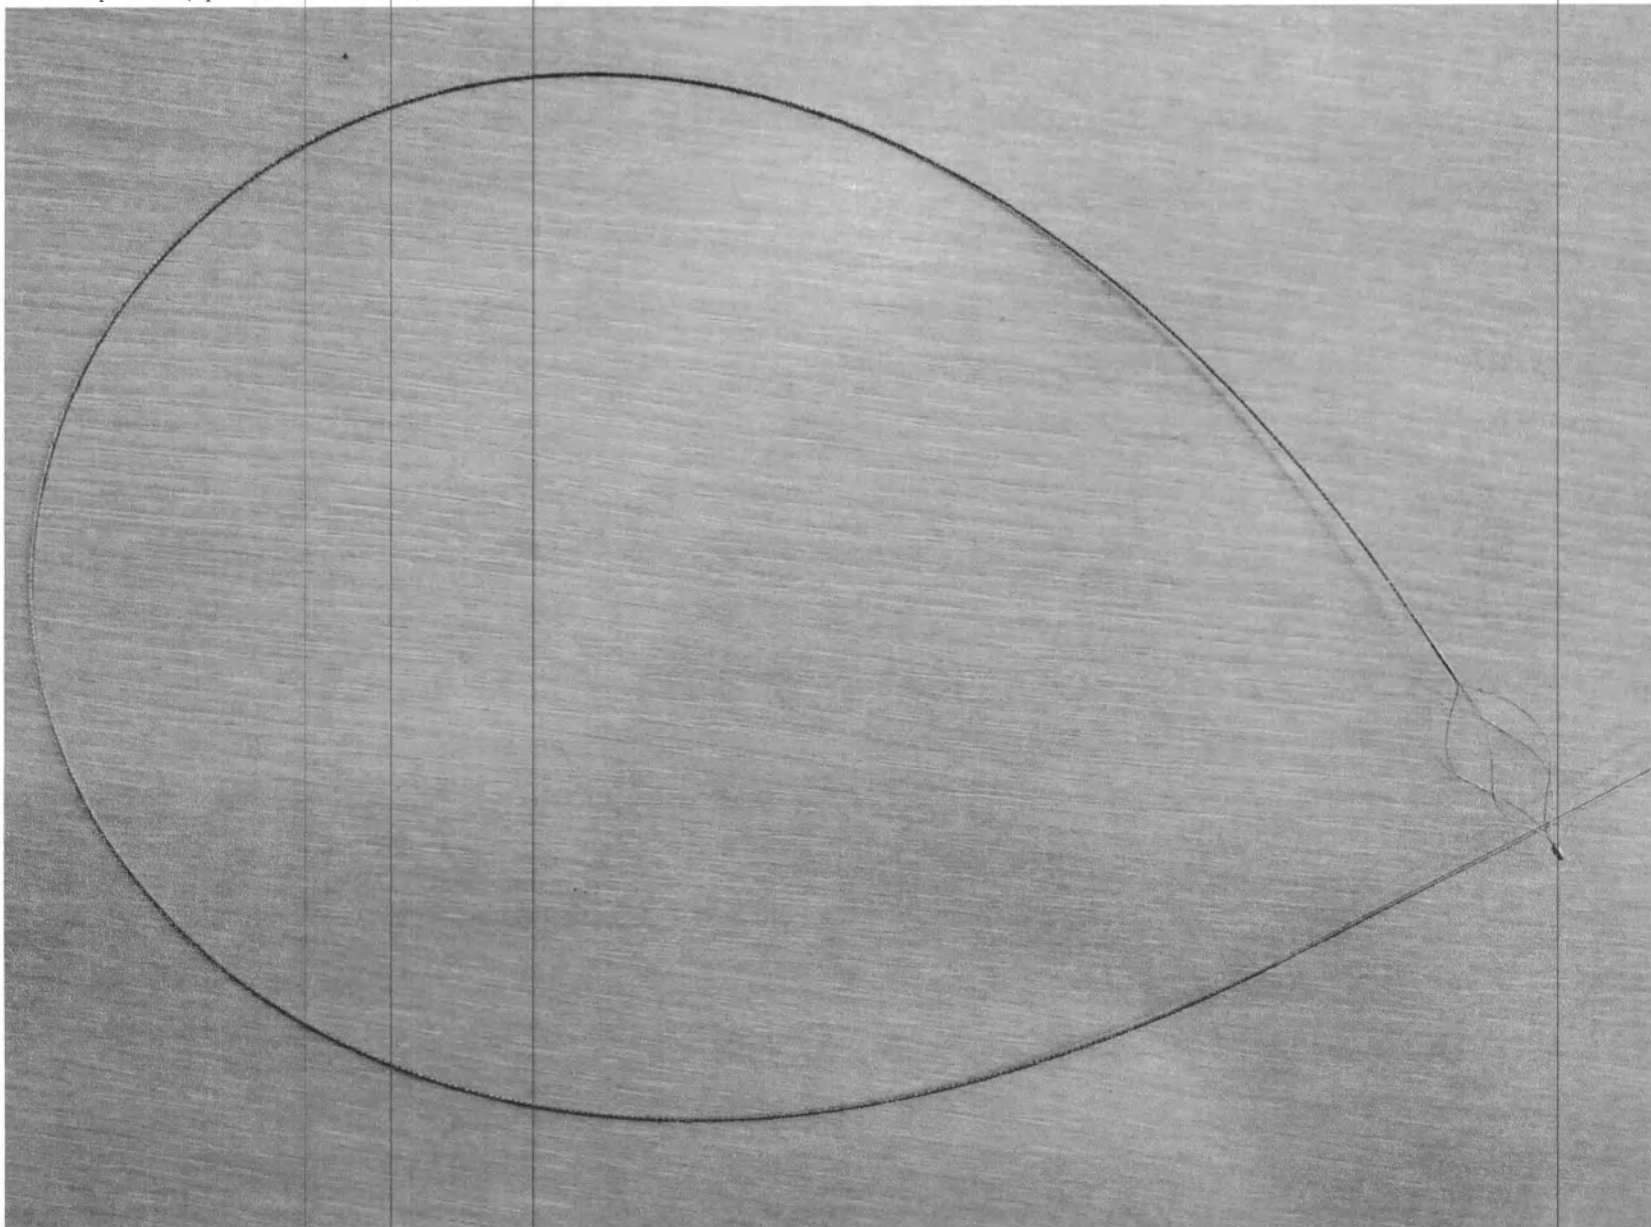

12.2 Корзинка (при необходимости) – не более 100 шт. (маркировка)




KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSCOPE

REF 27023VR

Körbchen, für 27023VK
Basket, for 27023 VK
Panier pour 27023 VK
Cestello, per 27023VK
Cestilla para 27023VK
Cesta para 27023VK


LOT	RP01
QTY	1



(L1)04048551073899(240)27023VR10RP01

CE 0123


12.3 Тубус внешний (при необходимости) – не более 100 шт.

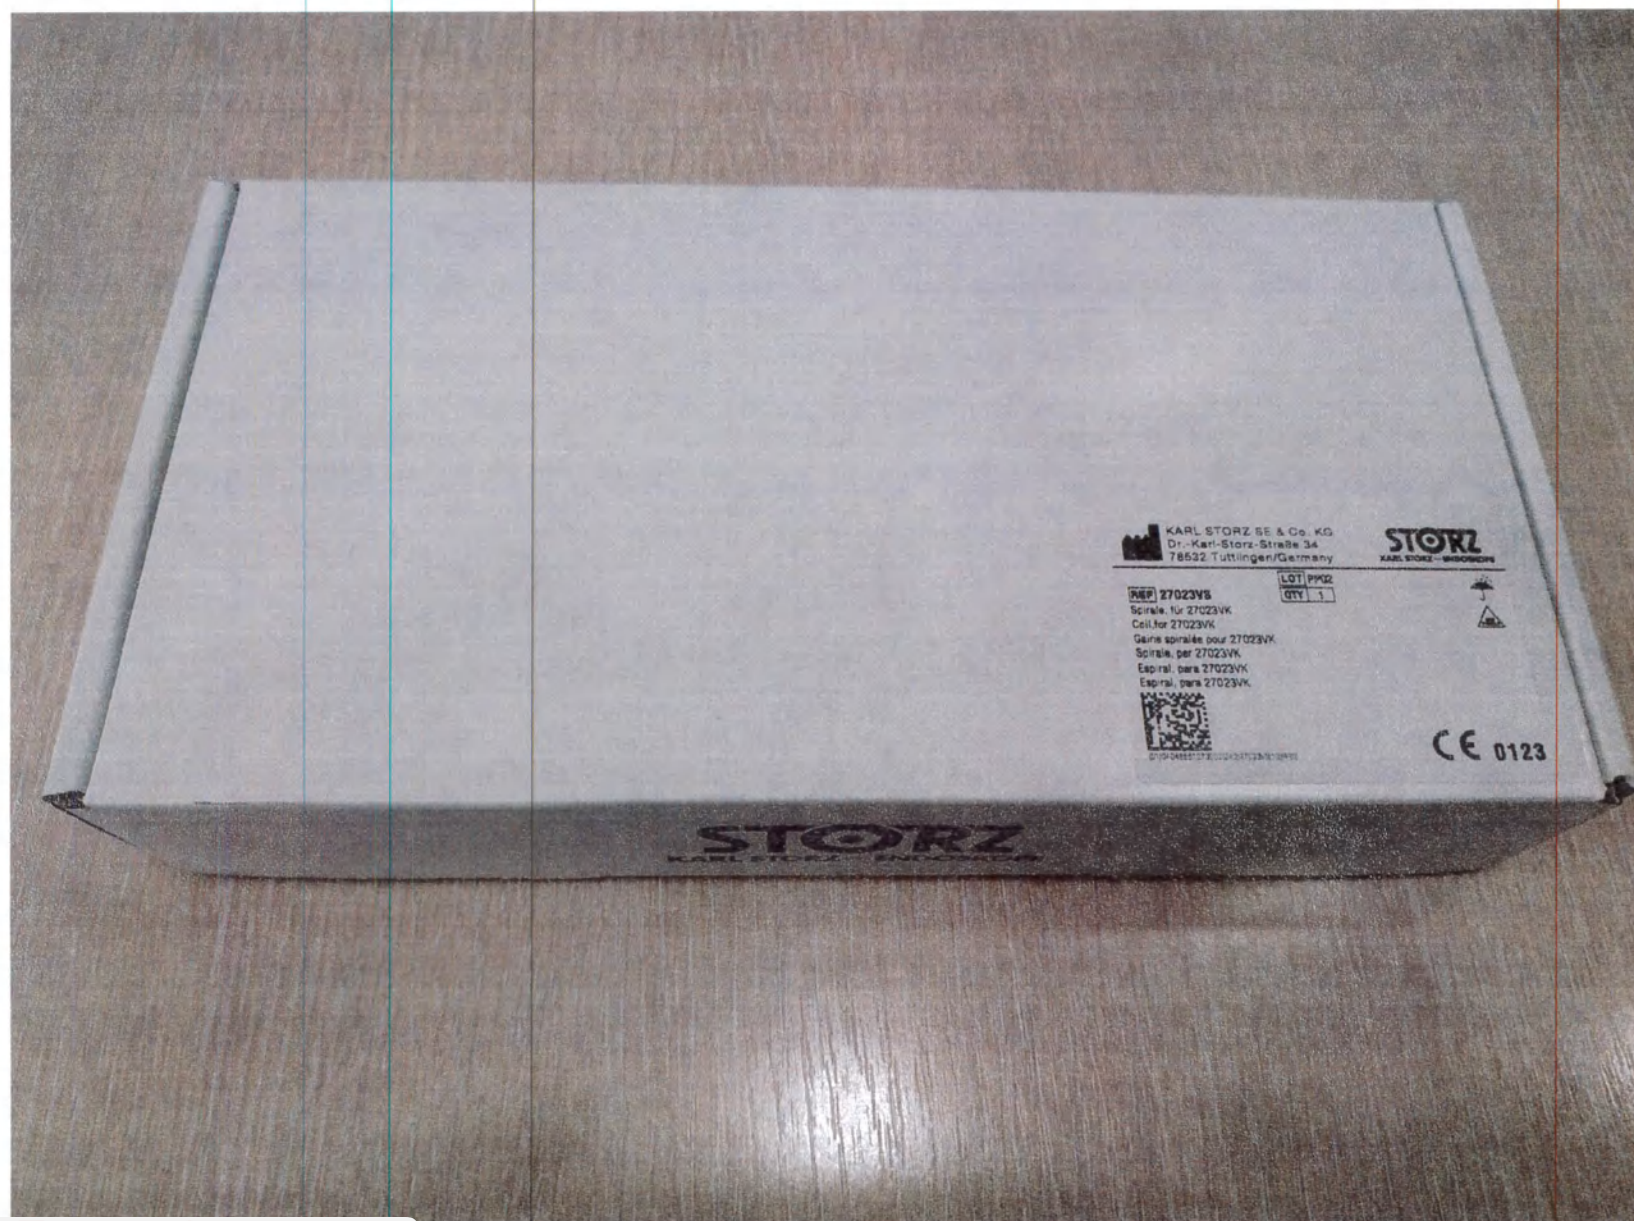

12.3 Тубус внешний (при необходимости) – не более 100 шт.



12.3 Тубус внешний (при необходимости) – не более 100 шт.

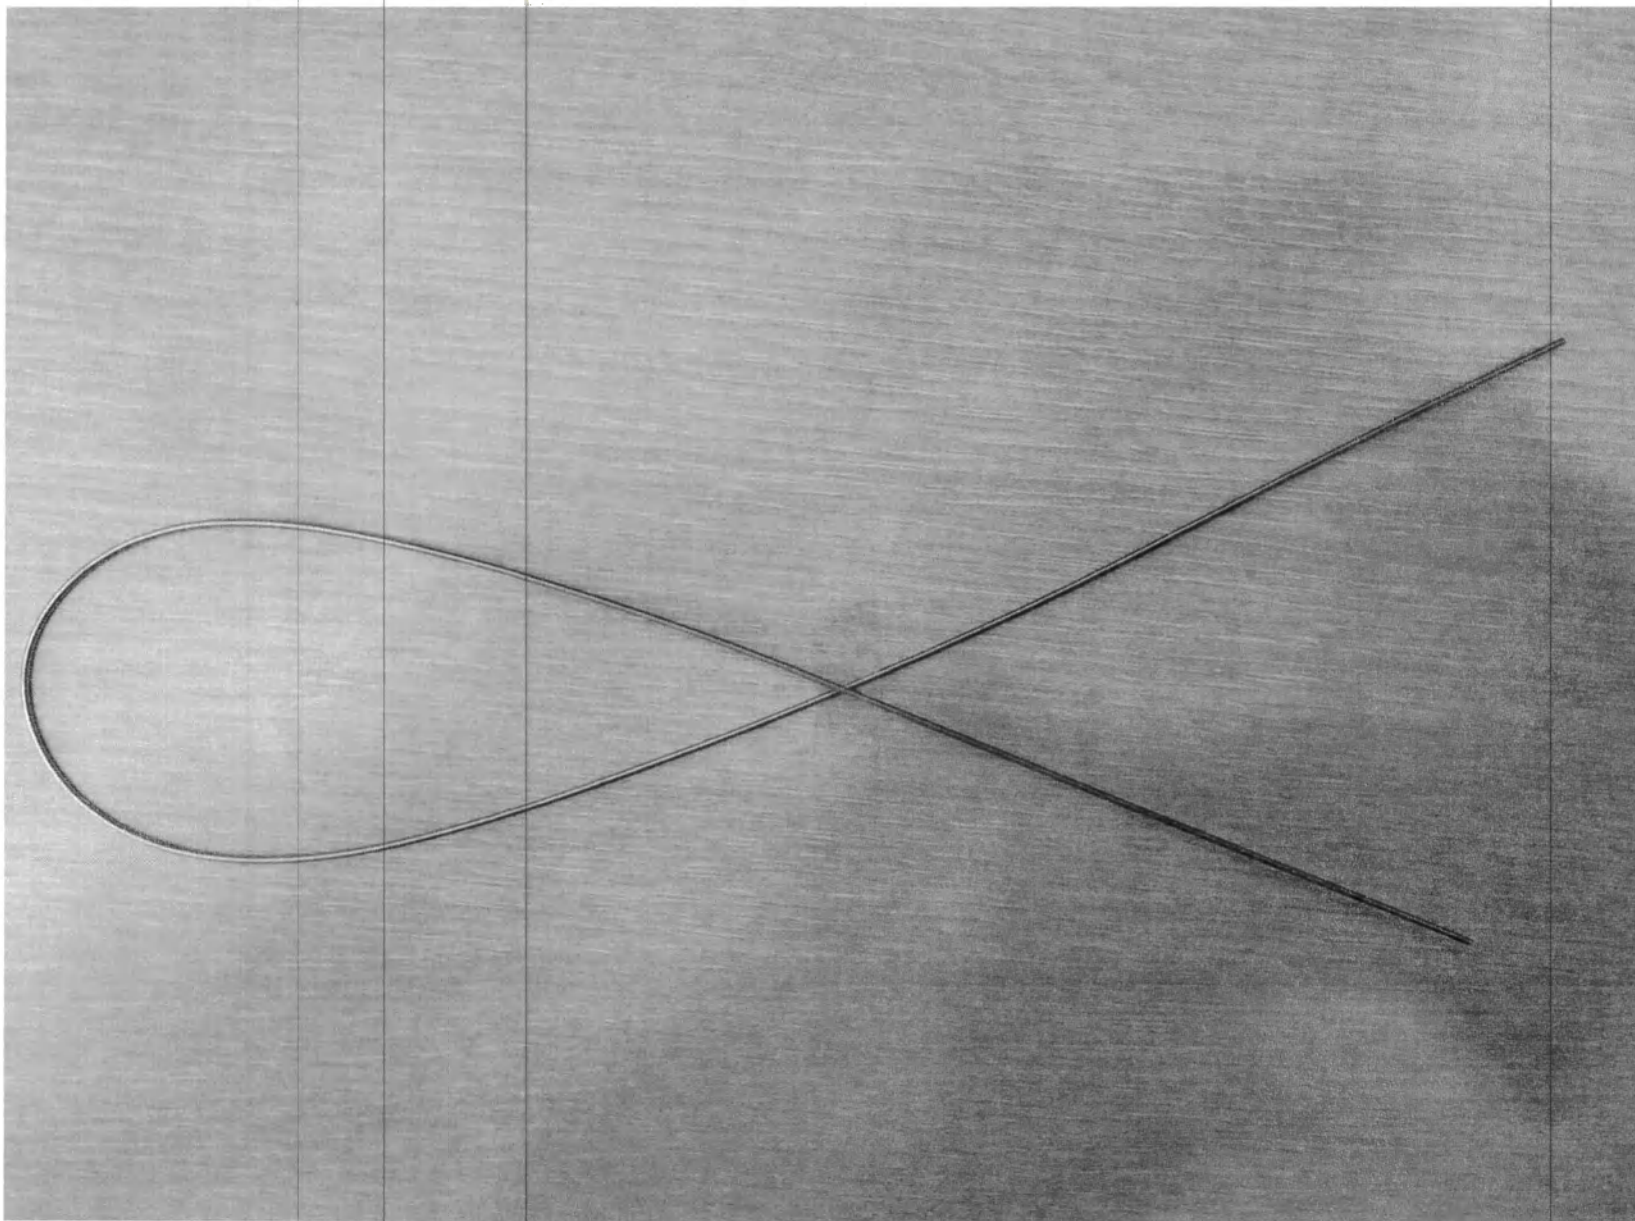

12.3 Тубус внешний (при необходимости) – не более 100 шт. (маркировка)



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPIE

REF 27023VS

Spirale, für 27023VK

Coil, for 27023VK


Gaine spiralée pour 27023VK

Spirale, per 27023VK

Espiral, para 27023VK

Espiral, para 27023VK

LOT	PP02
QTY	1



(01)04048551073002(240)27023VS(10)PP02

CE 0123

13. Уплотнитель для инструментального порта 10 шт./уп. (при необходимости) – не более 10 уп.



13. Уплотнитель для инструментального порта 10 шт./уп. (при необходимости) – не более 10 уп.



13. Уплотнения для инструментального порта-10шт./уп (при необходимости) – не более 10 уп. (маркировка)



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE

REF	27550N
-----	--------


LOT	SP
QTY	10

Dichtung, 10x
Seal, 10x
Joint, paquet de 10
Guarnizione, 10x
Junta, 10 x
Vedação, 10x




ID: 04040551083768024027550N(10)SP

1. Видеоцистоуретроскоп гибкий HD-VIEW (Набор 11272 VHUK):



1.1. Видеоцистоуретроскоп гибкий HD-View - 1 шт.

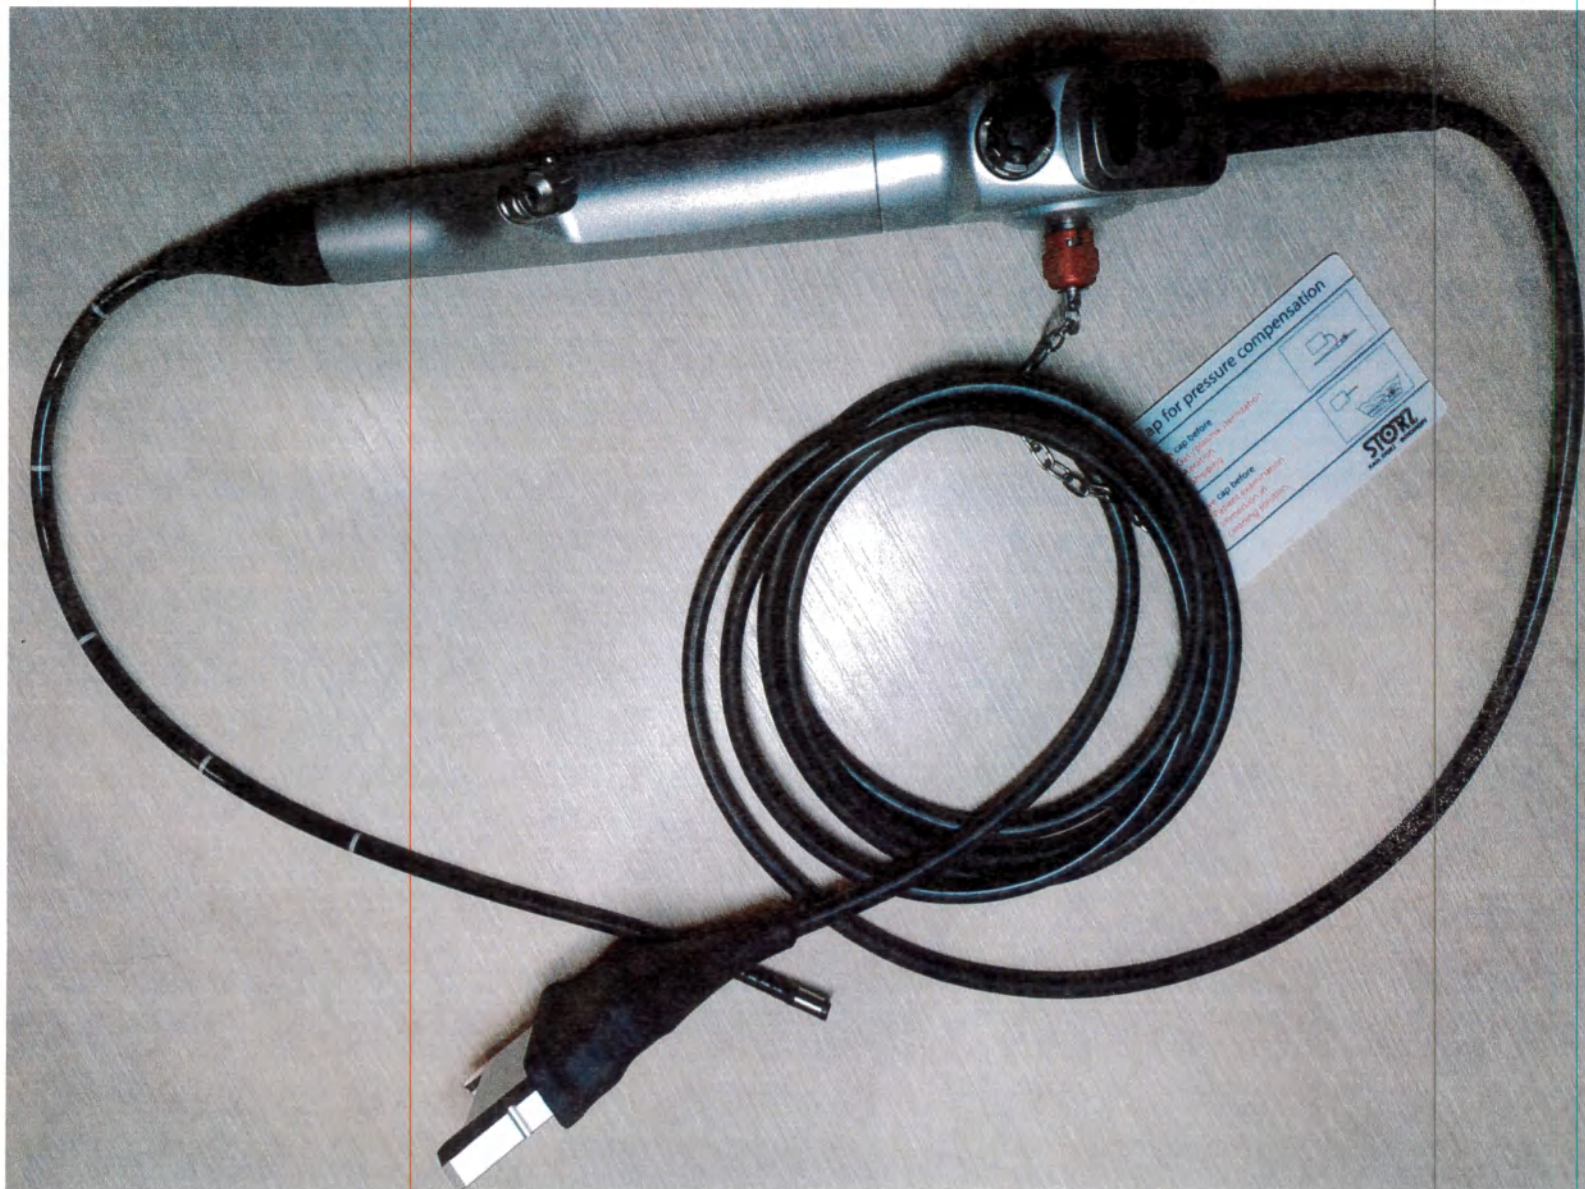

1.1. Видеоцистоскоп гибкий HD- VIEW - 1 шт. (макет маркировки)



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

REF 11272VHU

Flexibles Video-Cystoskop HD-VIEW

Flexible Video Cystoscope HD-VIEW

Cystoscope vidéo flexible HD-VIEW

Video-cistoscopio flessibile HD-VIEW

Videocistoscopio flexible HD-VIEW

Videocistoscópio flexível HD-VIEW



SN	123456
QTY	1



RxONLY

CE 0123

(01)04048551423363(240)11272VHU(21)123456

1.2. Переходник двойной LUER - 1 шт.



1.2. Переходник двойной LUER - 1 шт.



1.2. Переходник двойной LUER - 1 шт.. (маркировка)



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

REF 11014LU

Doppel LUER-Einlauf
Double LUER Port
Raccord LUER double
Attacco LUER doppio
Conexión LUER doble
Conexão LUER dupla

LOT TP01

QTY 1



RxONLY


CE 0123

(01)04048551422601(240)11014LU(10)TP01

1.3. Адаптер для чистки рабочего канала – 1 шт.



1.3. Адаптер для чистки рабочего канала – 1 шт.

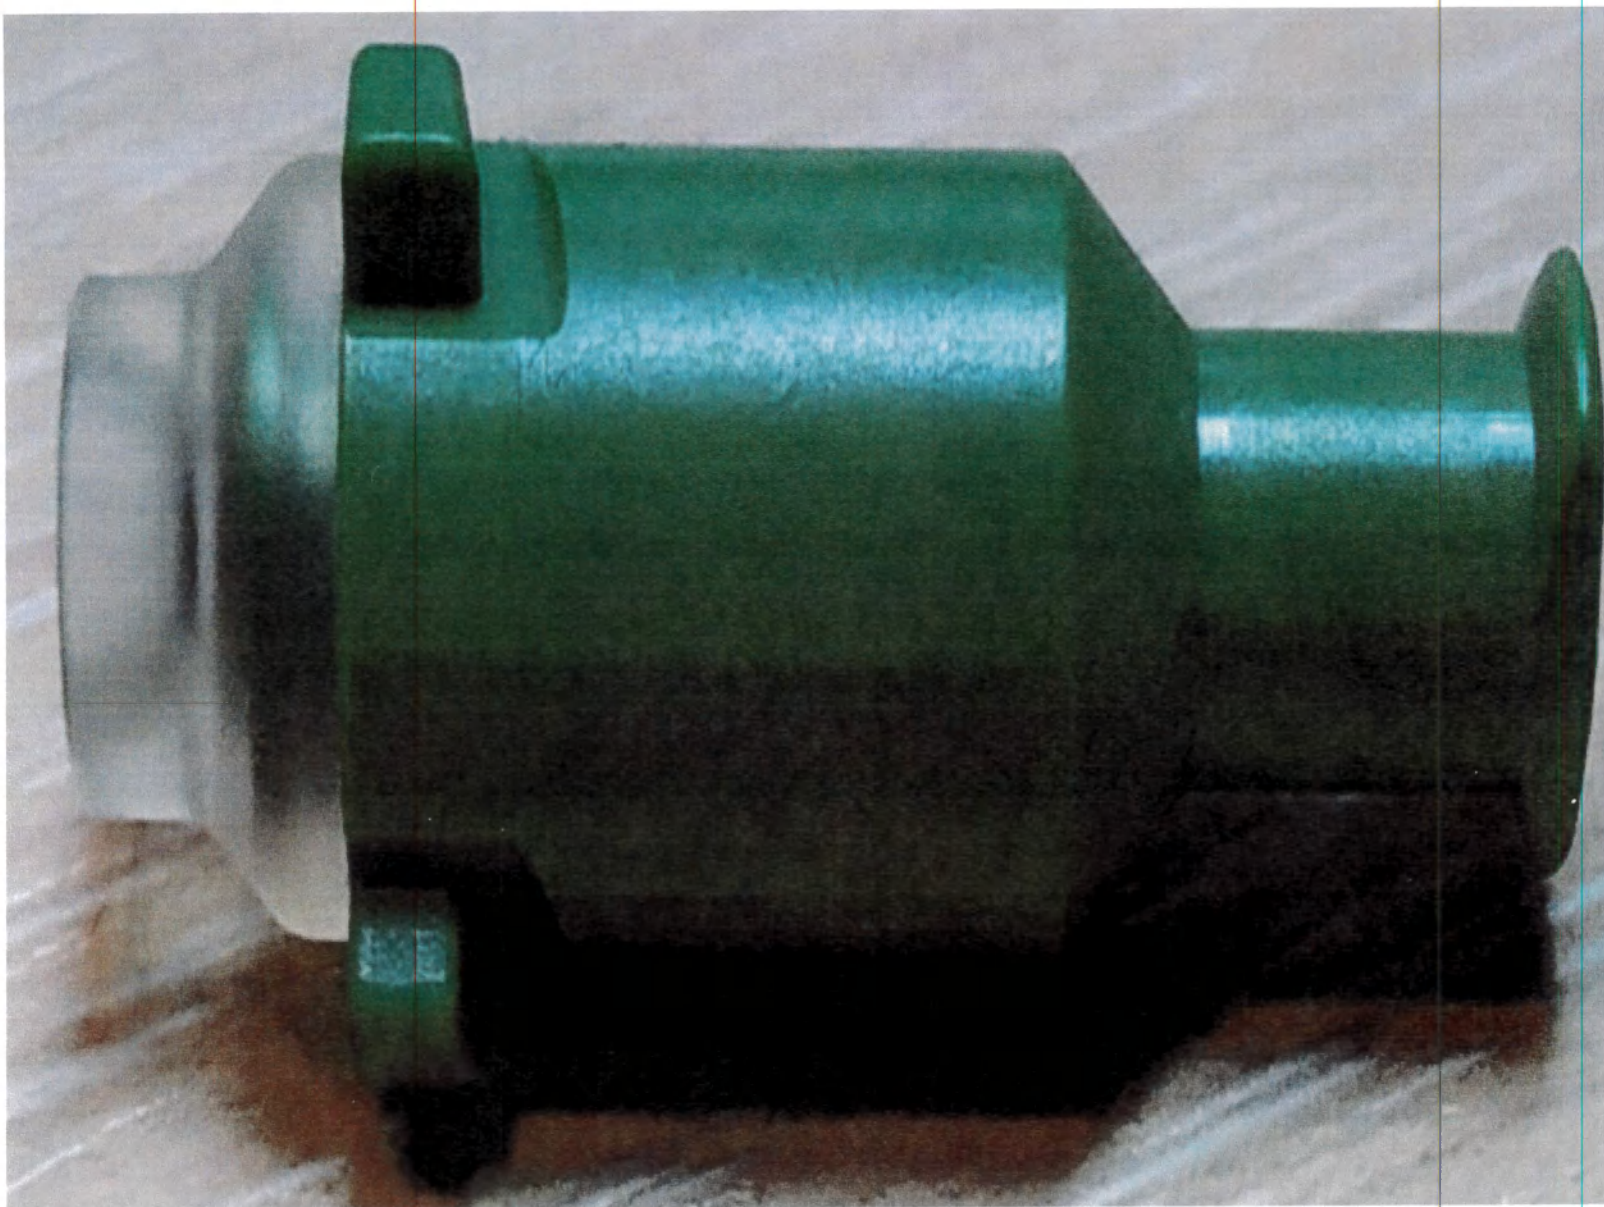

1.3. Адаптер для чистки рабочего канала – 1 шт. (маркировка)



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

REF 11014RA

Reinigungsadapter für Arbeitskanal
Cleaning Adaptor for Working Channel
Adaptateur nettoyage canal opérateur
Adattatore di pulizia per canale op.
Adaptador de limpieza, canal de trabajo
Adaptador de limpeza p/ canal de trab.

LOT OP01

QTY 1




RxONLY


CE

(01)X04048551423240(240)11014RA(10)OP01

1.4. Уплотнитель для рабочего канала коннектора – 10 шт./уп

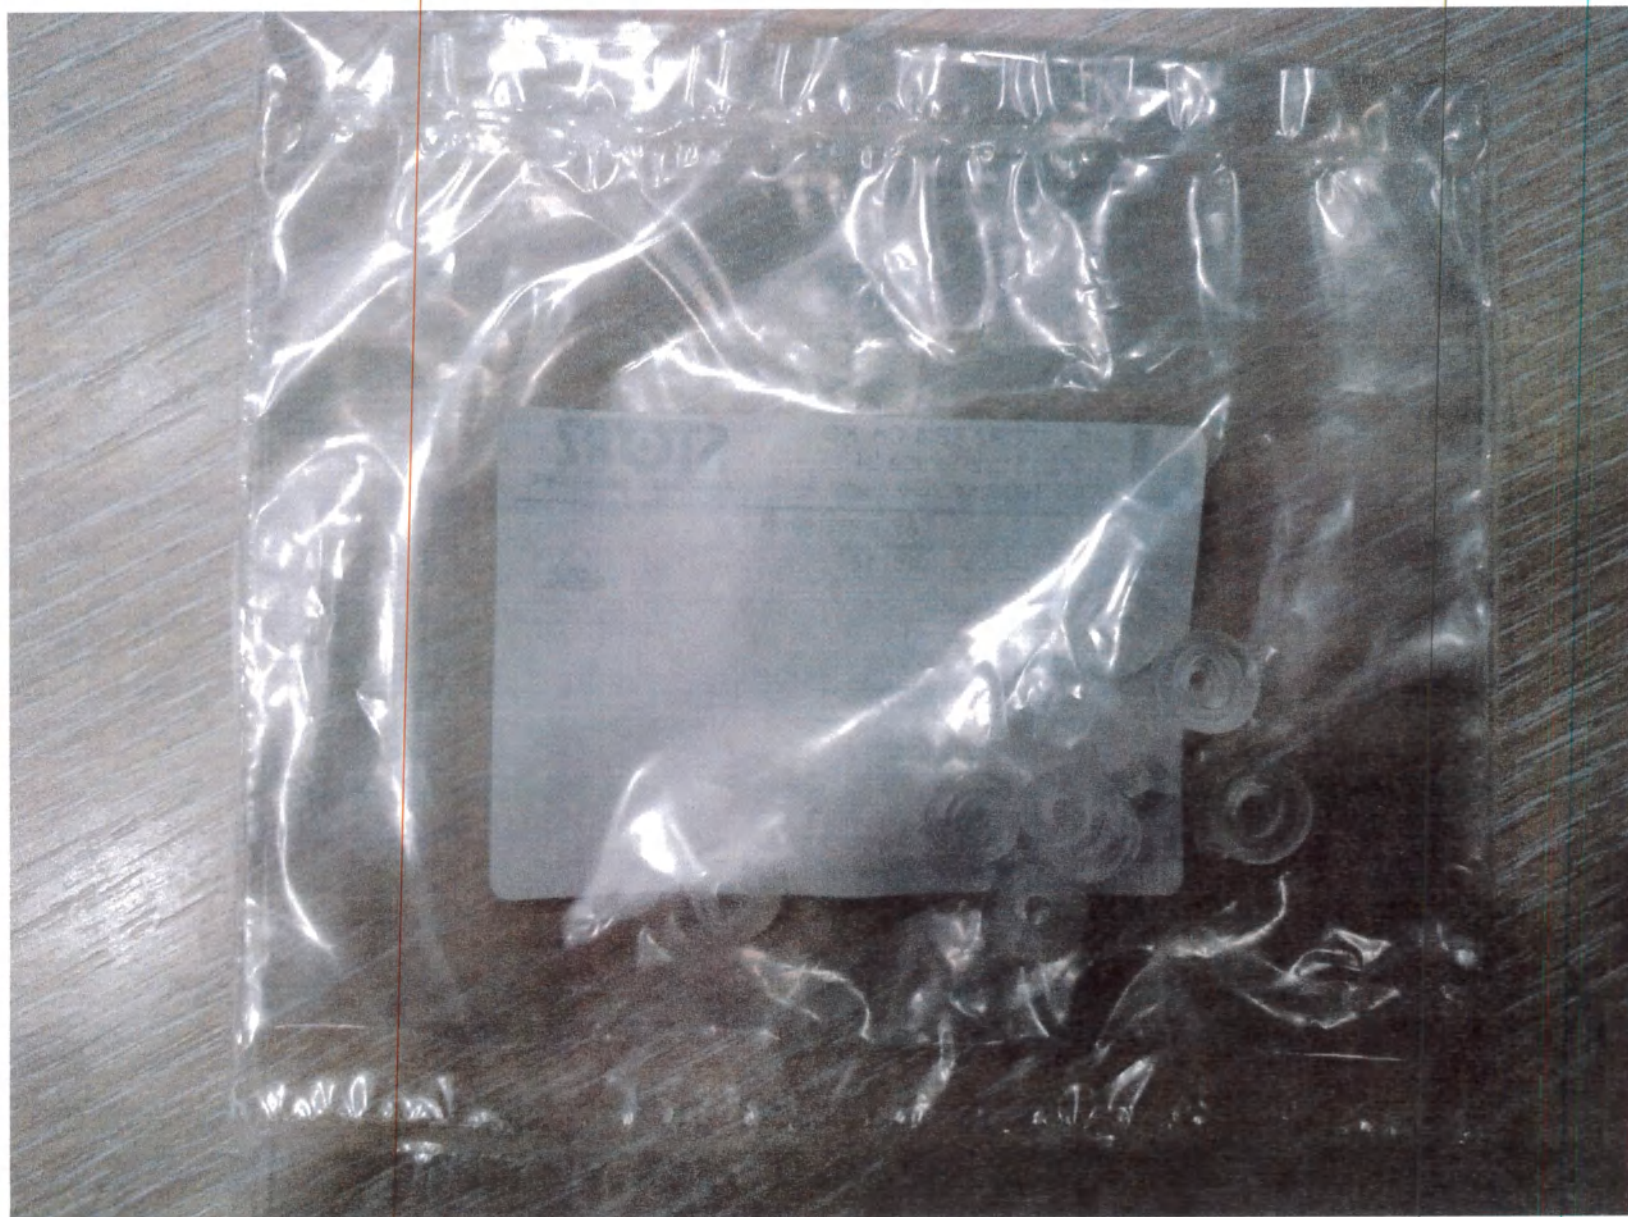

1.4. Уплотнитель для рабочего канала коннектора – 10 шт./уп

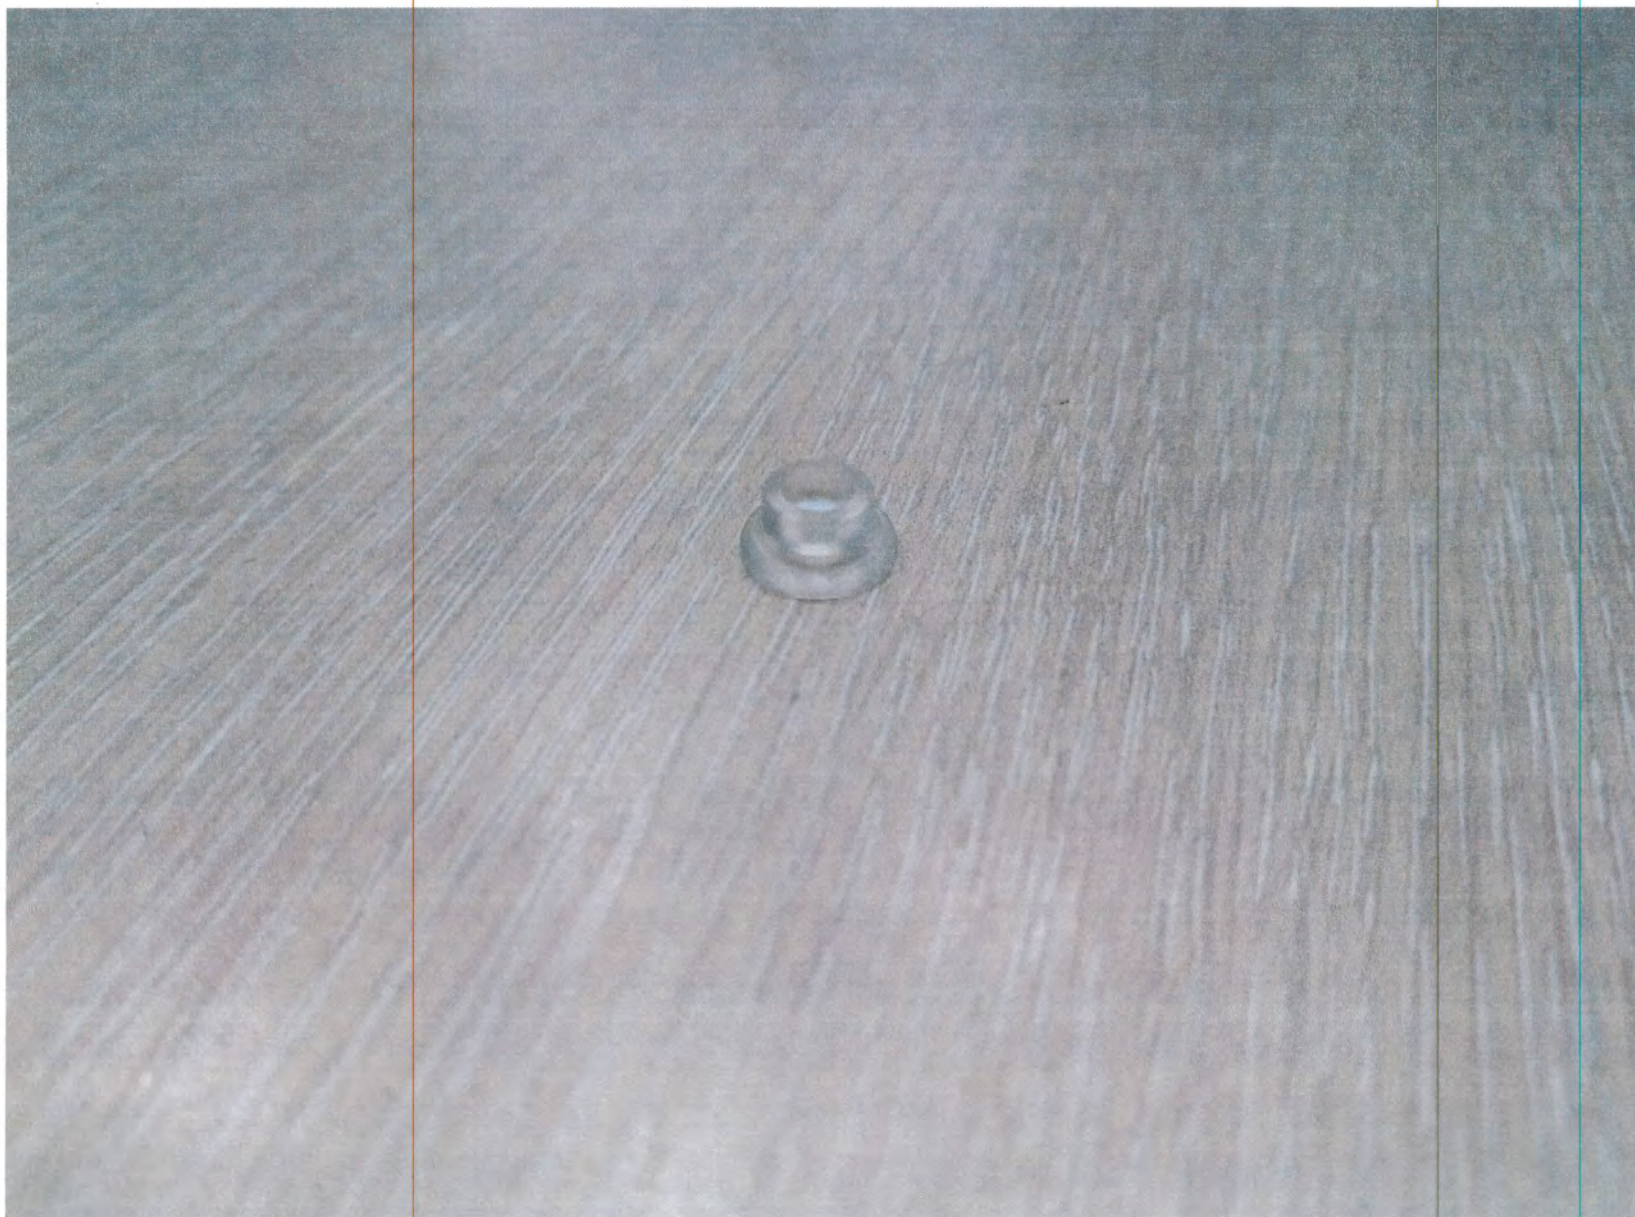

1.4. Уплотнитель для рабочего канала коннектора – 10 шт./уп. (маркировка)



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ ENDOSKOP

REF 11014DS

LOT 98883+99164

QTY 10

Dichtung Arbeitskanal Konnektor
Seal Working Channel Connector
Joint pour raccord au canal opérateur
Guarnizione canale operativo, connettore
Junta para canal de trabajo, conector
Vedação p/ conector de canal de trabalho




(01)04048551423202(240)11014DS(10)98883+99164

1.5. Адаптер для чистки – 1 шт.



1.5. Адаптер для чистки – 1 шт.

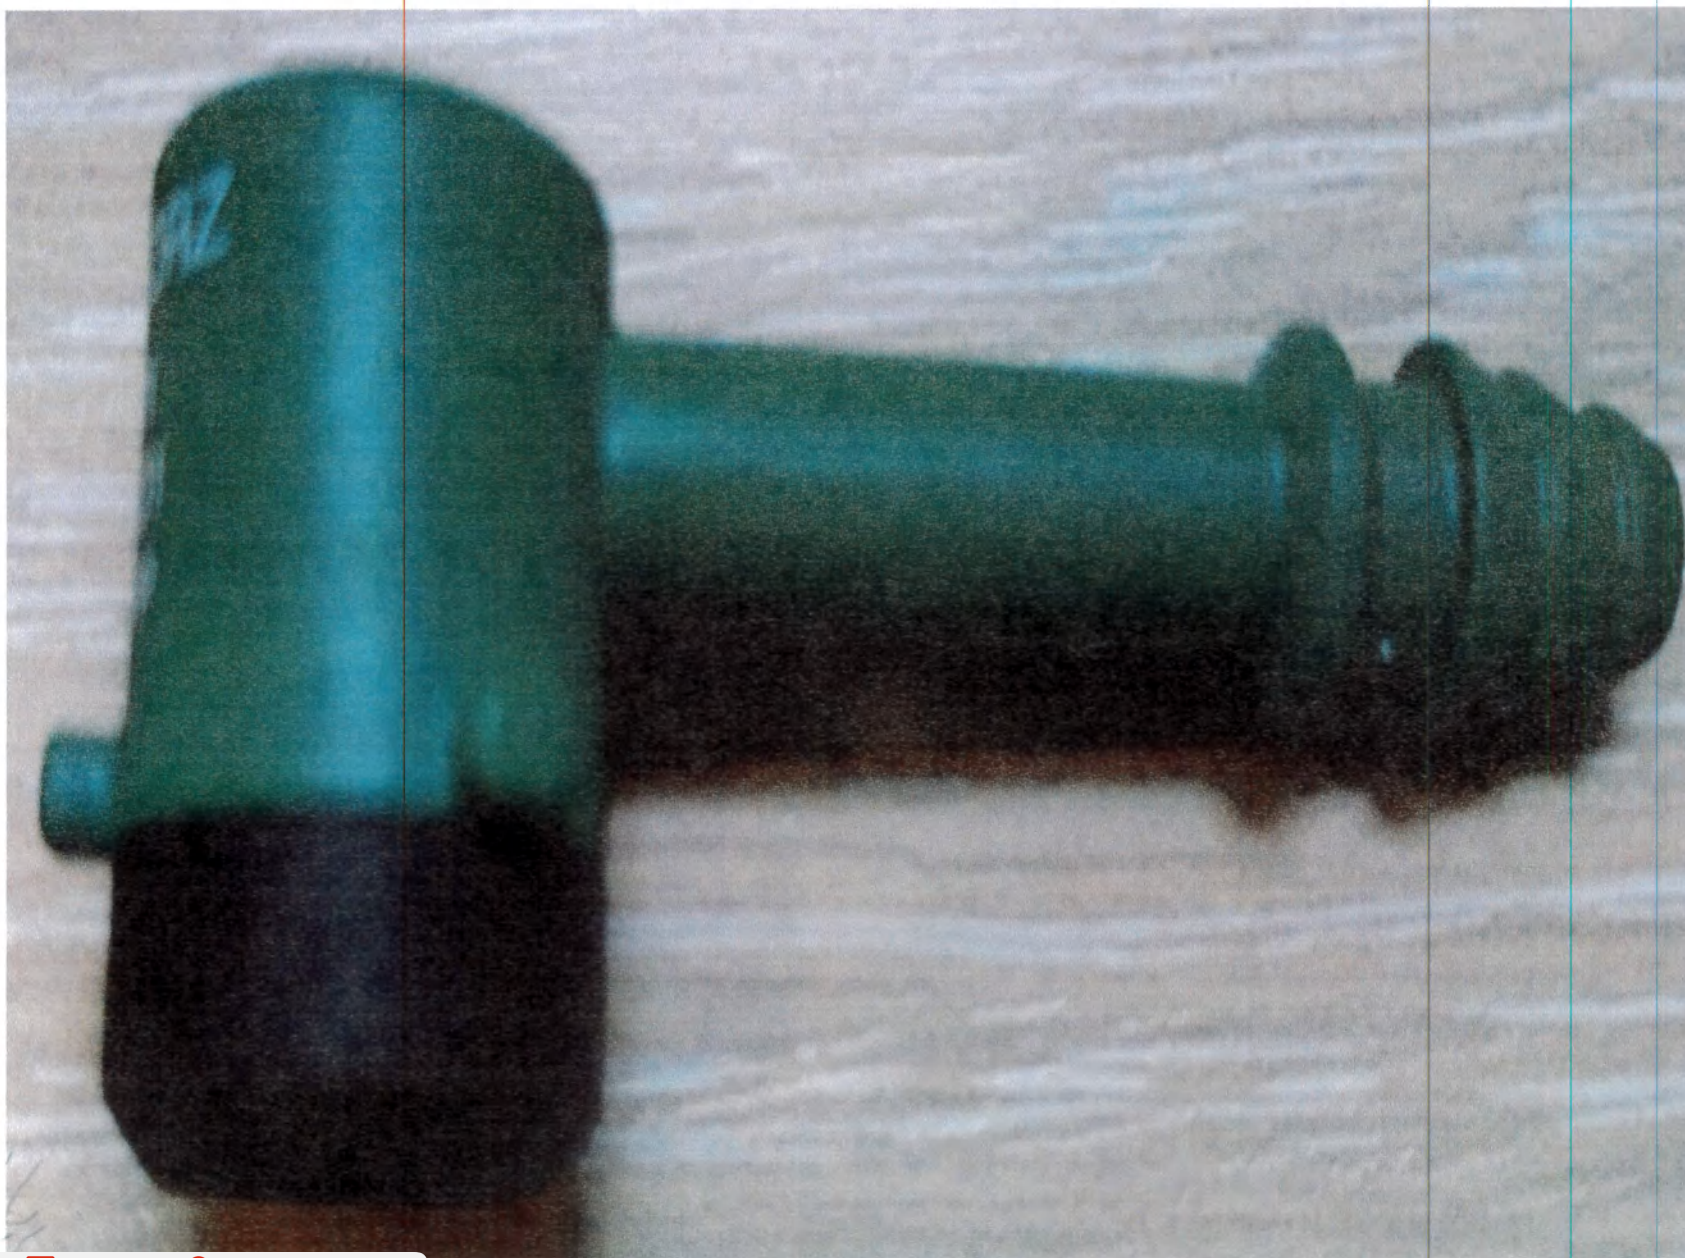

1.5. Адаптер для чистки – 1 шт. (маркировка)



1.6. Чемодан жесткий для видеоэндоскопа – 1 шт.



1.7. Прибор проверки герметичности– 1 шт.




1.8. Клапан выравнивания давления— 1 шт.



Druckausgleich-Kappe 11025 E


Anbringen vor

1. Gas-/Plasma Sterilisation
2. Entlüftung
3. Versand



Entfernen vor

1. Gebrauch am Patienten
2. Einlegen in Reinigungslösung



STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOP

1.9. Уплотнитель для седла аспирационного клапана – 1 шт.



1.10. Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

STORZ

KARL STORZ — ENDOSKOPE



GEBRAUCHSANWEISUNG
Flexibles Cystoskop HD-VIEW 11272VH/VHU




INSTRUCTION MANUAL
Flexible Cystoscope HD-VIEW 11272VH/VHU



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Гибкий цистоскоп HD-VIEW 11272VH/VHU



2. Видеоцистоуретроскоп гибкий HD- VIEW 11272 VHU (при необходимости) – не более 5 шт.

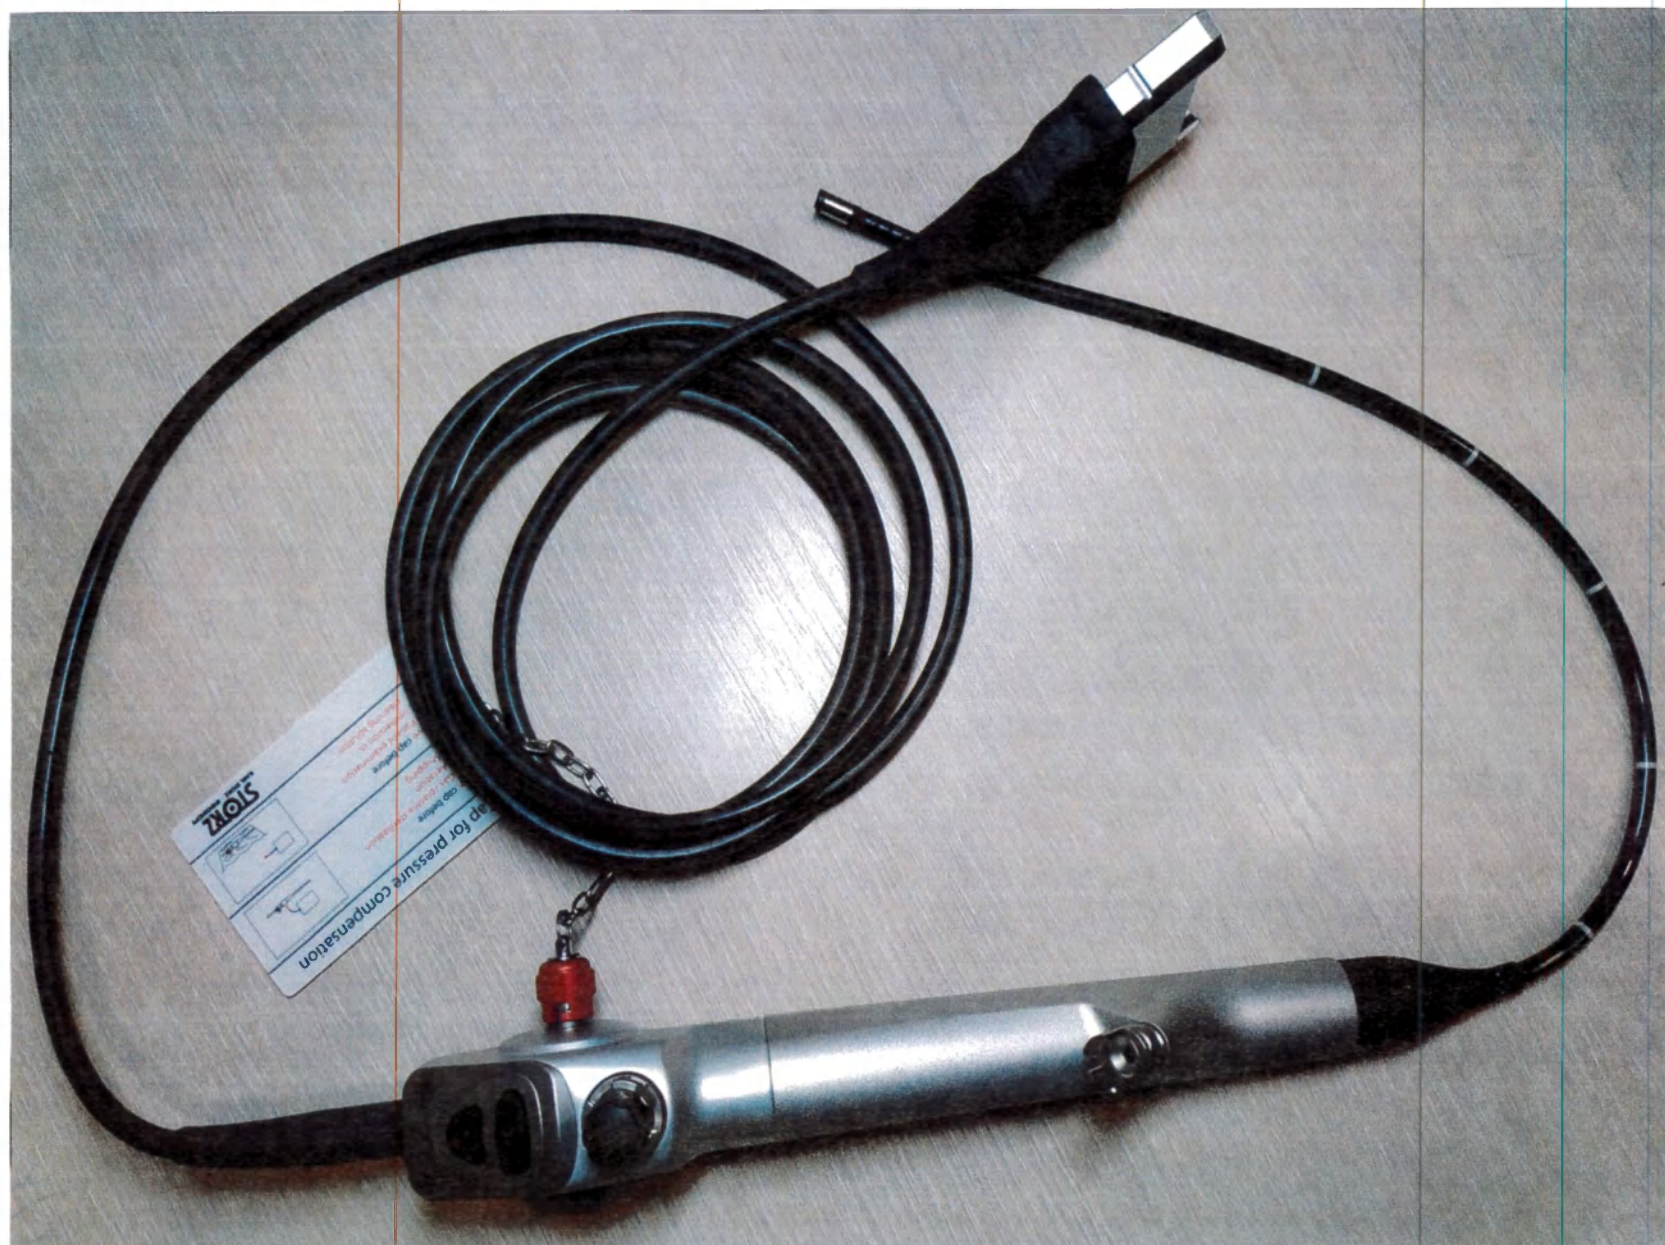

3. Щипцы захватывающие (при необходимости) – не более 100 шт.



3. Щипцы захватывающие (при необходимости) – не более 100 шт. (маркировка)

 **KARL STORZ SE & Co. KG**
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSCOPE

REF 27023FE

LOT PP02

QTY 1

Fasszange, 5 Charr., 73 cm
Grasping Forceps, 5 Fr., 73 cm
Pince à préhension, 5 Charr., 73 cm
Pinza da presa, 5 Charr., 73 cm
Pinzas de agarre, 5 Charr., 73 cm
Pinça de apreensão, 5 Fr., 73 cm







CE

(01)04048551073667(240)27023FE(10)PP02

4. Щипцы биопсийные (при необходимости) – не более 100 шт.

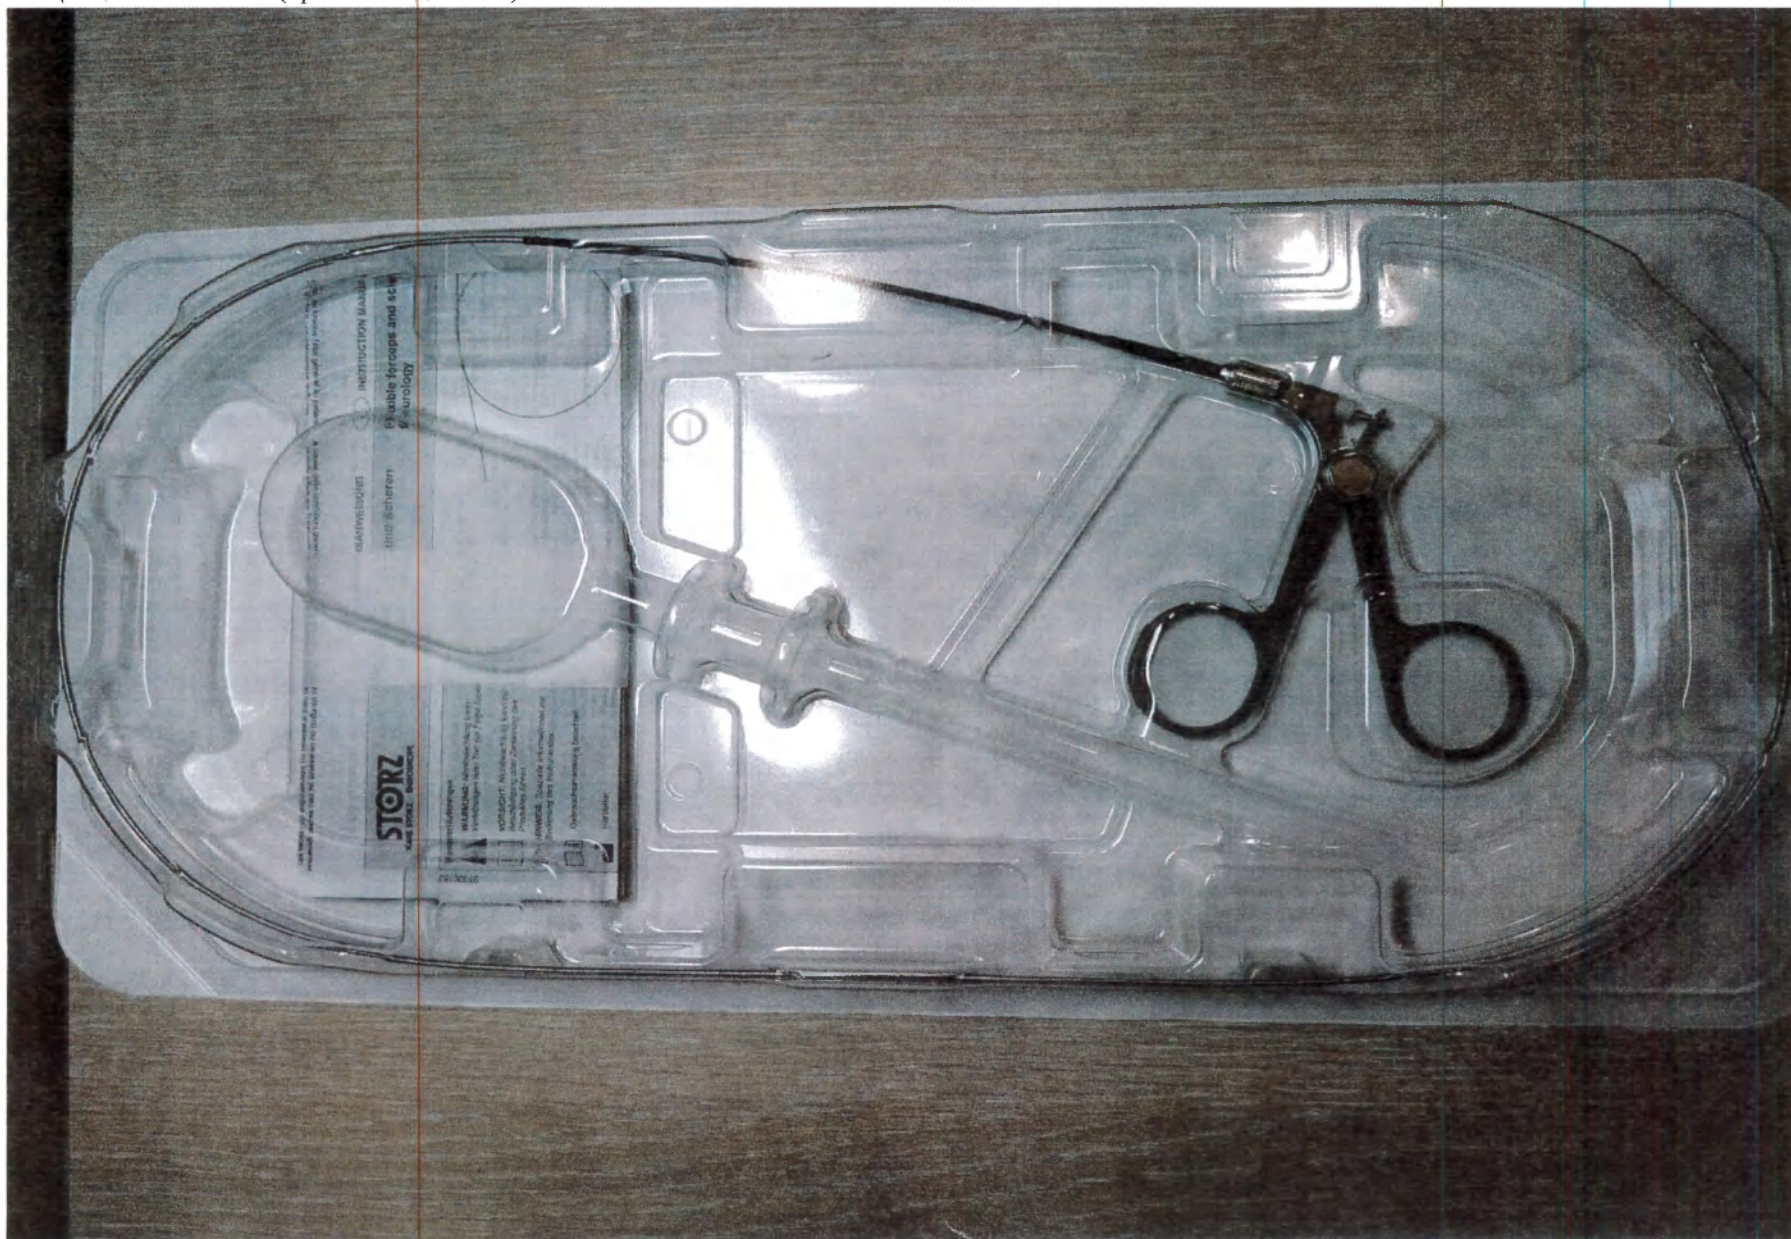

4. Щипцы биопсийные (при необходимости) – не более 100 шт. (маркировка)



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

REF	27023ZE	LOT	OP02
		QTY	1

Zange z. Probeexcision, 5 Charr., 73 cm
Biopsy Forceps, 5 Fr., 73 cm
Pince à biopsie, 5 Charr., 73 cm
Pinza da biopsia, 5 Charr., 73 cm
Pinzas para biopsia, 5 Charr., 73 cm
Pinça de biopsia, 5 Fr., 73 cm



CE

(01)04048551074008(240)27023ZE(10)OP02

5. Переходник двойной LUER (при необходимости) – не более 100 шт.



5. Переходник двойной LUER (при необходимости) – не более 100 шт.



5. Переходник двойной LUER (при необходимости) – не более 100 шт. (маркировка)



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ—ENDOSKOPE

REF 11014LU

Doppel LUER-Einlauf
Double LUER Port
Raccord LUER double
Attacco LUER doppio
Conexión LUER doble
Conexão LUER dupla

LOT TP01

QTY 1



RxONLY

CE 0123

(01)04048551422601(240)11014LU(10)TP01

6. Переходник LUER с кранами (при необходимости) – не более 100 шт.



6. Переходник LUER с кранами (при необходимости) – не более 100 шт.



6. Переходник LUER с кранами (при необходимости) – не более 100 шт. (маркировка)



7. Клапан аспирационный, одноразовый - 20шт./уп. (при необходимости) – не более 100 шт.



7. Клапан аспирационный, одноразовый - 20шт./уп. (при необходимости) – не более 100 шт.;



7. Клапан аспирационный, одноразовый - 20шт./уп. (при необходимости) — не более 100 шт. (маркировка)





KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

REF	11301CE1
LOT	RP
QTY	20

Abzugventil, zum Einmalgebrauch, 20x
Suction Valve for single use, 20x
Valve aspirat., usage unique, 20x
Valvola per aspirazione, monouso, 20x
Válvula de aspiración, un solo uso, 20x
Válvula de aspiração, descartável, 20x



CE 0123

(01)04048551314830(240)11301CE1(10)RP

8. Клапан аспирационный, многоразовый (при необходимости) – не более 100 шт.



8. Клапан аспирационный, многоходовый (при необходимости) – не более 100 шт.



8. Клапан аспирационный, многоразовый (при необходимости) – не более 100 шт. (маркировка)



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE

REF	11301CB1	LOT	NP
		QTY	1

Absaugventil, wiederverwendbar
Suction Valve, reusable
Valve d'aspiration, réutilisable
Valvola per aspirazione, riutilizzabile
Válvula de aspiración, reutilizable
Válvula de aspiração, reutilizável



00104048551314823(240)11301CB1(10)NP

CE 0123

9. Захват корзинчатый для камней, одноразовый (при необходимости) – не более 100 шт.





KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany


STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

Ø 12 mm, 70 cm
straight/tipless

REF 27023KF

LOT 20408

QTY 1



Steinfangkörbchen, 3,0 Charr.

Stone Basket, 3.0 Fr.

Panier extracteur de calculs, 3,0 Ch.

Cestello per calcoli, 3,0 Charr.

Cestilla para extracción de cálculos, 3,0 Charr.

Cesto coletor de cálculos, 3,0 Fr.



2024-10-28



V1710

STERILE EO

RxONLY



0123

(01)04048551390160(240)27023KF(17)241028(10)20408

REF 27023KF

QTY 1 LOT 20408

CE 0123



STERILE EO



RxONLY

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE



2024-10-28

REF 27023KF

QTY 1 LOT 20408

CE 0123



STERILE EO



RxONLY

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE



2024-10-28

REF 27023KF

QTY 1 LOT 20408

CE 0123



STERILE EO



RxONLY

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE



2024-10-28


Rev 1: Date: 2017-12-20

9. Захват корзинчатый для камней, одноразовый (при необходимости) – не более 100 шт. (маркировка)

10. Фиксатор лазерного волокна (при необходимости) – не более 100 шт.



10. Фиксатор лазерного волокна (при необходимости) – не более 100 шт.

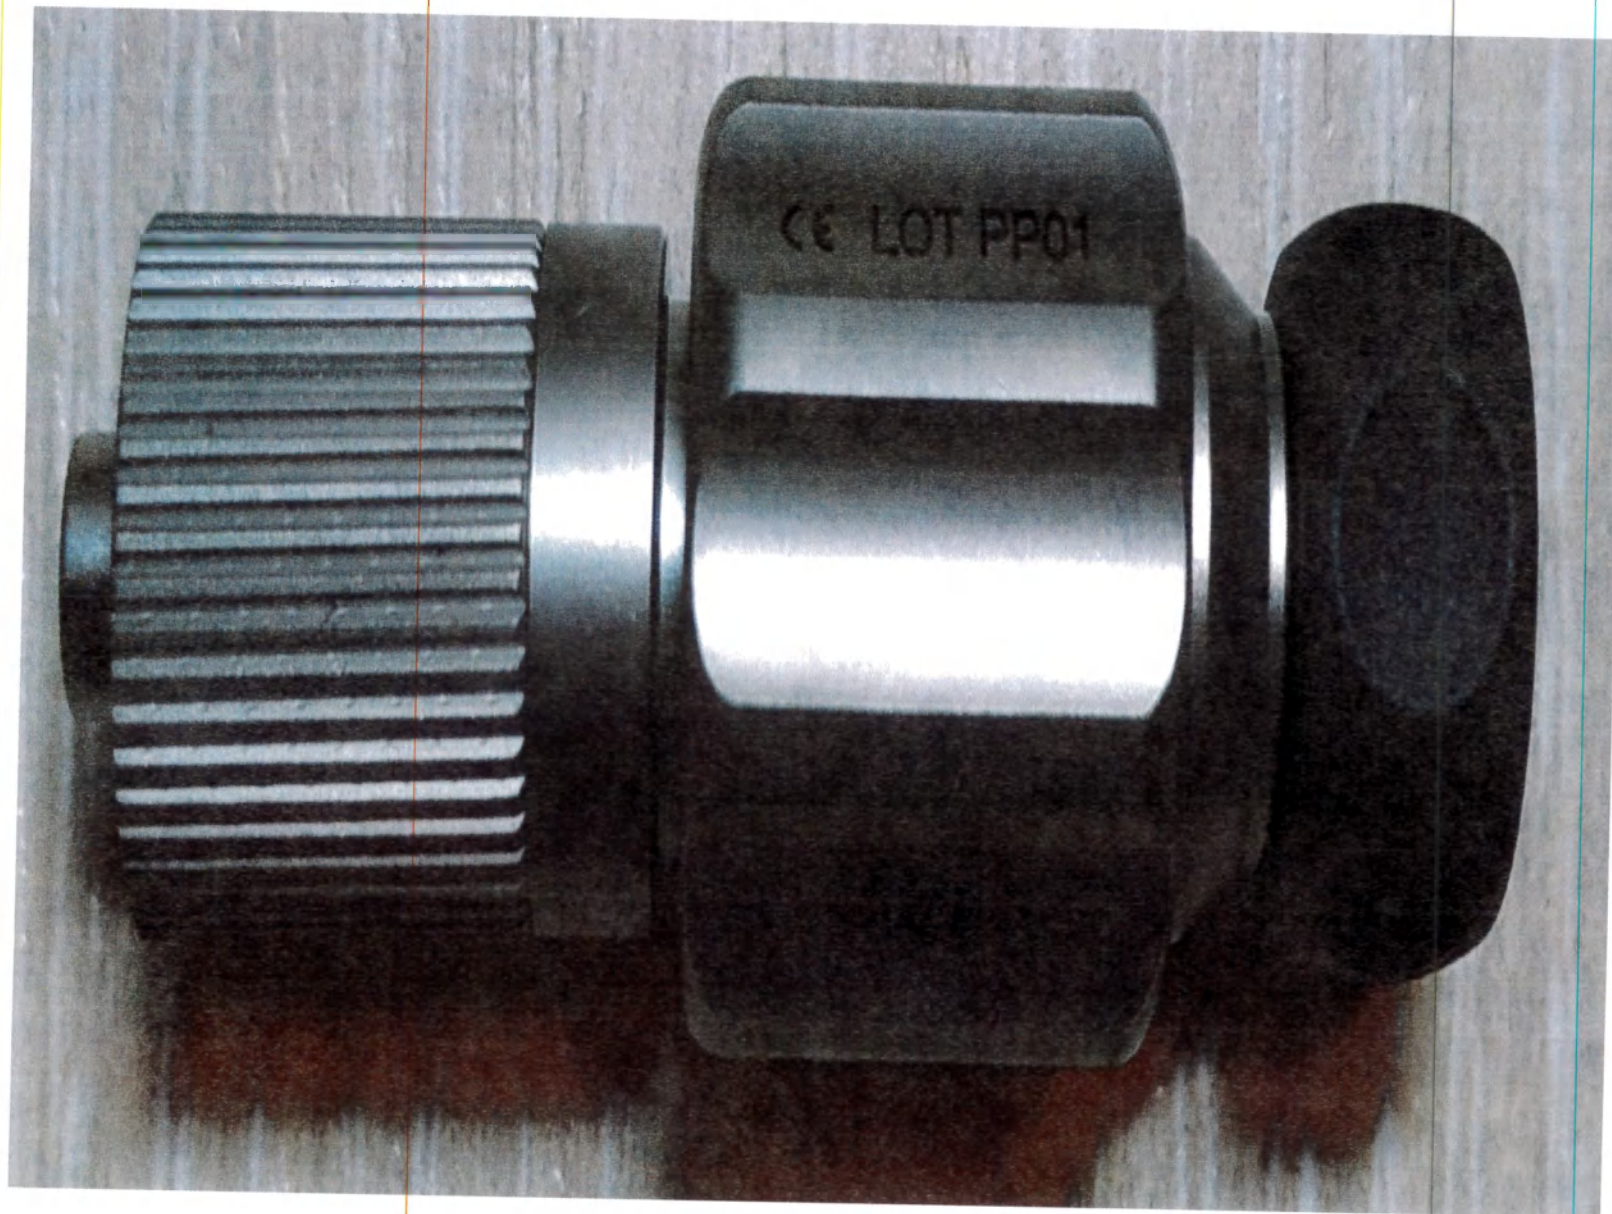


10. Фиксатор лазерного волокна (при необходимости) – не более 100 шт. (маркировка)



11. Адаптер для чистки инструментальных портов (при необходимости) – не более 100 шт.



11. Адаптер для чистки инструментальных портов (при необходимости) – не более 100 шт.

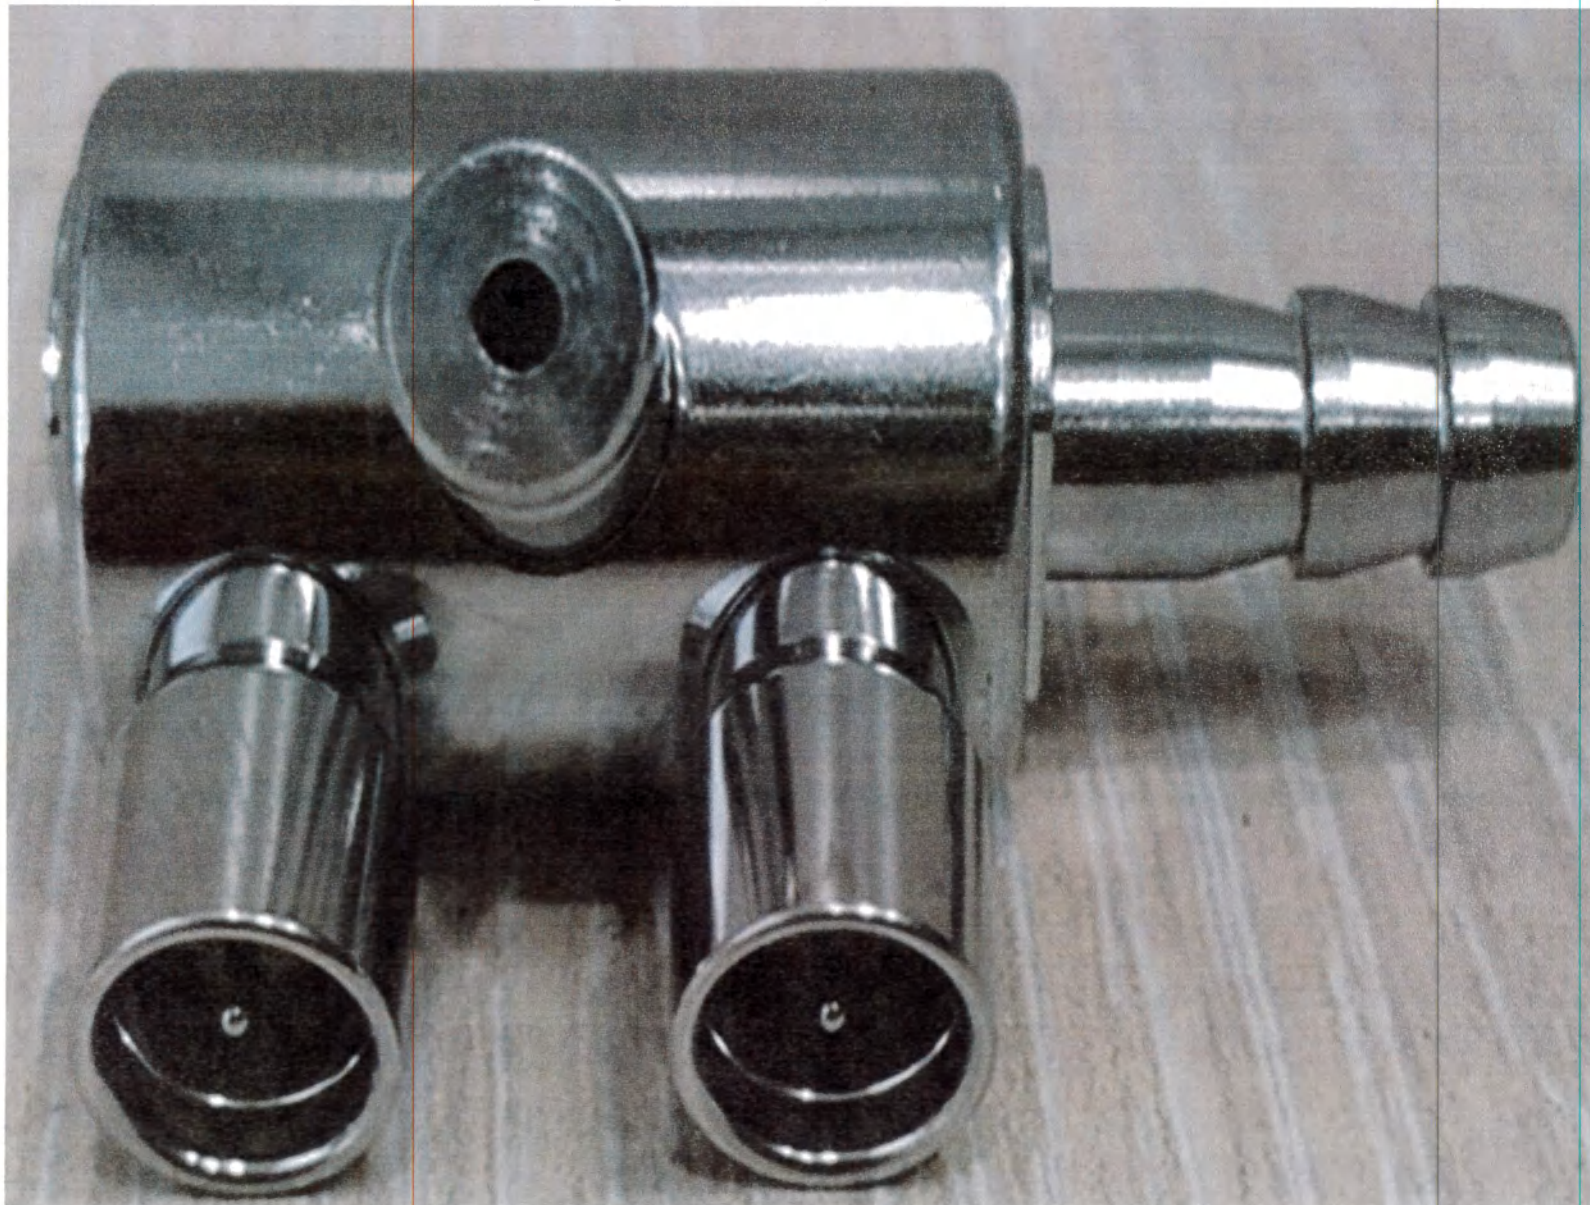

11. Адаптер для чистки инструментальных портов (при необходимости) – не более 100 шт. (маркировка)





12. Захват корзинчатый для камней, многоходовый:

12. Захват корзинчатый для камней, многоразовый (при необходимости) – не более 100 шт. (маркировка)



00340485512030247224

STORZ
KARL STORZ – ENDOSKOPE

REF 27023VK

QTY 1




Steinfänger, 5 Charr.
Stone Basket, 5 Fr.
(01)04048551073841(240)27023VK

bestehend aus: / consisting of

REF 27023VT

QTY 1



Dreiringgriff, für 27023VK
3-Ring Handle, for 27023VK
(01)04048551073926(240)27023VT(10)RP01

Batch RP01

REF 27023VR

QTY 3



Korbchen, für 27023VK
Basket, for 27023 VK
(01)04048551073889(240)27023VR(10)RP01

Batch RP01

REF 27023VS

QTY 3



Spirale, für 27023VK
Coil for 27023VK

Batch RP02

(01)04048551073902(240)27023VS(10)PP02


Product information see inside

KARL STORZ SE & Co. KG • PO Box 230 • 78503 Tuttlingen/Germany

LA
tan
me

either H
nd w
st

12.1 Рукоятка (при необходимости) – не более 100 шт.

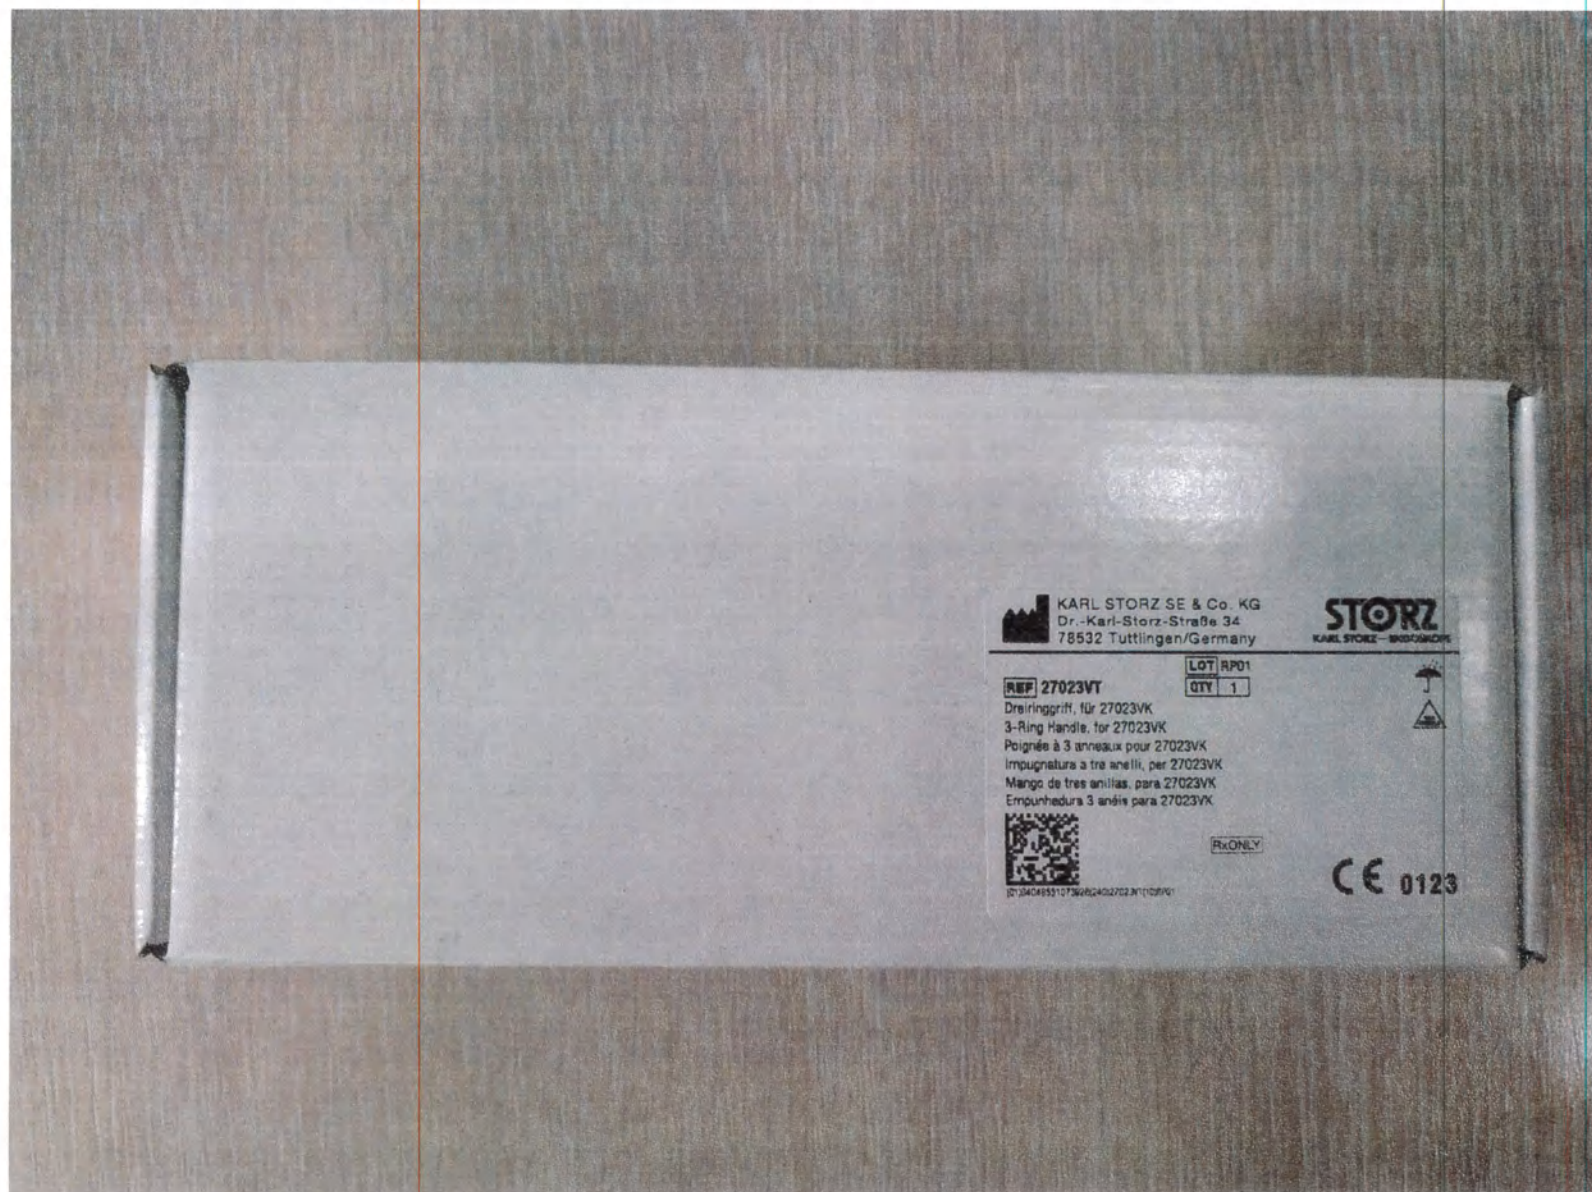

12.1 Рукоятка (при необходимости) – не более 100 шт.



12.1 Рукоятка (при необходимости) – не более 100 шт.




12.1 Рукоятка (при необходимости) – не более 100 шт. (маркировка)

	KARL STORZ SE & Co. KG Dr.-Karl-Storz-Straße 34 78532 Tuttlingen/Germany	STORZ KARL STORZ — ENDOSKOPE
REF 27023VT	LOT RP01	 
Dreiringgriff, für 27023VK 3-Ring Handle, for 27023VK Poignée à 3 anneaux pour 27023VK Impugnatura a tre anelli, per 27023VK Mango de tres anillas, para 27023VK Empunhadura 3 anéis para 27023VK	QTY 1	
	RxONLY	CE 0123
(01)04048551073926(240)27023VT(10)RP01		

12.2 Корзинка (при необходимости) – не более 100 шт.



12.2 Корзинка (при необходимости) – не более 100 шт.

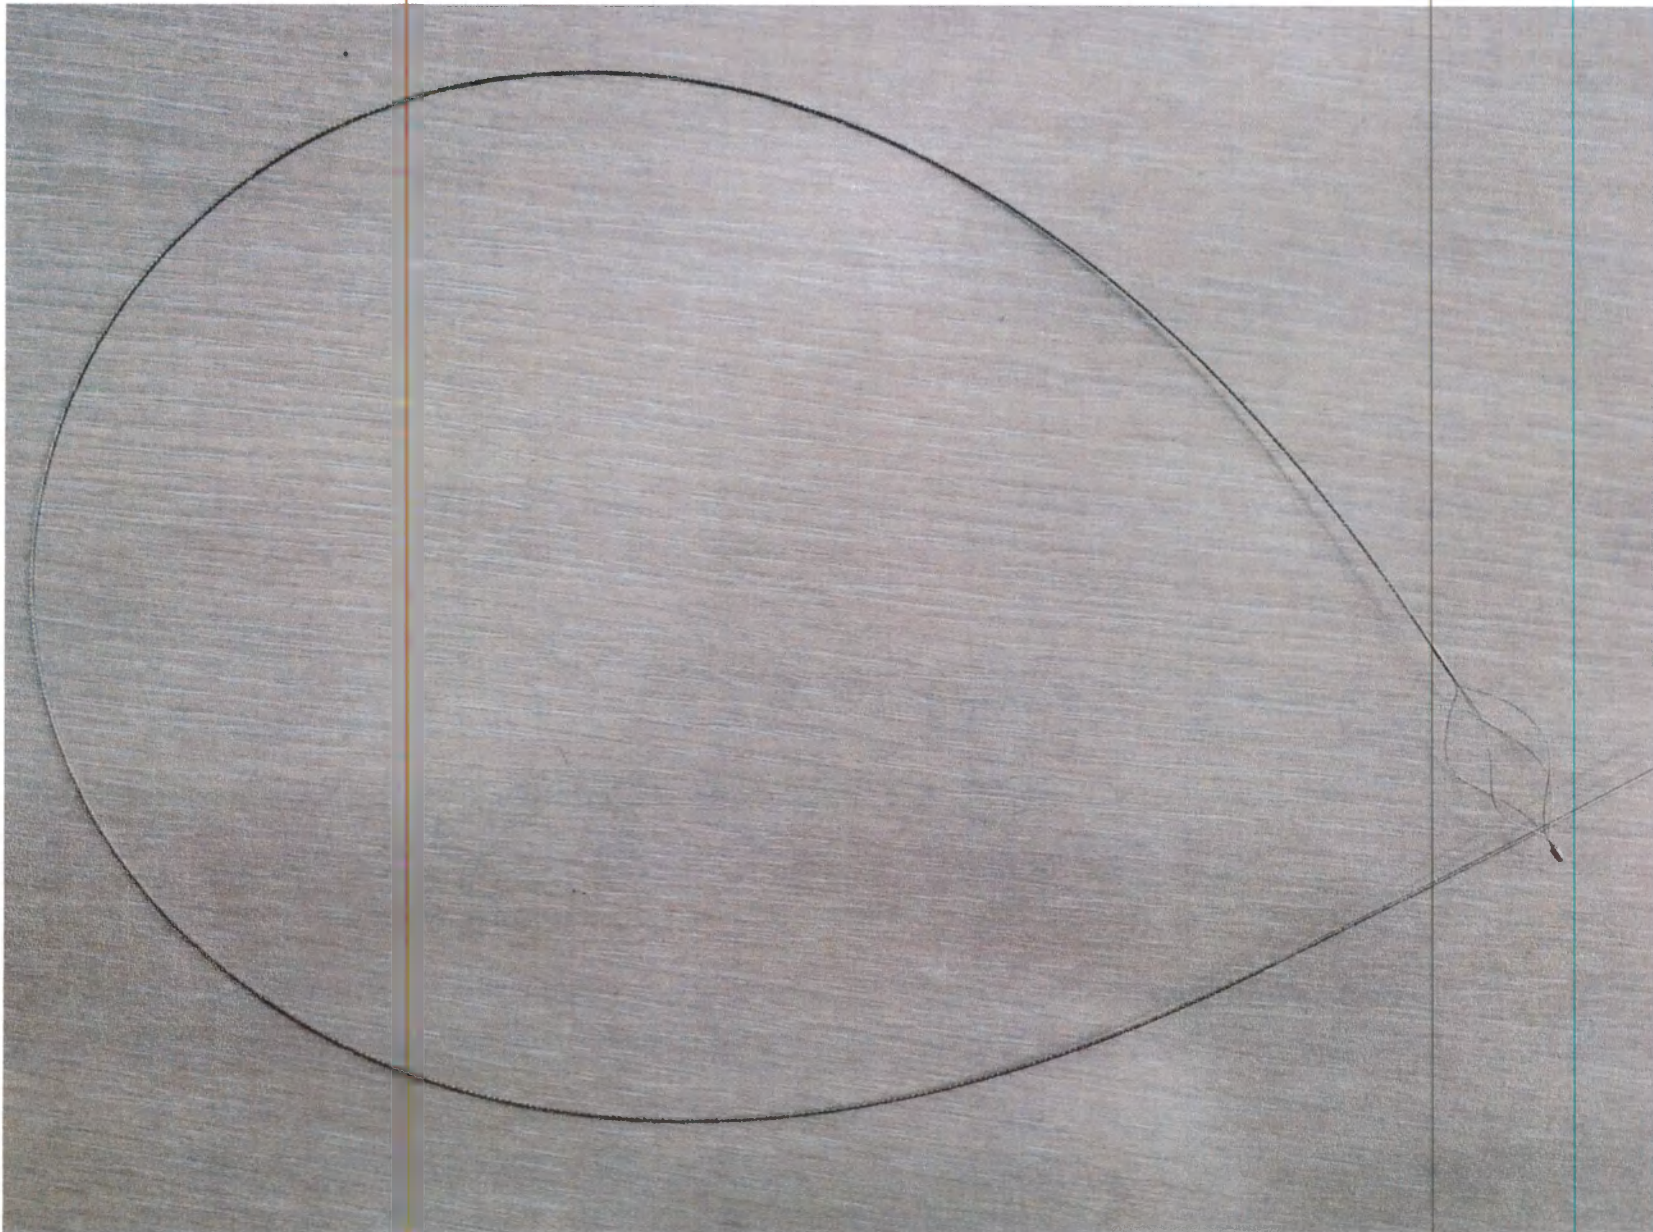

12.2 Корзинка (при необходимости) – не более 100 шт. (маркировка)



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ – ENDOSCOPE

REF 27023VR

Körbchen, für 27023VK

Basket, for 27023 VK

Panier pour 27023 VK

Cestello, per 27023VK

Cestilla para 27023VK

Cesta para 27023VK

LOT RP01

QTY 1




(*)104048551073889(240)27023VR1 QRP01

CE 0123

12.3 Тубус внешний (при необходимости) – не более 100 шт.



12.3 Тубус внешний (при необходимости) – не более 100 шт.

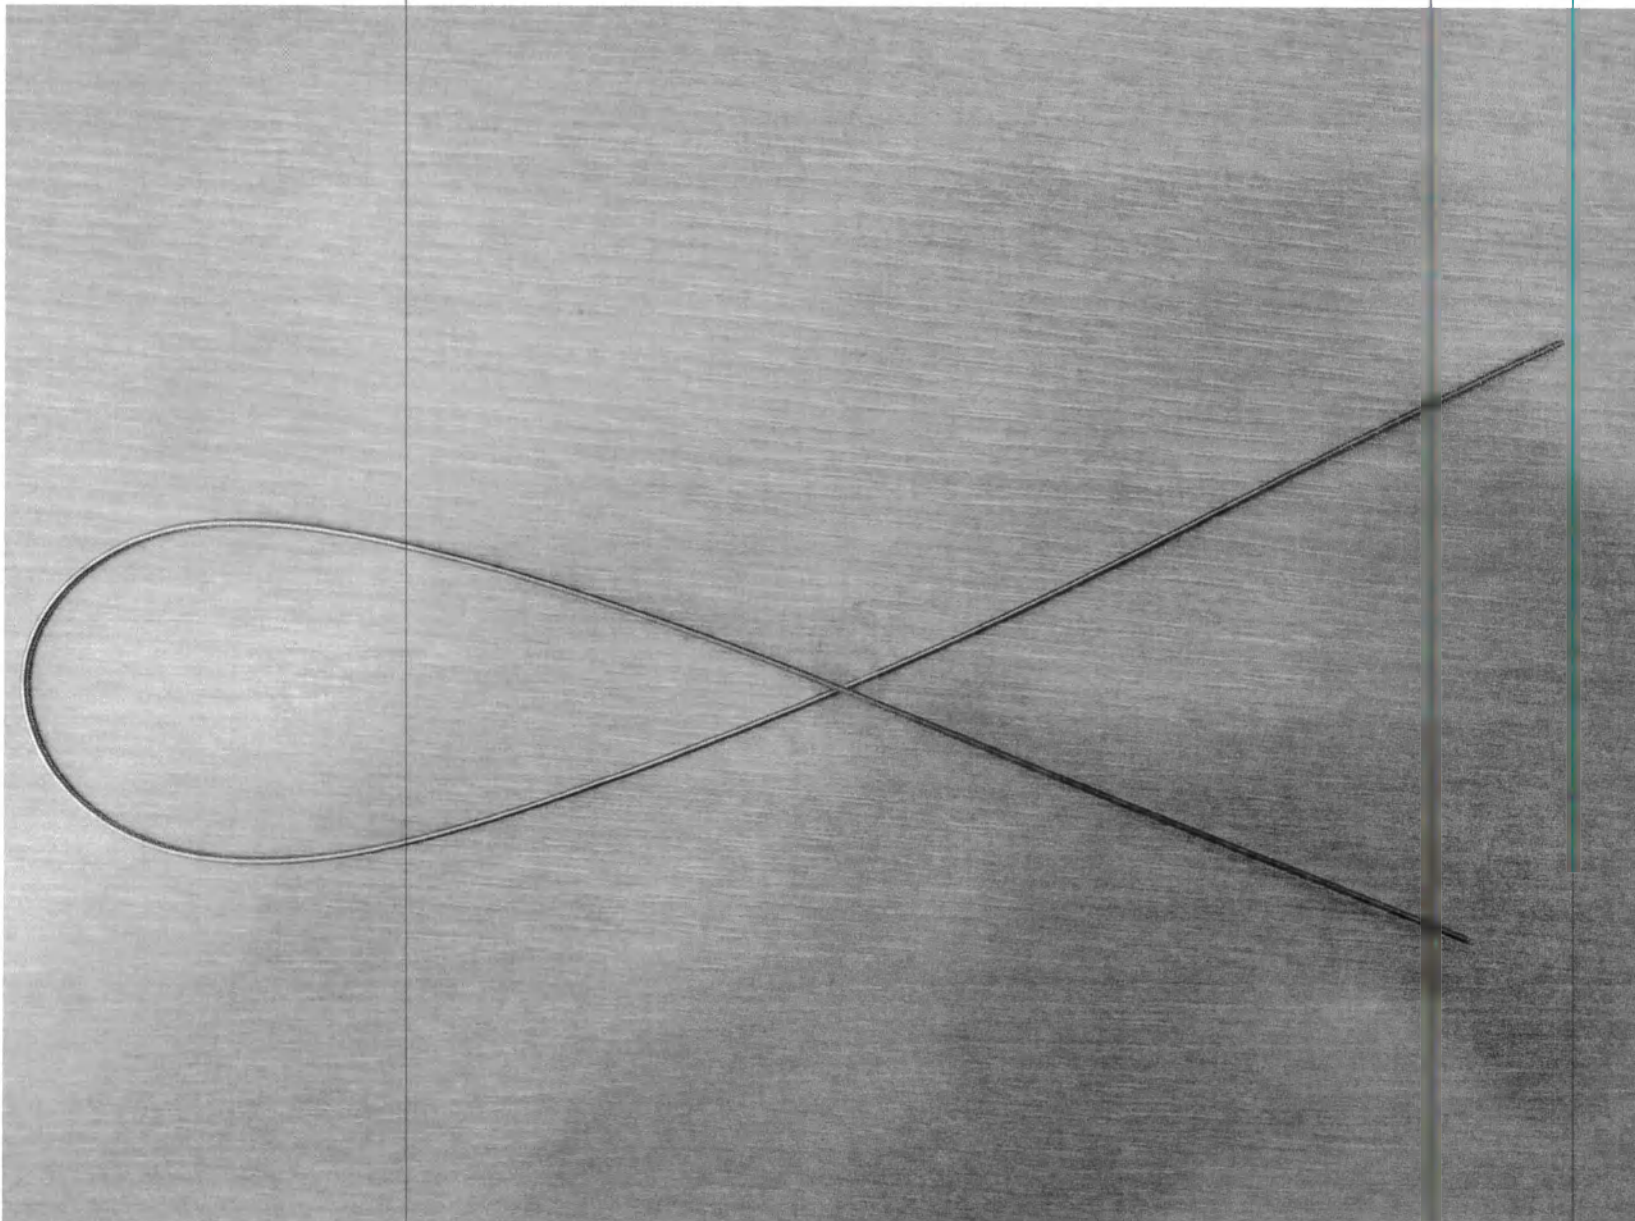

12.3 Тубус внешний (при необходимости) – не более 100 шт. (маркировка)



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

LOT	PP02
QTY	1

REF 27023VS

Spirale, für 27023VK

Coil, for 27023VK

Gaine spiralée pour 27023VK

Spirale, per 27023VK

Espiral, para 27023VK

Espiral, para 27023VK



(01)04-048551073902(240)27023VS(10)PP02



CE 0123

13. Уплотнитель для инструментального порта 10 шт./уп. (при необходимости) – не более 10 уп.



13. Уплотнитель для инструментального порта 10 шт./уп. (при необходимости) – не более 10 уп.



13. Уплотнитель для инструментального порта 10 шт./уп. (при необходимости) – не более 10 уп. (маркировка)



KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

REF	27550N
LOT	SP
QTY	10

Dichtung, 10x
Seal, 10x
Joint, paquet de 10
Guarnizione, 10x
Junta, 10 x
Vedação, 10x




0160495513837681240127550N101SP

1. Контейнер пластмассовый для гибких эндоскопов.

- [illegible]

Принадлежности:

1. Контейнер пластмассовый для гибких эндоскопов.

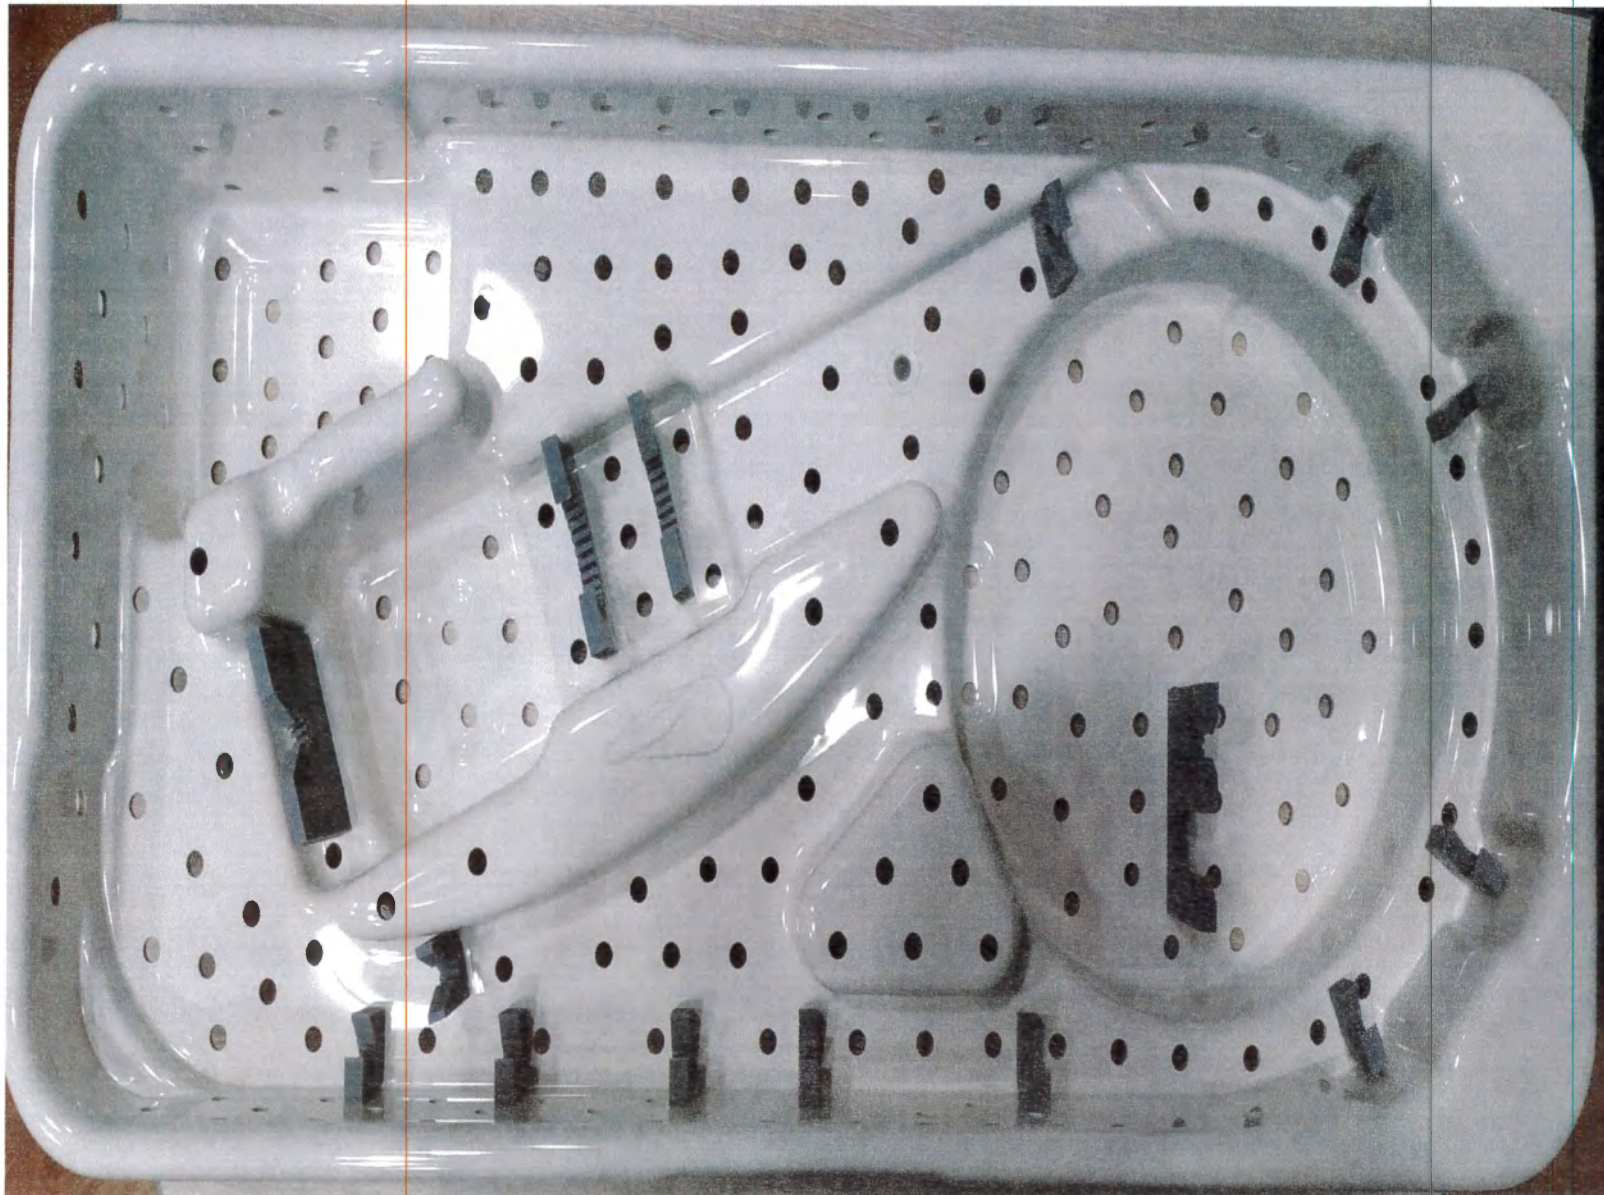

Принадлежности:

1. Контейнер пластмассовый для гибких эндоскопов. (маркировка)



