



НИАРМЕДИК

Россия, 125252, г. Москва,
ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12,
БЦ «Линкор», корпус «А», 2 этаж

Тел.: +7 (495) 741 49 89
Факс: +7 (499) 193 43 50

e-mail: info@nearmedic.ru
www.nearmedic.ru

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»

Ностеренко В.Г.

« 26 » июня 2019 г.



Фотографические изображения медицинского изделия
для in vitro диагностики

**Экспресс-система для выявления
наркотических веществ и алкоголя в слюне человека**



Фотография 1.

1. Общий вид МИ - «Экспресс-система для выявления наркотических веществ и алкоголя в слюне человека» в варианте исполнения – Экспресс-система для выявления 11 групп наркотических веществ и алкоголя в слюне человека:

Экспресс-система для выявления 11 групп наркотических веществ и алкоголя в слюне человека


Содержит:

- Контейнер с 12 тест-полосками для выявления 11 групп наркотических веществ и алкоголя в слюне человека: Амфетамин, Кокаин, Марихуана, Метамфетамин, Опиаты, Метадон, Фенциклидин, Оксикодон, Бензодиазепины, Бупренорфин, Барбитураты, Алкоголь
- Коллектор для сбора слюны
- Инструкция по применению


Вскрывать упаковку только перед тестированием.
Беречь от детей.



4. Общий вид МИ - «Экспресс-система для выявления наркотических веществ и алкоголя в слюне человека» в варианте исполнения – Экспресс-система для выявления 11 групп наркотических веществ в слюне человека:

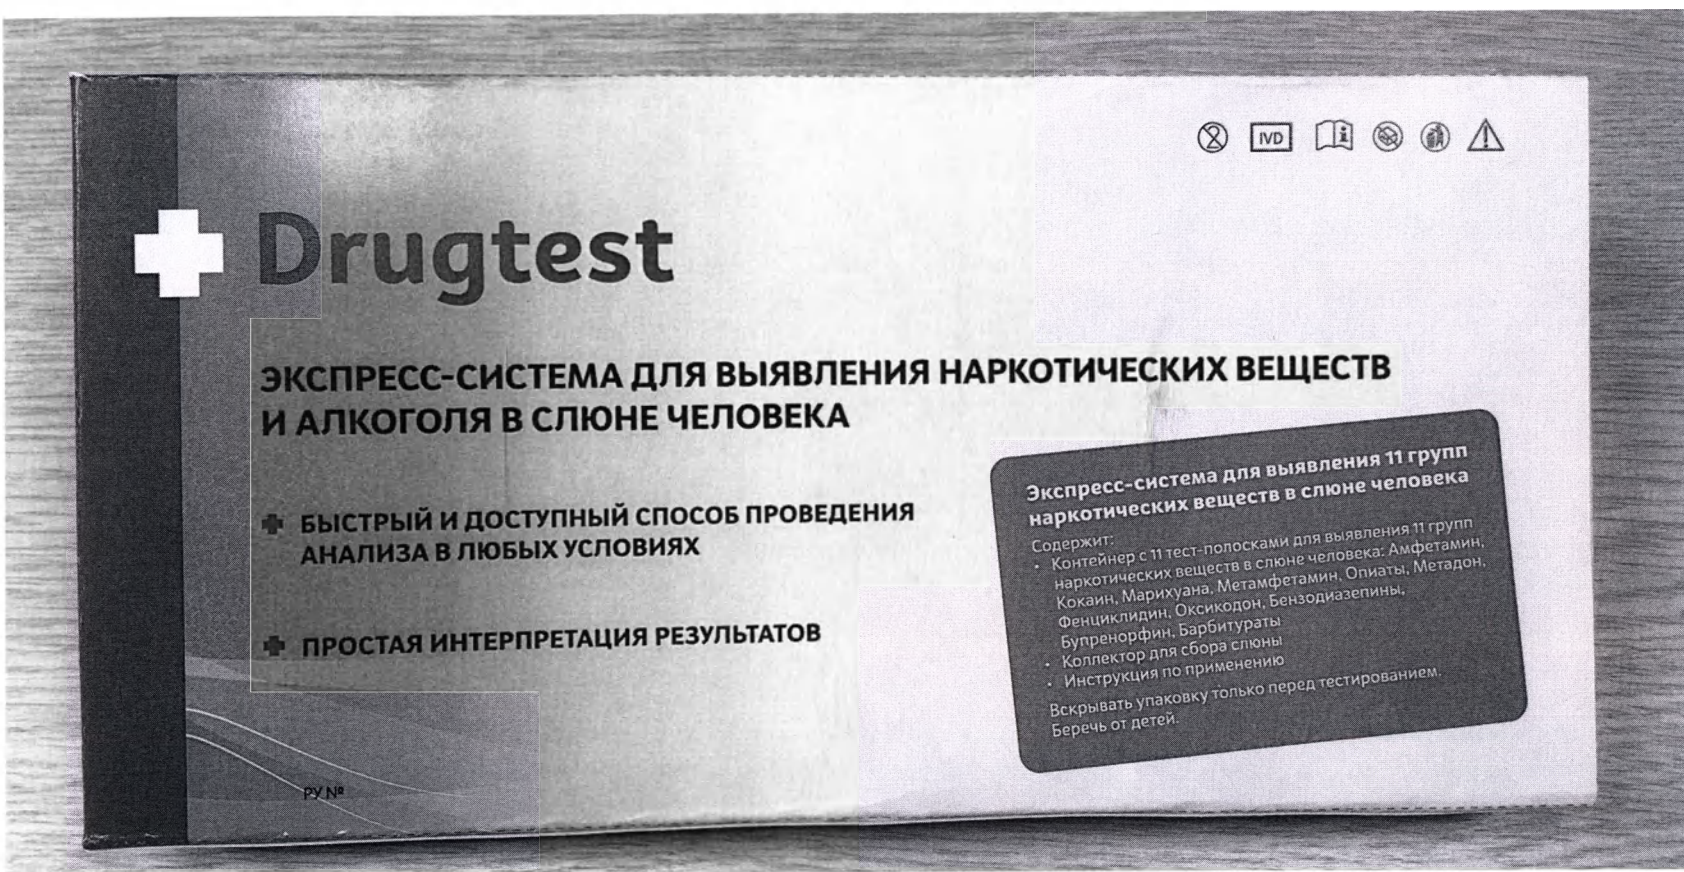

Фотография 1.

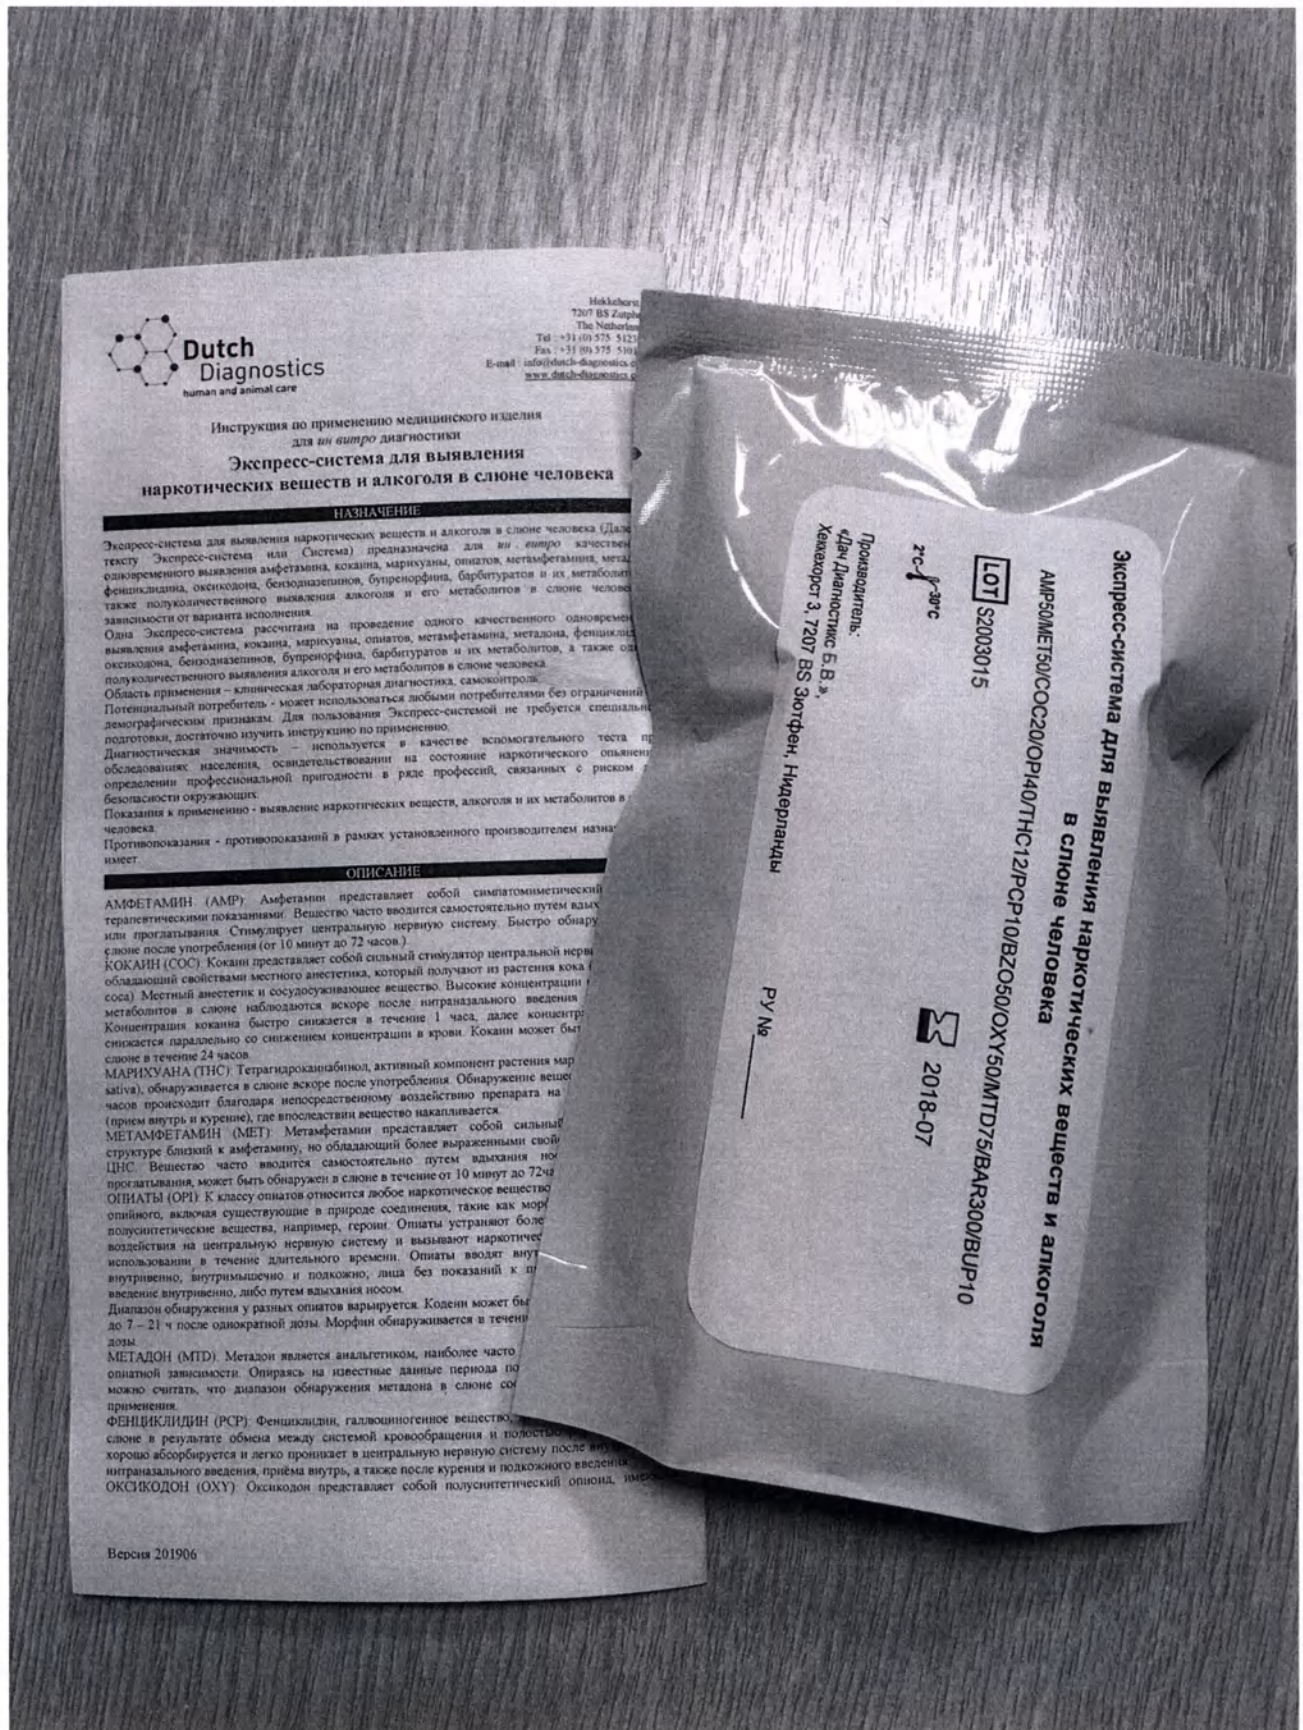

Фотография 3.



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

7 (семь) листов
цифрами прописью

Генеральный директор ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»

Нестеренко В.Г.

« 26 » июня 2019 г.





НИАРМЕДИК

Россия, 125252, г. Москва,
ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12,
БЦ «Линкор», корпус «А», 2 этаж

Тел.: +7 (495) 741 49 89
Факс: +7 (499) 193 43 50

e-mail: info@nearmedic.ru
www.nearmedic.ru

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»

Нестеренко В.Г.


« 26 » июня 2019 г.




Макет маркировки медицинского изделия
для in vitro диагностики

**Экспресс-система для выявления
наркотических веществ и алкоголя в слюне человека**

1. Макет маркировки «Экспресс-система для выявления наркотических веществ и алкоголя в слюне человека» в варианте исполнения – Экспресс-система для выявления 11 групп наркотических веществ и алкоголя в слюне человека (Фото 1):

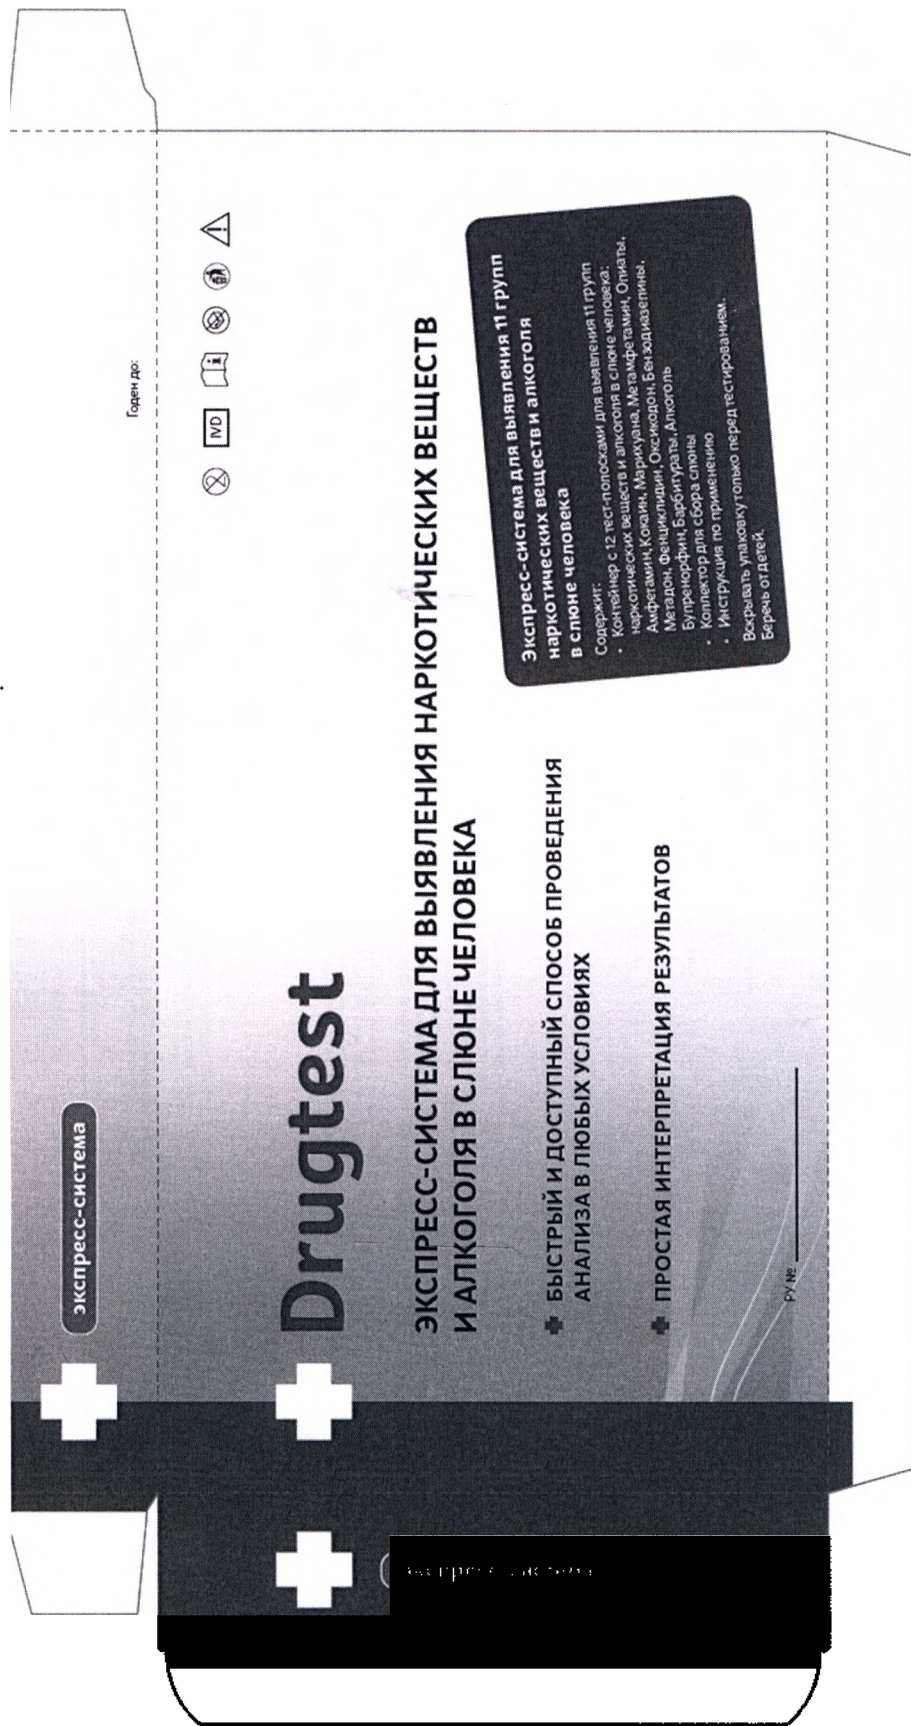

2. Макет маркировки «Экспресс-система для выявления наркотических веществ и алкоголя в слюне человека» в варианте исполнения – Экспресс-система для выявления 11 групп наркотических веществ и алкоголя в слюне человека (Фото 2):

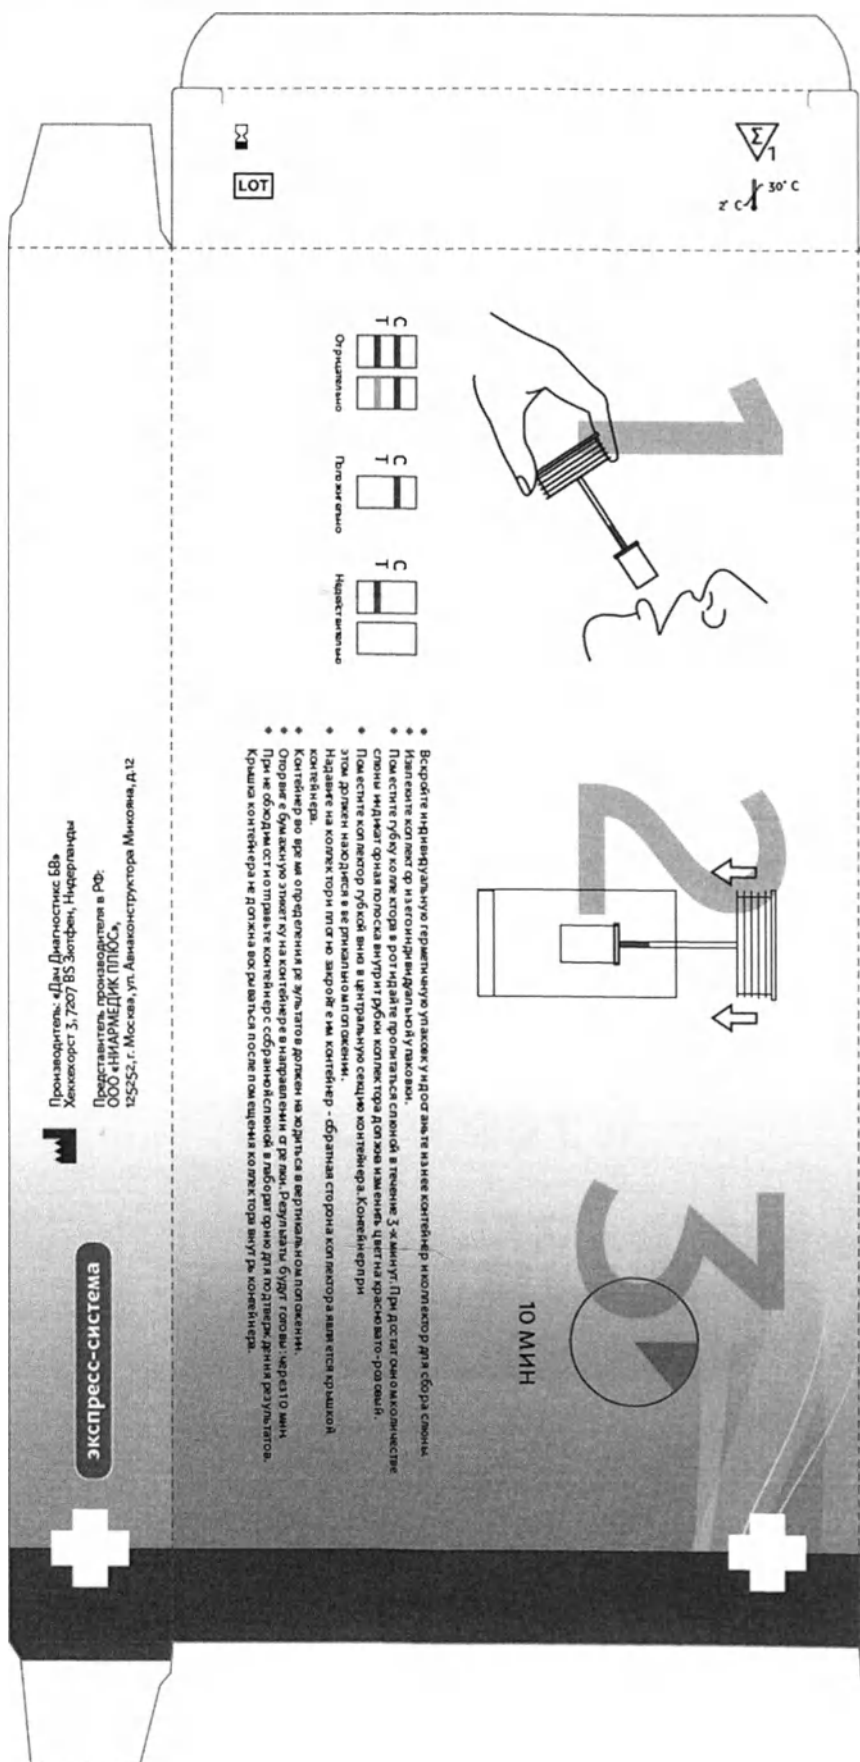

3. Макет маркировки первичной (индивидуальной) упаковки МИ в варианте исполнения – Экспресс-система для выявления 11 групп наркотических веществ и алкоголя в слюне человека:

**Экспресс-система для выявления наркотических веществ и алкоголя
в слюне человека**

AMP50/MET50/COC20/OPI40/THC12/PCP10/BZO50/OXY50/MTD75/BAR300/BUP10/ALC20

LOT

XXXXXXXXXX

XXXX-XX

2°C — 30°C

Производитель:
«Дач Диагностика Б.В.»,
Хеккехорст 3, 7207 BS Зютфен, Нидерланды

РУ № _____

4. Макет маркировки Коллектора для сбора слюны:

**Коллектор
для сбора слюны**

STERILE R

Лот:

Годен до:

5. Макет маркировки Контейнера с 12 тест-полосками для выявления 11 групп наркотических веществ и алкоголя в слюне человека:

Drugtest

Экспресс-система для выявления
11 групп наркотических веществ
и алкоголя в слюне человека

Для просмотра результата
удалите этикетку

Потянуть в направлении стрелки

ФИО: _____

Дата: _____

с т

отрицательный


с т

положительный


с т

недействительный

6. Макет маркировки «Экспресс-система для выявления наркотических веществ и алкоголя в слюне человека» в варианте исполнения – Экспресс-система для выявления 11 групп наркотических веществ в слюне человека (Фото 1):

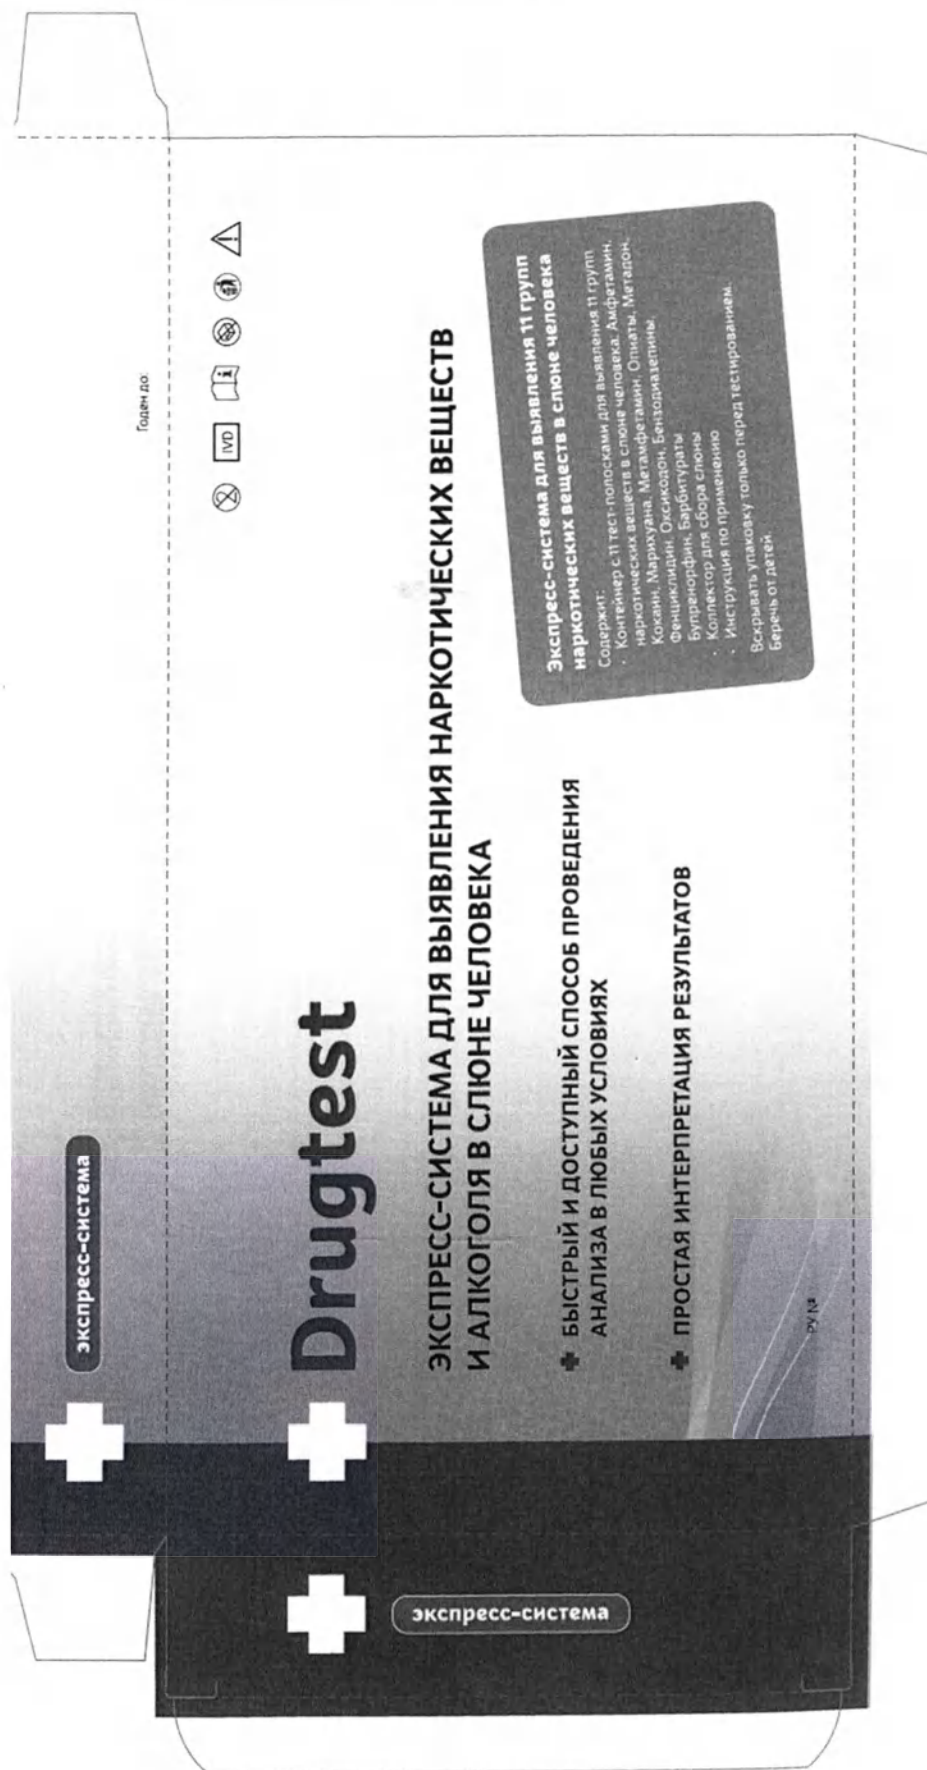

7. Макет маркировки «Экспресс-система для выявления наркотических веществ и алкоголя в слюне человека» в варианте исполнения – Экспресс-система для выявления 11 групп наркотических веществ в слюне человека (Фото 2):

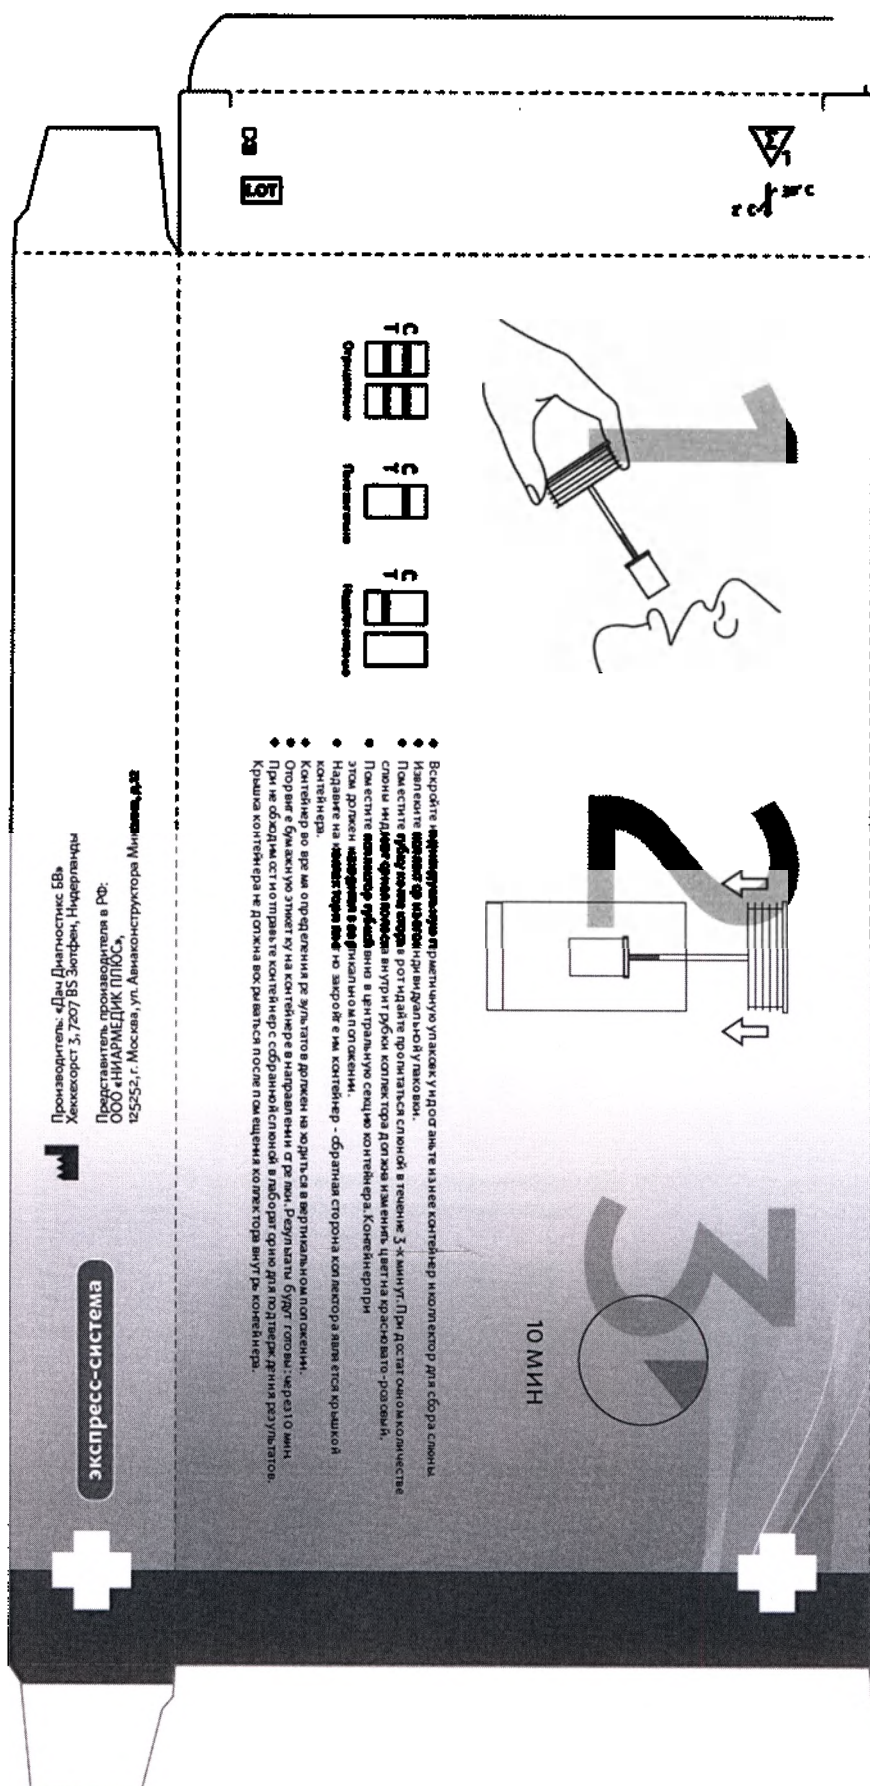

8. Макет маркировки первичной (индивидуальной) упаковки МИ в варианте исполнения – Экспресс-система для выявления 11 групп наркотических веществ в слюне человека:

**Экспресс-система для выявления наркотических веществ и алкоголя
в слюне человека**

AMP50/MET50/COC20/ORI40/THC12/PCP10/BZO50/OXY50/MTD75/BAR300/BUP10

LOT

XXXXXXXXXX

XXXX-XX

Производитель:
«Дач Диагностика Б.В.»,
Хемелорст 3, 7207 BS Эютфен, Нидерланды

РУ № _____

9. Макет маркировки Коллектора для сбора слюны:

**Коллектор
для сбора слюны**

STERILE R

Лот: _____

Годен до: _____

10. Макет маркировки Контейнера с 11 тест-полосками для выявления 11 групп наркотических веществ в слюне человека:

Drugtest

**Экспресс-система для выявления
11 групп наркотических веществ
в слюне человека**

Для просмотра результата
удалите этикетку

Потянуть в направлении стрелки

ФИО: _____

Дата: _____

СТ

СТ

СТ

отрицательный положительный недействительный

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

7 (семь) листа
цифрами прописью

Генеральный директор ООО «ЦИРМЕДИК ПЛЮС»

Нестеренко В.Г.

« 26 » июня 2019 г.





НИАРМЕДИК

Россия, 125252, г. Москва,
ул. Авиаконструктора Микояна, д. 12,
БЦ «Линкор», корпус «А», 2 этаж

Тел.: +7 (495) 741 49 89
Факс: +7 (499) 193 43 50

e-mail: info@nearmedic.ru
www.nearmedic.ru

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»

Нестеренко В.Г.



Макет маркировки медицинского изделия
для in vitro диагностики

**Экспресс тест для выявления
наркотических веществ в слюне человека**

1. Макет маркировки «Экспресс теста для выявления наркотических веществ в слюне человека» в варианте исполнения - Экспресс тест для выявления 11 групп наркотических веществ и алкоголя в слюне человека:



2. Макет маркировки первичной (индивидуальной) упаковки МИ в варианте исполнения - Экспресс тест для выявления 11 групп наркотических веществ и алкоголя в слюне человека:

Экспресс тест для выявления наркотических веществ в слюне человека
 (AMP50/MET50/COC20/OPI40/THC12/PCP10/BZO50/OXY50/MTD75/BAR300/BUP10/ALC20)

LOT



2°C — 30°C

Производитель:
 «Дач Диагностикс БВ»
 Хеккехорст 3, 7207 BS Зютфен, Нидерланды

РУ № _____

3. Макет маркировки Коллектора для сбора слюны:

Коллектор для сбора слюны

Лот: _____

Годен до: _____

STERILE R

3. Макет маркировки Контейнера с 12 тест-полосками для выявления 11 групп наркотических веществ и алкоголя в слюне человека:

Drugtest

Экспресс тест для выявления 11 групп наркотических веществ и алкоголя в слюне человека

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕСТУ ПОСМОТРЕТЬ ИНСТРУКЦИЮ

← Потянуть в направлении стрелки

ФИО: _____

Дата: _____

С Т

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

С Т

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

С Т

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ

4. Макет маркировки «Экспресс теста для выявления наркотических веществ в слюне человека» в варианте исполнения - Экспресс тест для выявления 11 групп наркотических веществ в слюне человека:



5. Макет маркировки первичной (индивидуальной) упаковки МИ в варианте исполнения - Экспресс тест для выявления 11 групп наркотических веществ в слюне человека:

Экспресс тест для выявления наркотических веществ в слюне человека
 (AMP50/MET50/COC20/OPI40/THC12/PCP10/BZO50/OXY50/MTD75/BAR300/BUP10)

LOT

2°C — 30°C

Производитель:
 «Дач Диагностикс БВ»
 Хеккехорст 3, 7207 BS Зютфен, Нидерланды

РУ № _____

6. Макет маркировки Коллектора для сбора слюны:

Коллектор для сбора слюны

Лот: _____

Годен до: _____

STERILE R

7. Макет маркировки Контейнера с 11 тест-полосками для выявления 11 групп наркотических веществ в слюне человека:

Drugtest

**Экспресс тест для выявления
11 групп наркотических веществ
в слюне человека**

*Для просмотра результата
удалите этикетку*

← Потянуть в направлении стрелки

ФИО: _____

Дата: _____

С Т

отрицательный

С Т

положительный

С Т

недействительный

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

5 (пять) листов
цифрами прописью

Генеральный директор ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»

Нестеренко В.Г.

«04» марта 2019 г.

