

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Апексмед Рус»

М.М. Вердиев

2021 г.



Фотографические изображения медицинских изделий

Концентратор кислорода медицинский SENSITEC с принадлежностями


Производство:

«Apexmed International B.V.», the Netherlands

(«Апексмед Интернэшнл Б.В.»), Нидерланды

2021 г.

Концентратор кислорода медицинский SENSITEC с принадлежностями
Фотографическое изображение общего вида концентратора кислорода МОС-01

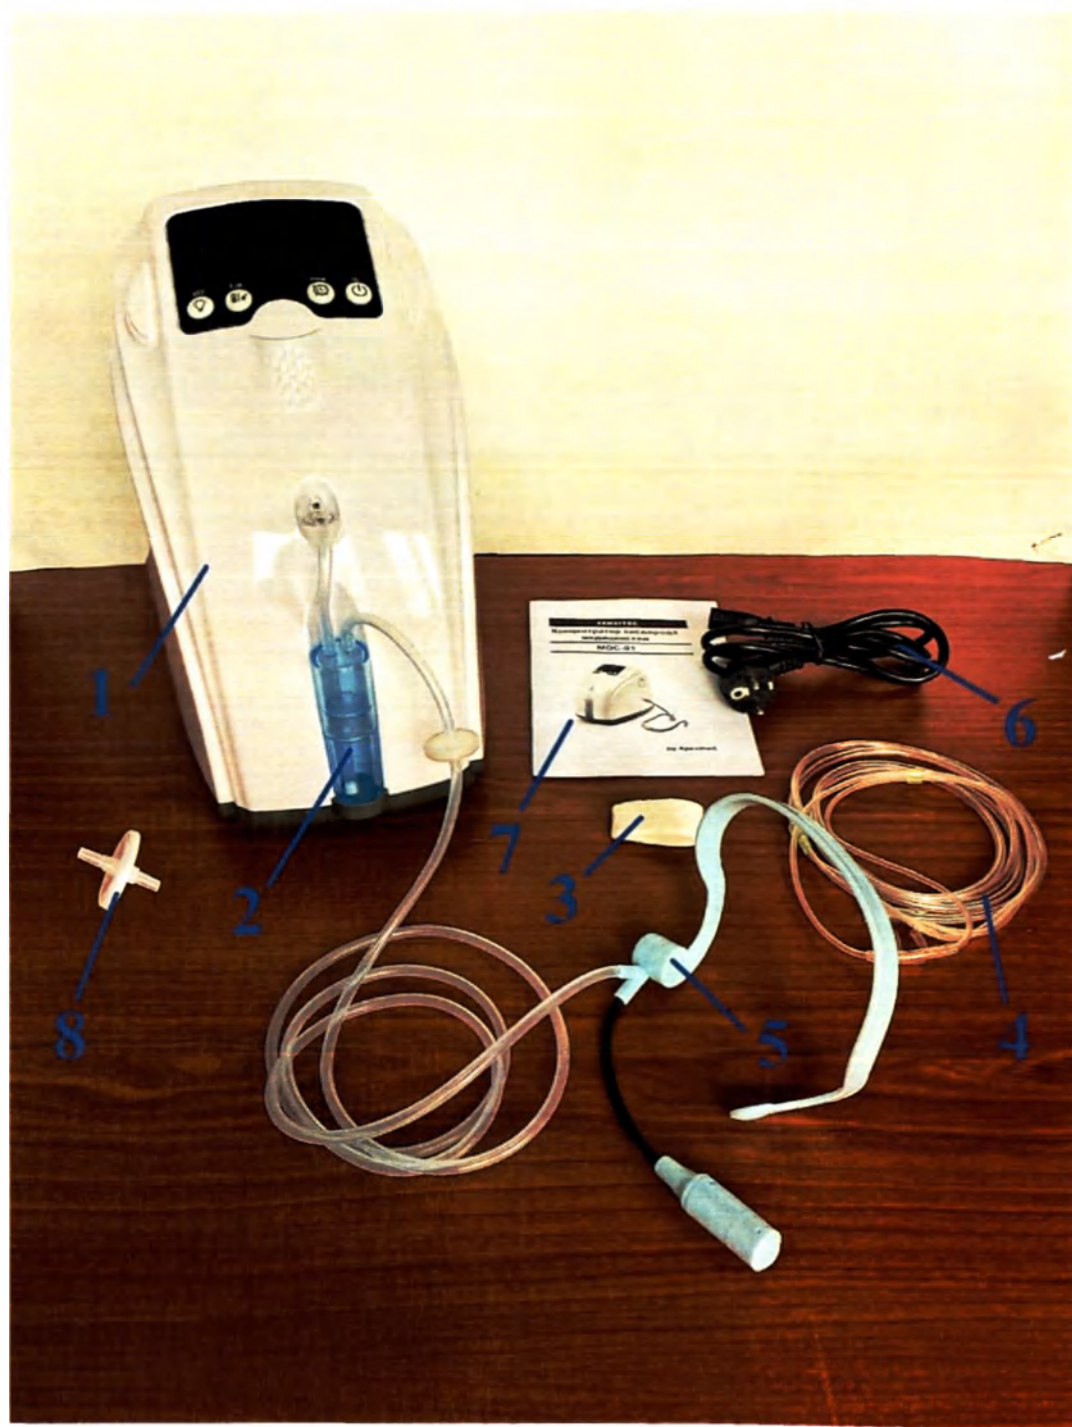

Концентратор кислорода медицинский МОС-01 в составе:


1. Концентратор кислорода МОС-01 в сборе – (1)
2. Канюля назальная, кислородная – (4)
3. Головная гарнитура с диффузором в сборе – (5)
4. Кабель сетевой – (6)
5. Руководство по эксплуатации – (7)

Принадлежности:

6. Фильтр впускной, грубой очистки – (3)
7. Фильтр тонкой очистки – (8)
8. Увлажнитель в сборе – (2)




1. Концентратор кислорода МОС-01 в сборе

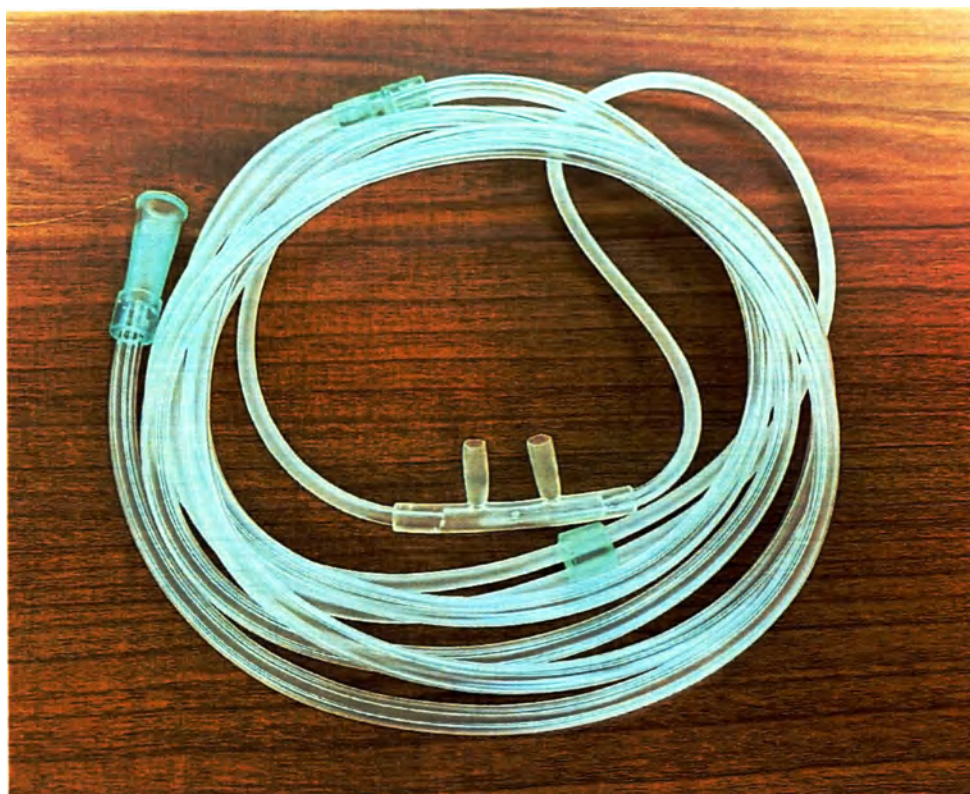

2. Канюля назальная, кислородная



3. Головная гарнитура с диффузором в сборе

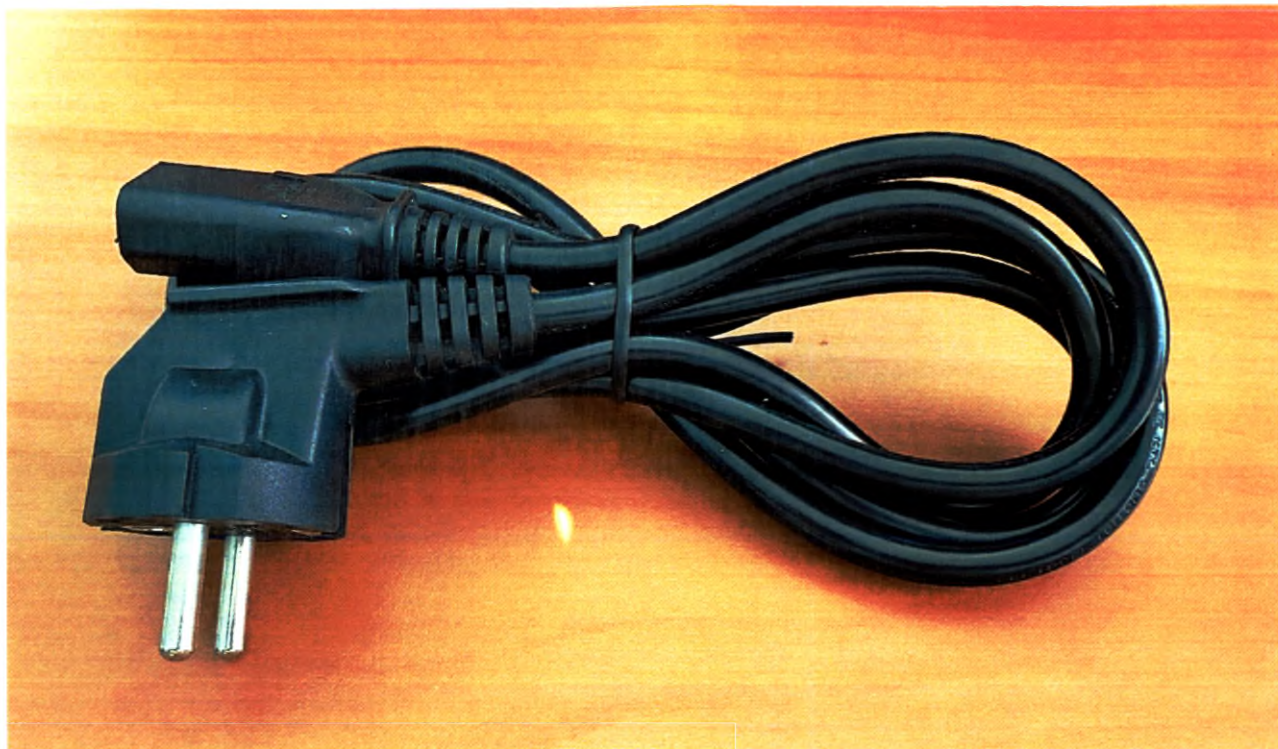


4. Кабель сетевой




5. Руководство по эксплуатации



6. Фильтр впускной, грубой очистки

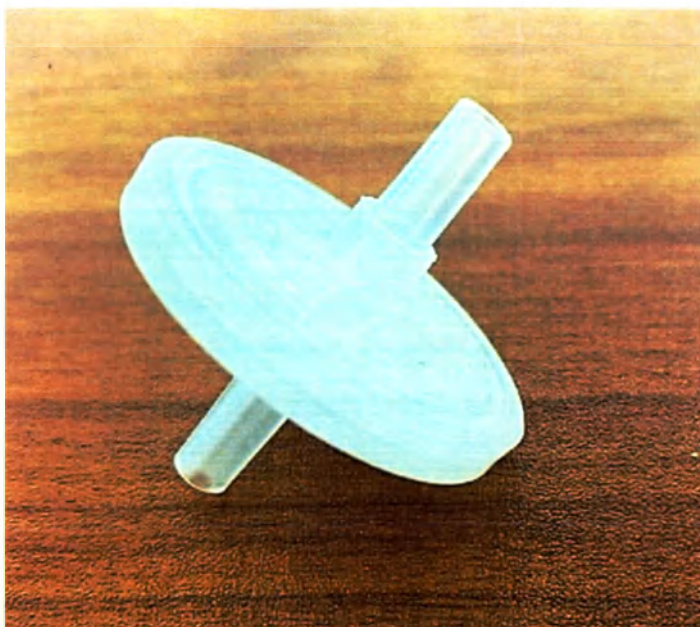

7. Фильтр тонкой очистки

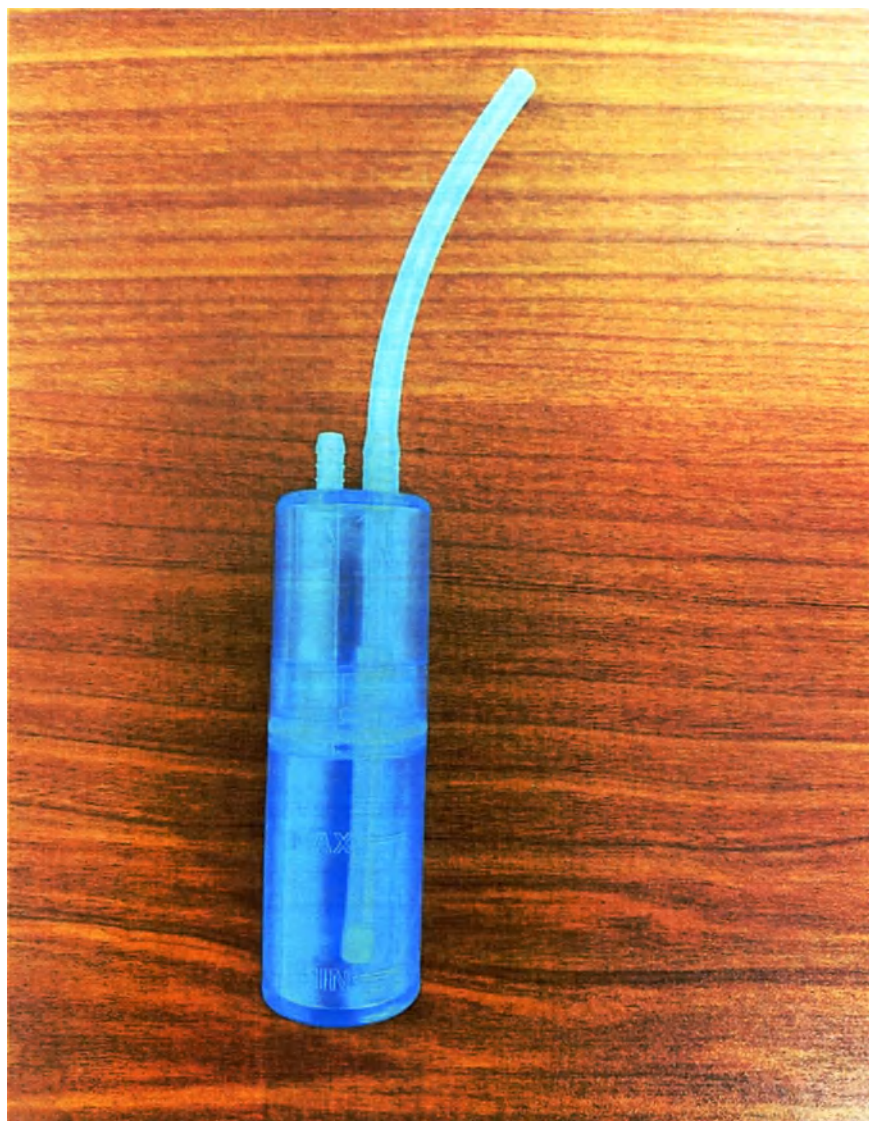


8. Увлажнитель в сборе



Фотографическое изображение упаковки канюли назальной, кислородной



Фотографическое изображение упаковки головной гарнитуры с диффузором в сборе

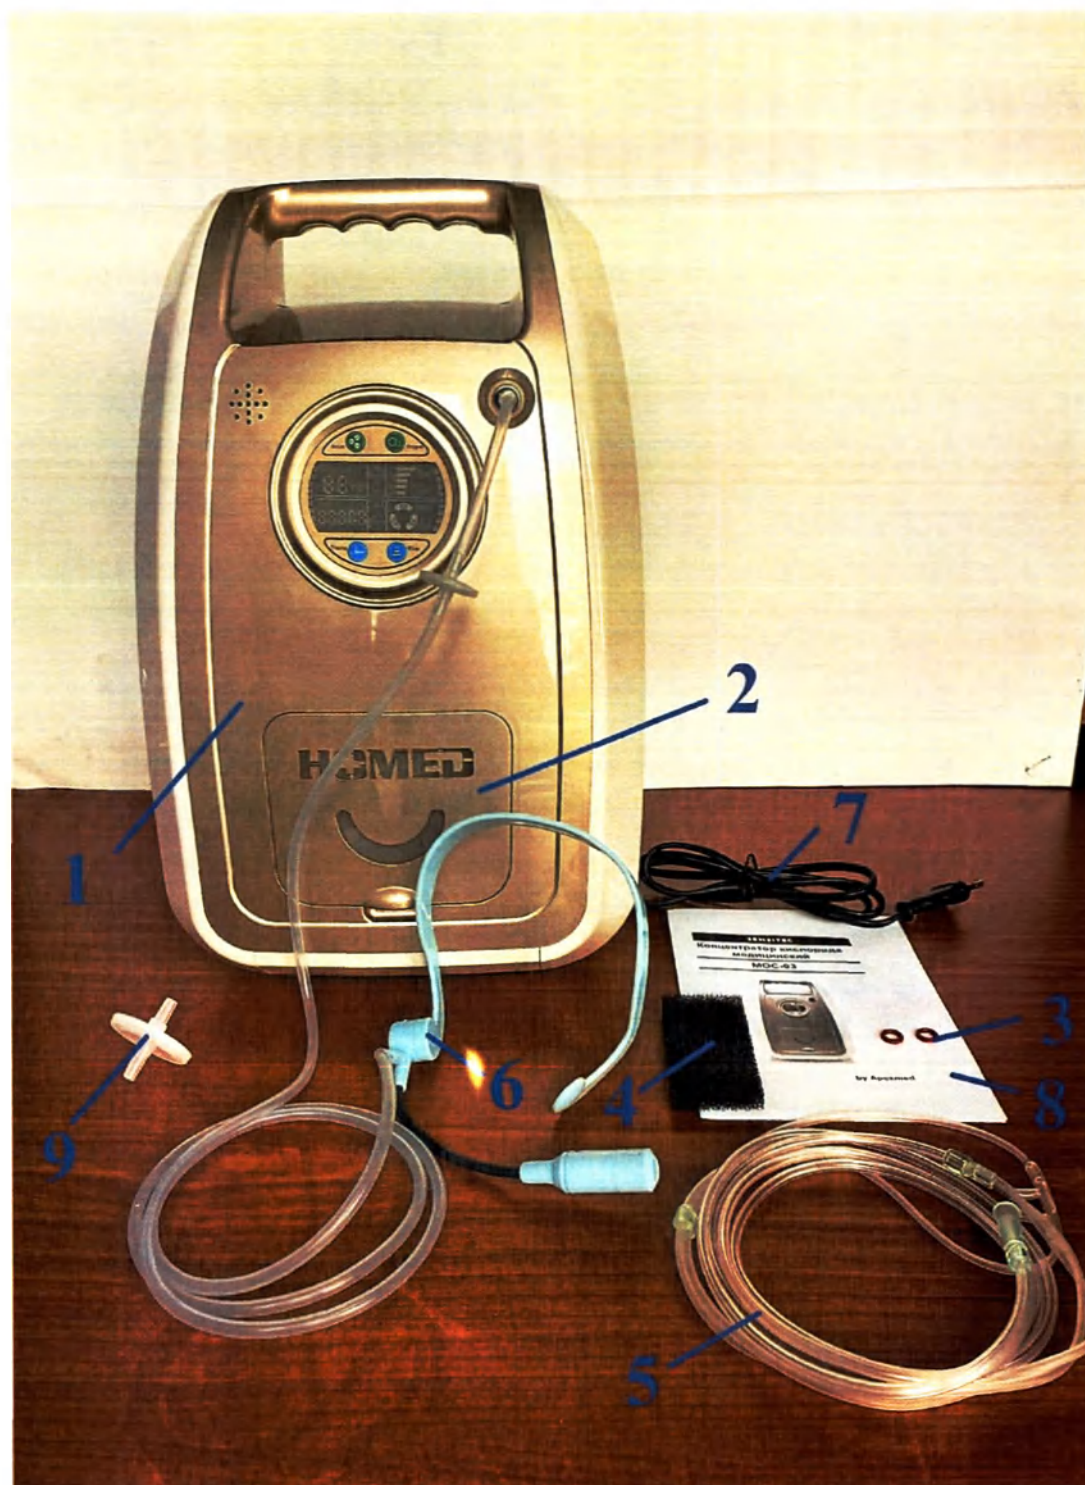

Концентратор кислорода медицинский МОС-03 в составе:


1. Концентратор кислорода МОС-03 в сборе – (1)
2. Канюля назальная, кислородная – (5)
3. Головная гарнитура с диффузором в сборе – (6)
4. Кабель сетевой – (7)
5. Руководство по эксплуатации – (8)

Принадлежности:

6. Фильтр впускной, грубой очистки – (4)
7. Фильтр тонкой очистки – (9)
8. Увлажнитель в сборе – (2)
9. Уплотнительное кольцо для ёмкости увлажнителя – (3)




1. Концентратор кислорода МОС-03 в сборе

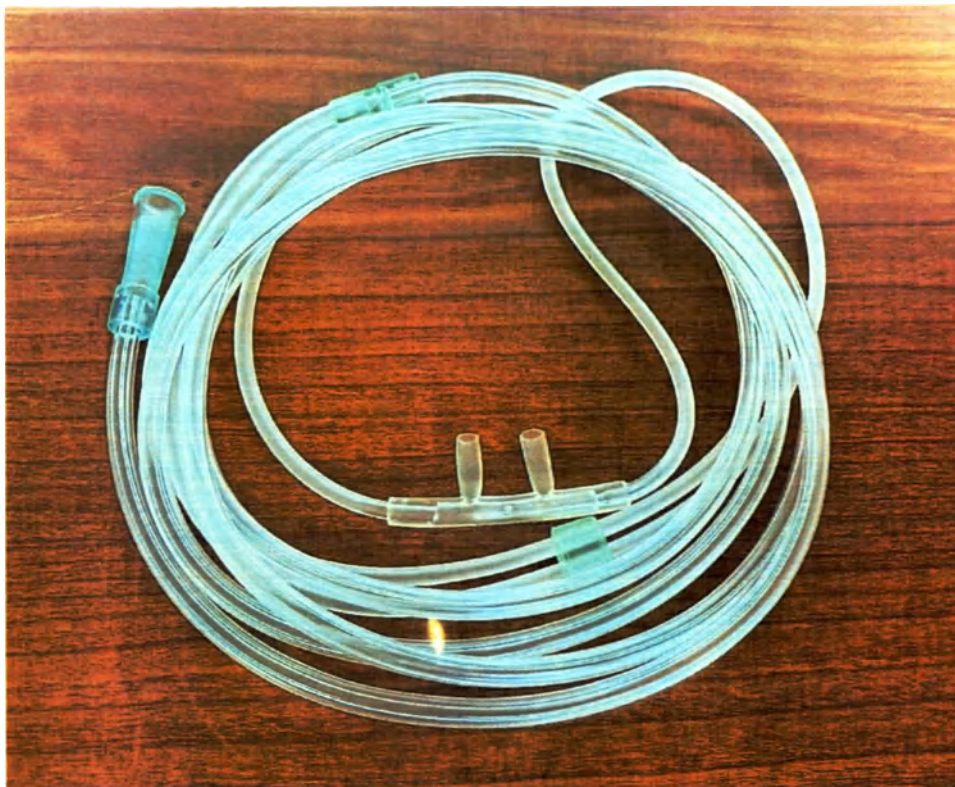

2. Канюля назальная, кислородная




3. Головная гарнитура с диффузором в сборе

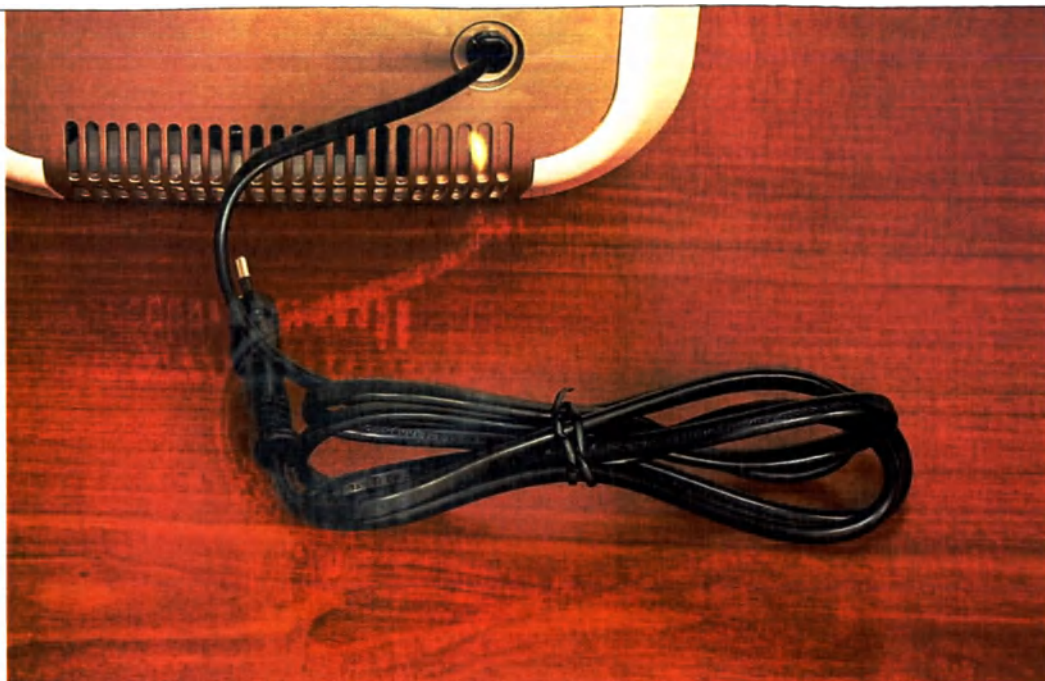

4. Кабель сетевой



5. Руководство по эксплуатации

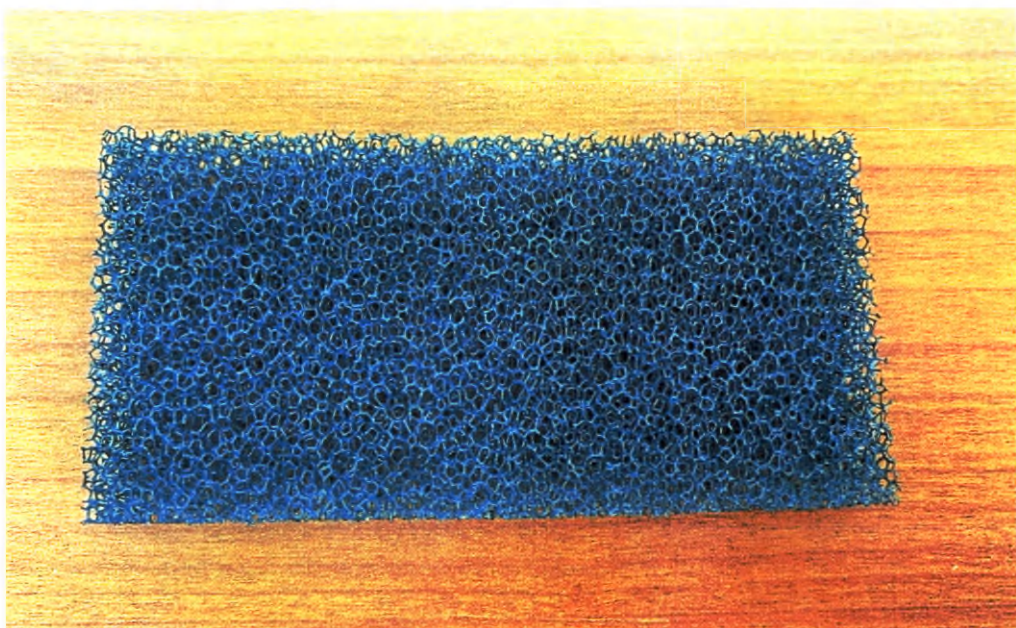

6. Фильтр впускной, грубой очистки



7. Фильтр тонкой очистки



8. Увлажнитель в сборе



9. Уплотнительное кольцо для ёмкости увлажнителя – 2 шт.



Фотографическое изображение упаковки канюли назальной, кислородной



Фотографическое изображение упаковки головной гарнитуры с диффузором в сборе



Концентратор кислорода медицинский МОС-05 в составе:

1. Концентратор кислорода МОС-05 в сборе – (1)
2. Трубка кислородная, соединительная – (3)
3. Канюля назальная, кислородная – (5)
4. Головная гарнитура с диффузором в сборе – (6)
5. Кабель сетевой – (7)
6. Руководство по эксплуатации – (8)

Принадлежности:

7. Фильтр впускной, грубой очистки – (4)
8. Фильтр тонкой очистки – (9)
9. Увлажнитель в сборе – (2)



1. Концентратор кислорода МОС-05 в сборе



2. Трубка кислородная, соединительная



3. Канюля назальная, кислородная



4. Головная гарнитура с диффузором в сборе




5. Кабель сетевой

SENSITEC


**Концентратор кислорода
медицинский**

МОС-05

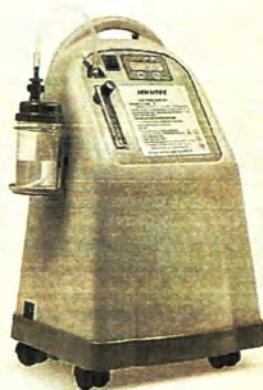


by Apexmed

6. Руководство по эксплуатации

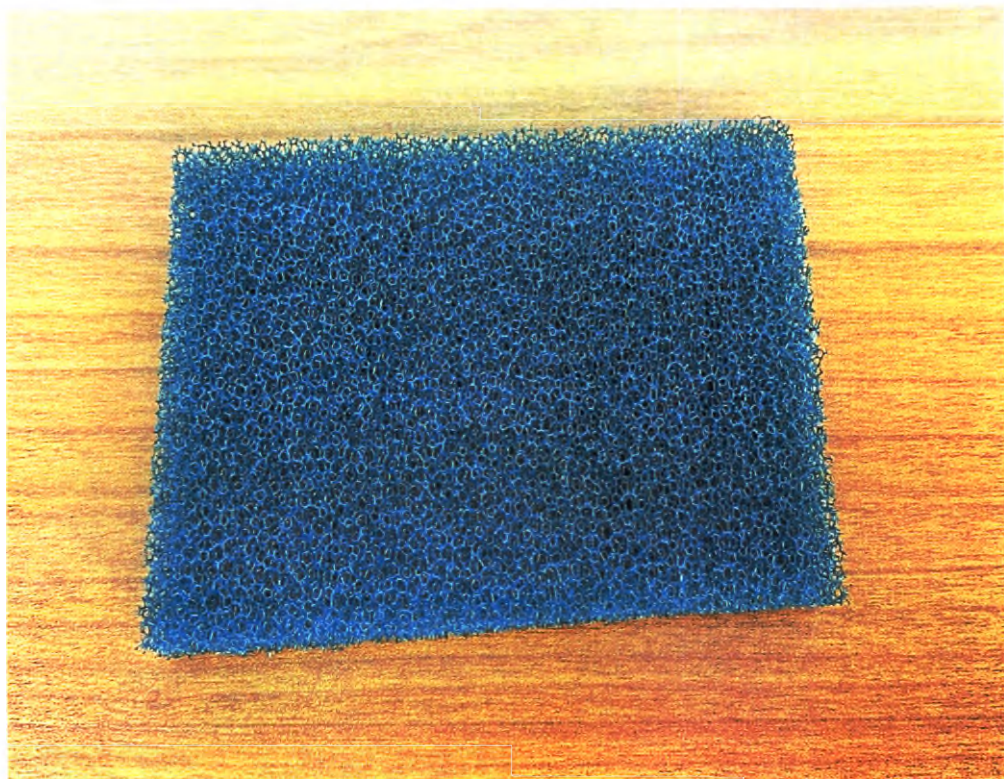

7. Фильтр впускной, грубой очистки

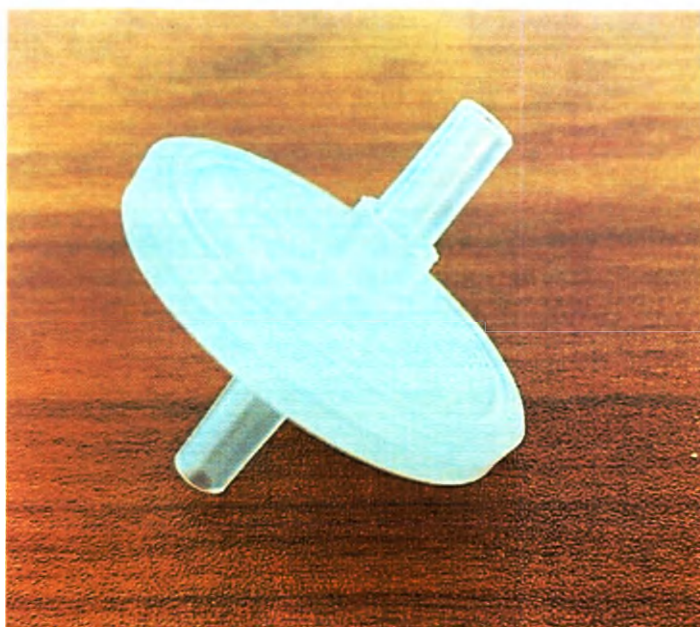


8. Фильтр тонкой очистки



9. Увлажнитель в сборе




Фотографическое изображение упаковки канюли назальной, кислородной

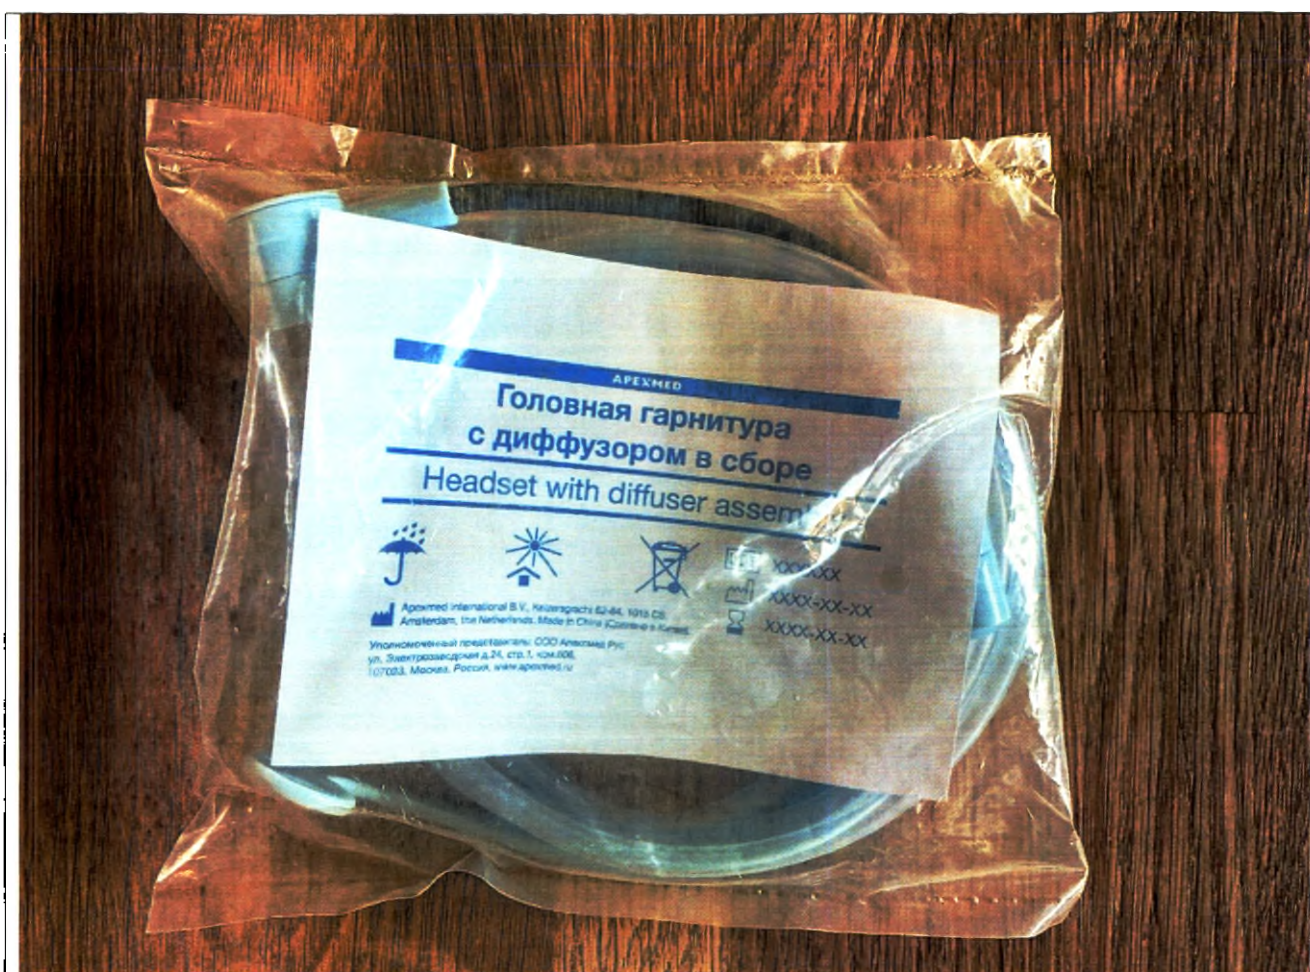

Фотографическое изображение упаковки головной гарнитуры с диффузором в сборе

Фотографическое изображение общего вида концентратора кислорода МОС-03А, МОС-05А, МОС-08А, МОС-10А.

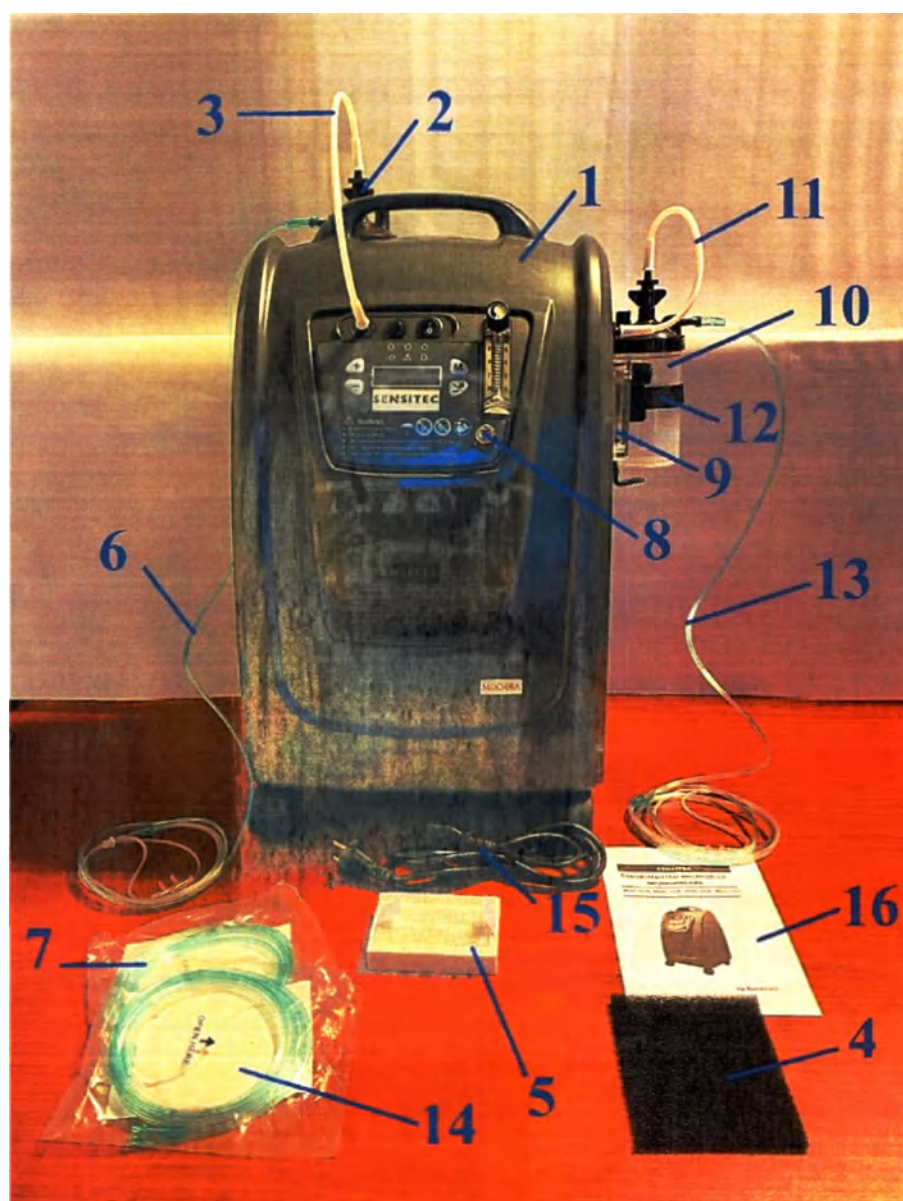

Концентратор кислорода медицинский МОС-08А в составе:


1. Концентратор кислорода МОС-08А в сборе – (1)
2. Трубка кислородная соединительная – (2)
3. Канюля носовая, кислородная – 2 шт. (6), (7)
4. Дополнительный разъем для подключения небулайзера – (8)
5. Второй выход подачи кислорода в составе:
Расходомер – (9)
Увлажнитель в сборе – (10)
Трубка кислородная соединительная – (11)
Держатель для фиксации ёмкости увлажнителя – (12)
Канюля носовая, кислородная – 2 шт. (13), (14)
6. Кабель сетевой – (15)
7. Руководство по эксплуатации – (16)

Принадлежности:


8. Фильтр грубой очистки – (4)
9. Фильтр тонкой очистки – (5)
10. Увлажнитель в сборе – (2)




1. Портативный концентратор кислорода МОС-08А в сборе

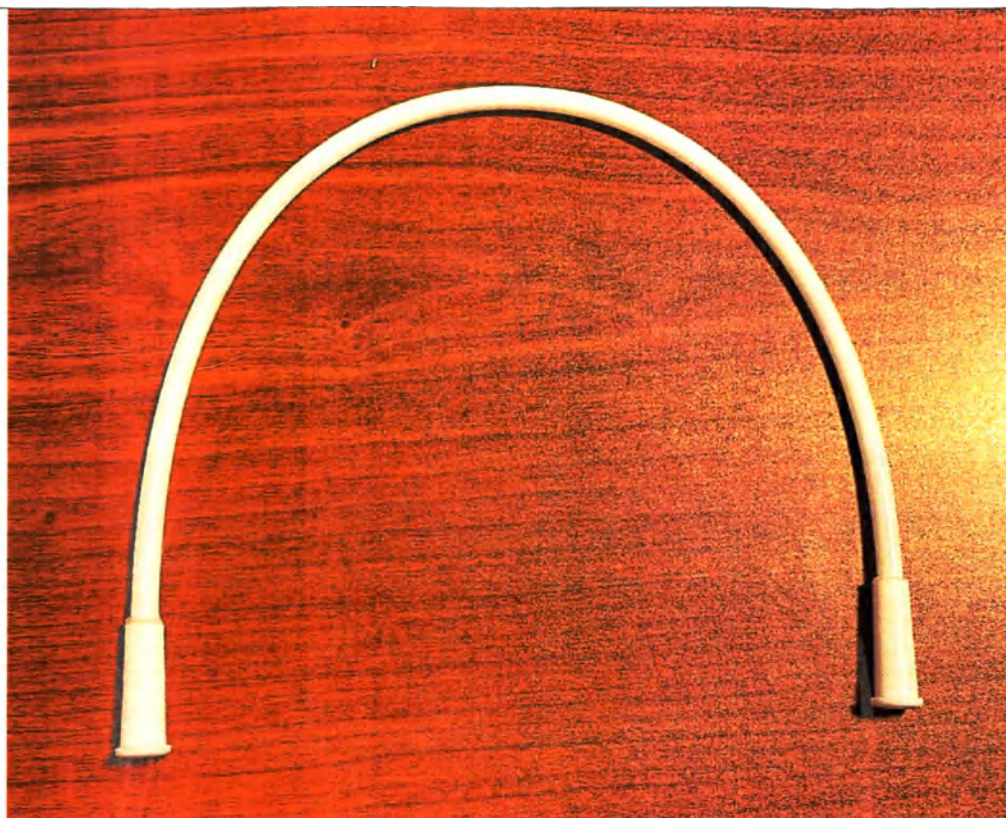


2. Трубка кислородная, соединительная

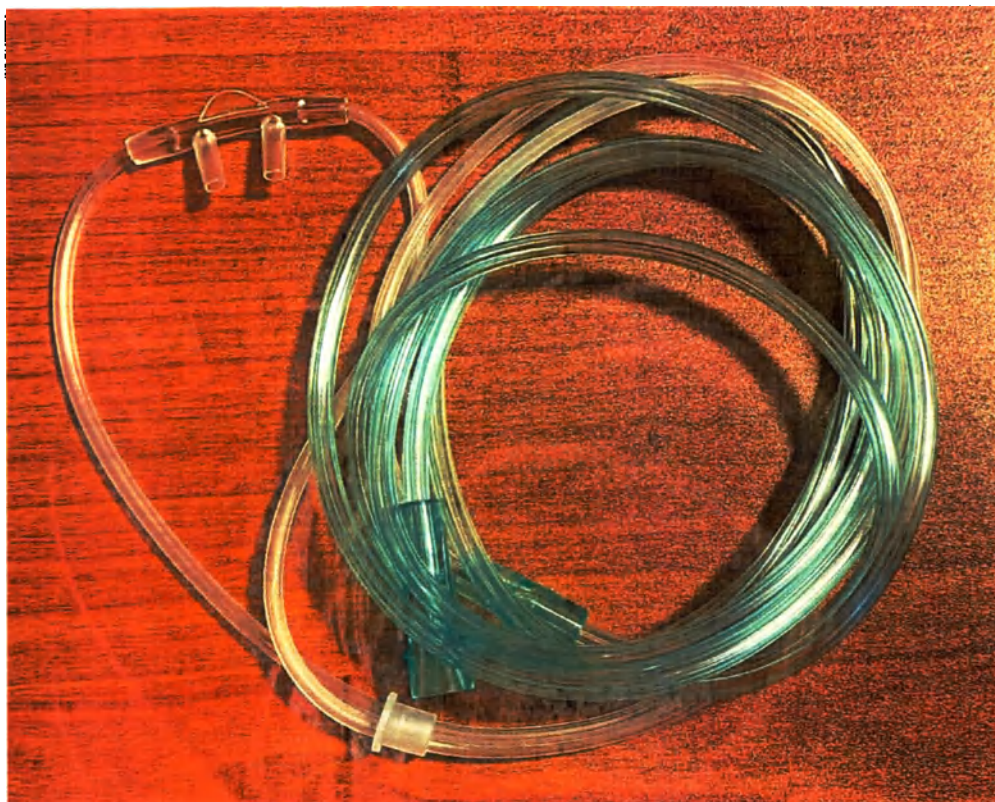

3 К-под надувную камеру

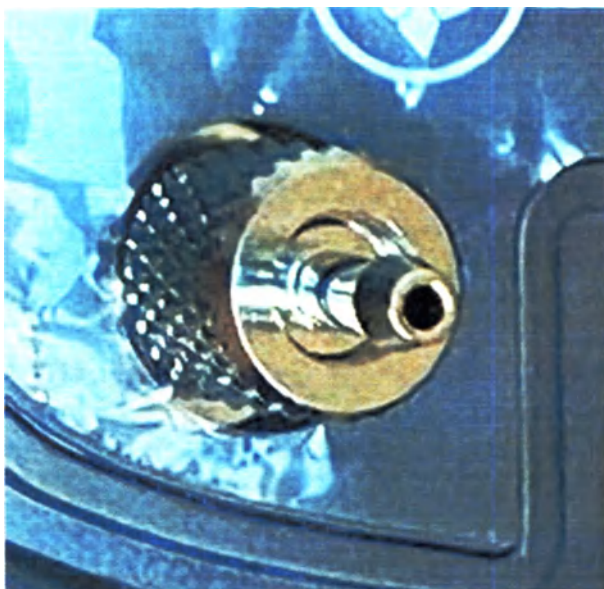


4. Дополнительный разъем для подключения небулайзера

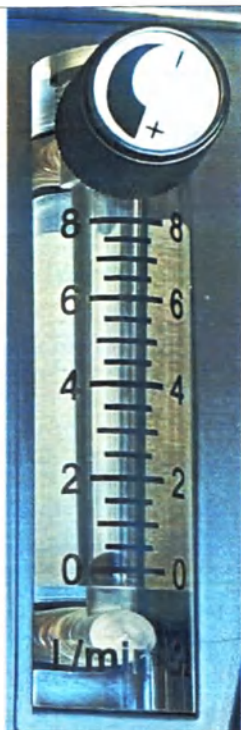

а) Расходомер



б) Увлажнитель в сборе

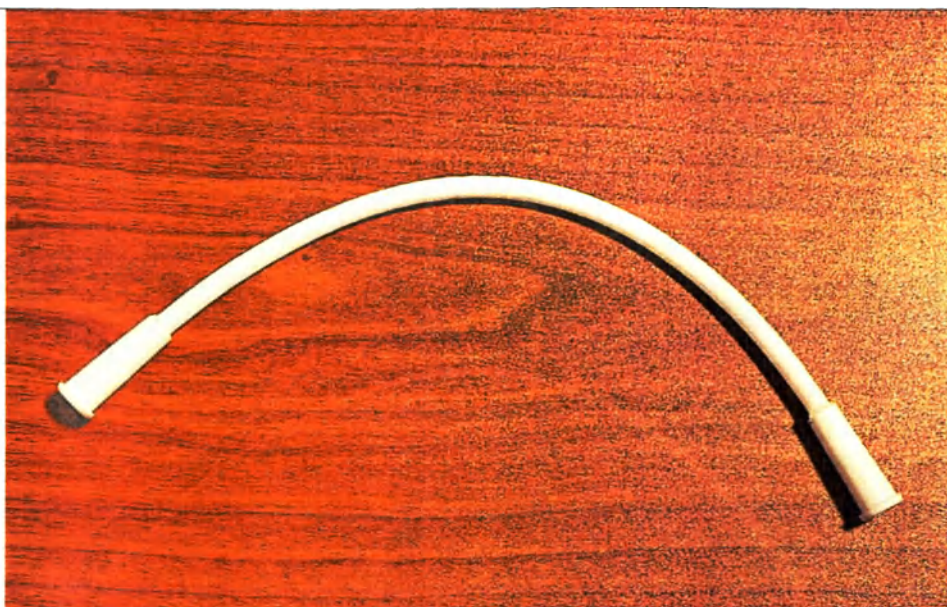

в) Трубка кислородная, соединительная




г) Держатель для держателя ёмкости увлажнителя



Рис. 4. Канюля для подачи кислорода

5. Из перечисленного оборудования в составе:


- а) Расчетная таблица – 1 шт.
- б) Увлажнитель воздуха – 1 шт.
- в) Трубка для подачи кислорода – 1 шт.
- г) Держатель для фиксации емкости с жидкостью – 1 шт.
- д) Канюля для подачи кислорода – 1 шт.

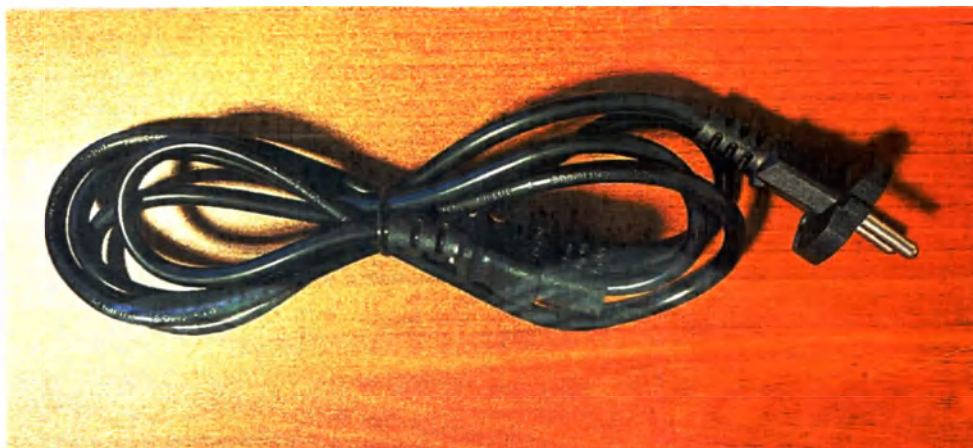


6. Кабель сетевой




7. Правила эксплуатации

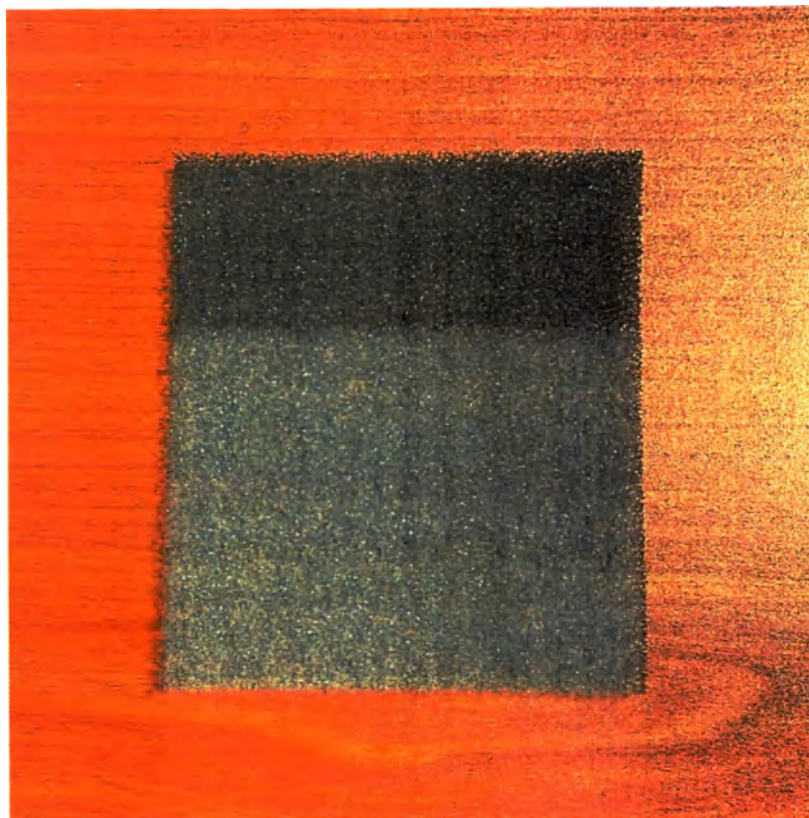

52

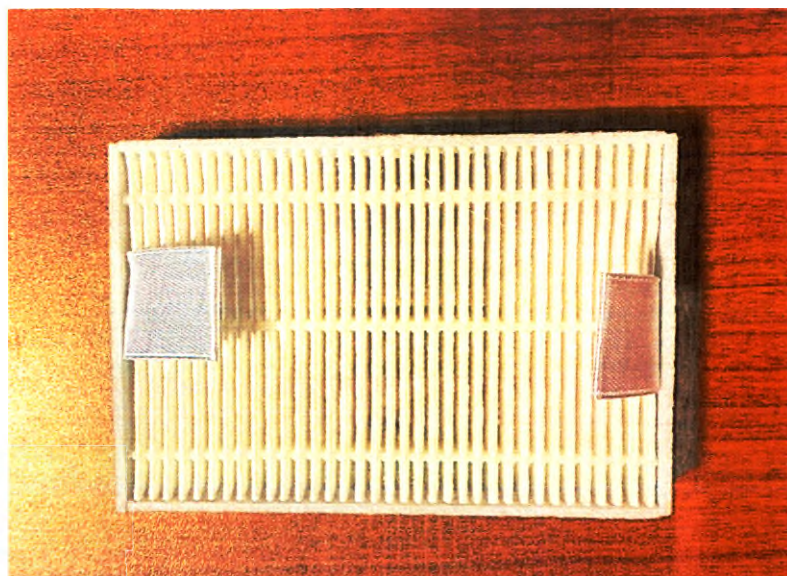

9. Фильтр тонкой очистки

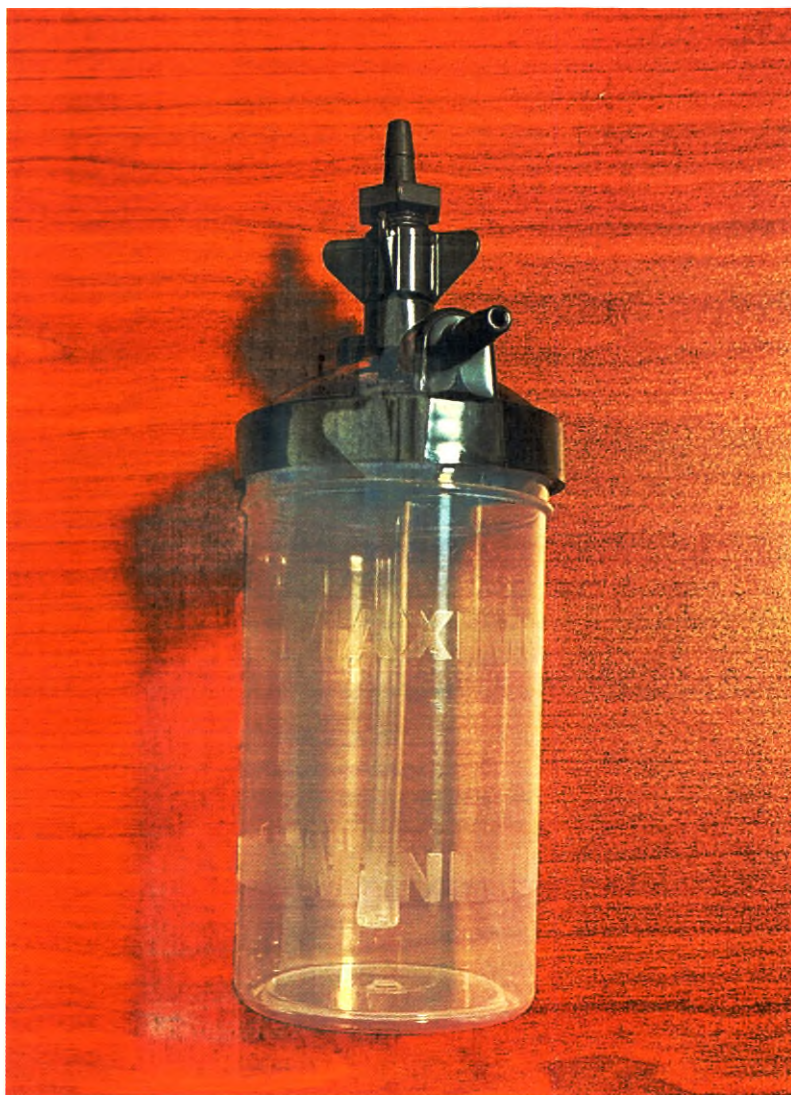

10. Увлажнитель в сборе



Фотографическое изображение упаковки канюли назальной, кислородной

Сшито и заверено печатью 50
невдвдст) лист 06

Генеральный директор
ООО «Апексмед Рус»
М.М. Вердиге

