


Фотографические изображения

Реагент VENTANA pan-TRK (EPR17341) Assay для качественного иммуногистохимического выявления С-концевой области протеинов А, В и С тропомиозин-рецепторной киназы (ТРК) для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark


Реагент VENTANA pan-TRK (EPR17341) Assay для качественного иммуногистохимического выявления С-концевой области протеинов А, В и С тропомиозин-рецепторной киназы (ТРК) для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark (общий вид)




Реагент VENTANA pan-TRK (EPR17341) Assay для качественного иммуногистохимического выявления С-концевой области протеинов А, В и С тропомиозин-рецепторной киназы (ТРК) для диагностики *in vitro* на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark (дозатор с реагентом)

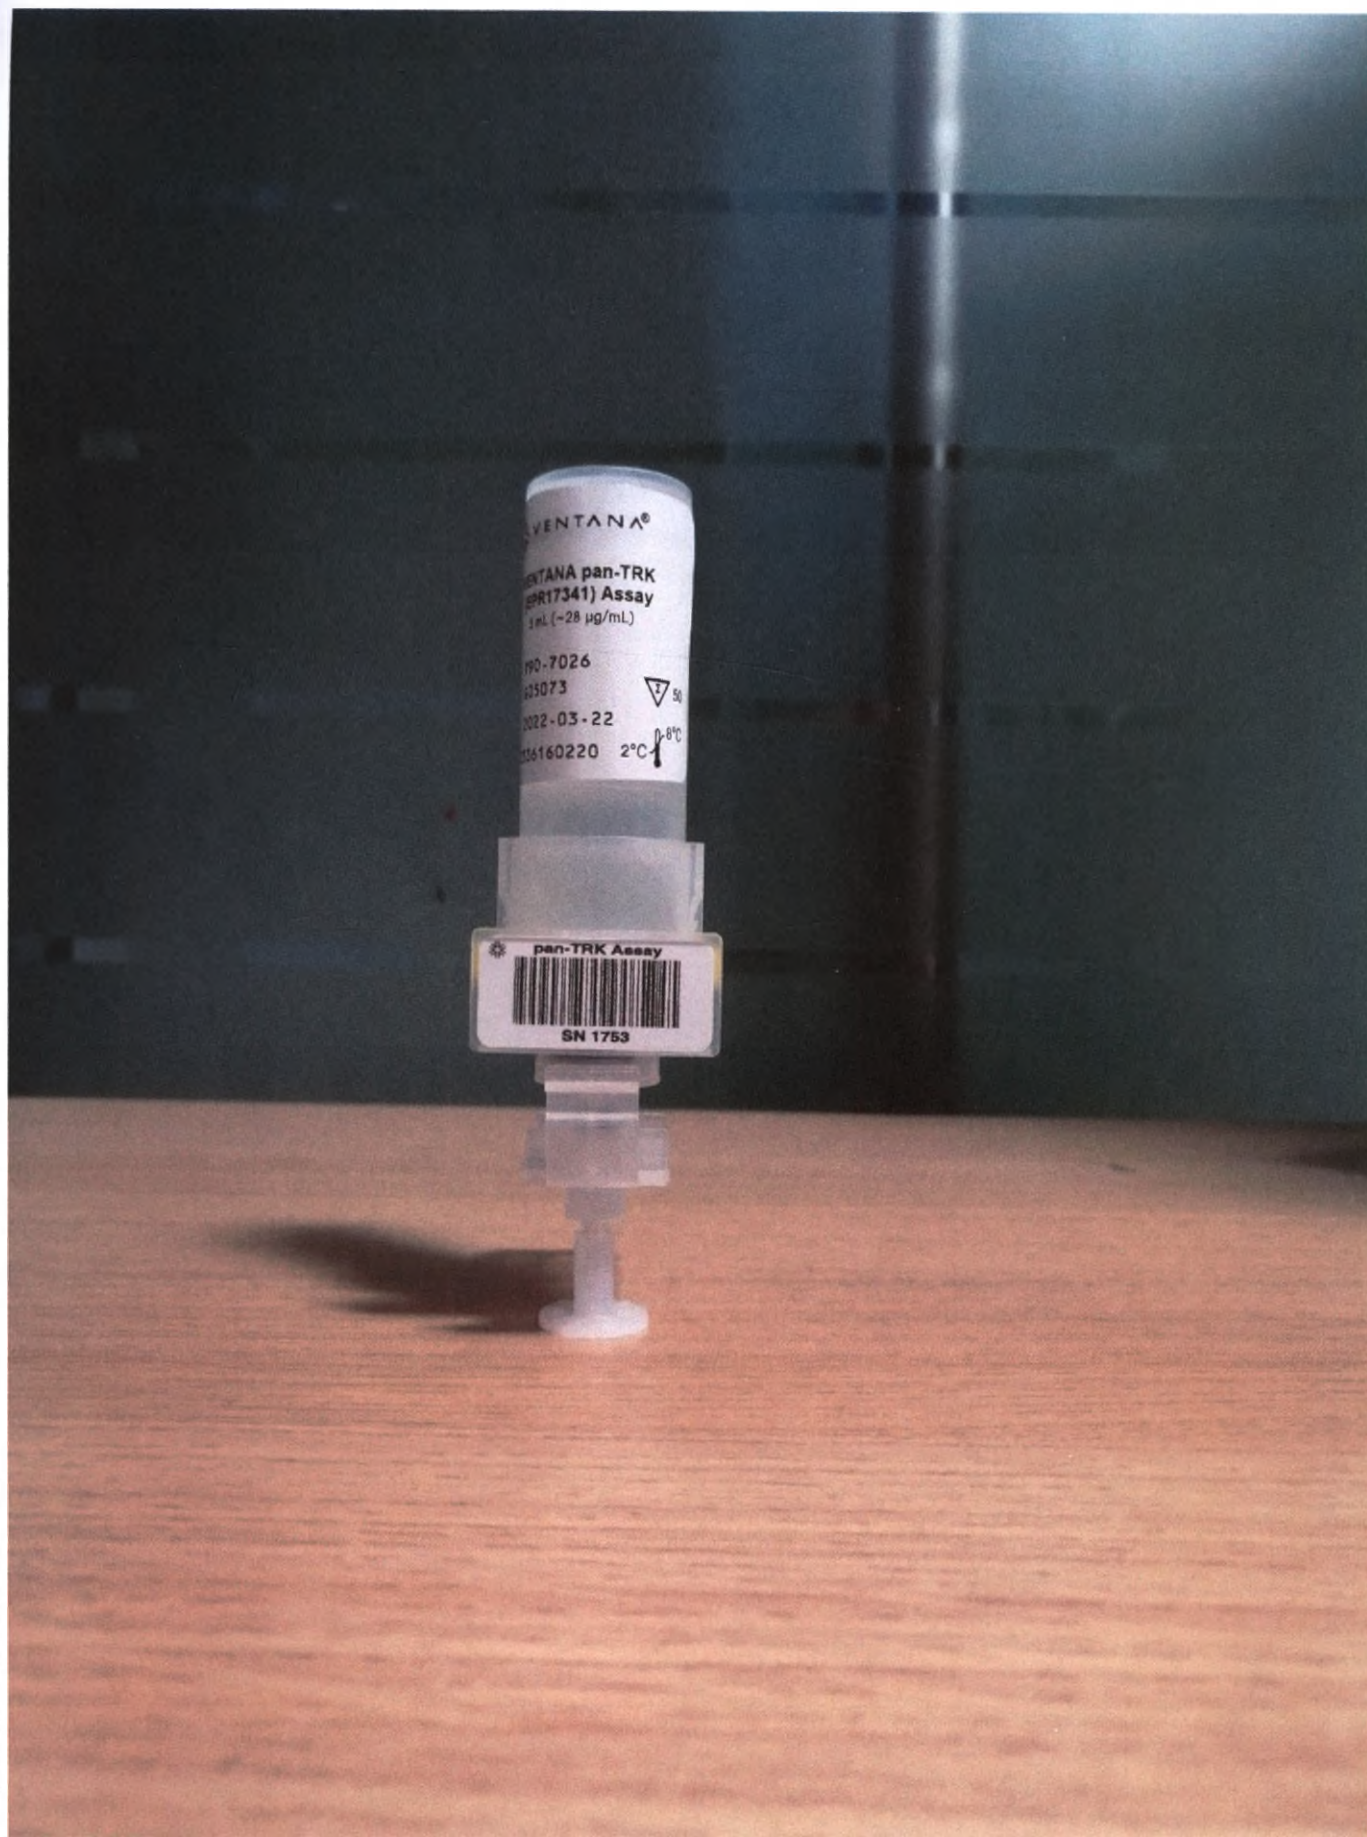

Реагент VENTANA pan-TRK (EPR17341) Assay для качественного иммуногистохимического выявления С-концевой области протеинов А, В и С тропомиозин-рецепторной киназы (ТРК) для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark (дозатор с реагентом)

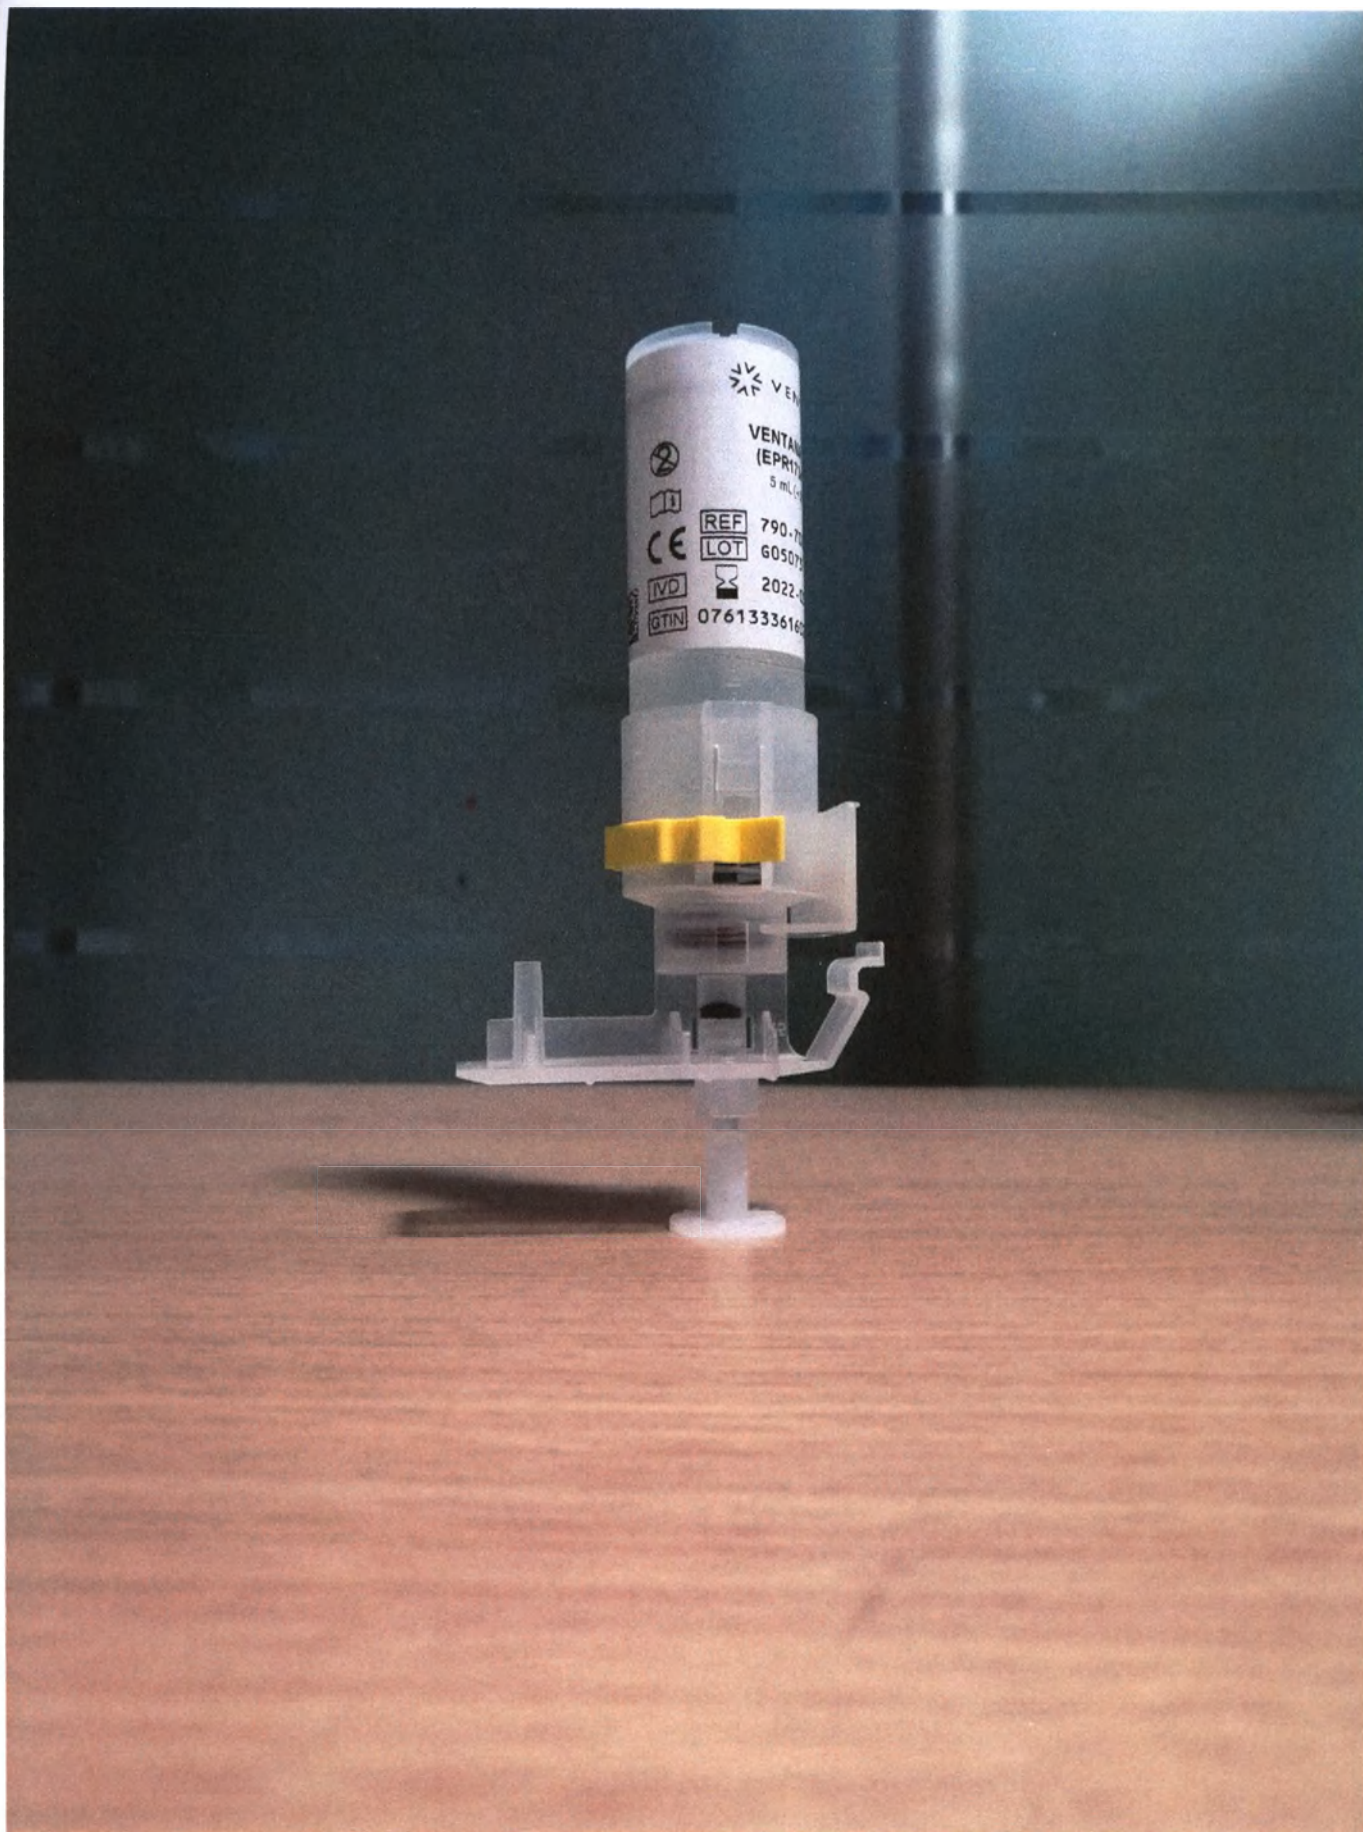

Реагент VENTANA pan-TRK (EPR17341) Assay для качественного иммуногистохимического выявления С-концевой области протеинов А, В и С тропомиозин-рецепторной киназы (ТРК) для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark (дозатор с реагентом)

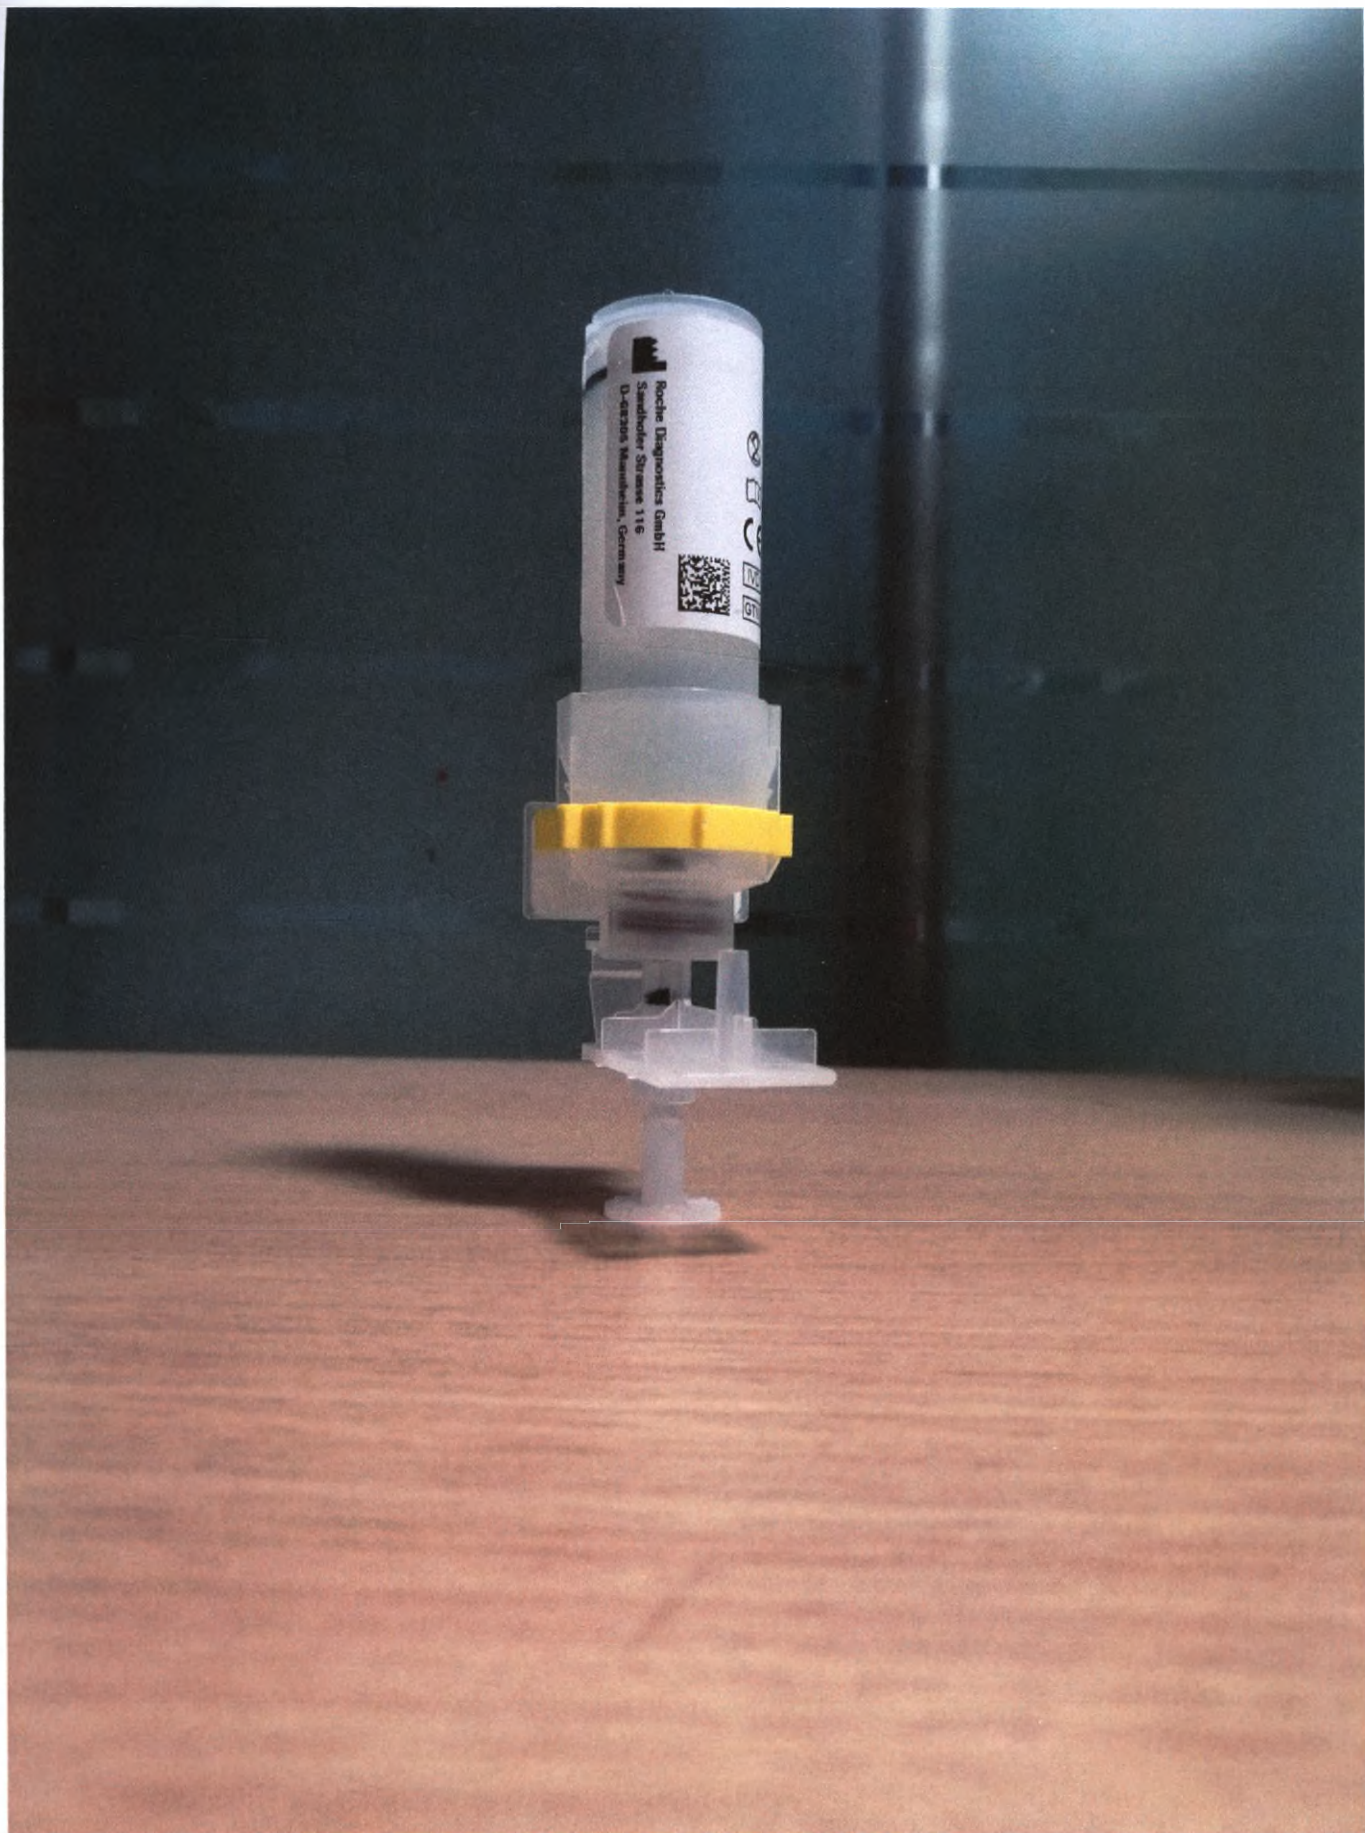

Реагент VENTANA pan-TRK (EPR17341) Assay для качественного иммуногистохимического выявления С-концевой области протеинов А, В и С тропомиозин-рецепторной киназы (ТРК) для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark (маркировка)




реагент VENTANA пан-TRK (EPR17341) Assay для качественного иммуногистохимического выявления С-концевой области протеинов А, В и С тропомиозин-рецепторной киназы (ТРК) для диагностики in vitro на иммуногистохимических автоматических сериях BenchMark (маркировка)



реагент VENTANA pan-TRK (EPR17341) Assay для качественного иммуногистохимического выявления С-концевой области протеинов А, В и С тропомиозин-рецепторной киназы (ТРК) для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark (маркировка)



реагент VENTANA pan-TRK (EPR17341) Assay для качественного иммуногистохимического выявления С-концевой области протеинов А, В и С тропомиозин-рецепторной киназы (ТРК) для диагностики in vitro на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark (маркировка)



VENTANA®

**VENTANA pan-TRK
(EPR17341) Assay**
5 mL (~28 µg/mL)

REF 790-7026

GTIN 07613336160220

LOT 605073



2020-03-23



2022-03-22

IVD


(240) 08494665001 -Roche #



50



2°C



8°C




790-7026605073 0011



VENTANA

Реагент VENTANA pan-TRK (EPR17341) Assay для качественного иммуногистохимического выявления С-концевой области протеинов А, В и С тропомиозин-рецепторной киназы (ТРК) для диагностики *in vitro* на иммуноштейнерах автоматических серии BenchMark (маркировка)

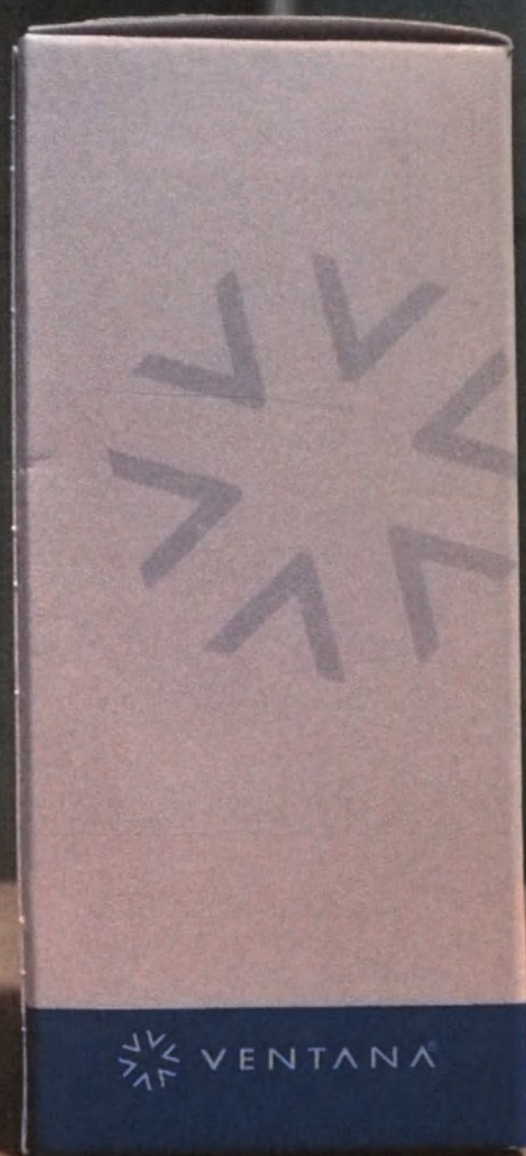

[illegible]

по доверенности (Ермишова Д.В.)
от 04.02.2021

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
11 листа (ов)

