

Генеральный директор ООО "Страйкер"

Усачев Д.А.

«Страйкер»  
Stryker Ltd

(Подпись)

" 27 "

06

2021 г.

Фотографические изображения медицинского изделия:

Аппарат высокочастотный для электролечения Multigen 2 с принадлежностями

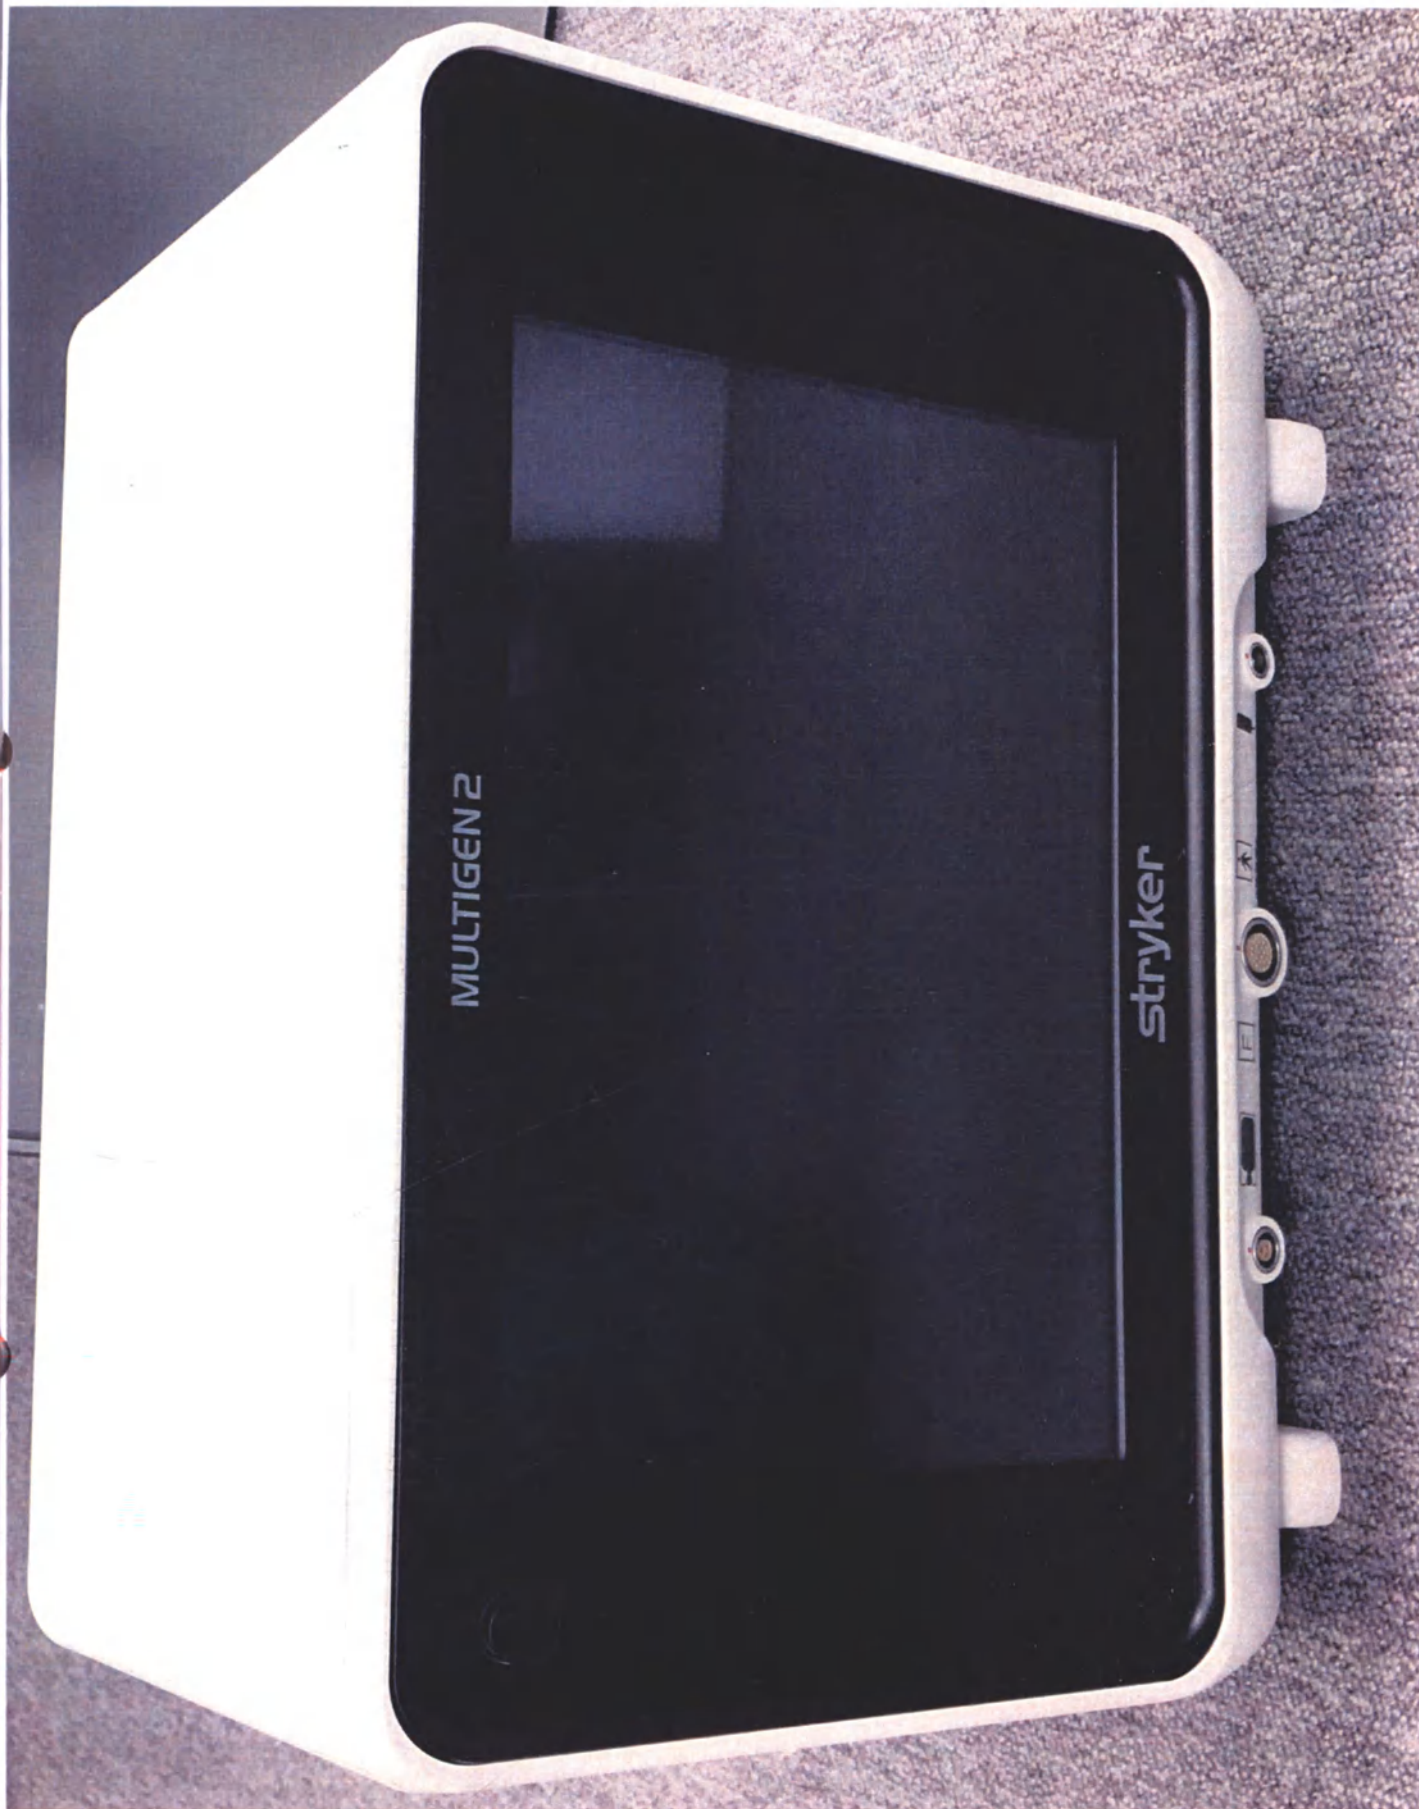


Фото 1 – Общий вид изделия спереди (Консоль Multigen 2)

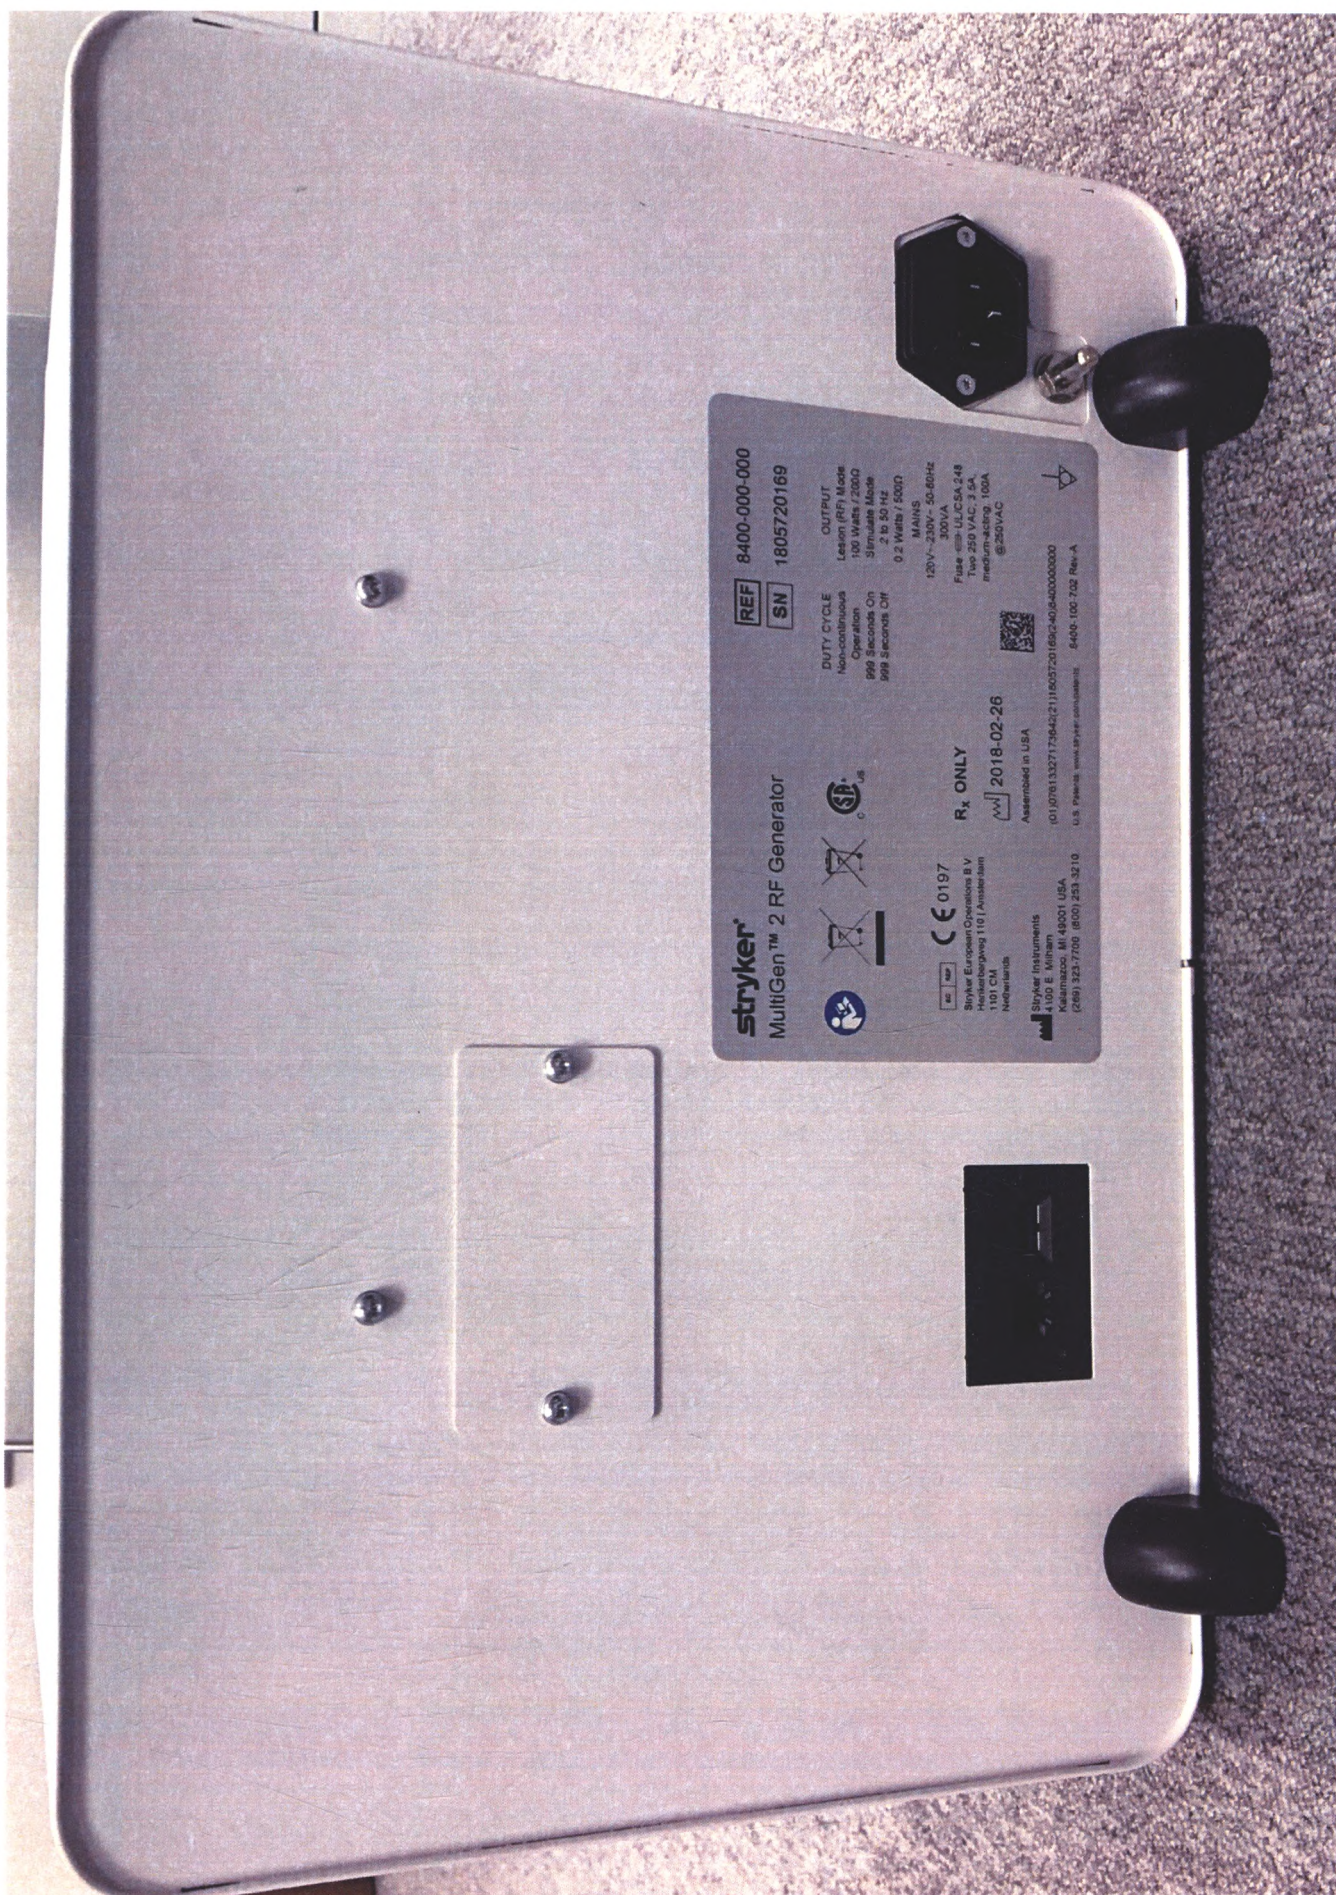


Фото 2 – Общий вид изделия сзади (Консоль Multigen 2)

Фото 3 – Кабель питания

4




**Аппарат высокочастотный для электролечения Multigen 2  
с принадлежностями**

**REF 8400-000-000**

**Инструкции по применению**

**R<sub>x</sub> ONLY**

**CE 0197**

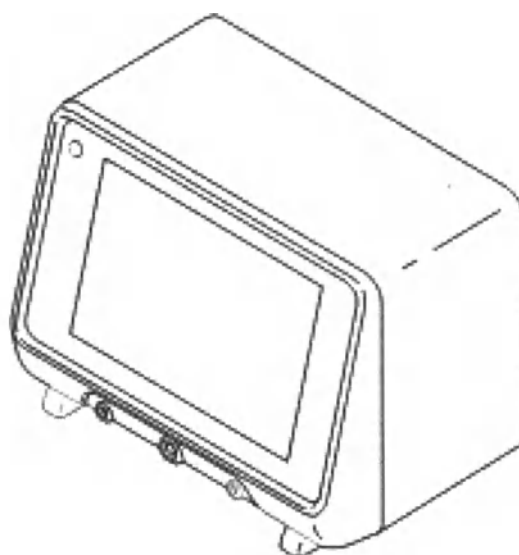

181,87610217190256

**Версия программного обеспечения**

**1.2.x**

2017-11

8400-000-700 Rev-D

[www.styker.com](http://www.styker.com)

2

Фото 4 – Инструкция по применению



Фото 5 – Пульт ручного управления

Прошнуровано, пронумеровано и  
скреплено печатью 6 листа (ов)  
Генеральный директор ООО «Страйкер»

Д.А. Усачев

