



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НПО БЛИЗАР»

С.Е. Моисеев

«01» марта 2021 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ПРОМЫВОЧНЫЙ РАСТВОР «ФЛУРЕНС®»
ДЛЯ ХРОМАТОГРАФА ЖИДКОСТНОГО ПОРТАТИВНОГО
«БЛИЗАР CDT» ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO,
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ
ТУ 21.20.23-001-45629787-2021**



Рисунок 1 –Индивидуальная упаковка промывочного раствора «Флуоренс® А»



Рисунок 2 – Индивидуальная упаковка промывочного раствора «Флуренс® Б», 1 л



Рисунок 3 – Индивидуальная упаковка промывочного раствора «Флуоренс® Б», 5 л

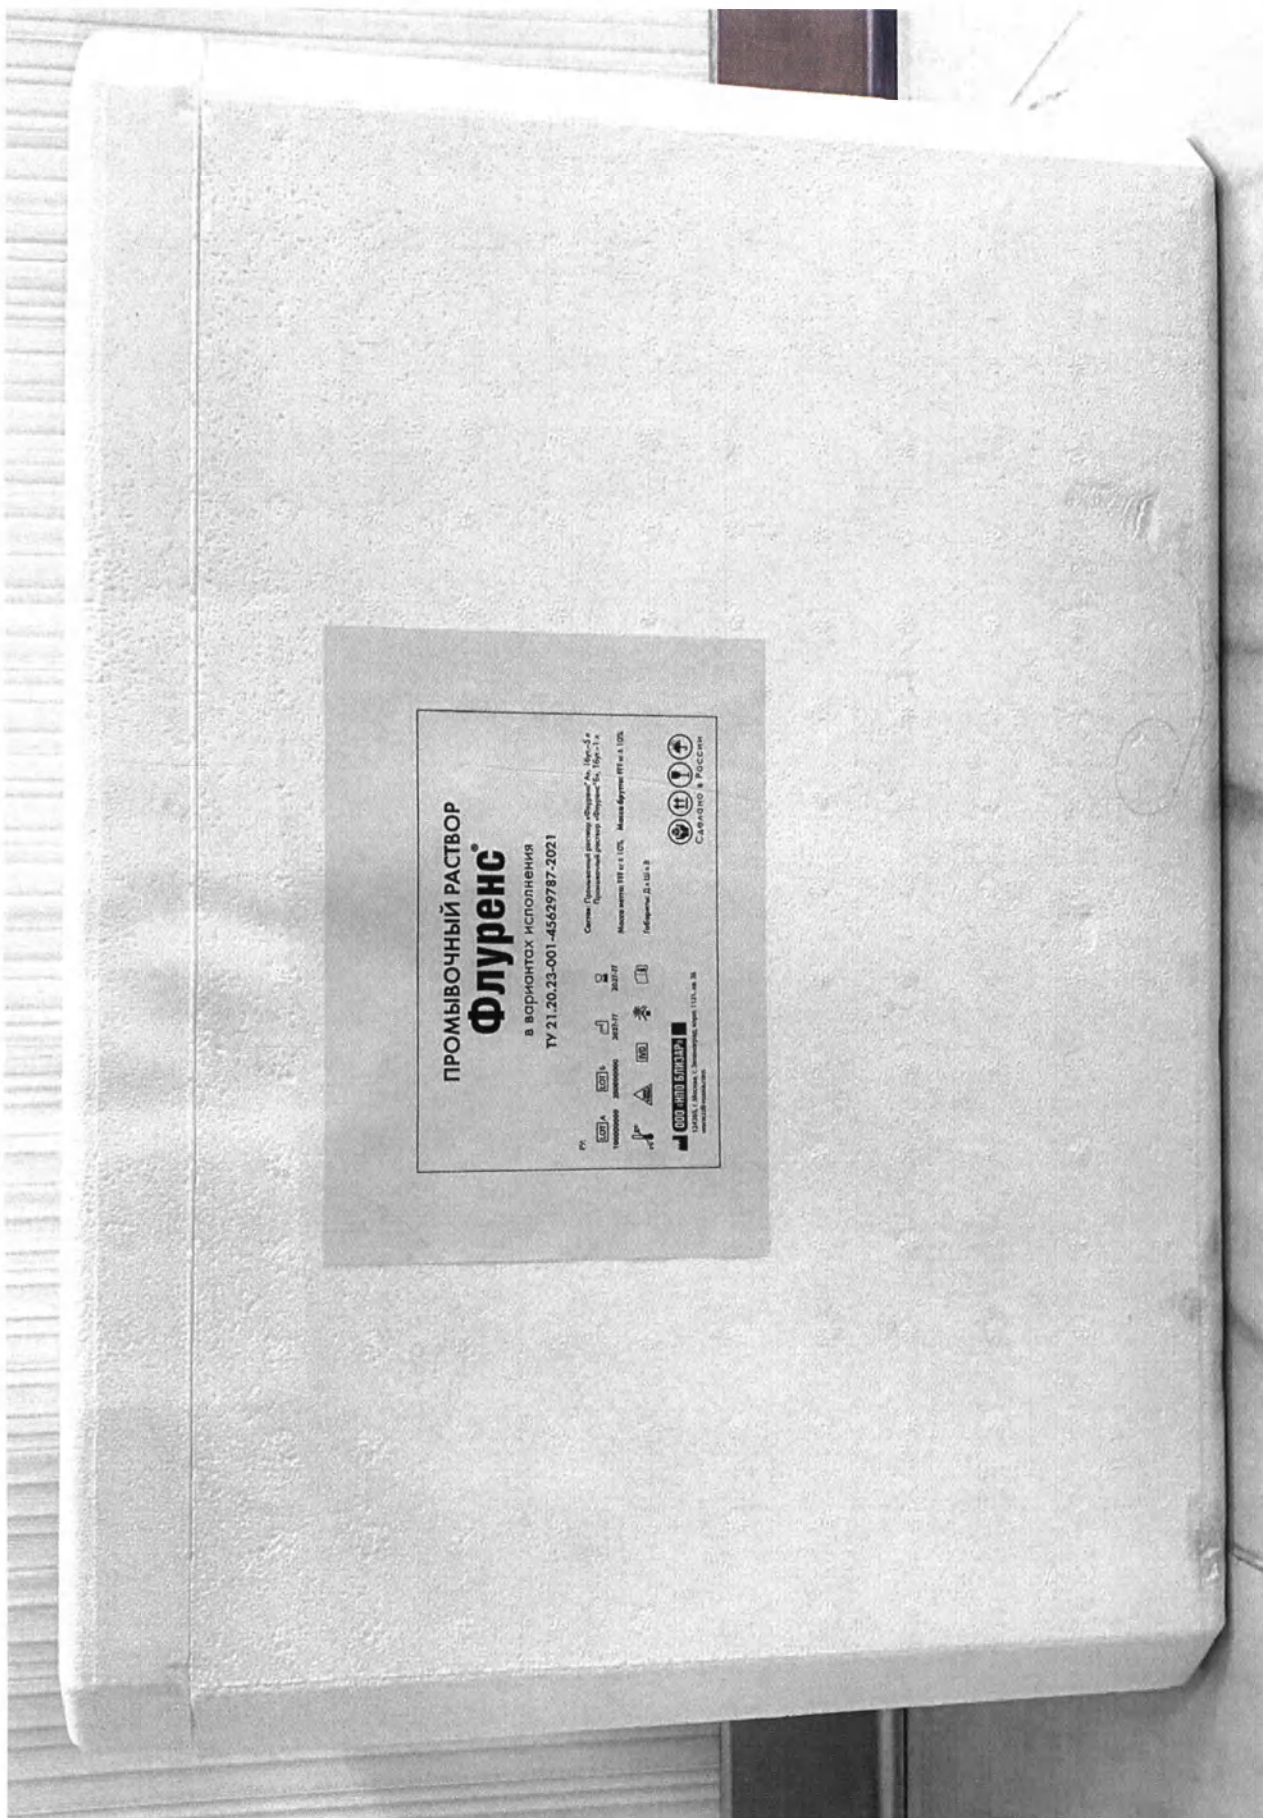


Рисунок 4 – Транспортная упаковка промывочного раствора «Флуоренс®»

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
5 (шт) листов.

Генеральный директор
ООО «НПО БЛИЗАР»
Моисеев Сергей Евгеньевич

(подпись)





УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НПО БЛИЗАР»

С.Е. Моисеев

«01» марта 2021 г.

МАКЕТ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ПРОМЫВОЧНЫЙ РАСТВОР «ФЛУРЕНС®»
ДЛЯ ХРОМАТОГРАФА ЖИДКОСТНОГО ПОРТАТИВНОГО
«БЛИЗАР CDT» ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO,
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ
ТУ 21.20.23-001-45629787-2021

1. Макет индивидуальной маркировки



Рисунок 1 – Макет маркировки индивидуальной упаковки промывочного раствора «Флуоренс® А»

Флуренс® Б

ТУ 21.20.23-001-45629787-2021

Промывочный раствор

пу:

LOT
200000000

2027-??

2027-??



Объем

5 Л



ООО "НПО БЛИЗАР"

124365, г. Москва, г. Зеленоград,
корп. 1131, кв. 36
www.cdt-russia.com



Рисунок 2 – Макет маркировки индивидуальной упаковки промывочного раствора «Флуренс® Б»,
5л

Флуренс® Б

ТУ 21.20.23-001-45629787-2021

Промывочный раствор

ПУ:



Объем
1 Л

 **ООО "НПО БЛИЗАР"**
124365, г. Москва, г. Зеленоград,
корп. 1131, кв. 36
www.cdt-russia.com



Рисунок 3 – Макет маркировки индивидуальной упаковки промывочного раствора «Флуренс® Б»,
1л

2. Макет маркировки транспортной упаковки



Рисунок 3 – Макет маркировки транспортной упаковки промывочного раствора «Флуренс®» в вариантах исполнения. Комплектность поставки 1



Рисунок 4 – Макет маркировки транспортной упаковки промывочного раствора «Флуренс®» в вариантах исполнения. Комплектность поставки 2

3. Символы, используемые в маркировке медицинского изделия

Символ	Описание
	Медицинское изделие для диагностики in vitro
	Изготовитель
	Использовать до
	Код партии
	Обратитесь к инструкции по применению
	Температурный диапазон
	Дата производства
	Не допускать воздействия солнечного света
	Не стерильно
	Беречь от влаги
	Хрупкое, обращаться осторожно
	Верх



Обращаться с осторожностью

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
7 (семь) листов.

Генеральный директор
ООО «НПО БЛИЗАР»
Моисеев Сергей Евгеньевич


(подпись)

