

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «СОЛТ»

«12» апреля 2021 г.

В.В. Запц



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Анализаторы автоматические иммунохимические OC-Sensor для количественного in vitro определения гемоглобина (скрытой крови) в образцах кала человека в вариантах исполнения OC-SENSOR io, OC-SENSOR PLEDIA с принадлежностями (см. Приложение),

производства

EIKEN CHEMICAL CO., LTD. (ЭЙКЕН КЕМИКАЛ КО., ЛТД), Япония.

Анализатор OC-SENSOR io




MODEL	OC-SENSOR io	IVD
SERIAL	19CE1168	
POWER	100-240V	CE
	150W	
	50/60Hz	


  **EIKEN CHEMICAL CO., LTD.**
4-19-9, Taito, Taito-ku, Tokyo 110-8408, Japan

  **WELLKANG TECH CONSULTING**
Suite B, 29 Harley Street, London, W1G 9QR, UK
MADE IN JAPAN

Шнур питания

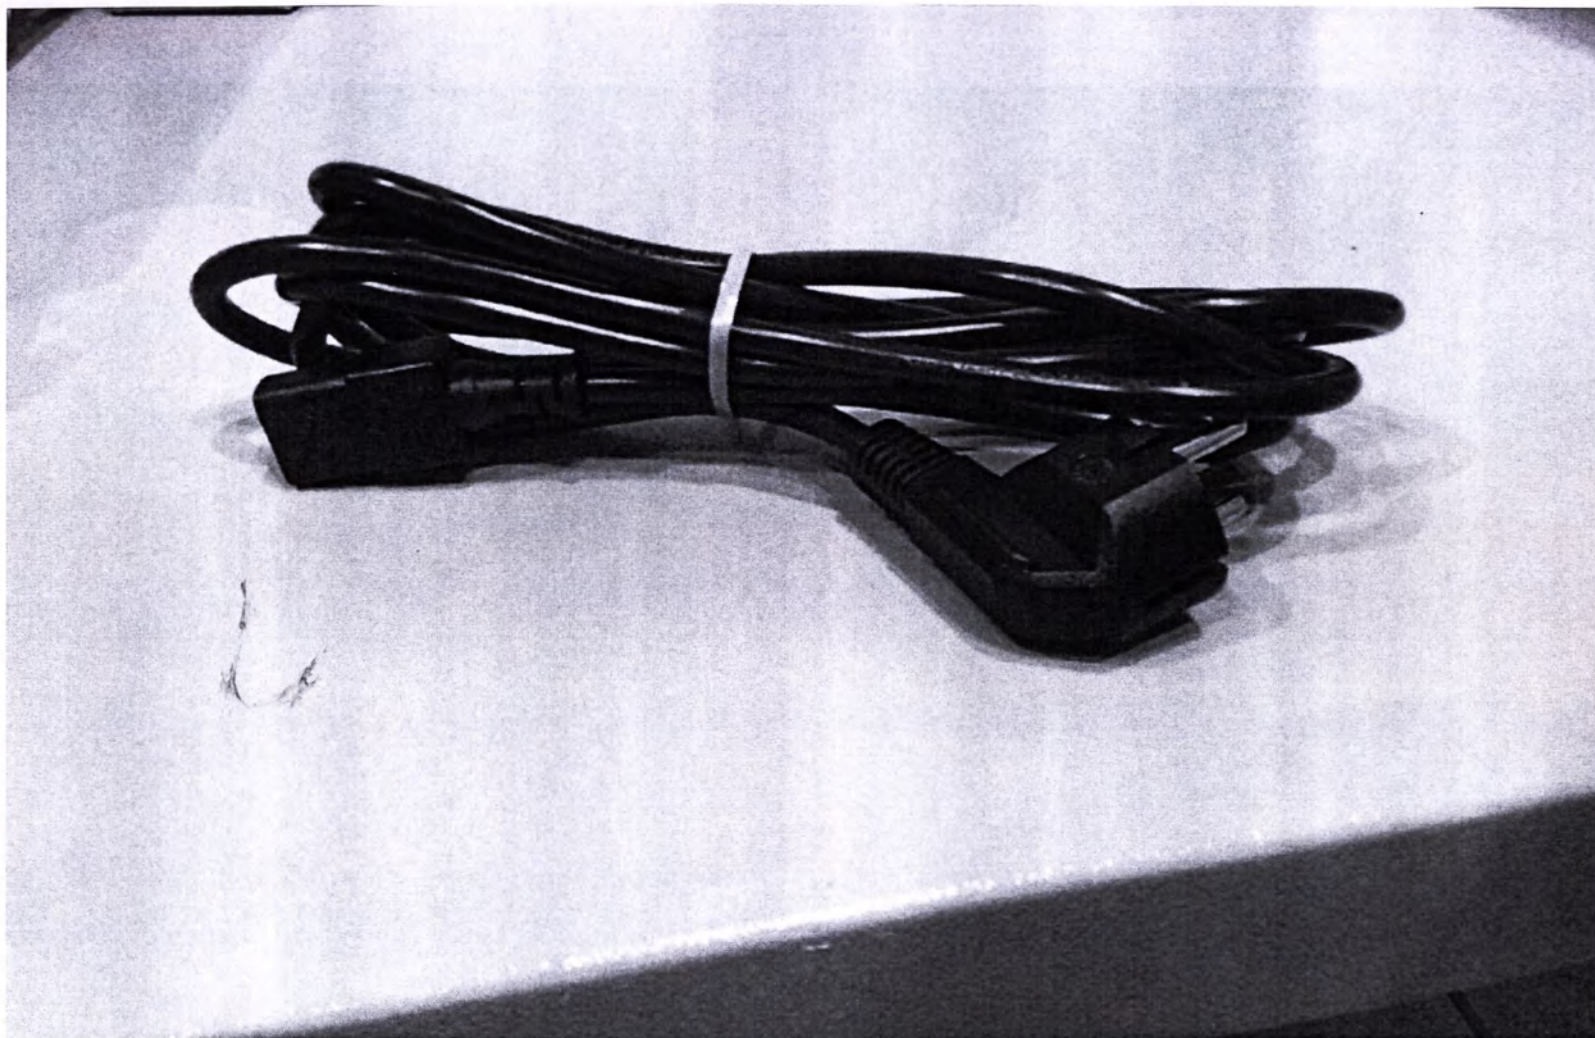


Бутыль для буферного раствора на 250 мл

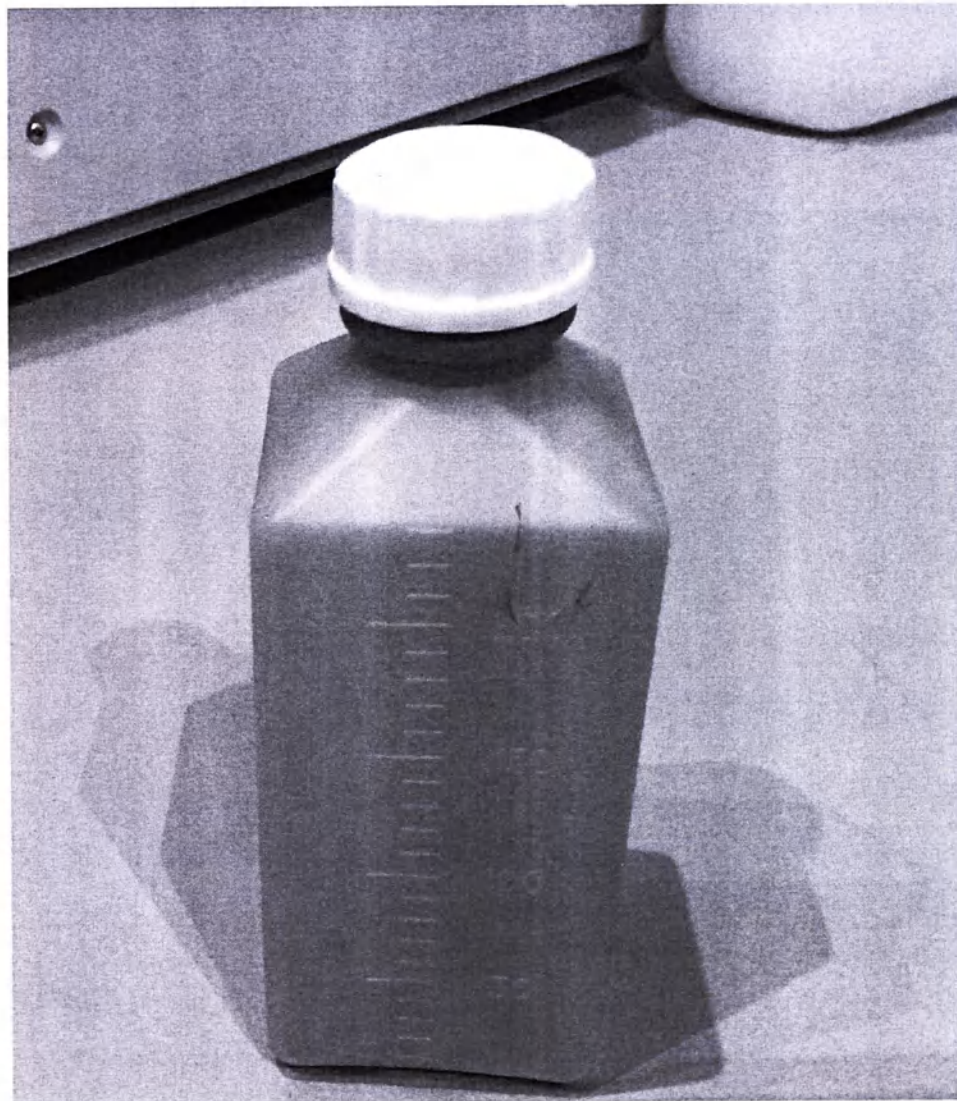


Бутыль для очищенной воды на 500 мл




Бутыли для промывочного раствора на 500 мл

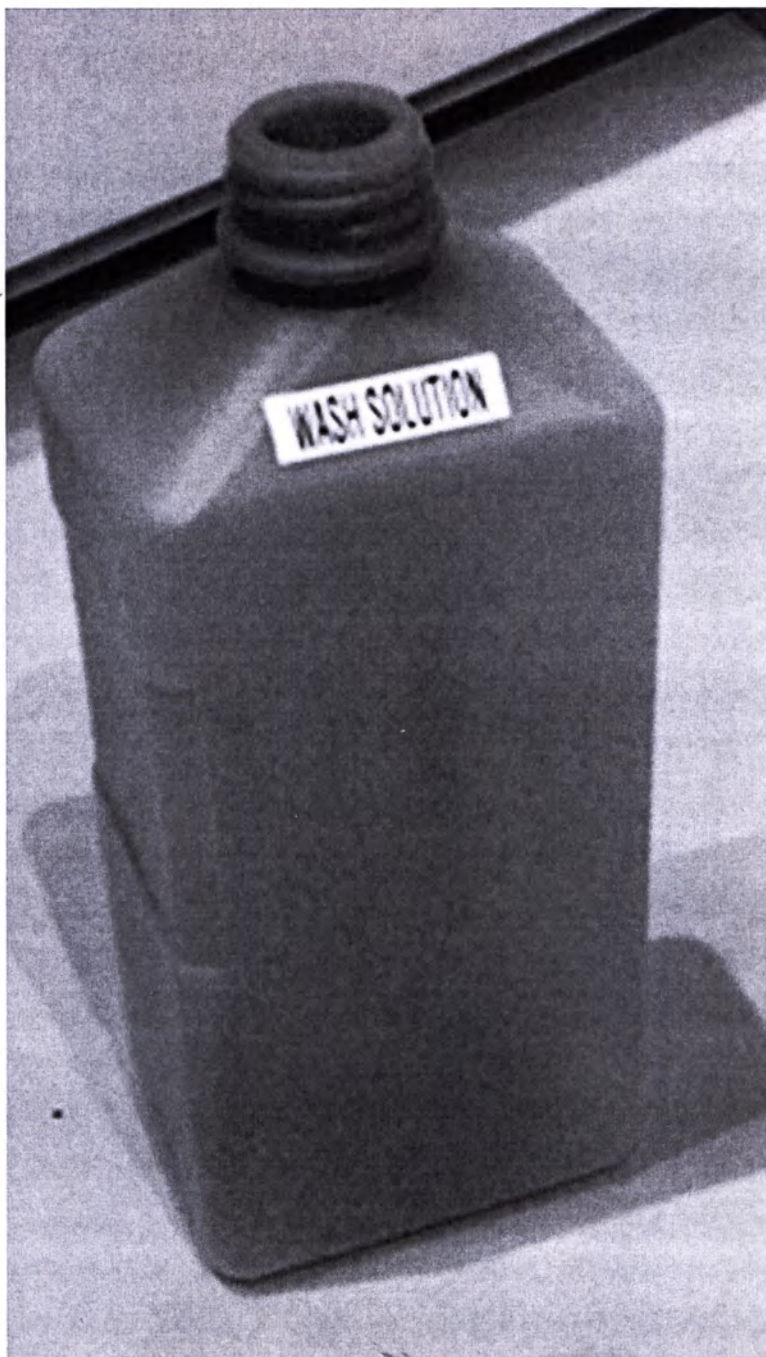


Патрубок коленчатый

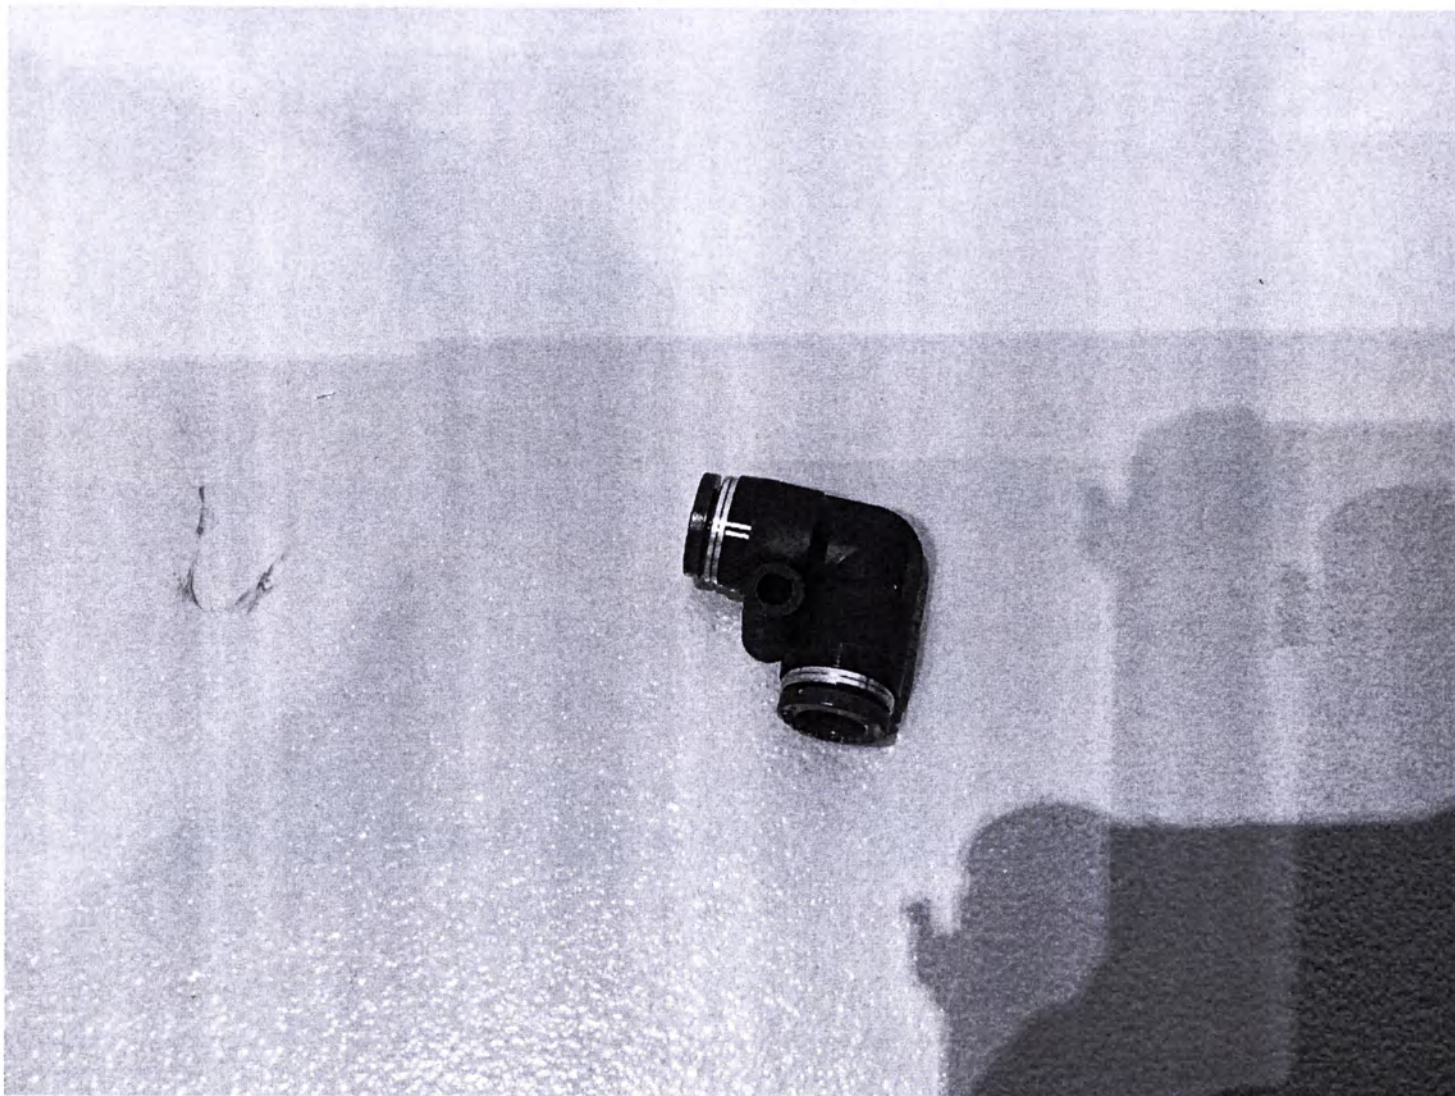


Переходник

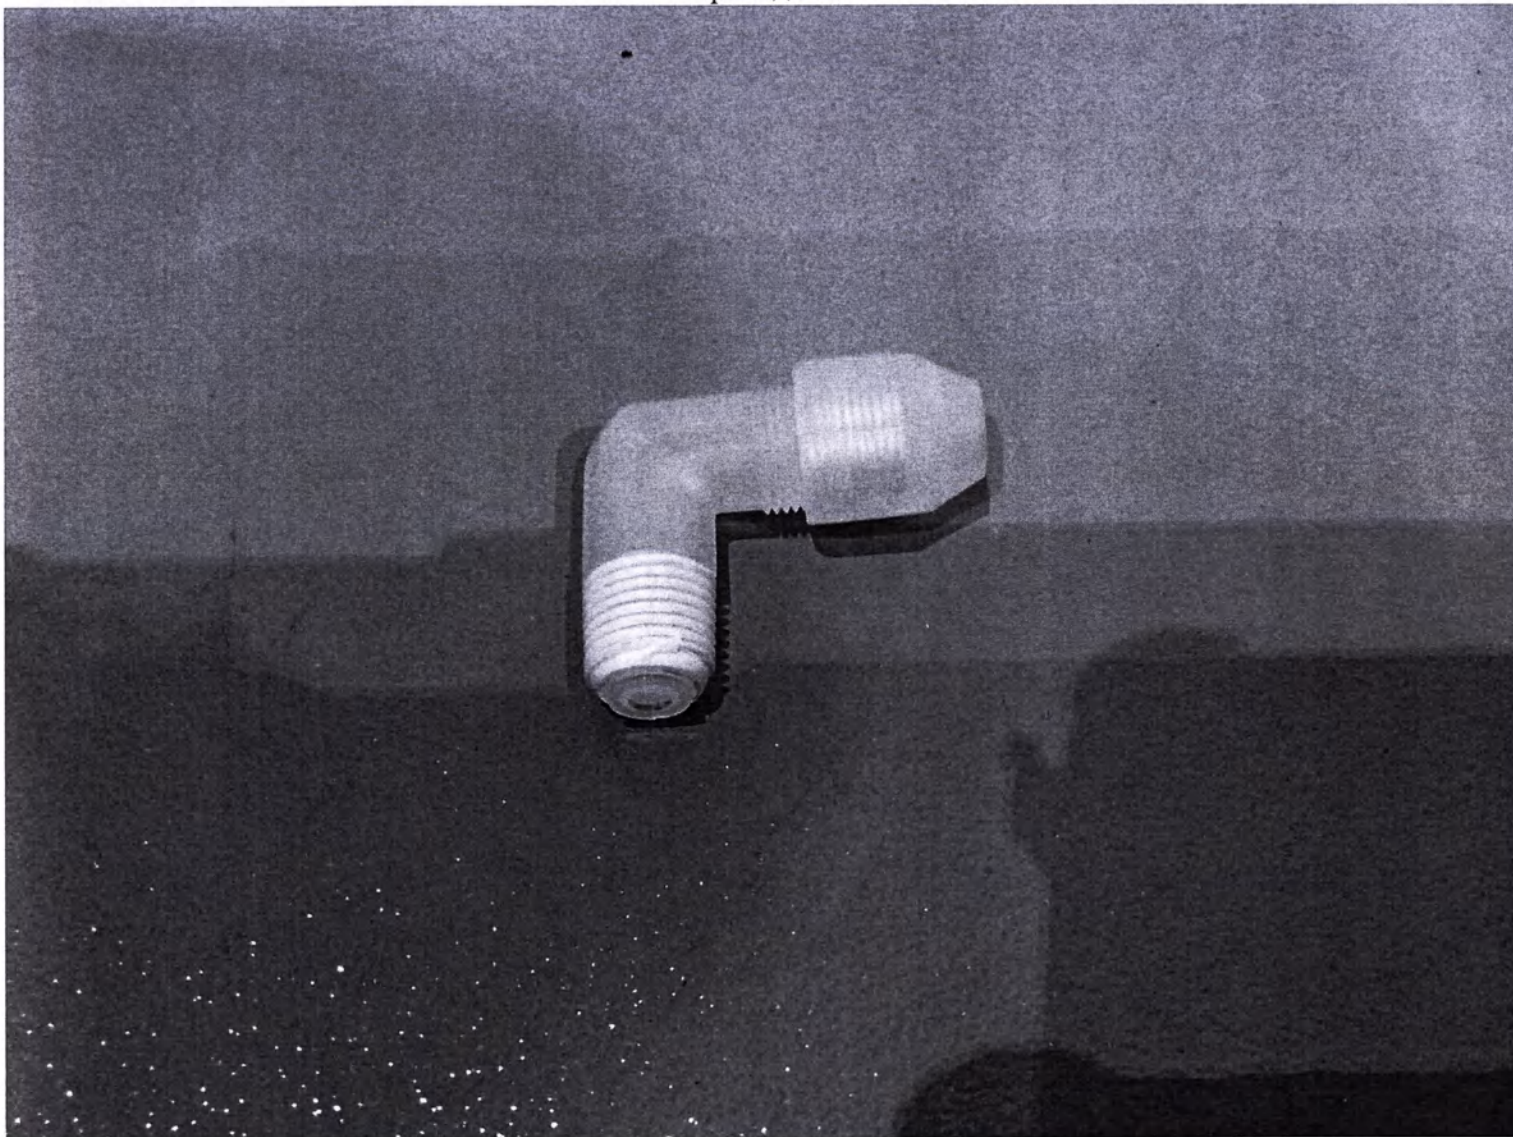


Термобумага рулонная

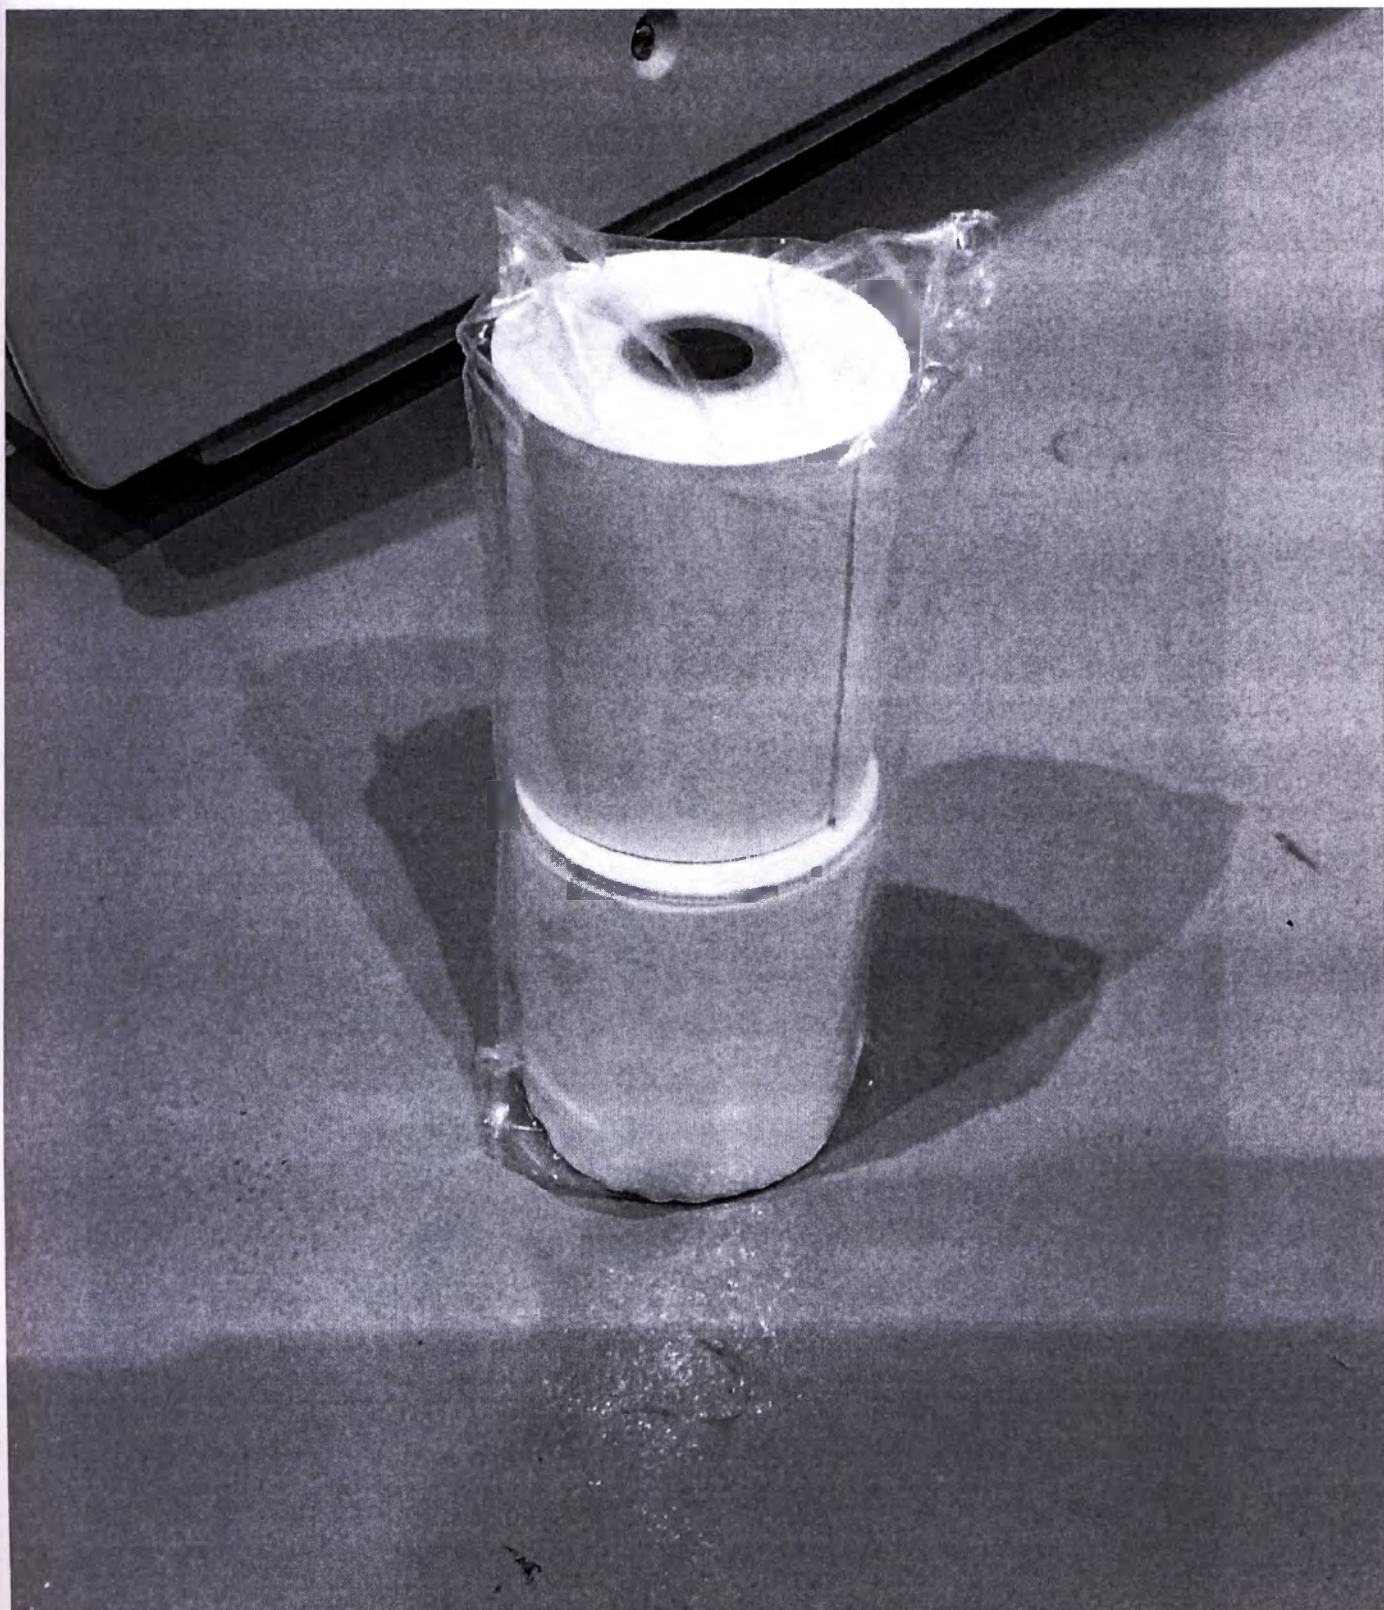


Сливная трубка

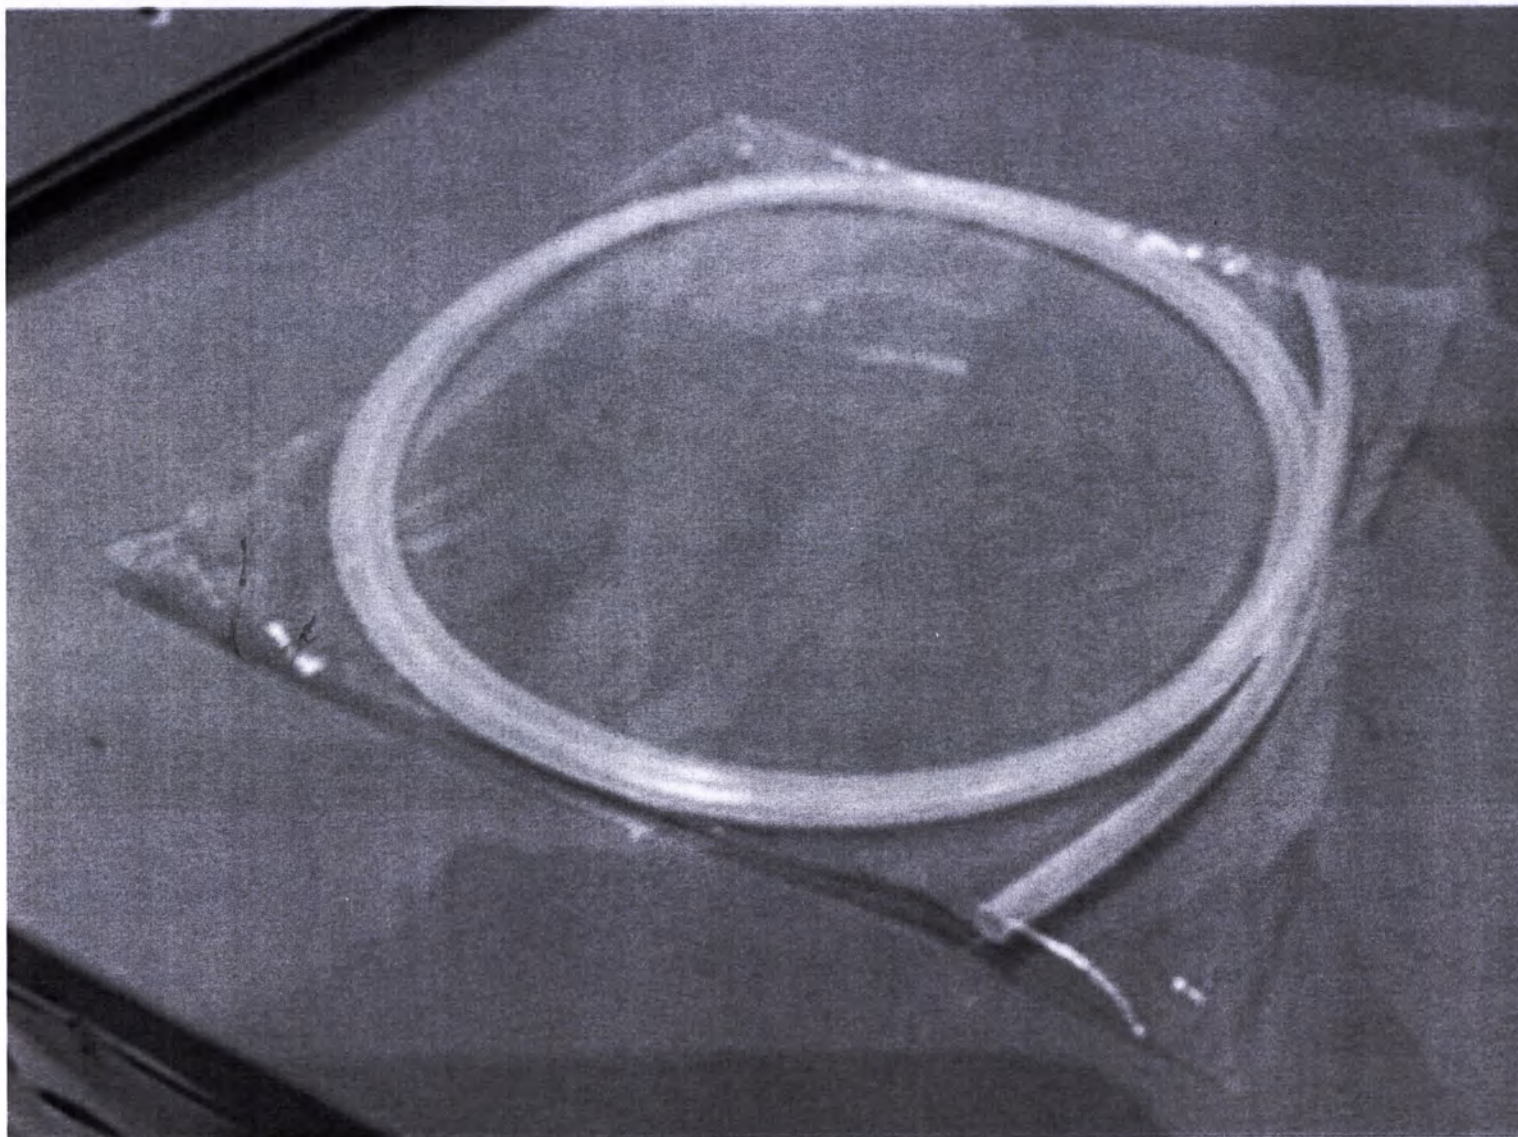


Штатив для образцов

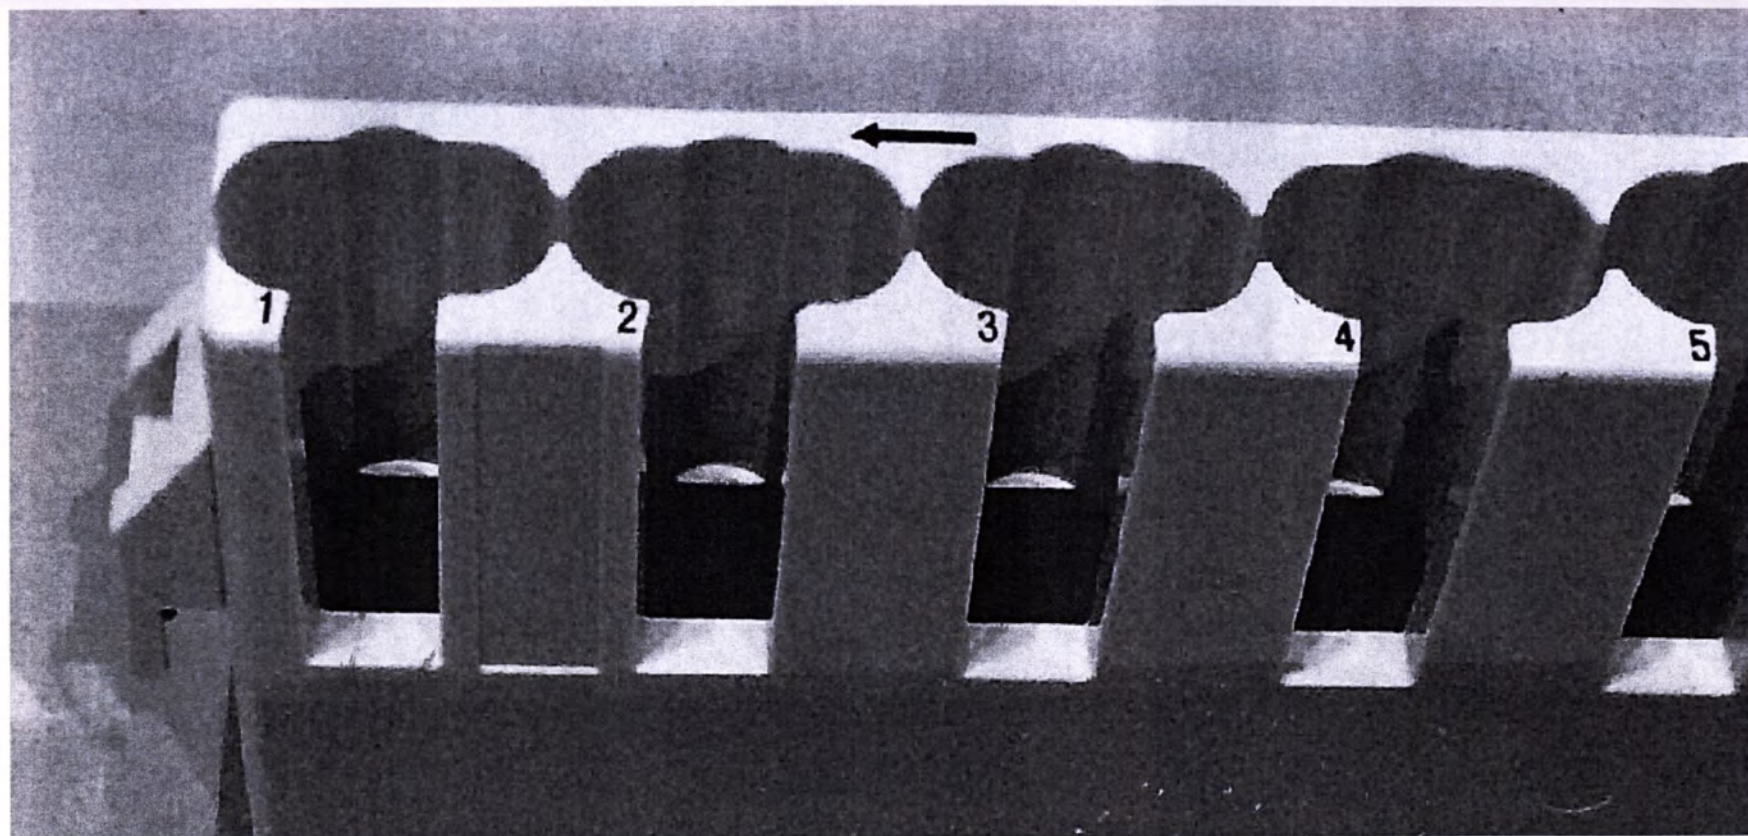


Этикетка со штрих-кодом штатива

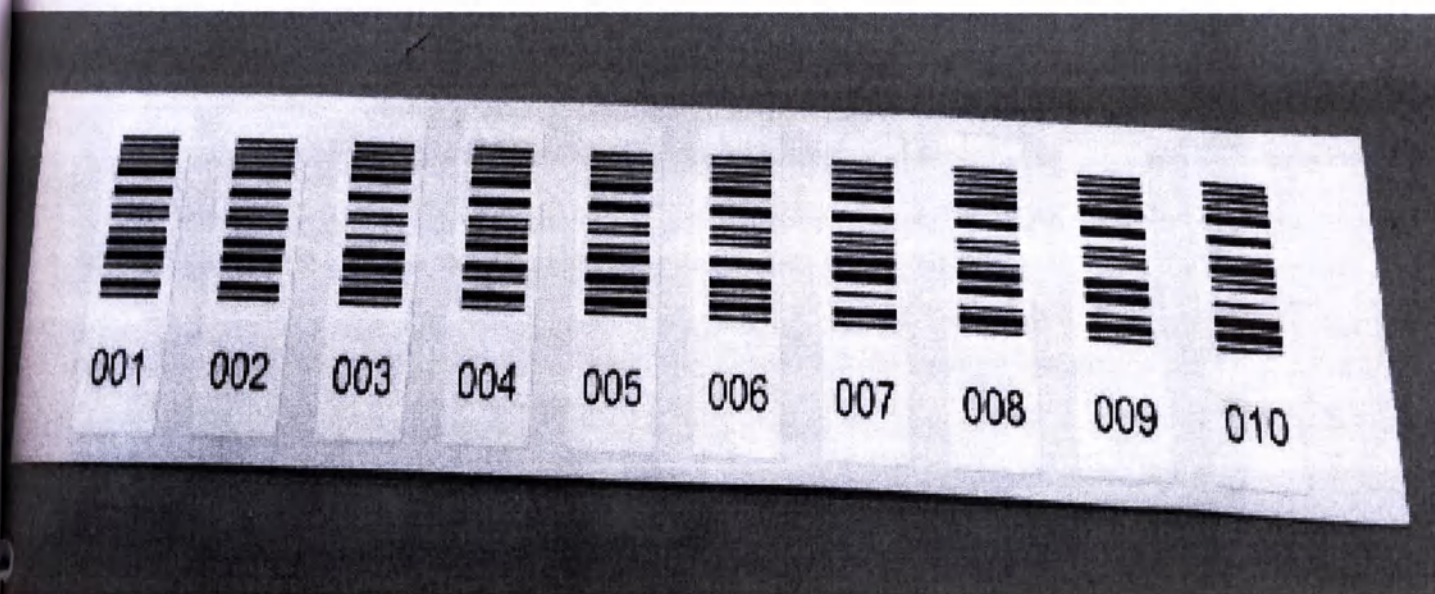


Предохранитель

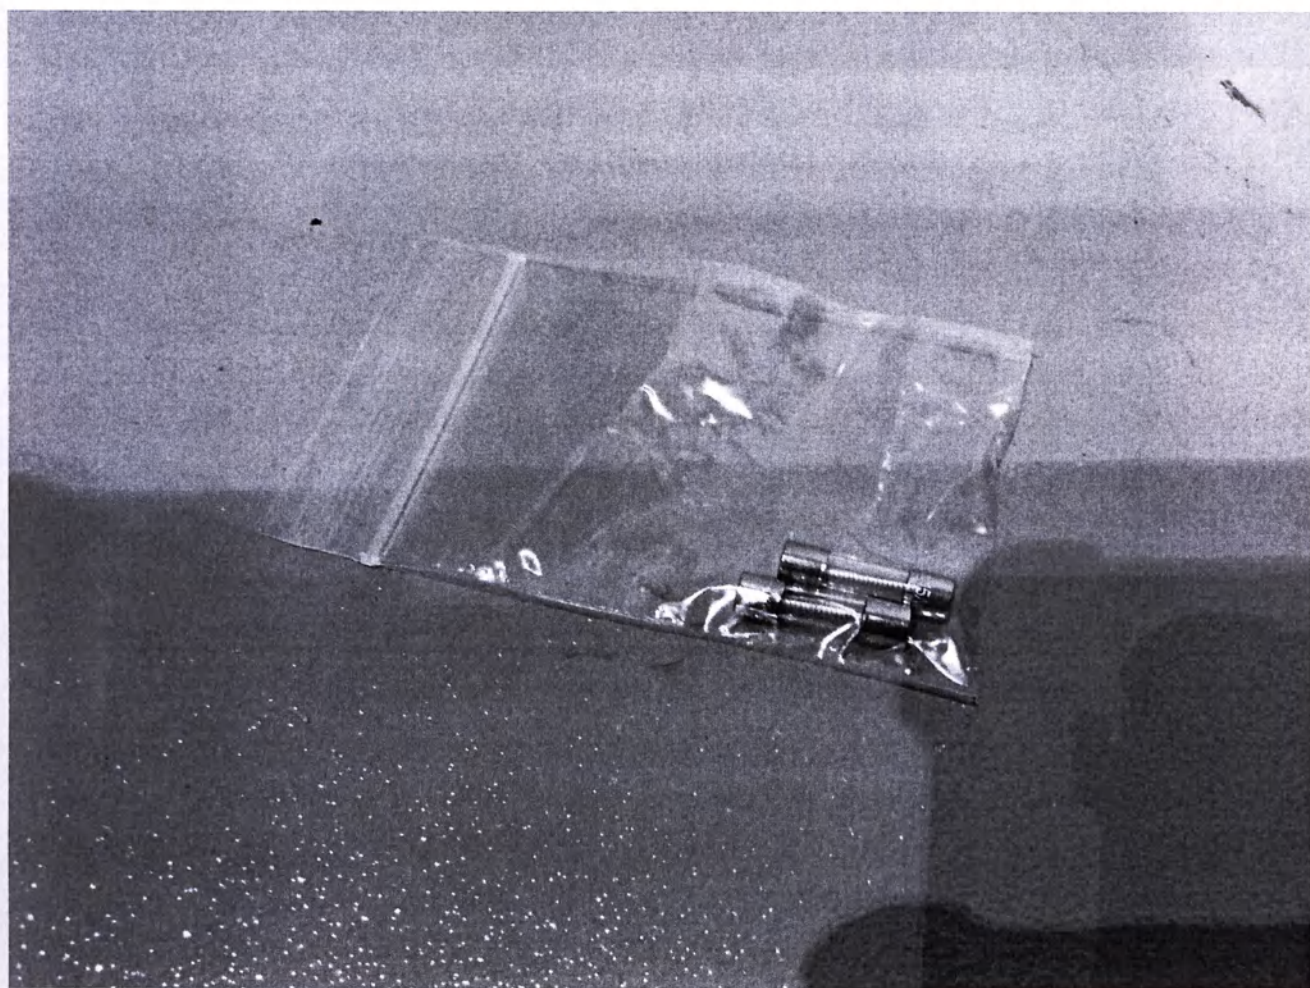


Кювета-картридж 10-секционная реакционная DISPO-1


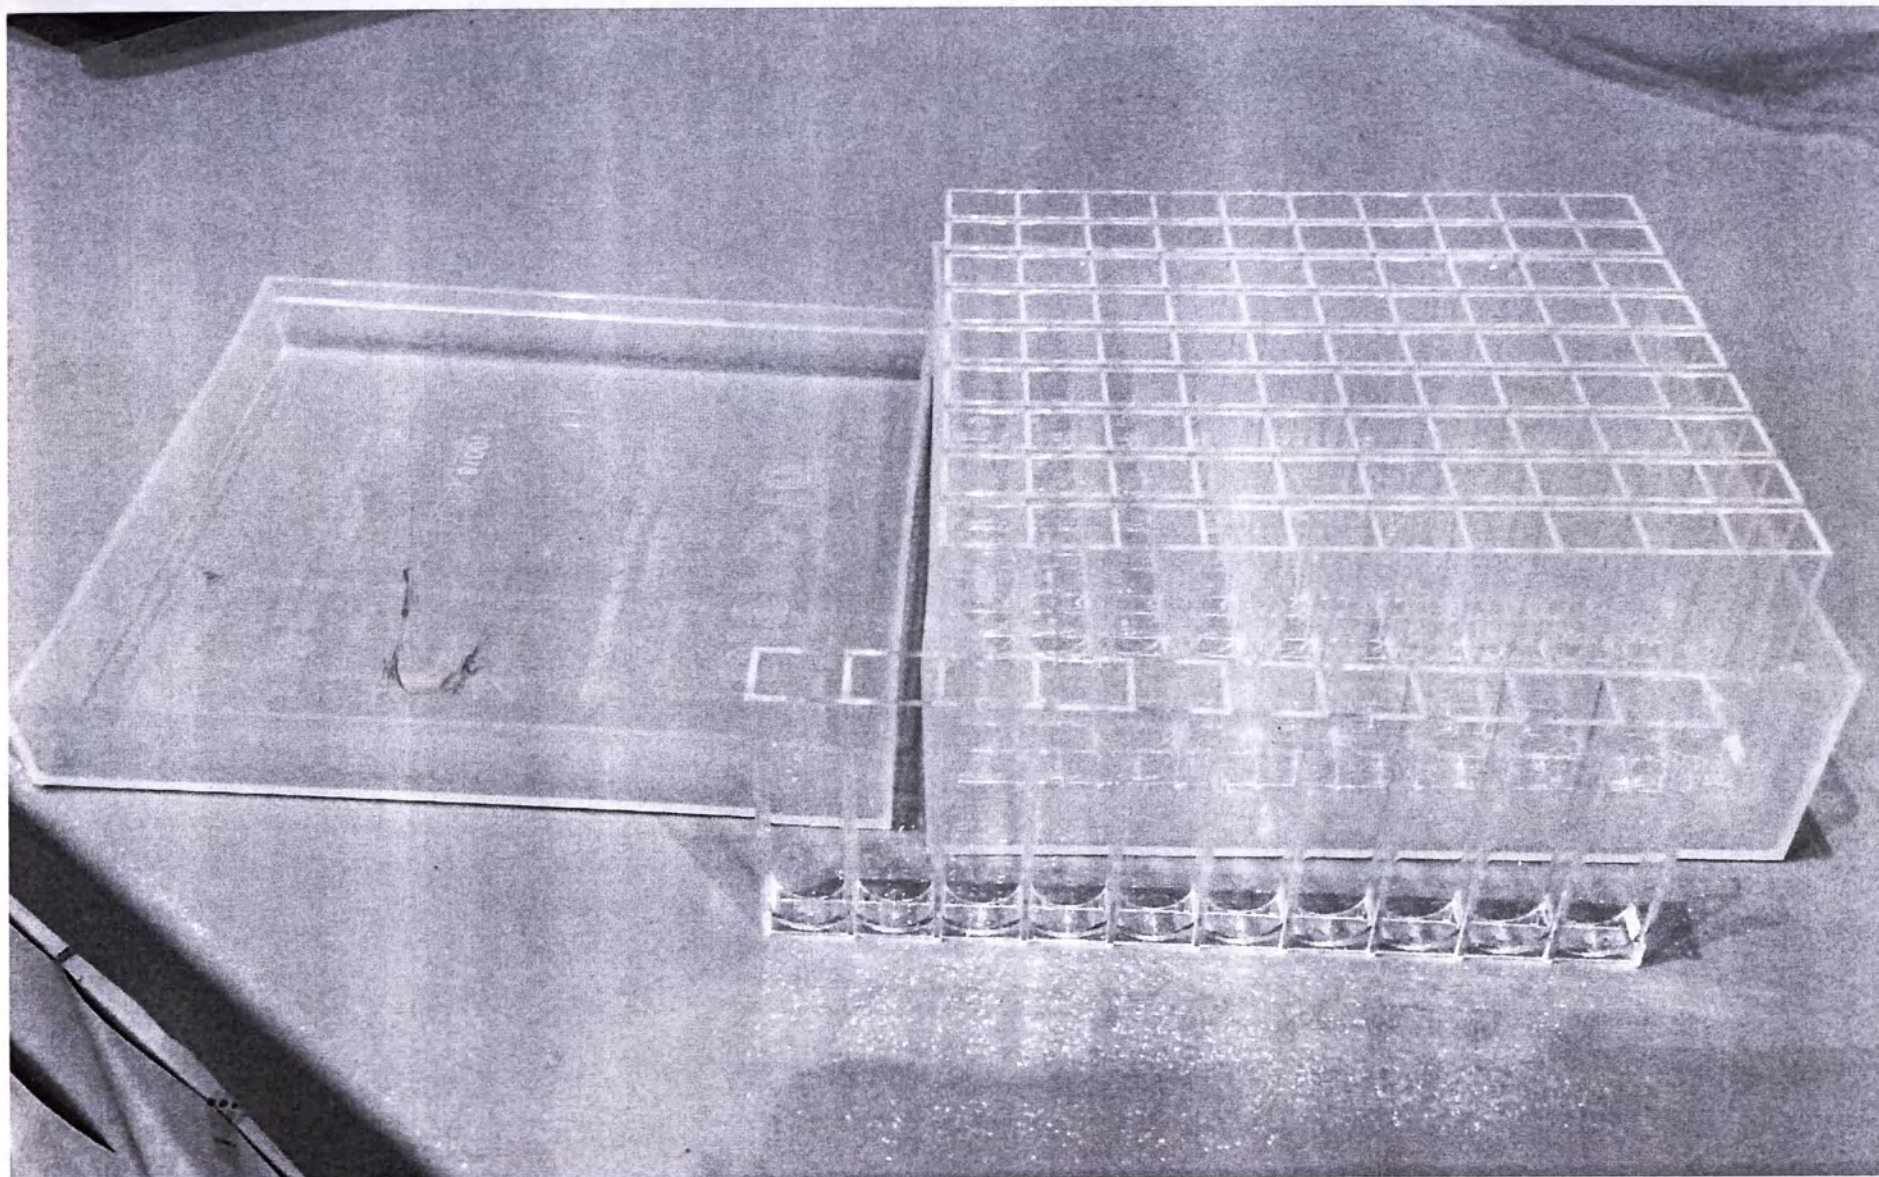


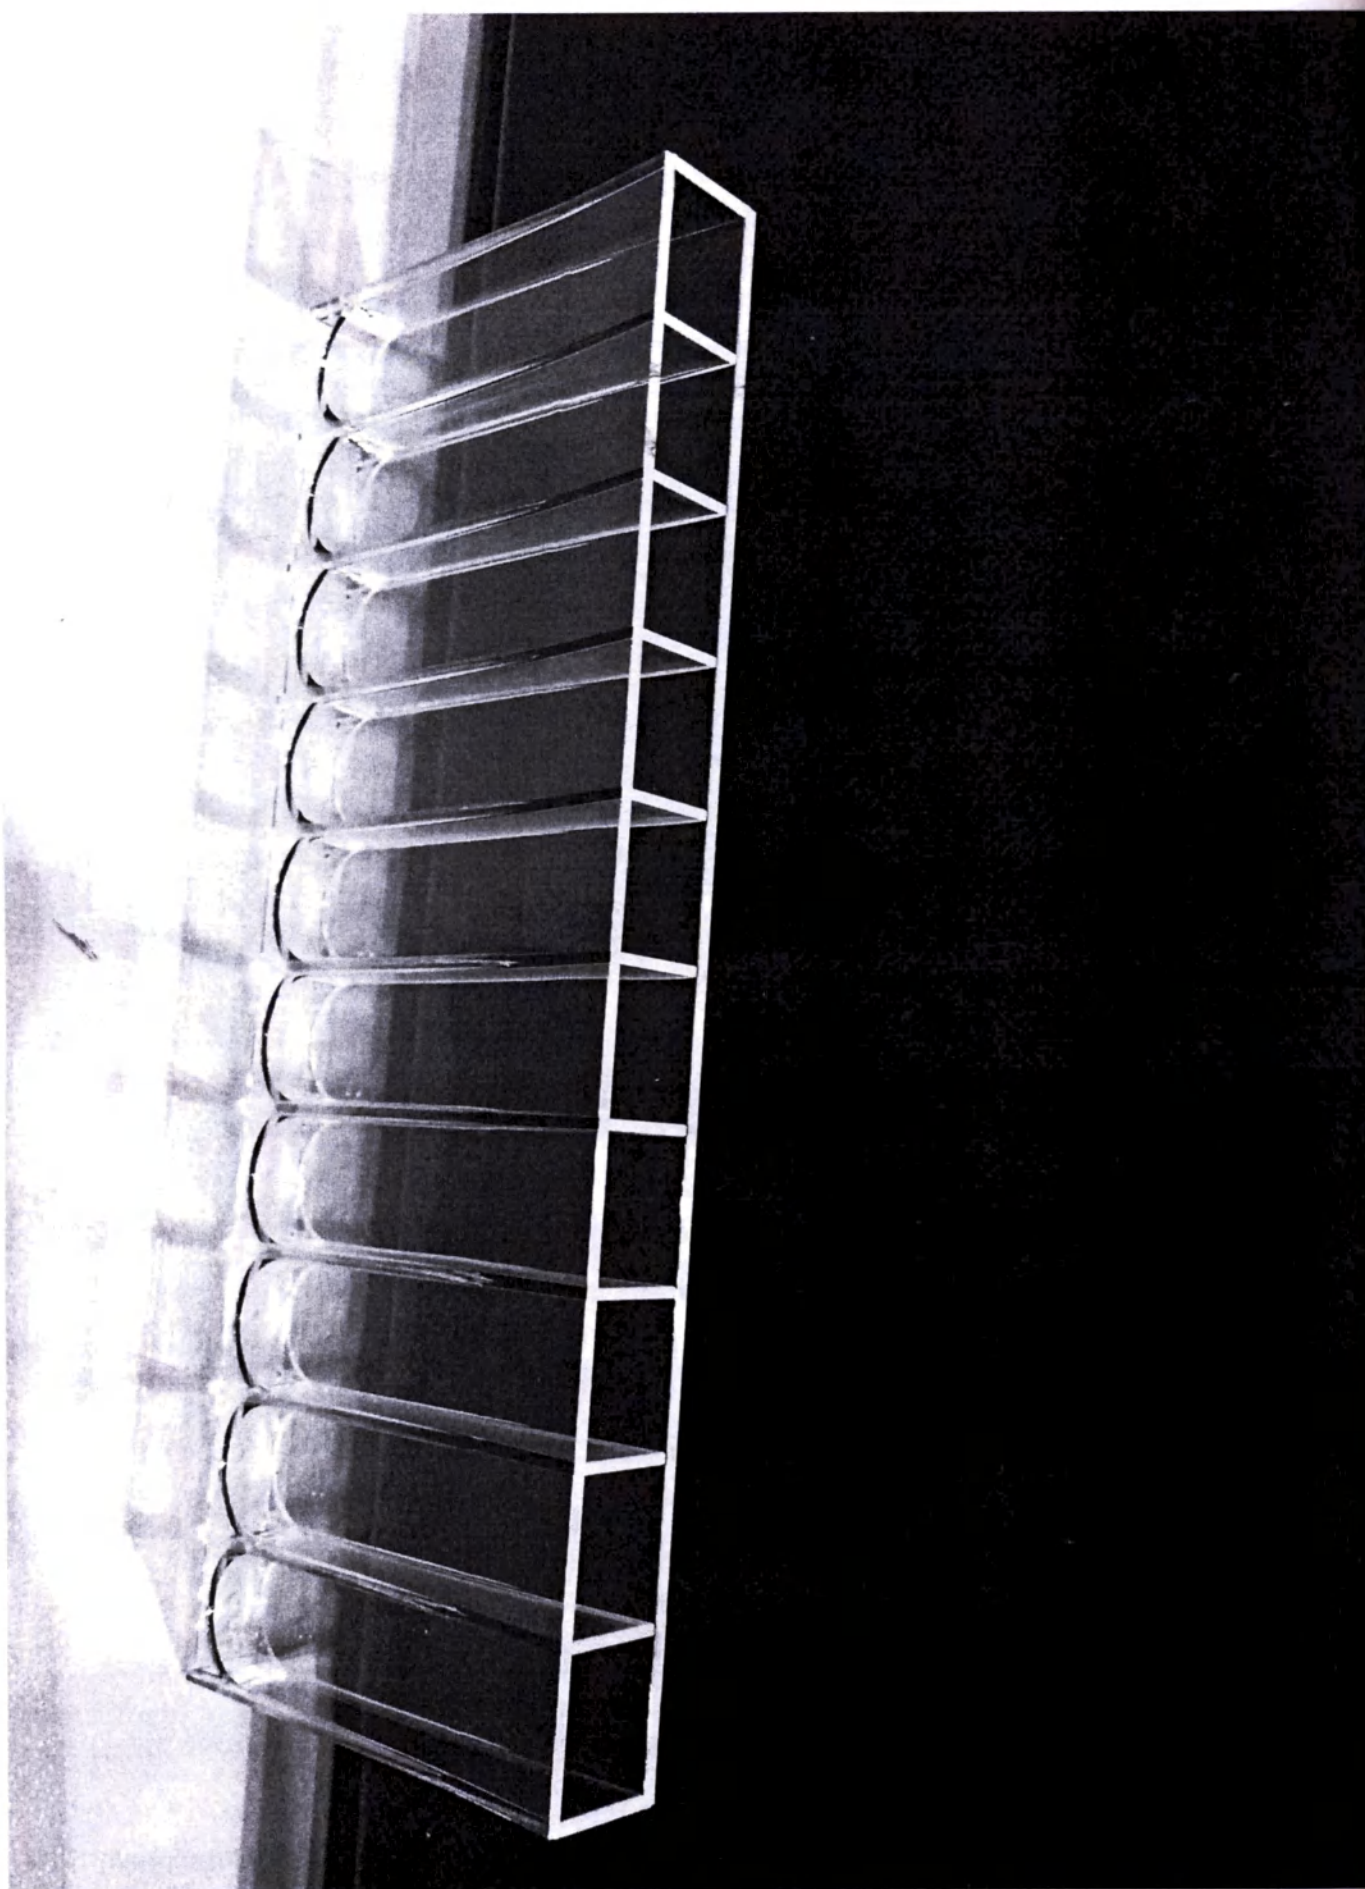

Стартовый набор реагентов ОС-Auto 3 для количественного определения гемоглобина (скрытой крови) в кале в составе:


- латексный реагент ОС-AUTO 3 Latex Reagent (флакон 7 мл – 2 шт.);

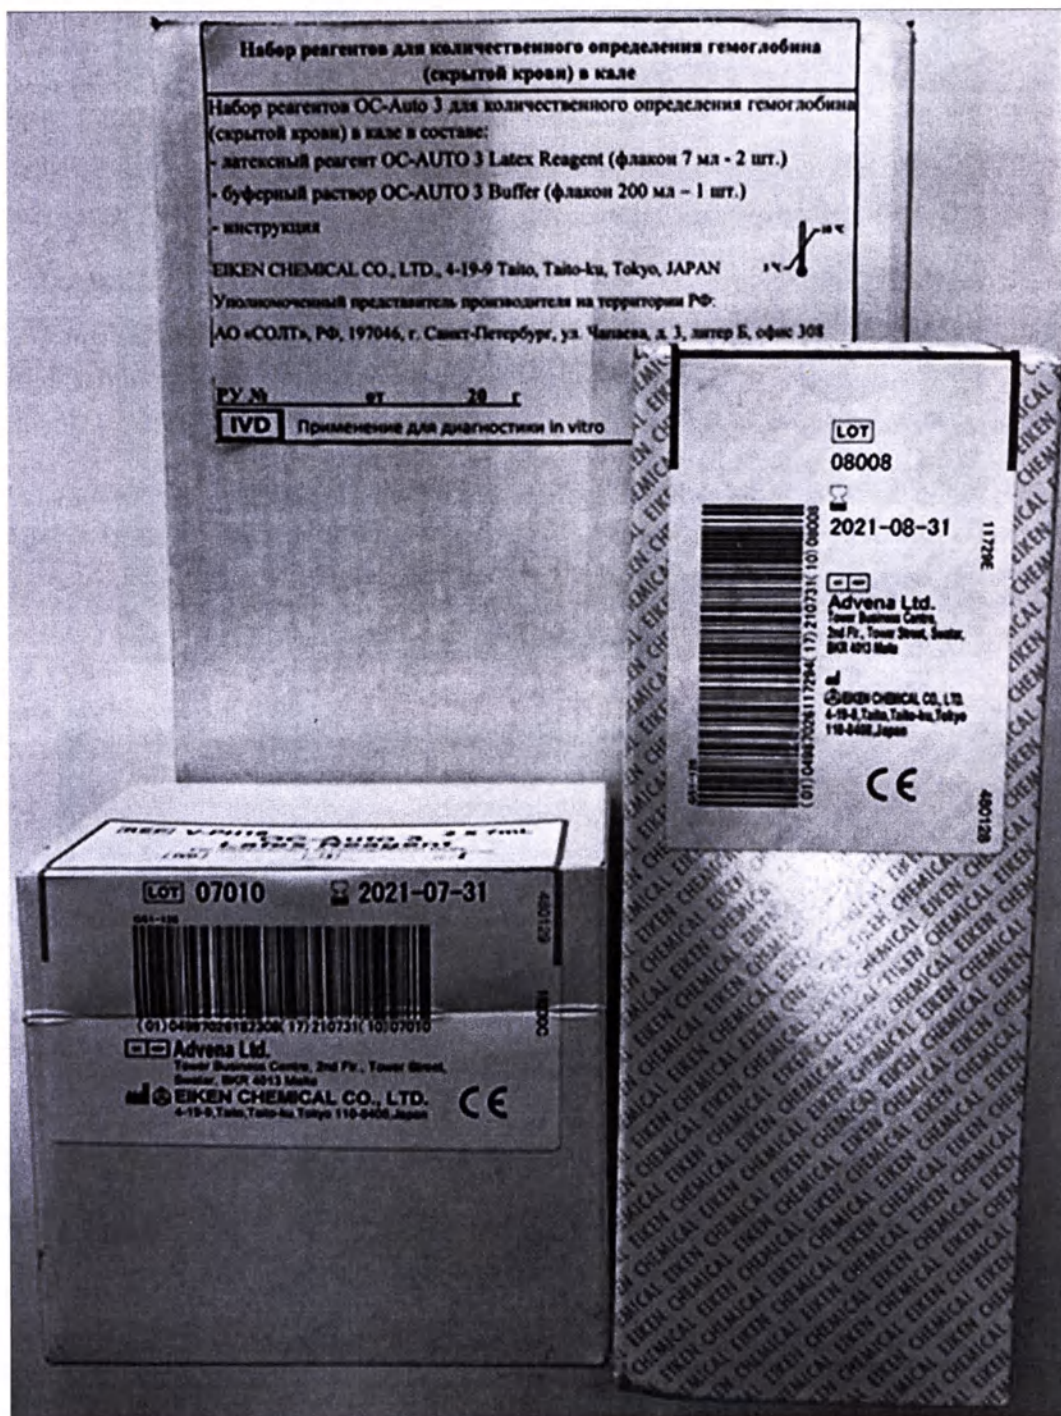

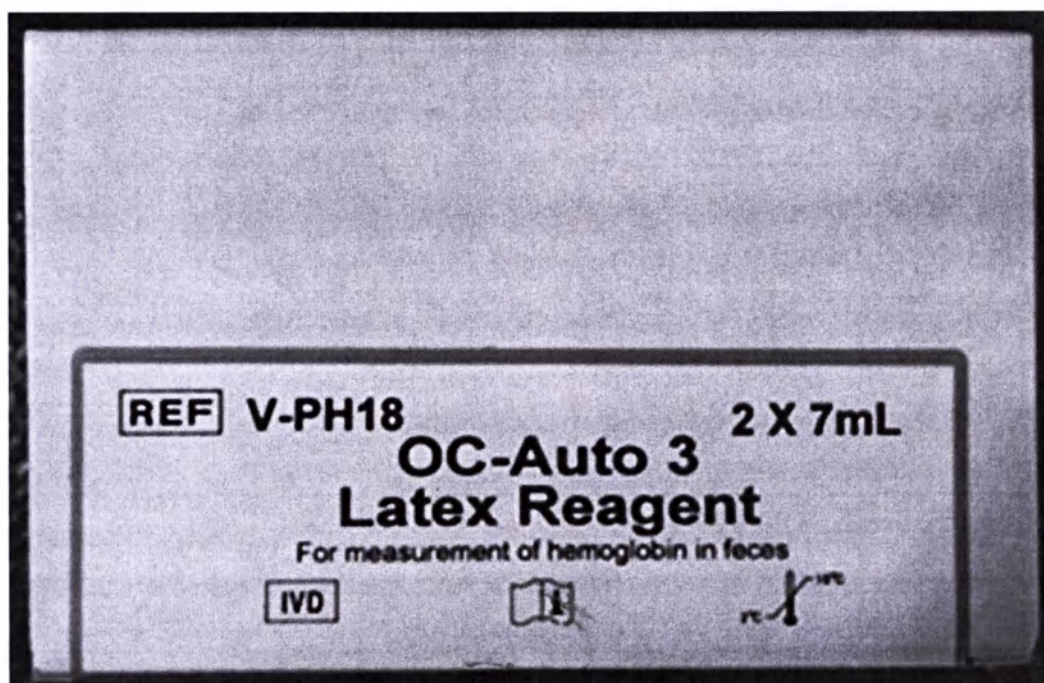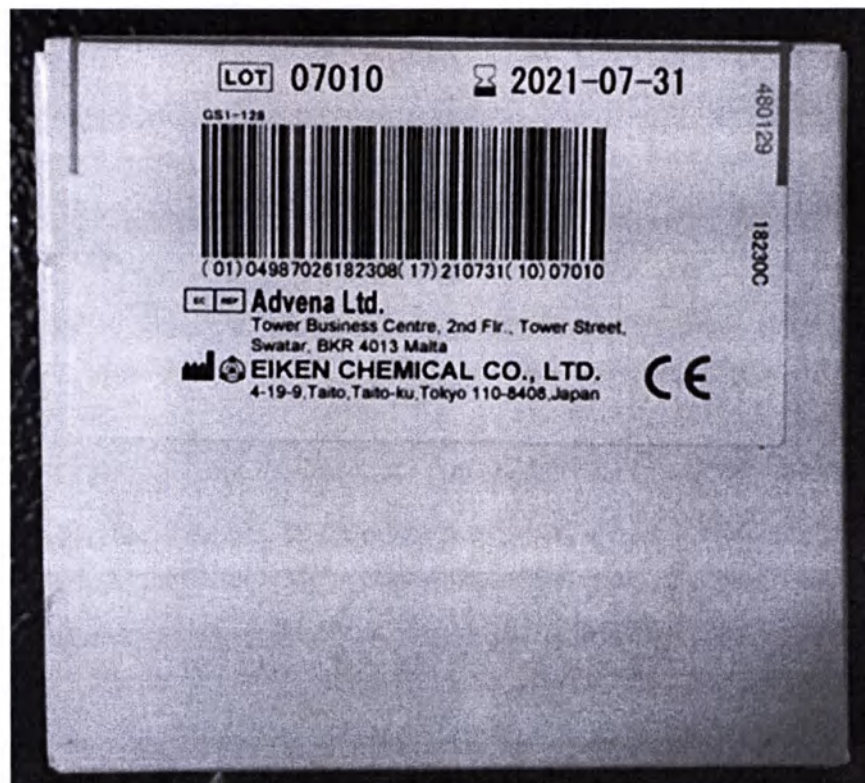










- буферный раствор OC-AUTO 3 Buffer (флакон 200 мл – 1 шт.)

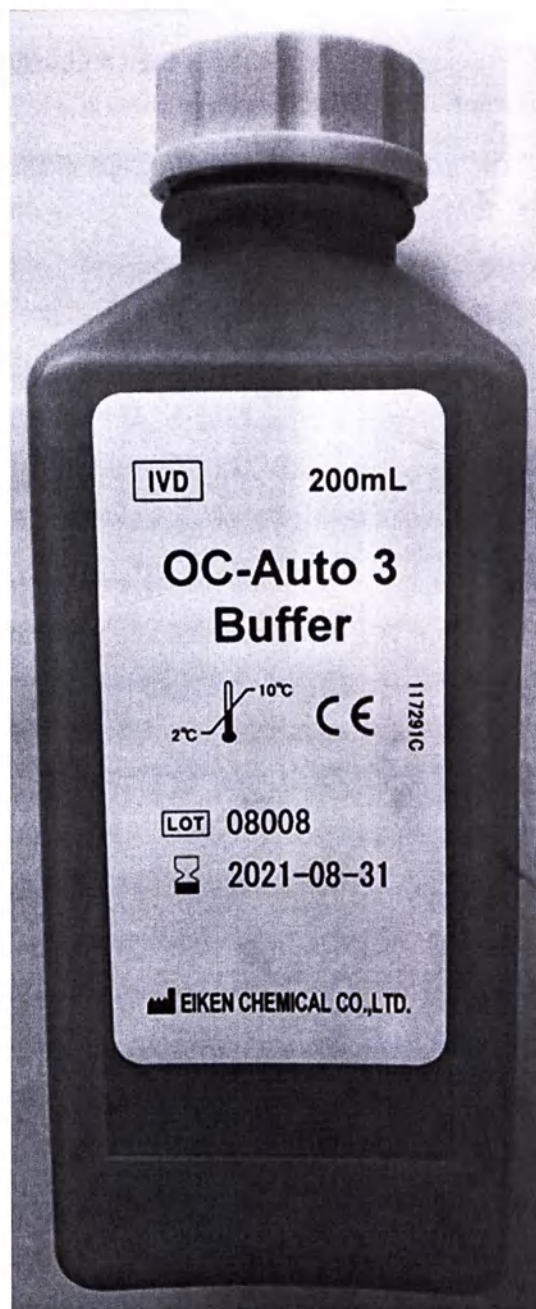


Набор Калибраторов для количественного определения гемоглобина (скрытой крови) в кале OC-Calibrator 2 kit в составе:

- калибратор OC-Calibrator 2 (флакон 3 мл – 1 шт.);
- растворитель калибратора OC-Calibrator Diluent (флакон 45 мл – 1 шт.);
- инструкция.

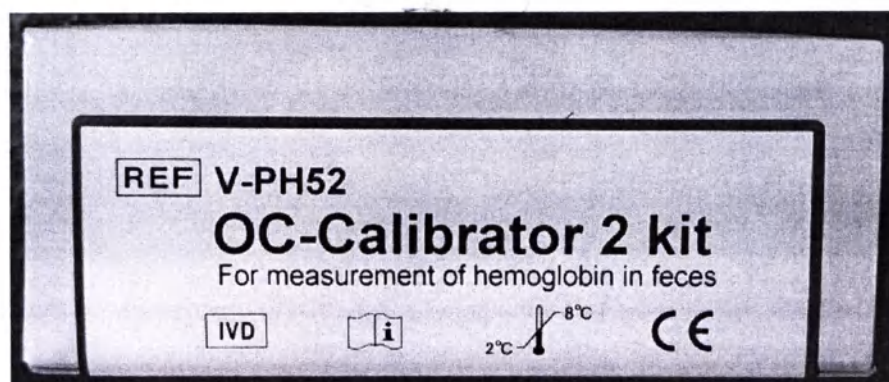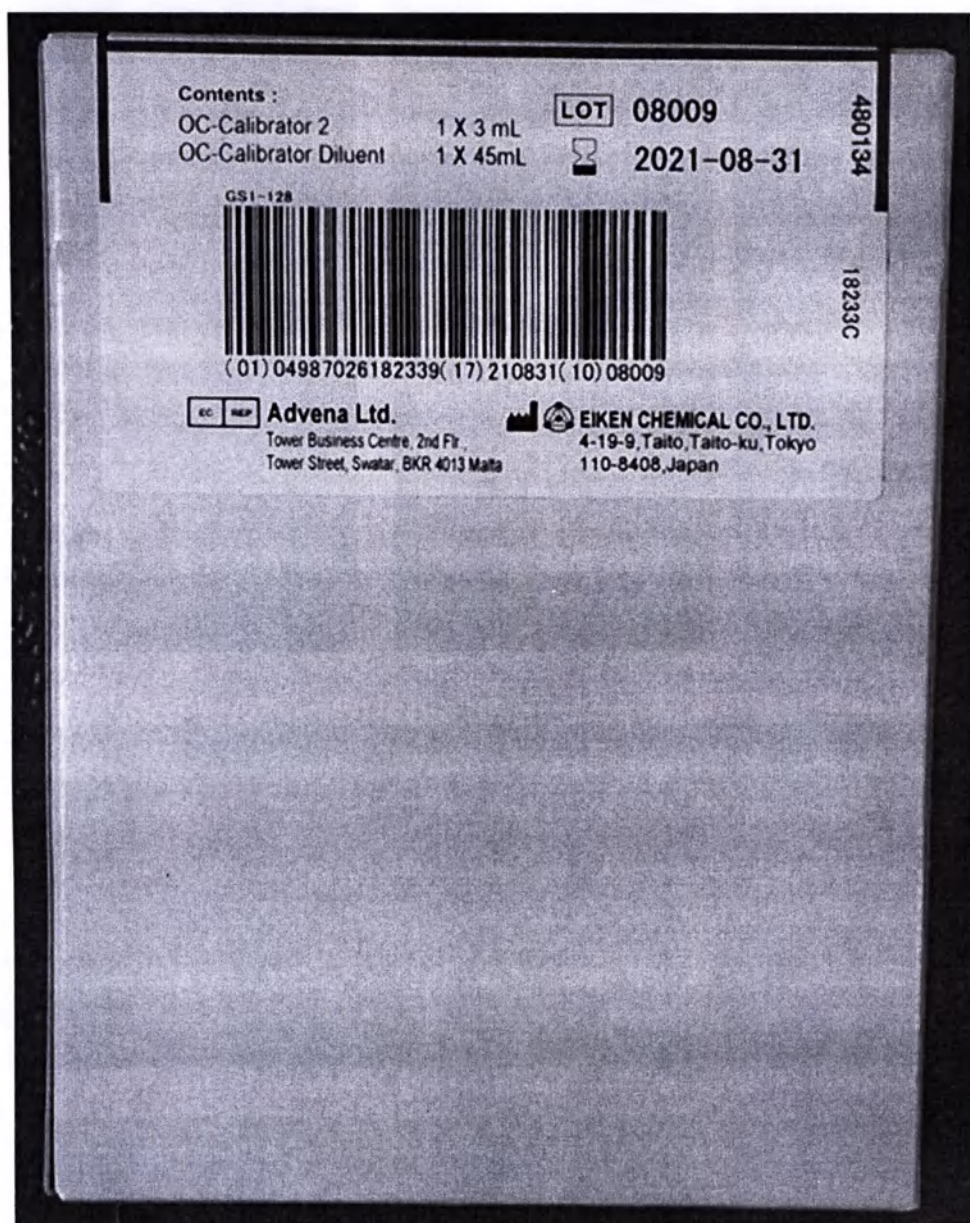


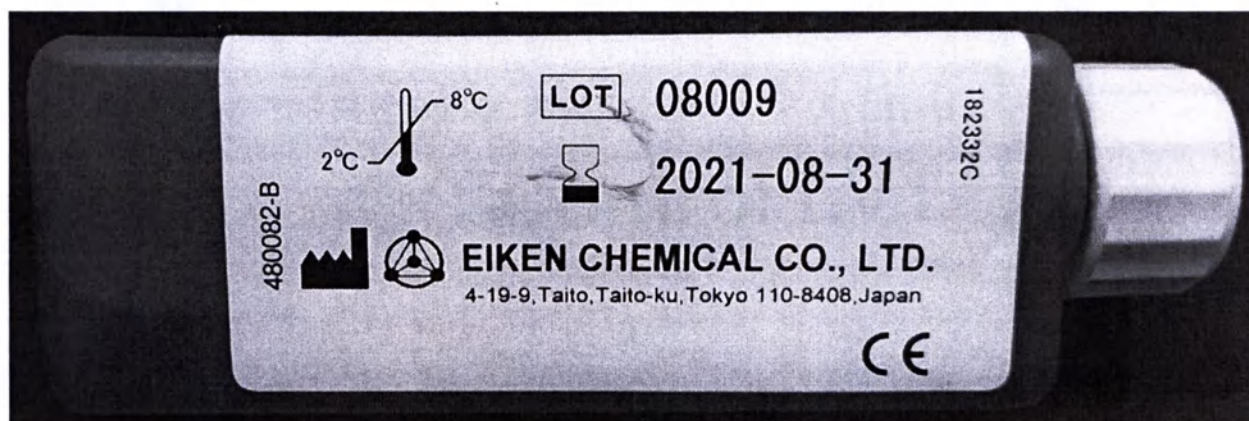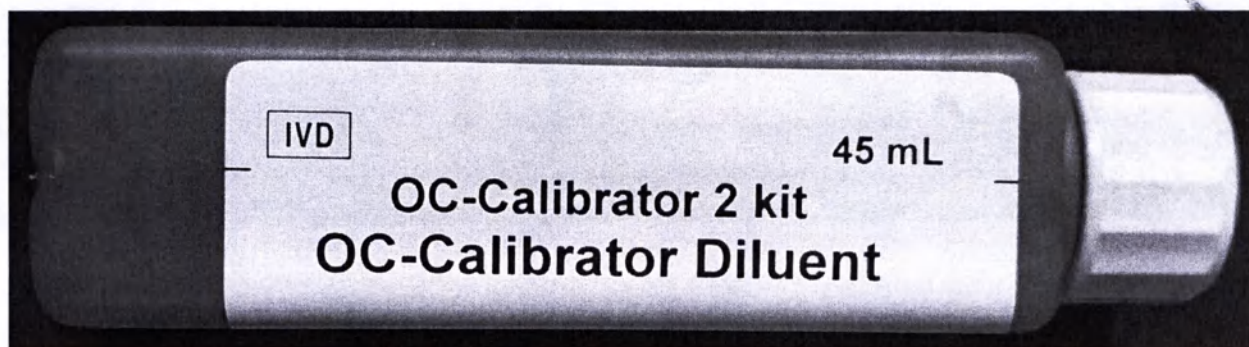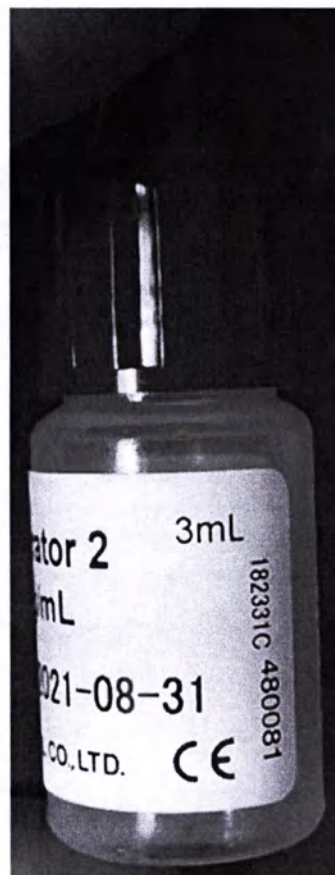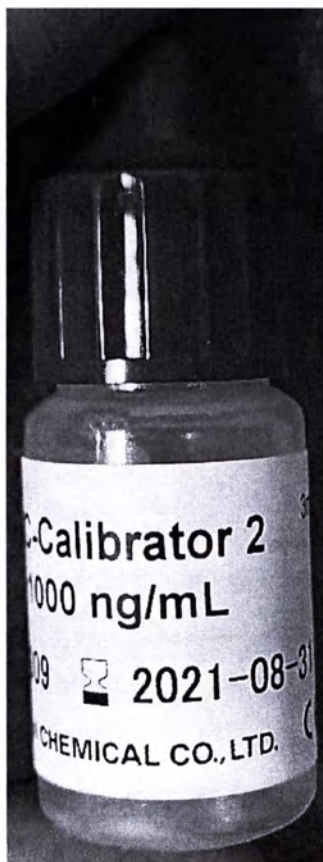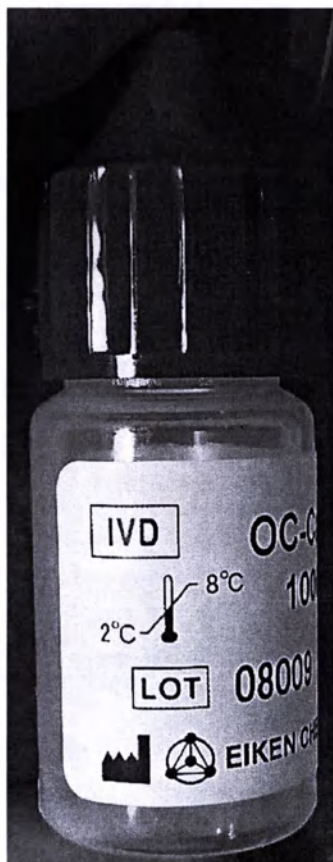


Контрольный материал для количественного определения гемоглобина (скрытой крови) в кале OC-Control LV1 в составе: OC-Control LV1 (флакон 5 мл - 2 шт.), инструкция.

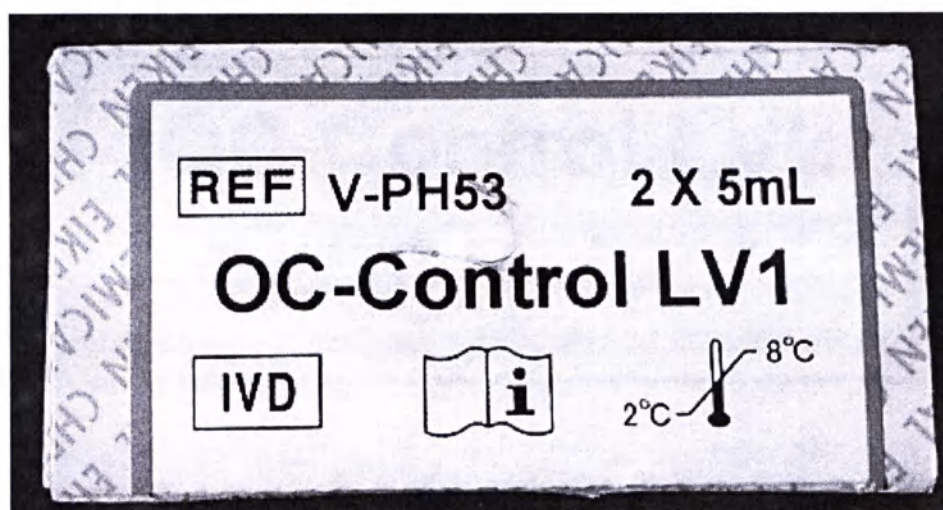


Контрольный материал для количественного определения гемоглобина (скрытой крови) в кале OC-Control LV2 в составе: OC-Control LV2 (флакон 5 мл - 2 шт.), инструкция.

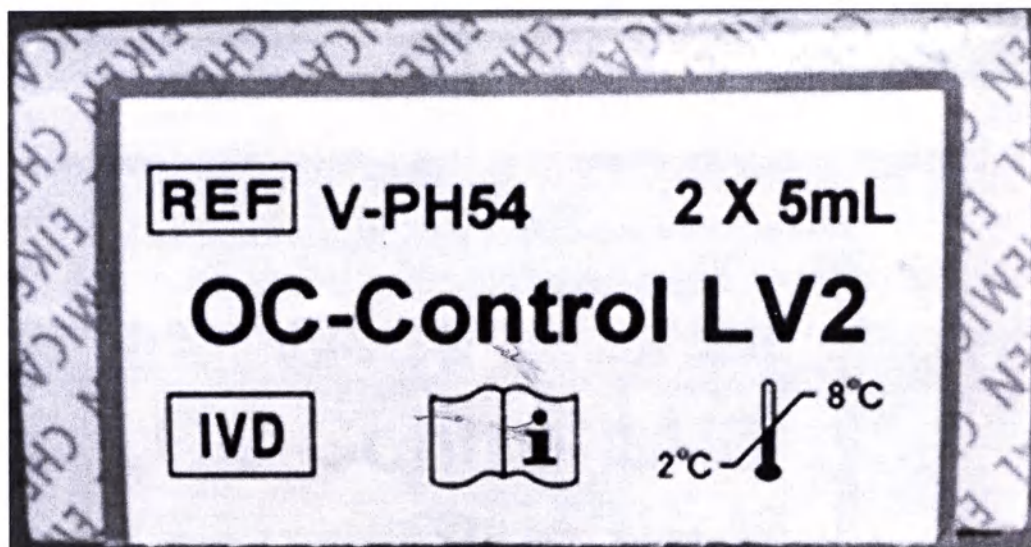


Контрольный материал для количественного определения гемоглобина (скрытой крови) в кале OC-Control LV3 в составе: OC-Control LV3 (флакон 5 мл - 2 шт.), инструкция.

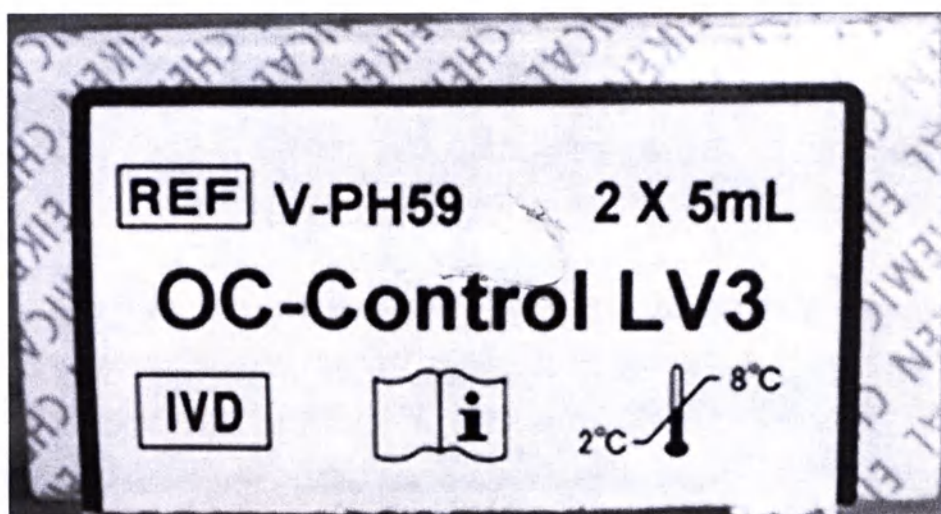


Закрытая пластиковая емкость для забора образца OC-AUTO Sampling Bottle 3

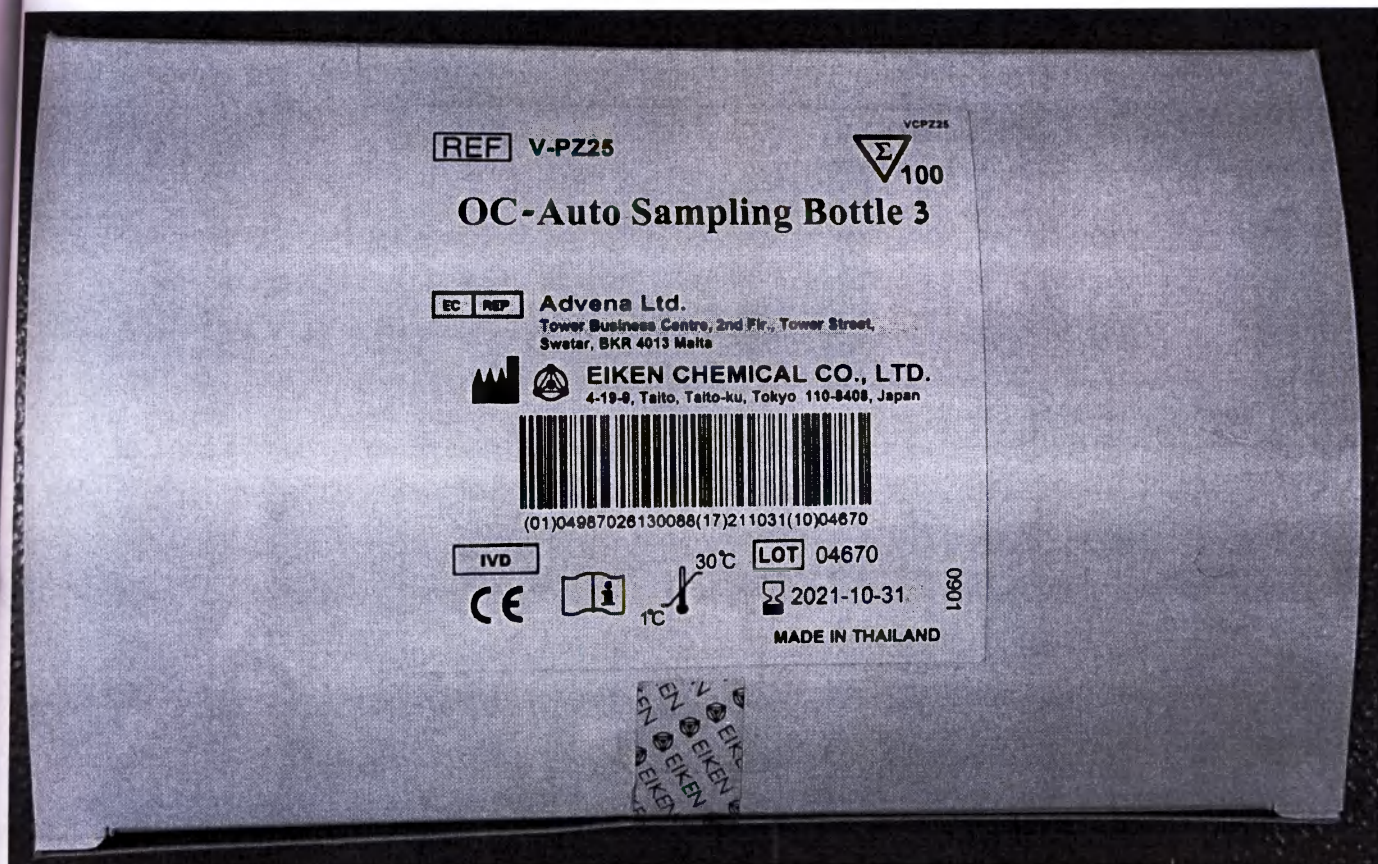

Анализатор OC-SENSOR PLEDIA

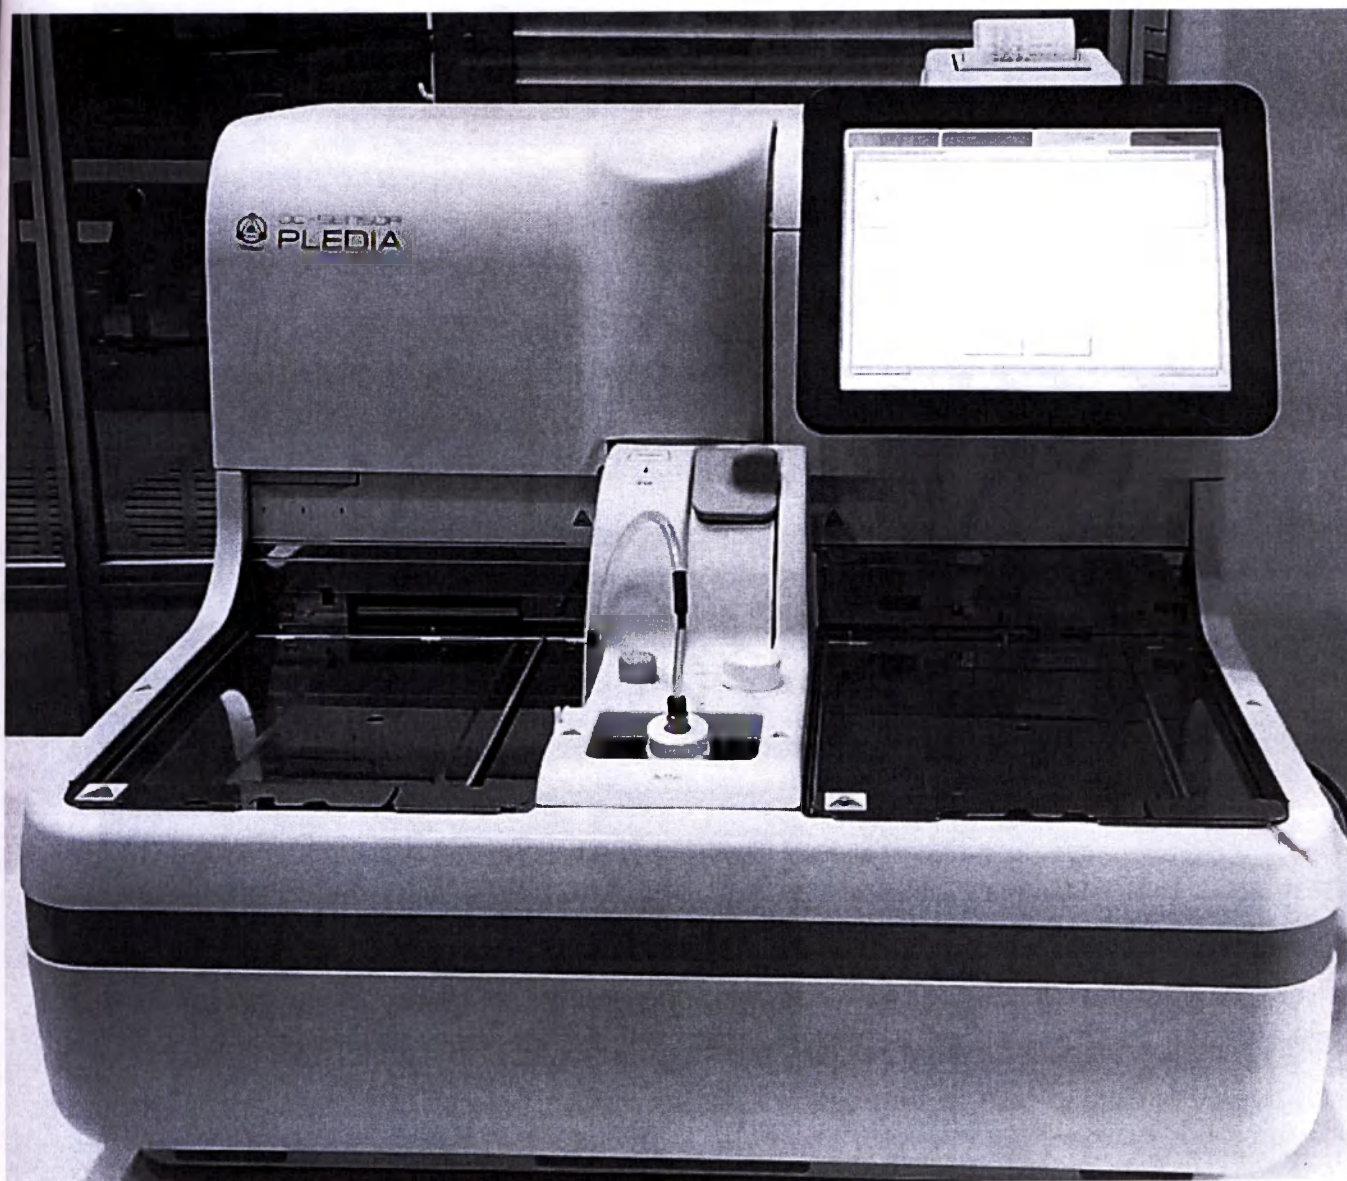

Бак сливной на 10 л с датчиком

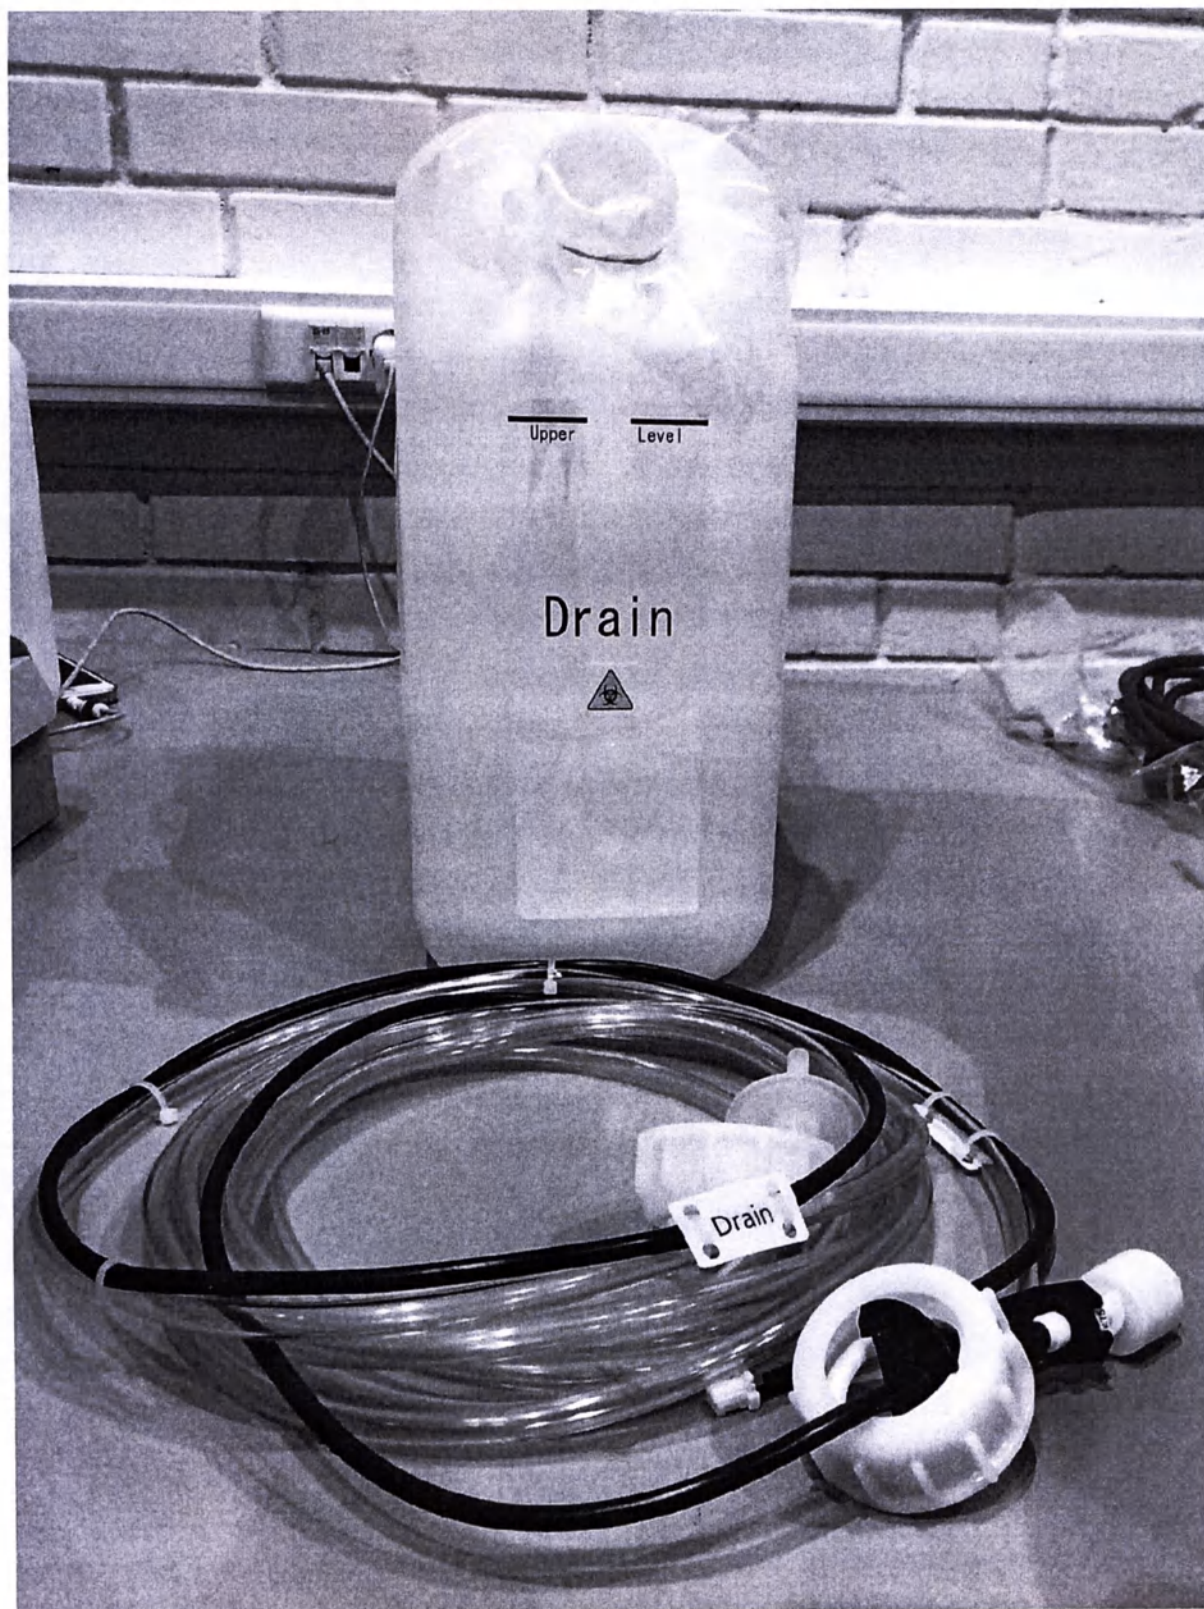

Бутыль вспомогательная на 5 л




Бутыль для буферного раствора




Бутыль для очищенной воды на 10 л с датчиком




Бутиль для приготовления промывочного раствора на 5 л

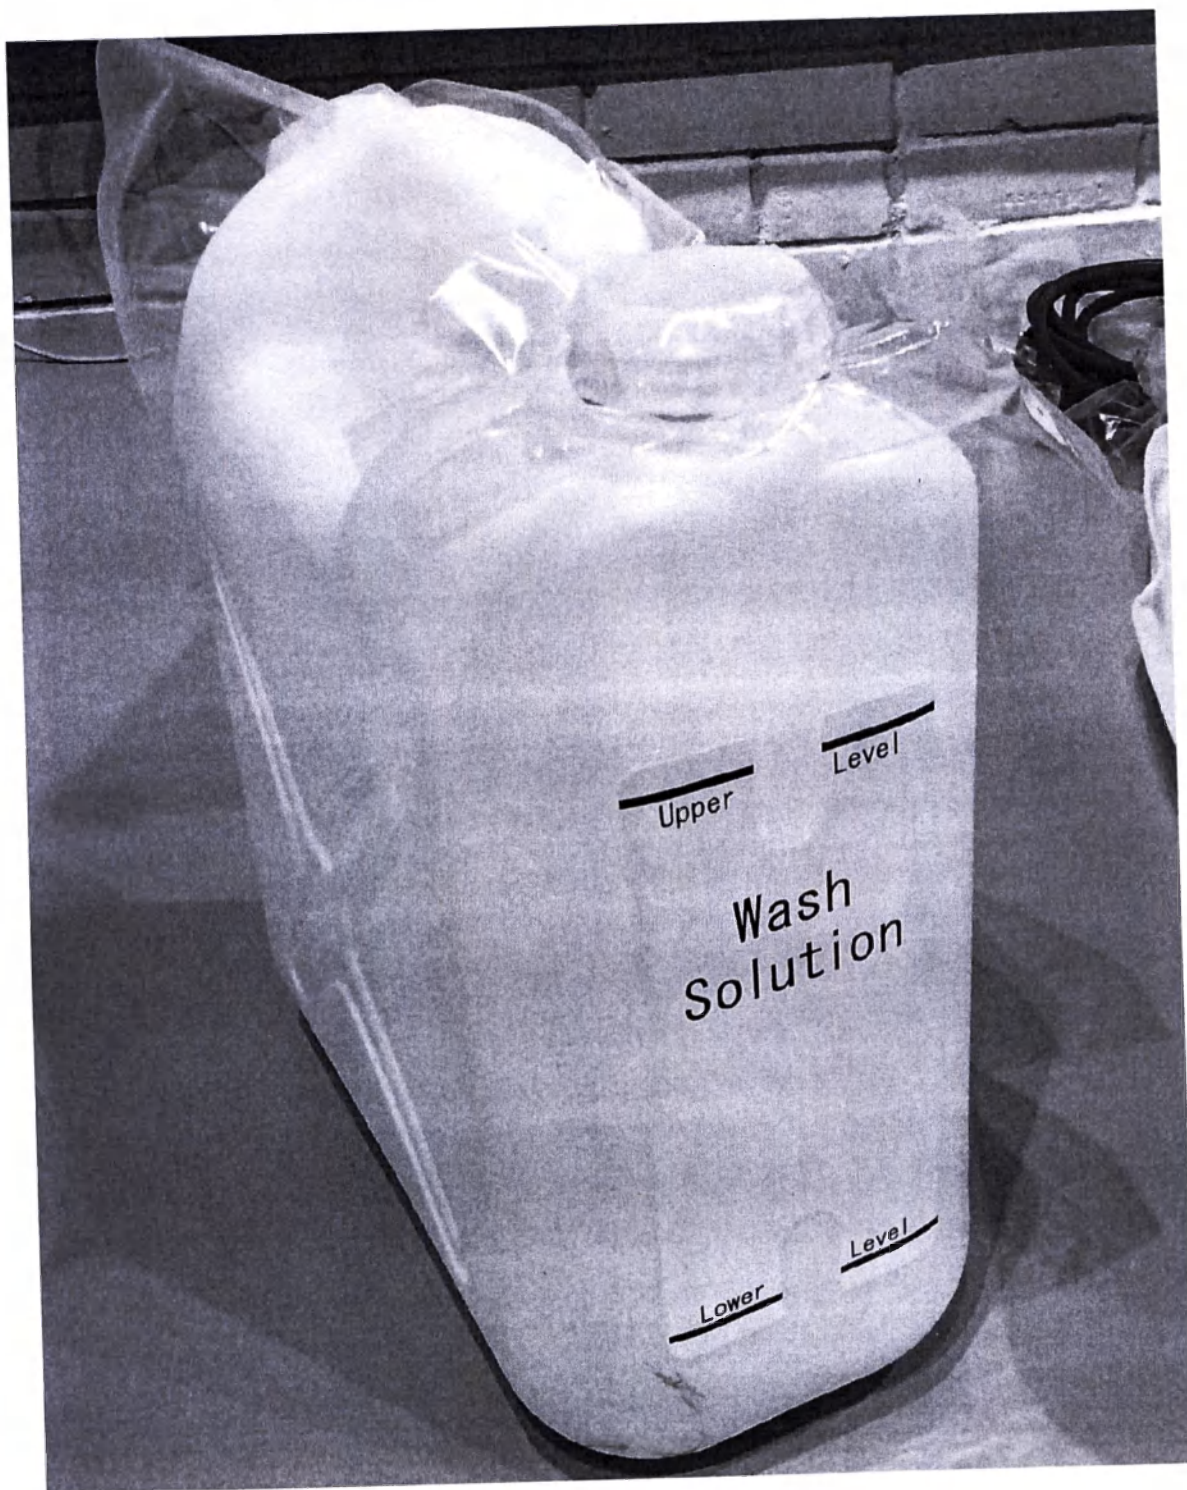


Бутыль для промывочного раствора на 5 л с датчиком

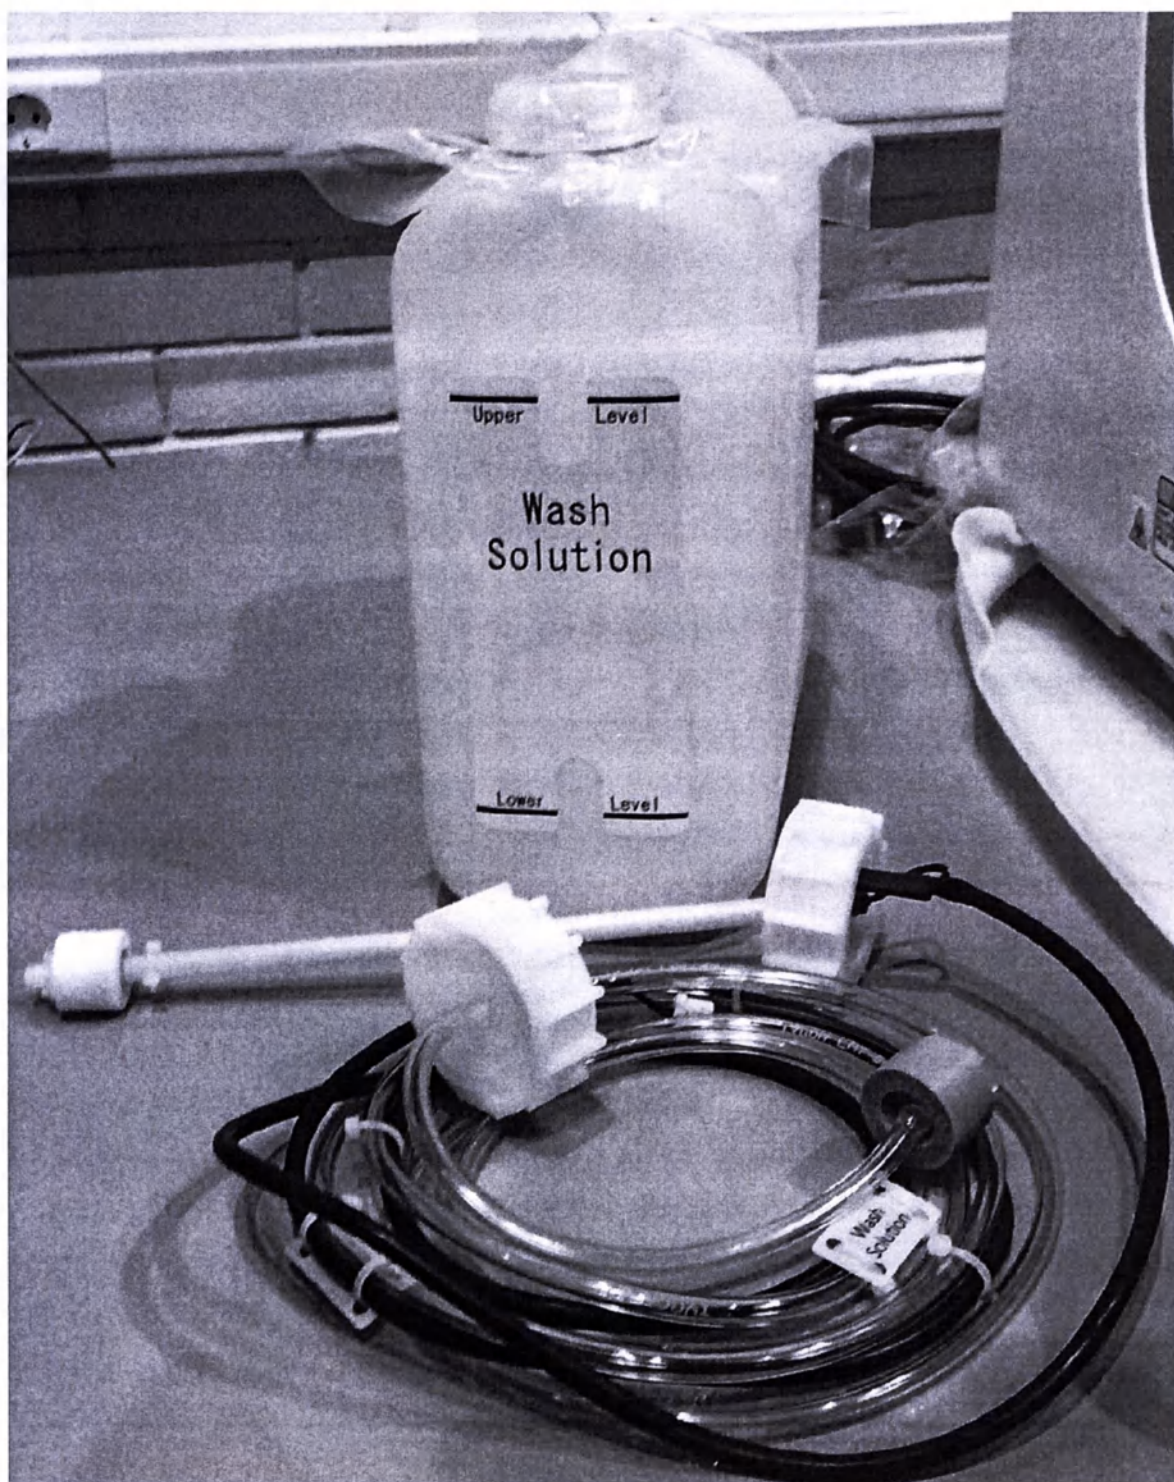

Измерительные ячейки

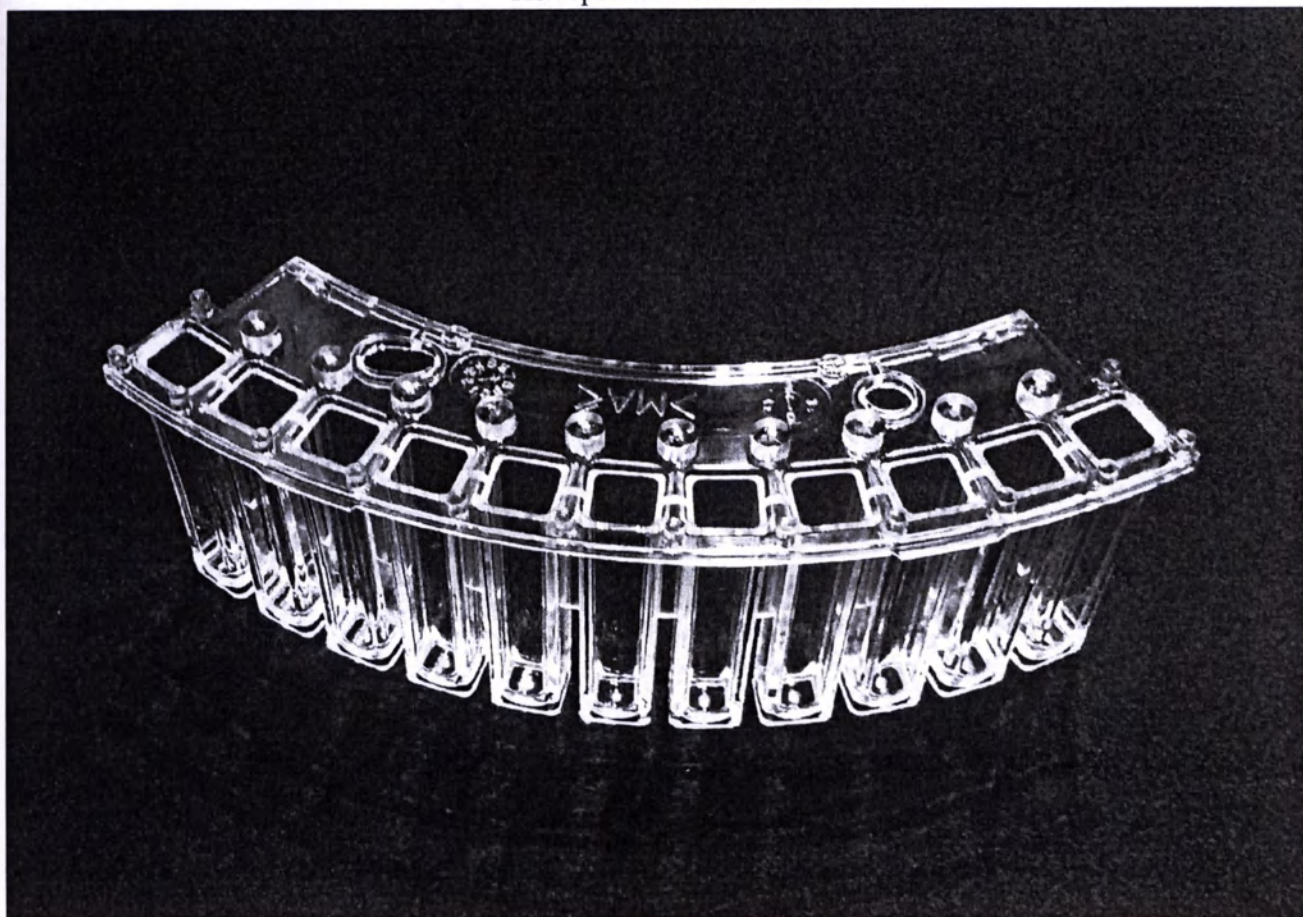

Кольцо концевое

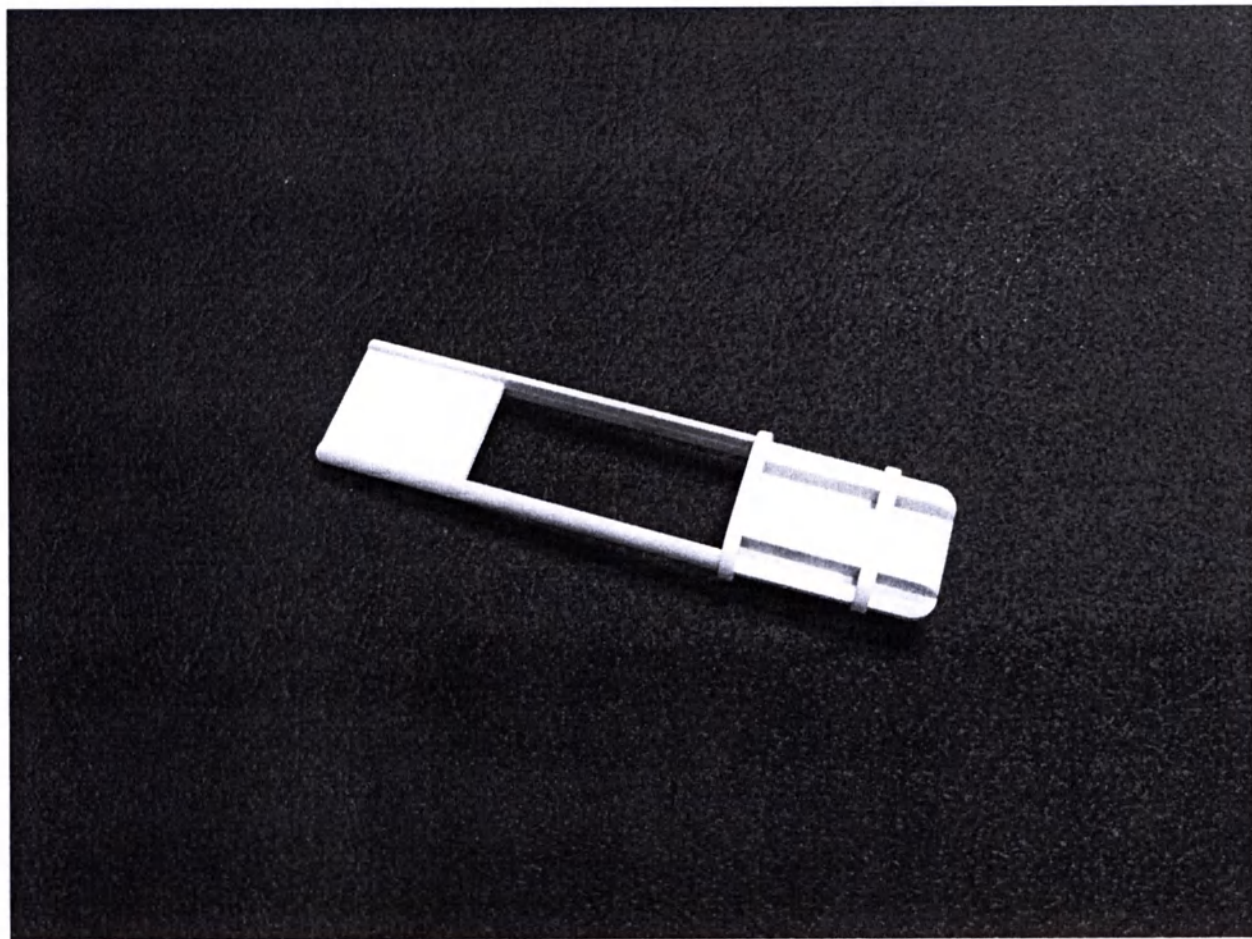

Прокладка крышки для бутылки на 5 литров



Прокладка крышки для бутылки на 10 литров




Прокладка крышки для бутылки для буферного раствора




Рулонная термобумага




Штатив для повторного анализа

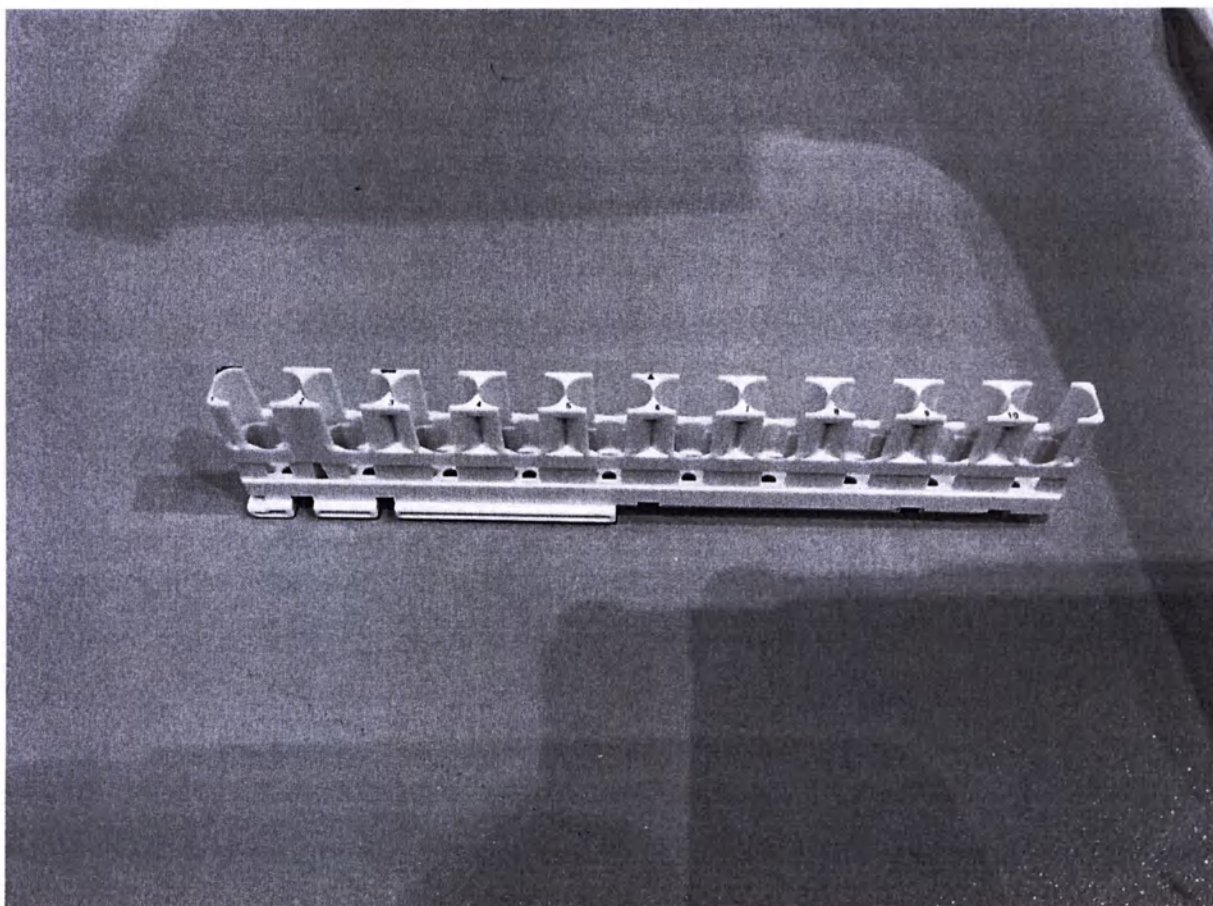


Штатив для разведения проб

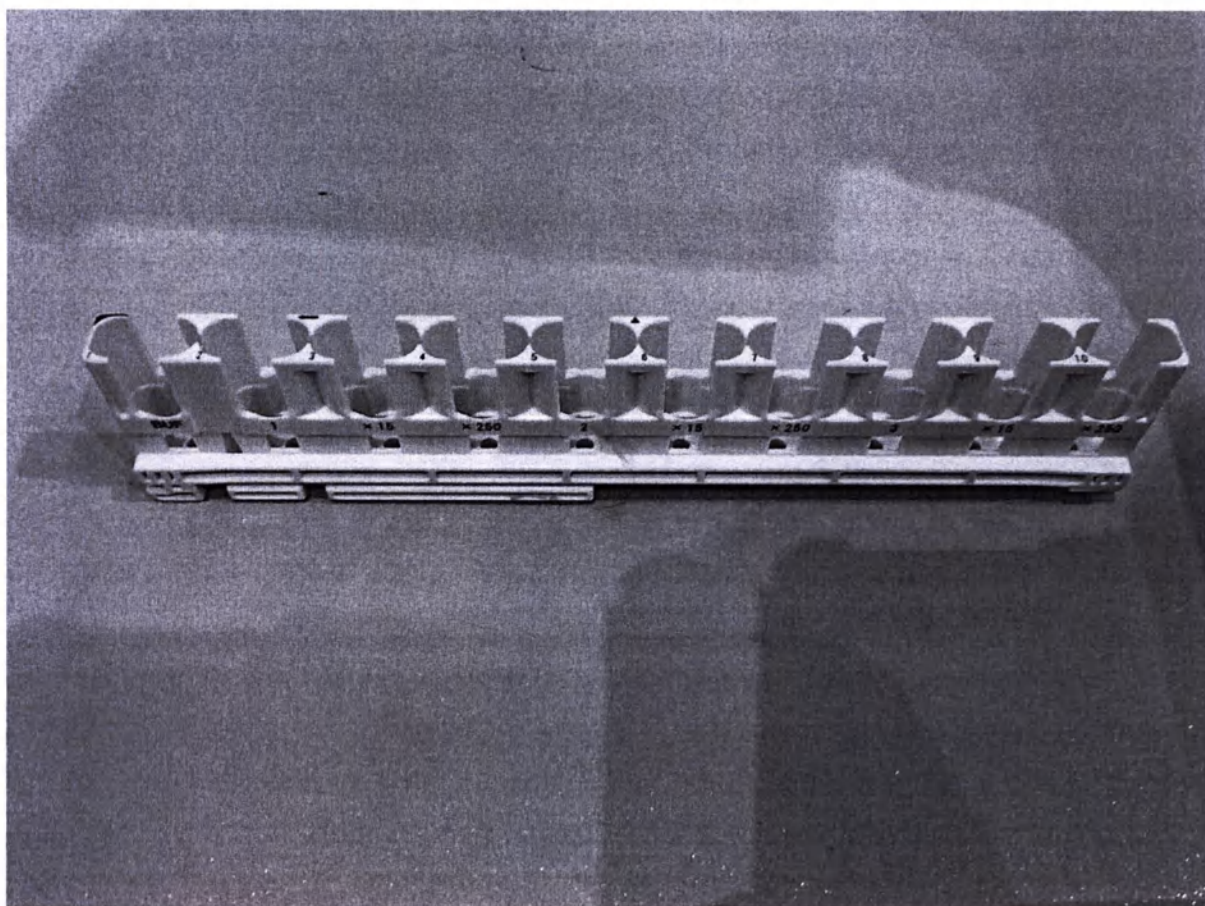


Штативы STD/QC

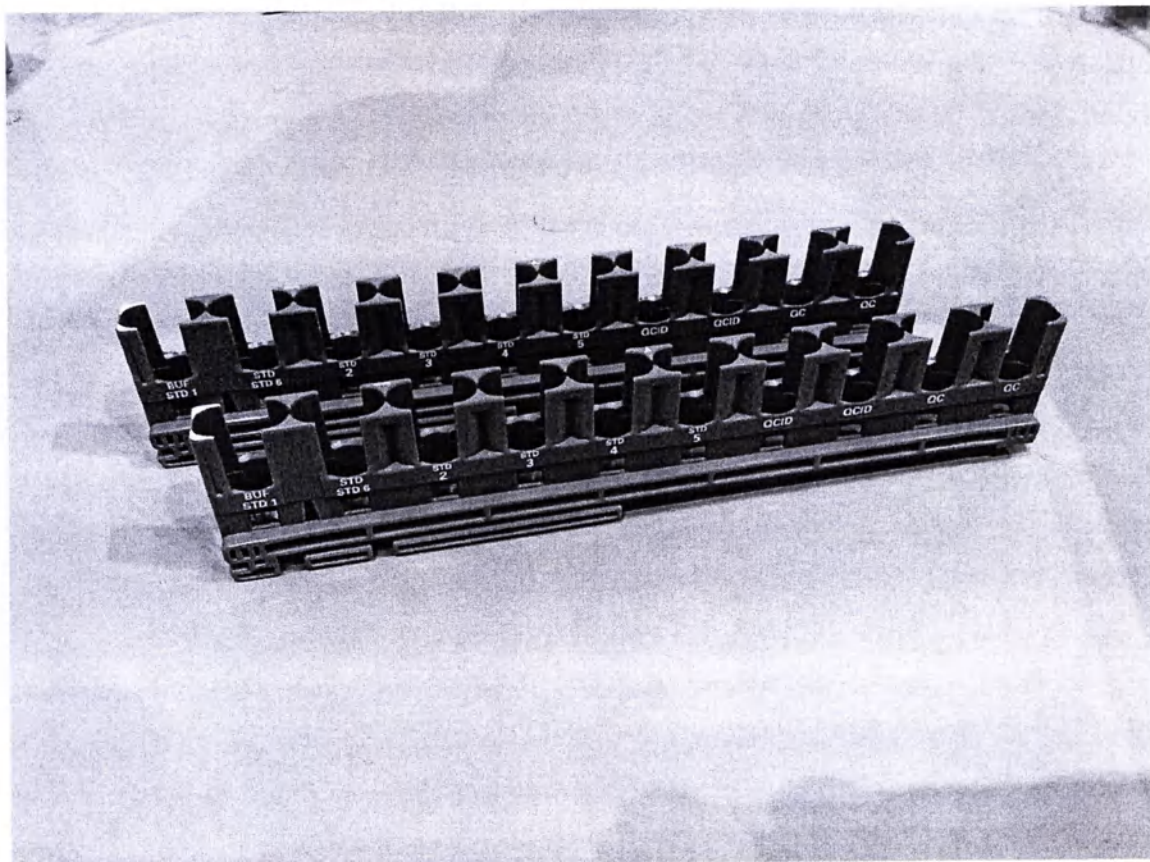


Штативы для образцов

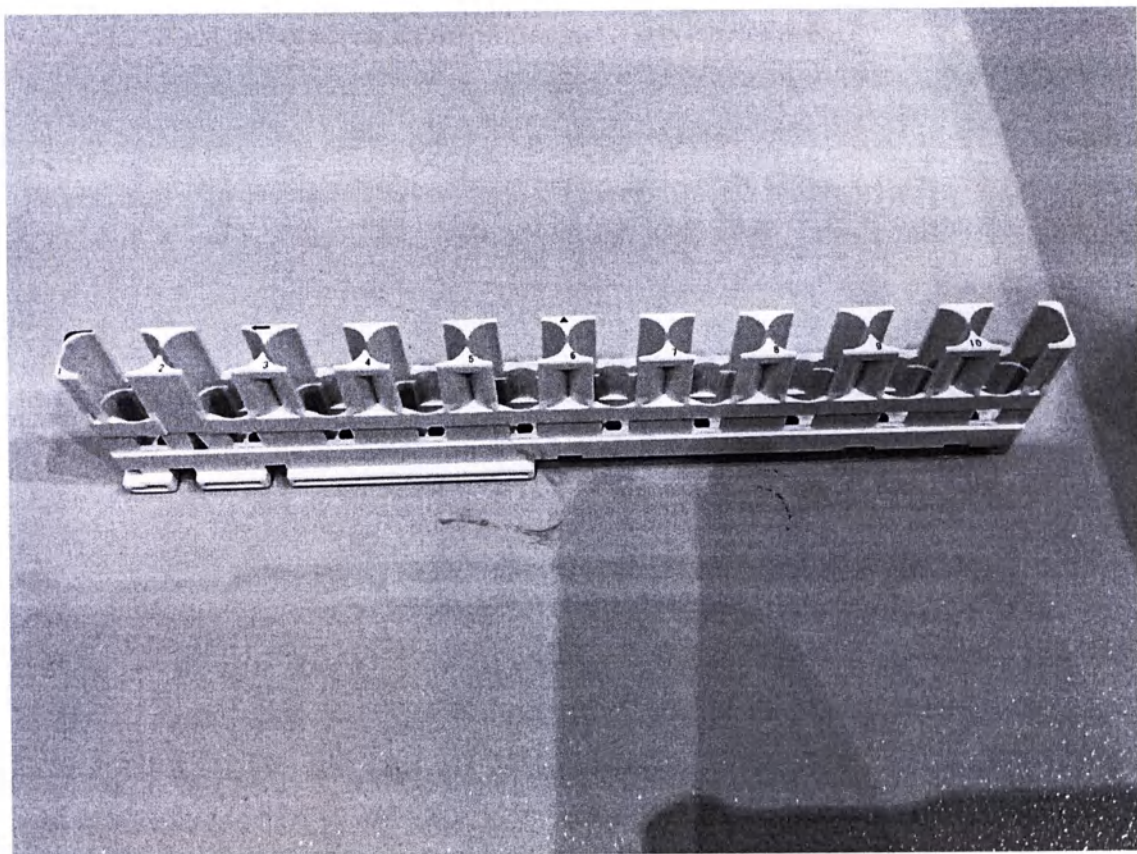


Штуцеры для резервуаров

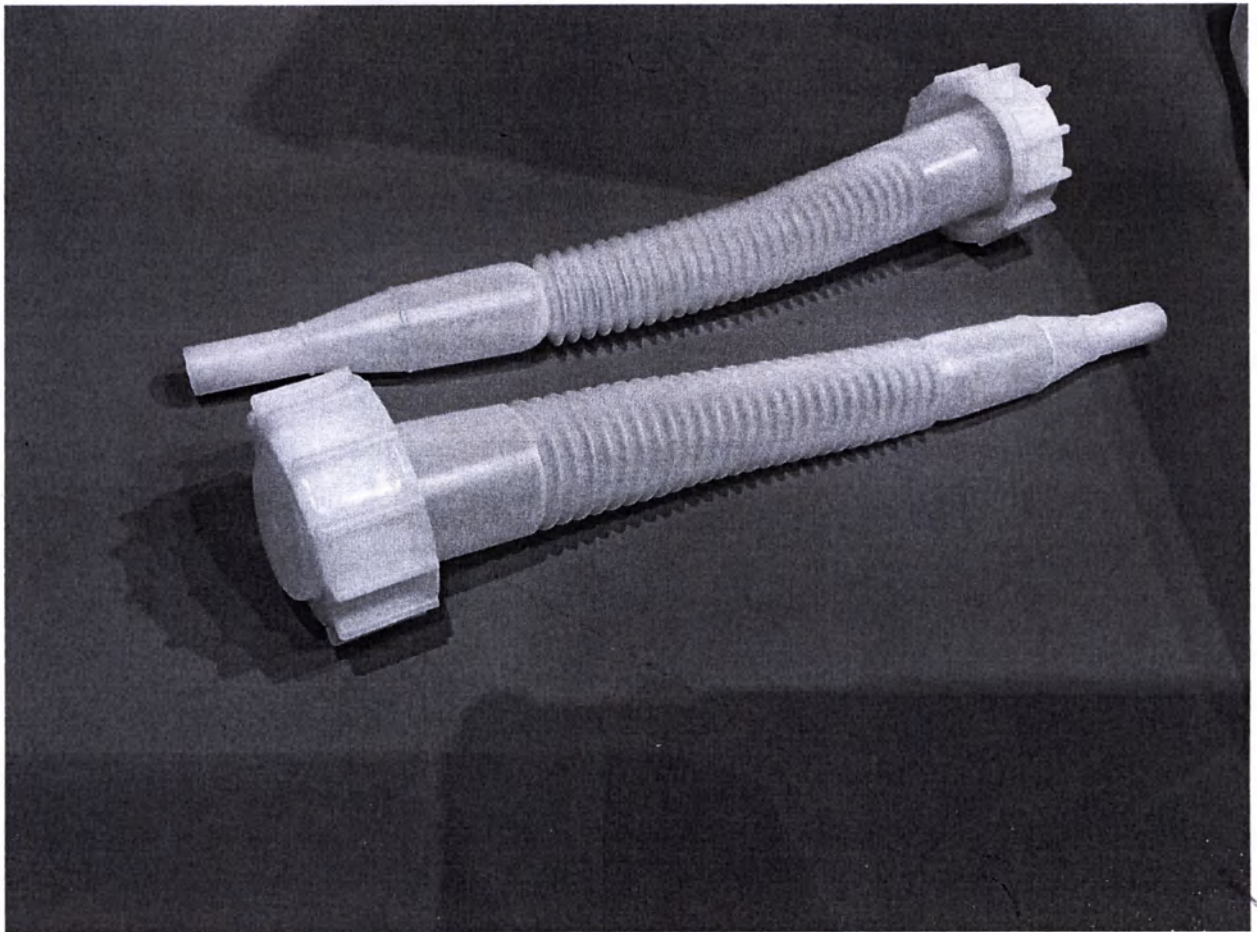


Этикетки со штрих-кодами для штативов

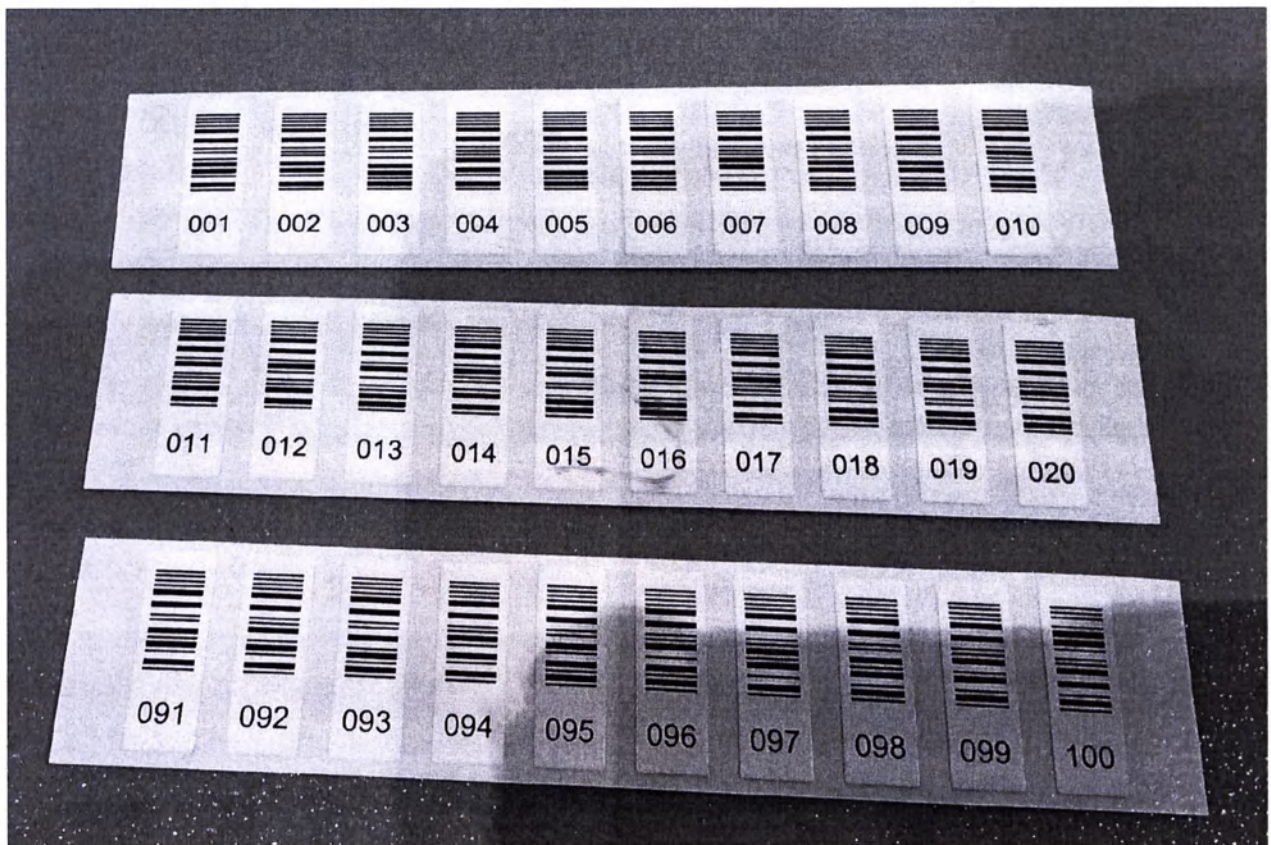

Поддоны для штативов

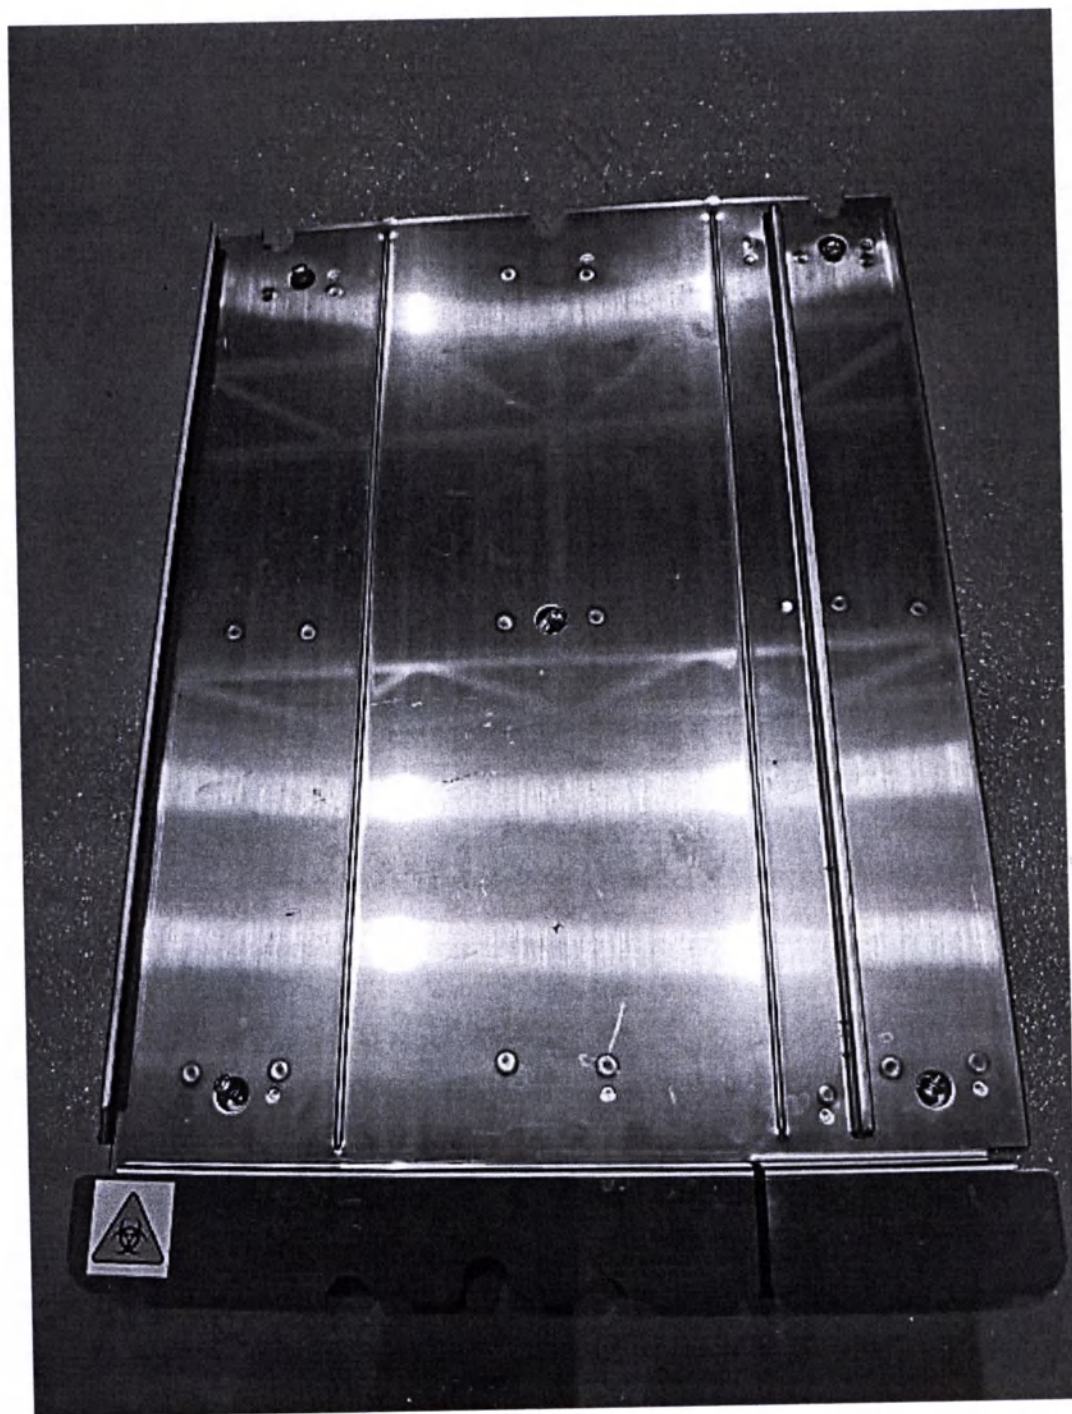

Крышка светозащитная

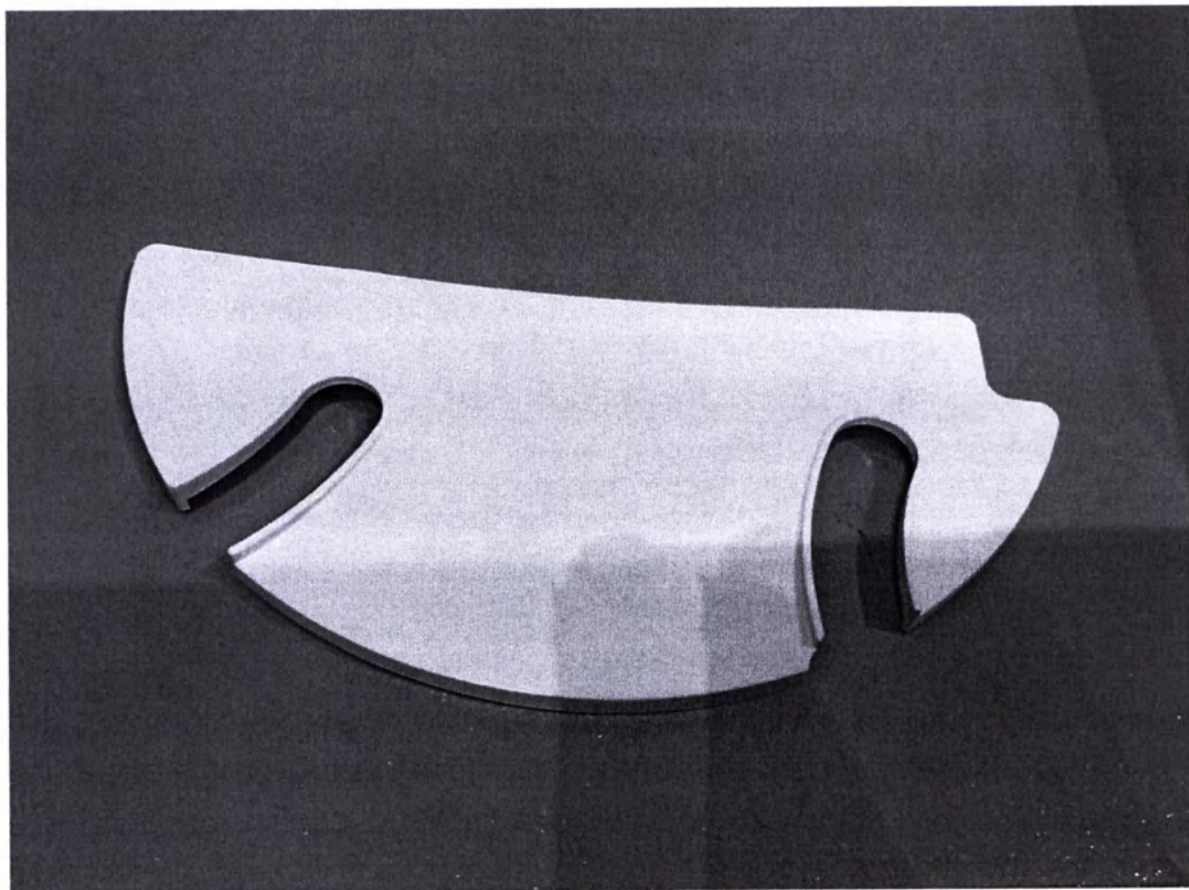

Чашки для образцов



Шнур питания






Стакан химический




Стартовый набор реагентов OC-SENSOR DIANA для количественного определения гемоглобина (скрытой крови) в кале в составе:

- латексный реагент OC-SENSOR DIANA (флакон 15 мл - 5 шт.);
- буферный раствор OC-SENSOR DIANA (флакон 500 мл - 1 шт.);
- инструкция.

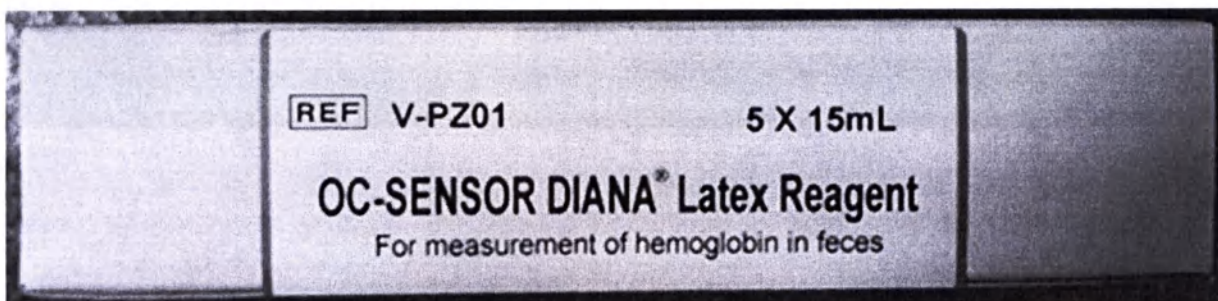


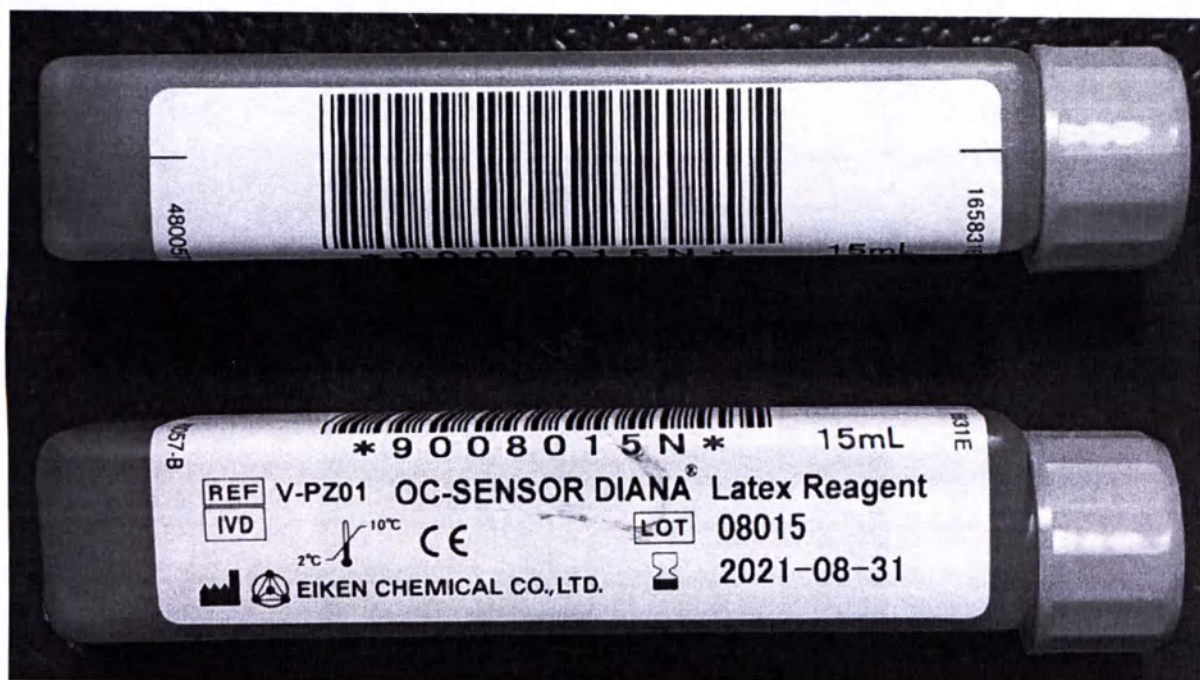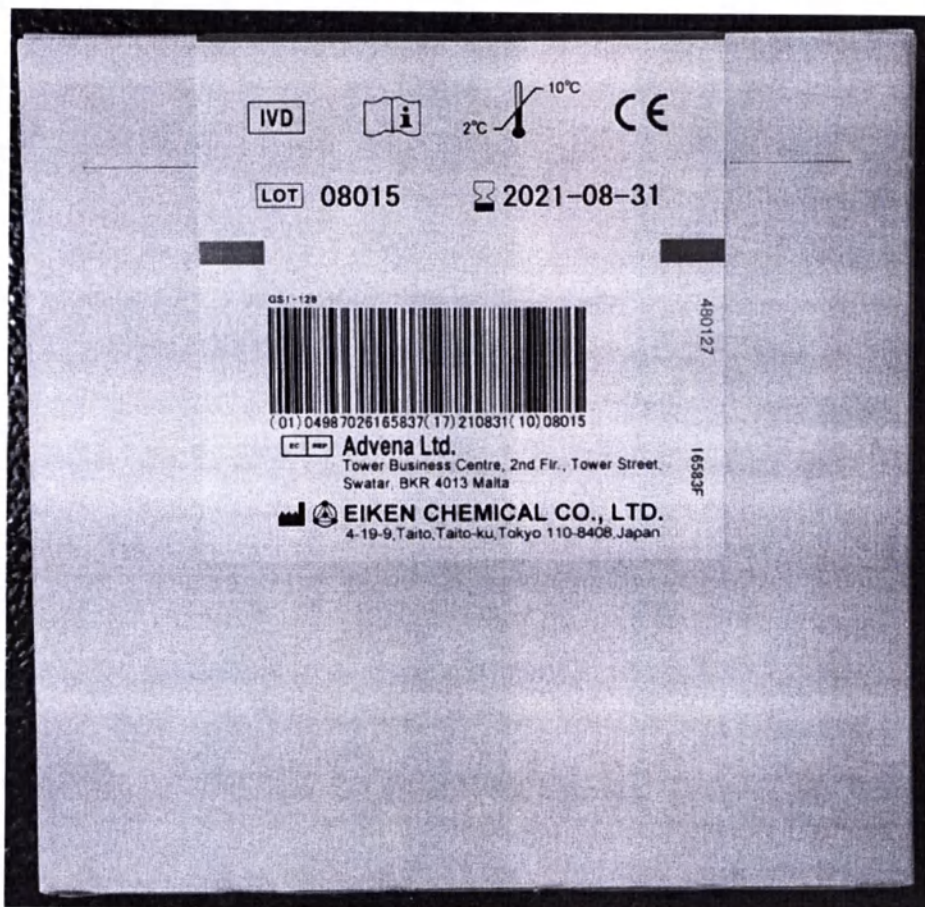


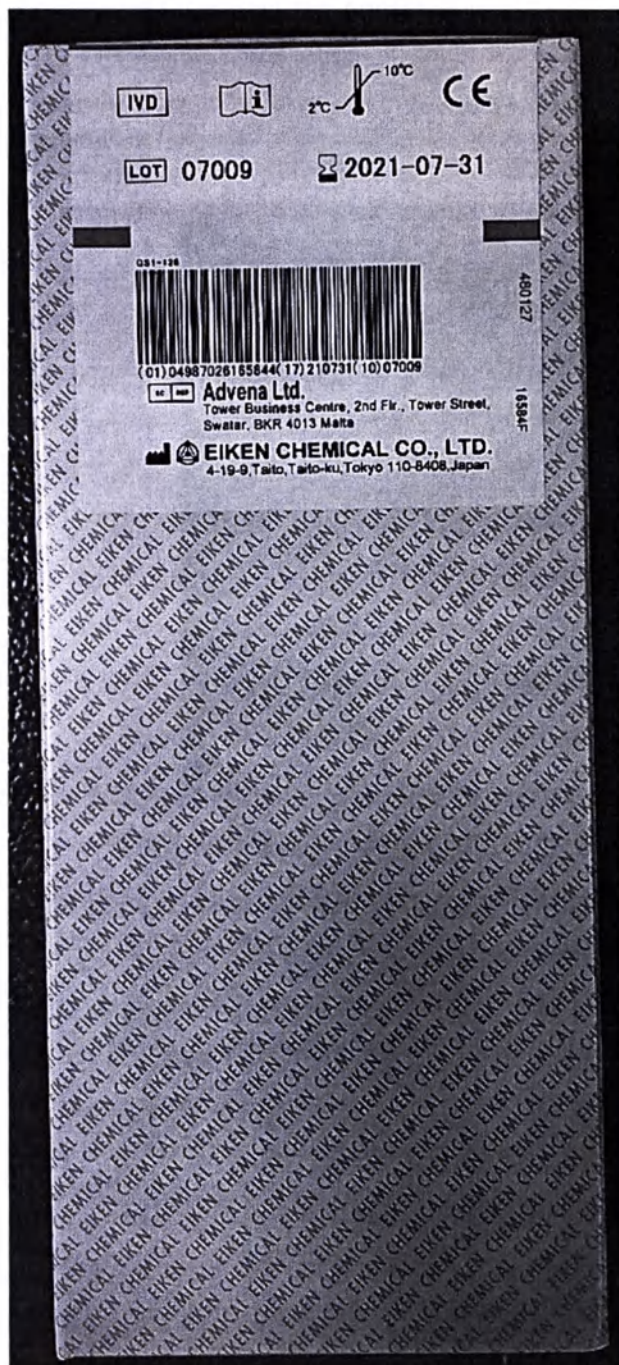


Набор Калибраторов для количественного определения гемоглобина (скрытой крови) в кале OC-Calibrator 2 kit в составе:

- калибратор OC-Calibrator 2 (флакон 3 мл – 1 шт.);
- растворитель калибратора OC-Calibrator Diluent (флакон 45 мл – 1 шт.);
- инструкция.


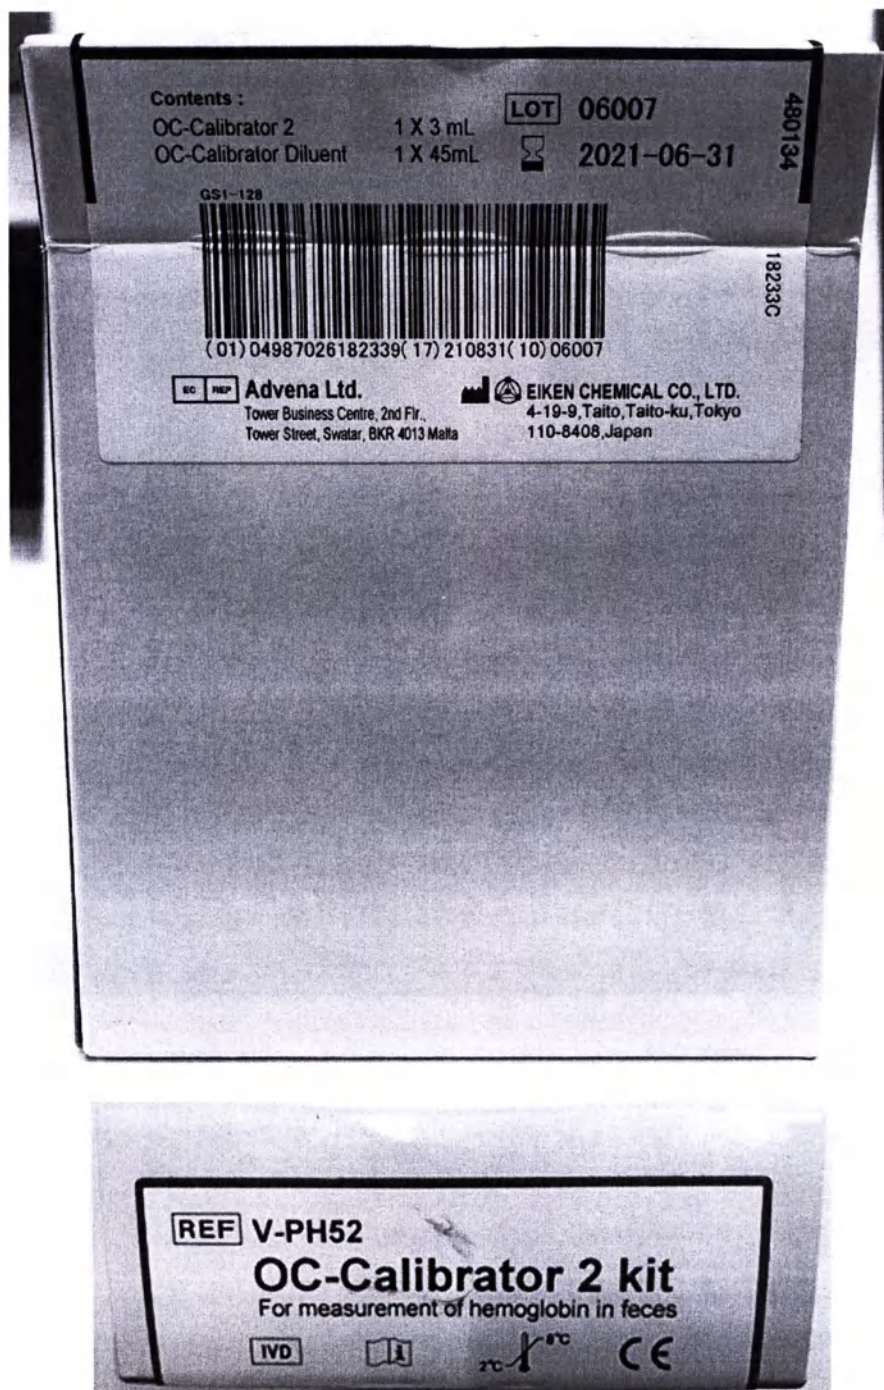


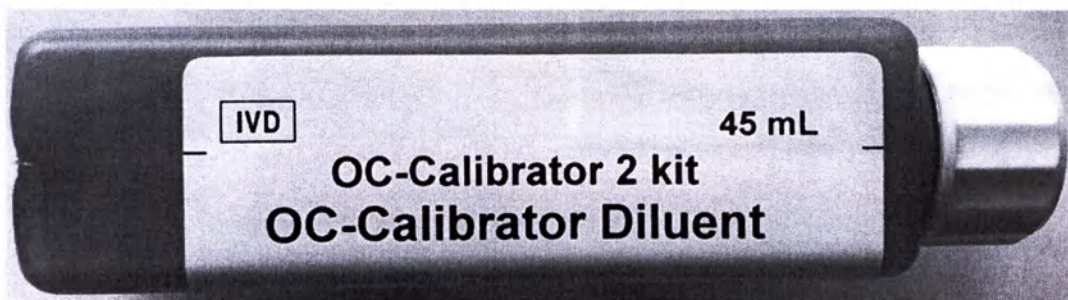


Контрольный материал для количественного определения гемоглобина (скрытой крови) в кале OC-Control LV1 в составе: OC-Control LV1 (флакон 5 мл - 2 шт.), инструкция.

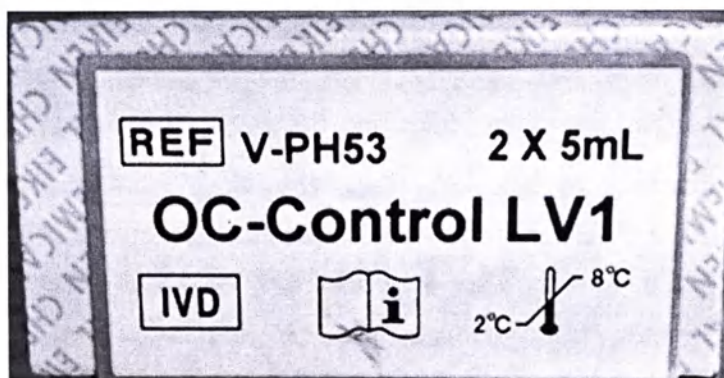

Контрольный материал для количественного определения гемоглобина (скрытой крови) в кале OC-Control LV2 в составе: OC-Control LV2 (флакон 5 мл - 2 шт.), инструкция.

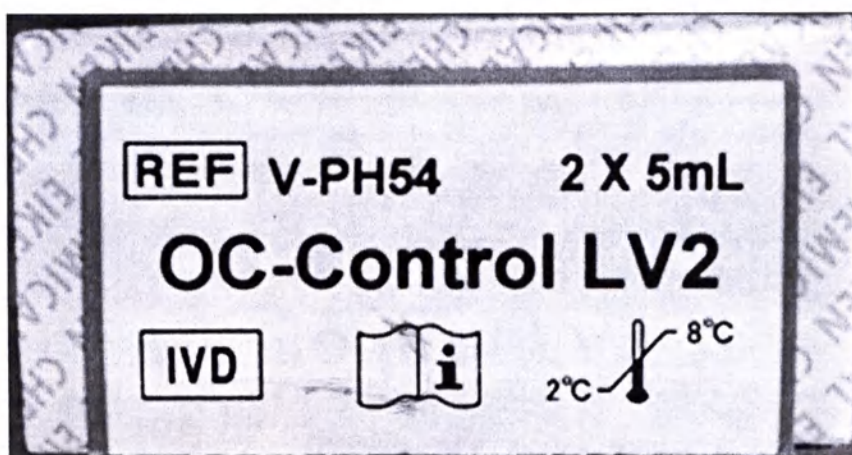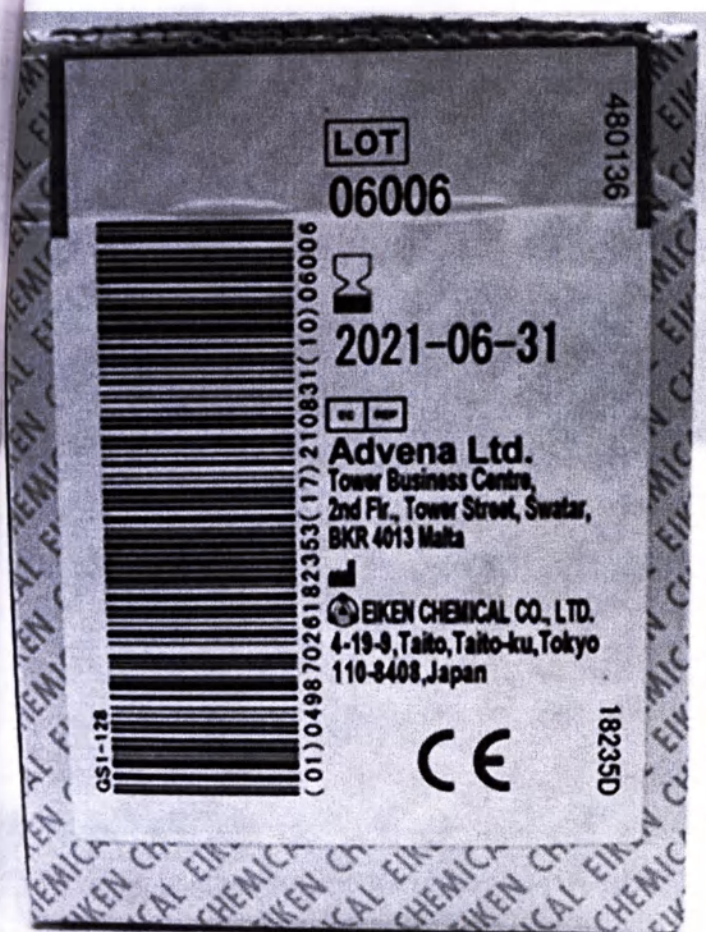

Контрольный материал для количественного определения гемоглобина (скрытой крови) в кале OC-Control LV3 в составе: OC-Control LV3 (флакон 5 мл - 2 шт.), инструкция.

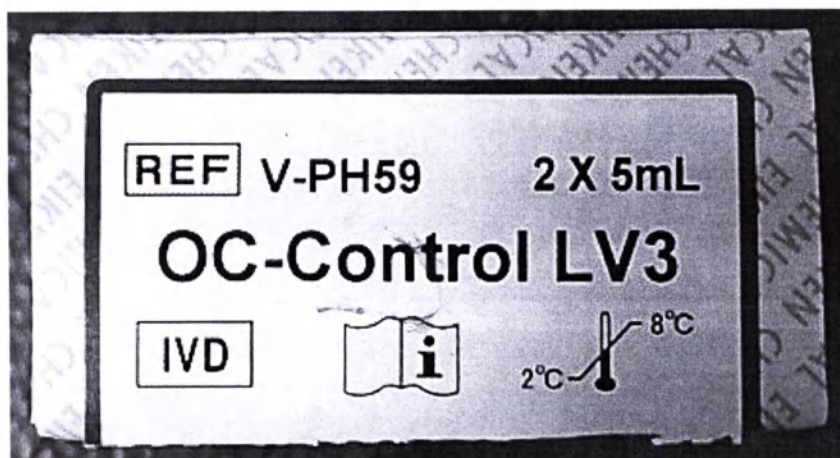

Закрытая пластиковая емкость для забора образца OC-AUTO Sampling Bottle 3

REF V-PZ25



OC-Auto Sampling Bottle 3

EC REP

Advena Ltd.

Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street,
Swatar, BKR 4813 Malta




EIKEN CHEMICAL CO., LTD.

4-19-1, 2-15-1, 3-15-1, 11-1-1, 11-1-1, 11-1-1, Japan



(01)04987028130088(17)211031(10)04668

IVD



LOT 04668

2021-10-31

MADE IN THAILAND

1160



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 49

(сорок девять) листах

