

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «СОЛТ»

В.В. Заяц

«01» ноября 2021 г.




**ДОПОЛНЕНИЕ К ФОТОГРАФИЧЕСКИМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Набор реагентов для количественного определения гемоглобина (скрытой крови)
в кале человека, в вариантах исполнениях,**

производства

EIKEN CHEMICAL CO., LTD. (ЭЙКЕН КЕМИКАЛ КО., ЛТД), Япония.

Набор реагентов ОС-Auto 3 для количественного определения гемоглобина (скрытой крови) в кале человека в составе:

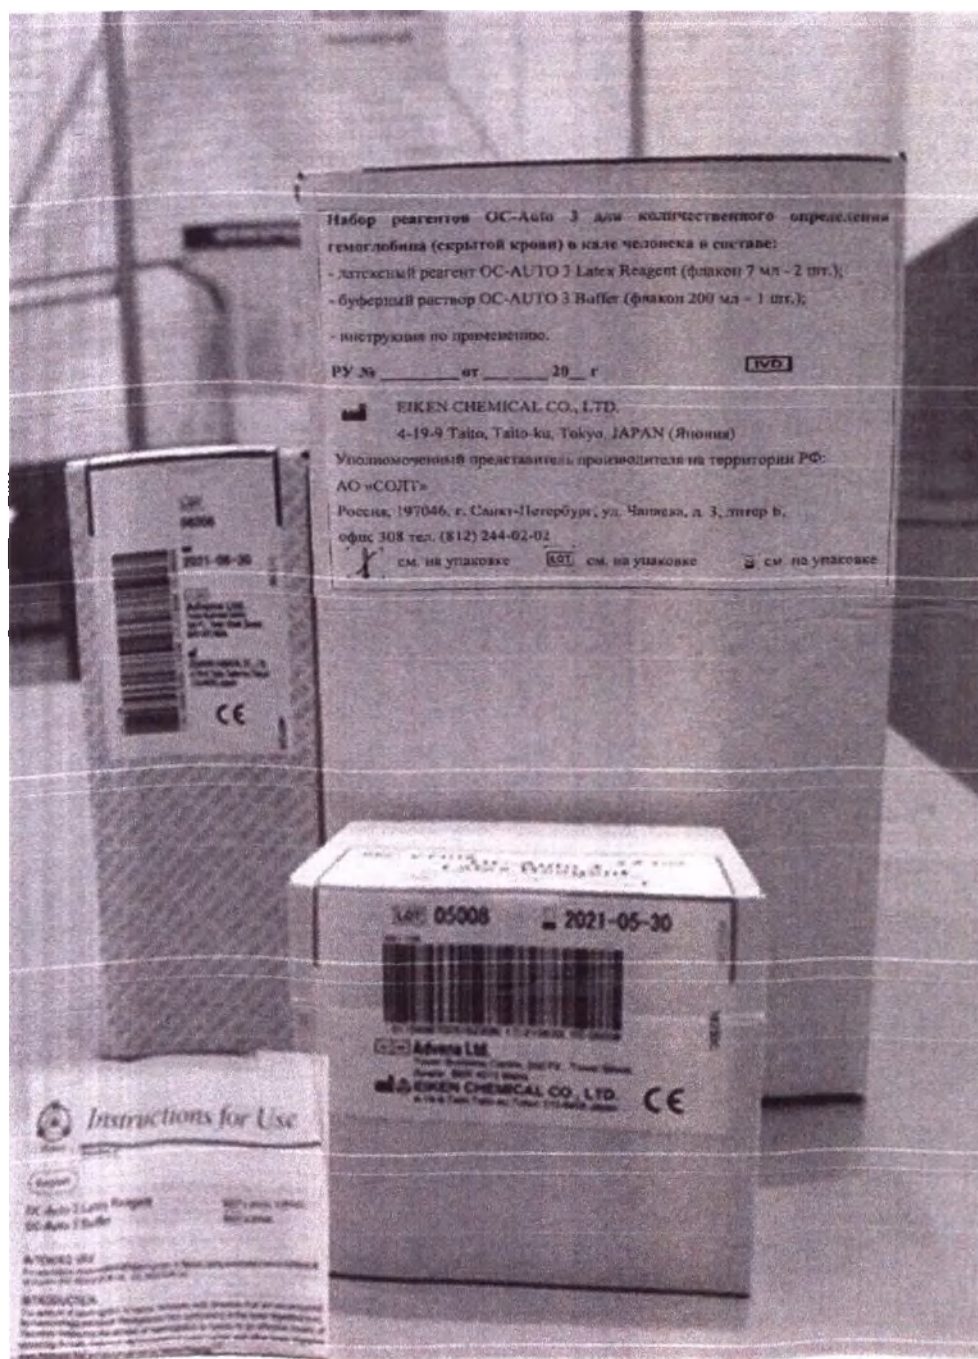

Набор реагентов OC-SENSOR DIANA для количественного определения гемоглобина (скрытой крови) в кале человека в составе:

- Набор реагентов OC-SENSOR DIANA для количественного определения гемоглобина (скрытой крови) в кале человека в составе:
- латексный реагент OC-SENSOR DIANA Latex Reagent (флакон 15 мл - 5 шт.);
 - буферный раствор OC-SENSOR DIANA BUFFER (флакон 500 мл - 1 шт.);
 - инструкция по применению.

РУ № _____ от _____ 20__ г

IVD



EIKEN CHEMICAL CO., LTD.

4-19-9 Taiho, Taito-ku, Tokyo, JAPAN (Япония)

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

АО «СОЛП»

Россия, 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 3, литер Б,
офис 308 тел. (812) 244-02-02



см. на упаковке

LOT

см. на упаковке

см. на упаковке

IVD

LOT

07009

2021-07-31

CE



1011048 00240004 17121021 180000

Advena Ltd.

Tokyo Business Center, 2nd Fl., Tokyo Street

Shinjuku, 160-0013 Tokyo

EIKEN CHEMICAL CO., LTD.

4-19-9 Taiho, Taito-ku, Tokyo 110-8402, Japan

IVD

LOT

08015

2021-08-31

CE



1011048 00240004 17121021 180000

Advena Ltd.

Tokyo Business Center, 2nd Fl., Tokyo Street

Shinjuku, 160-0013 Tokyo

EIKEN CHEMICAL CO., LTD.

4-19-9 Taiho, Taito-ku, Tokyo 110-8402, Japan



Instructions for Use

Прошнуровано, пронумеровано

Количество 3 лист 2

Генеральный директор

АО "СОЛТ"

Заяц В В

