


### **Фотографические изображения**

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 300 тестов. Лот 54069001.

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 300 тестов. Лот 54069001.

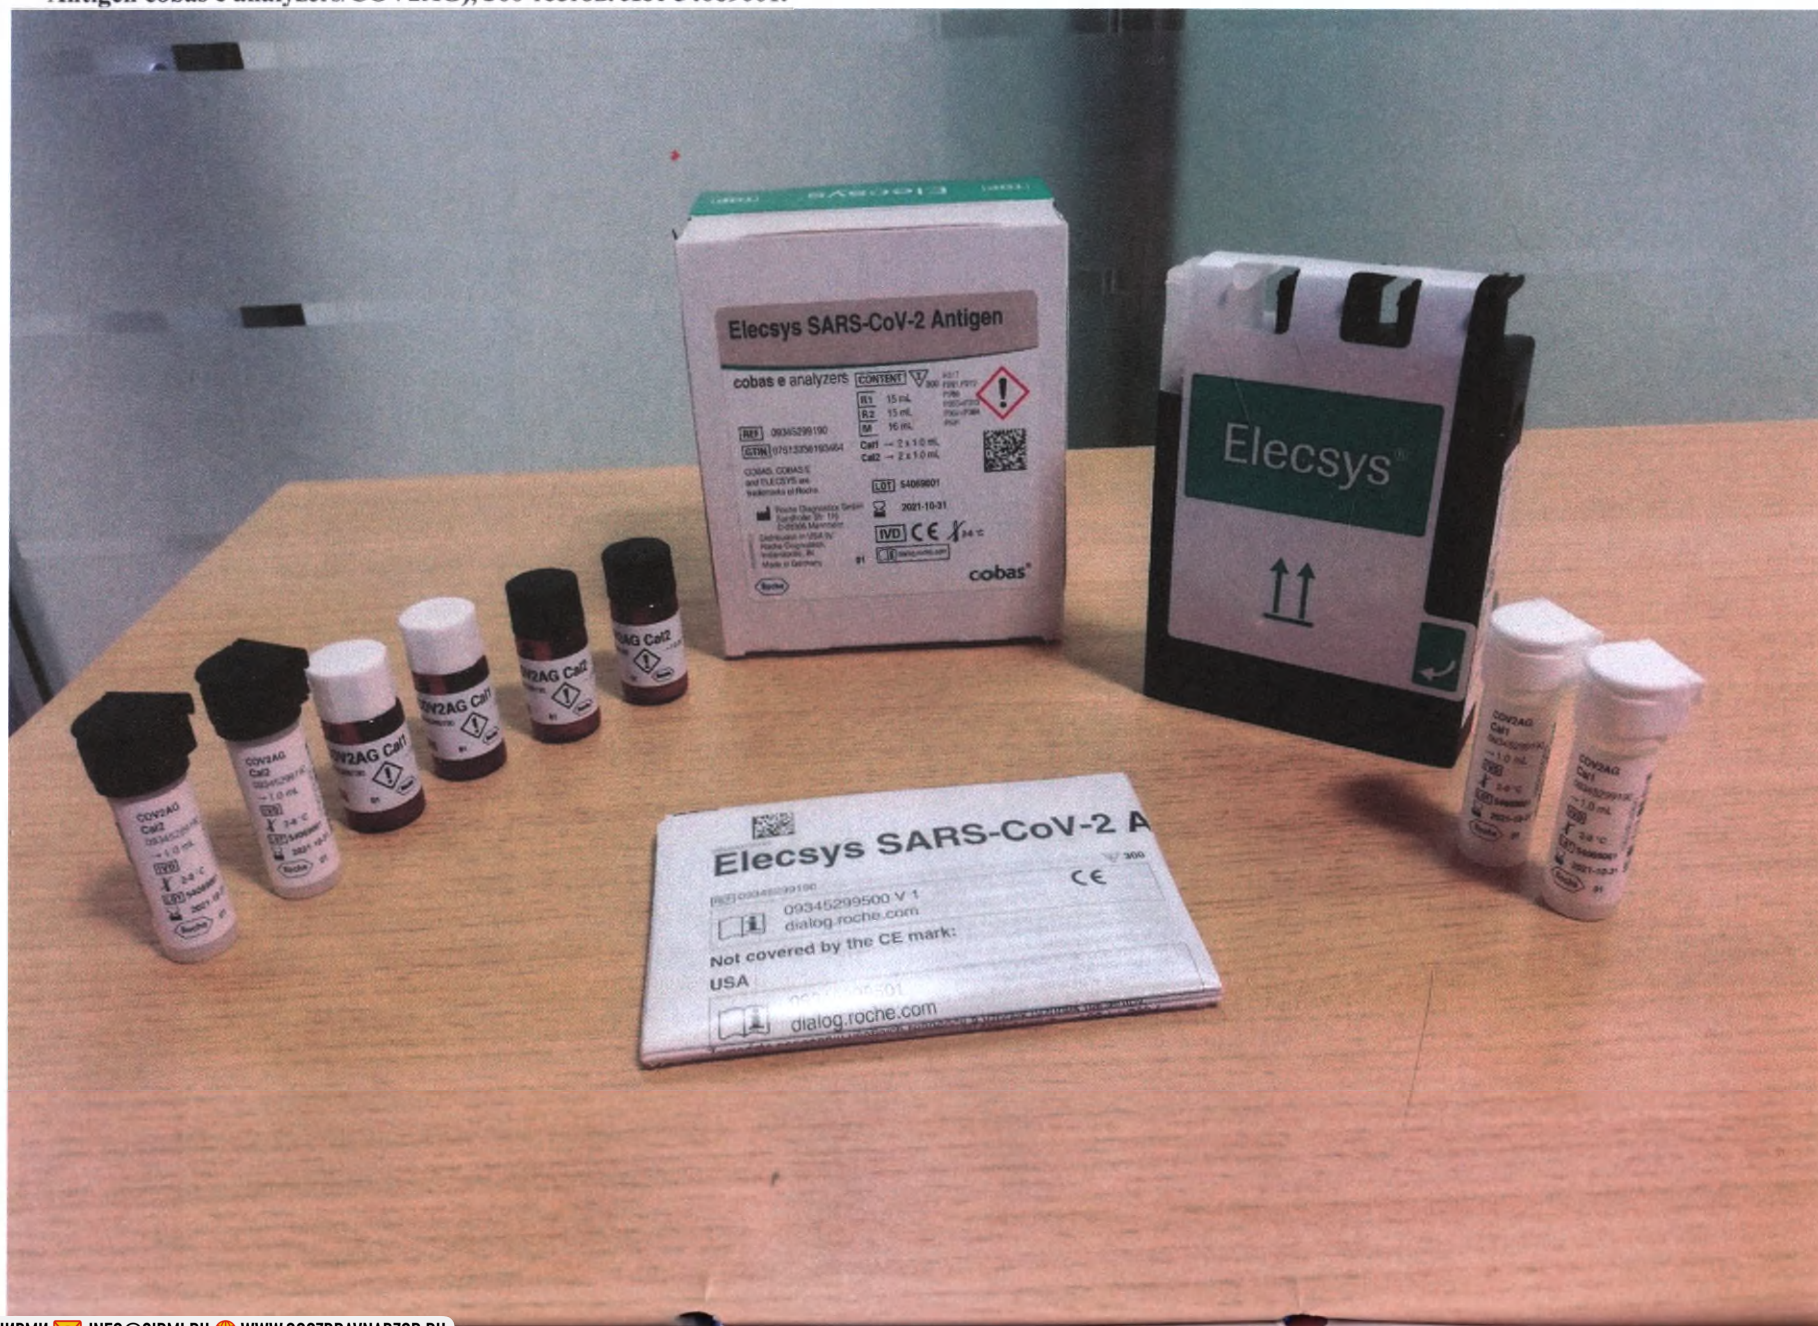

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 300 тестов. Лот 54069001



Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 300 тестов. Лот 54069001

## Elecsys SARS-CoV-2 Antigen

REF 09345299190

For USA: CONTENT

For Emergency Use Authorization only

- M** Streptavidin-coated microparticles 0.72 mg/mL
- R1** Biotinylated monoclonal anti-SARS-CoV-2 antibody (mouse) <1.4 mg/L; HEPES buffer
- R2** Two monoclonal anti-SARS-CoV-2 antibodies (rabbit) labeled with ruthenium complex < 2.3 mg/L (each); HEPES buffer
- Cal1** Non-reactive for SARS-CoV-2 antigen, buffer
- Cal2** Reactive for SARS-CoV-2 antigen, buffer




Rx only


01



Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG). 300 тестов. Лот 54069001

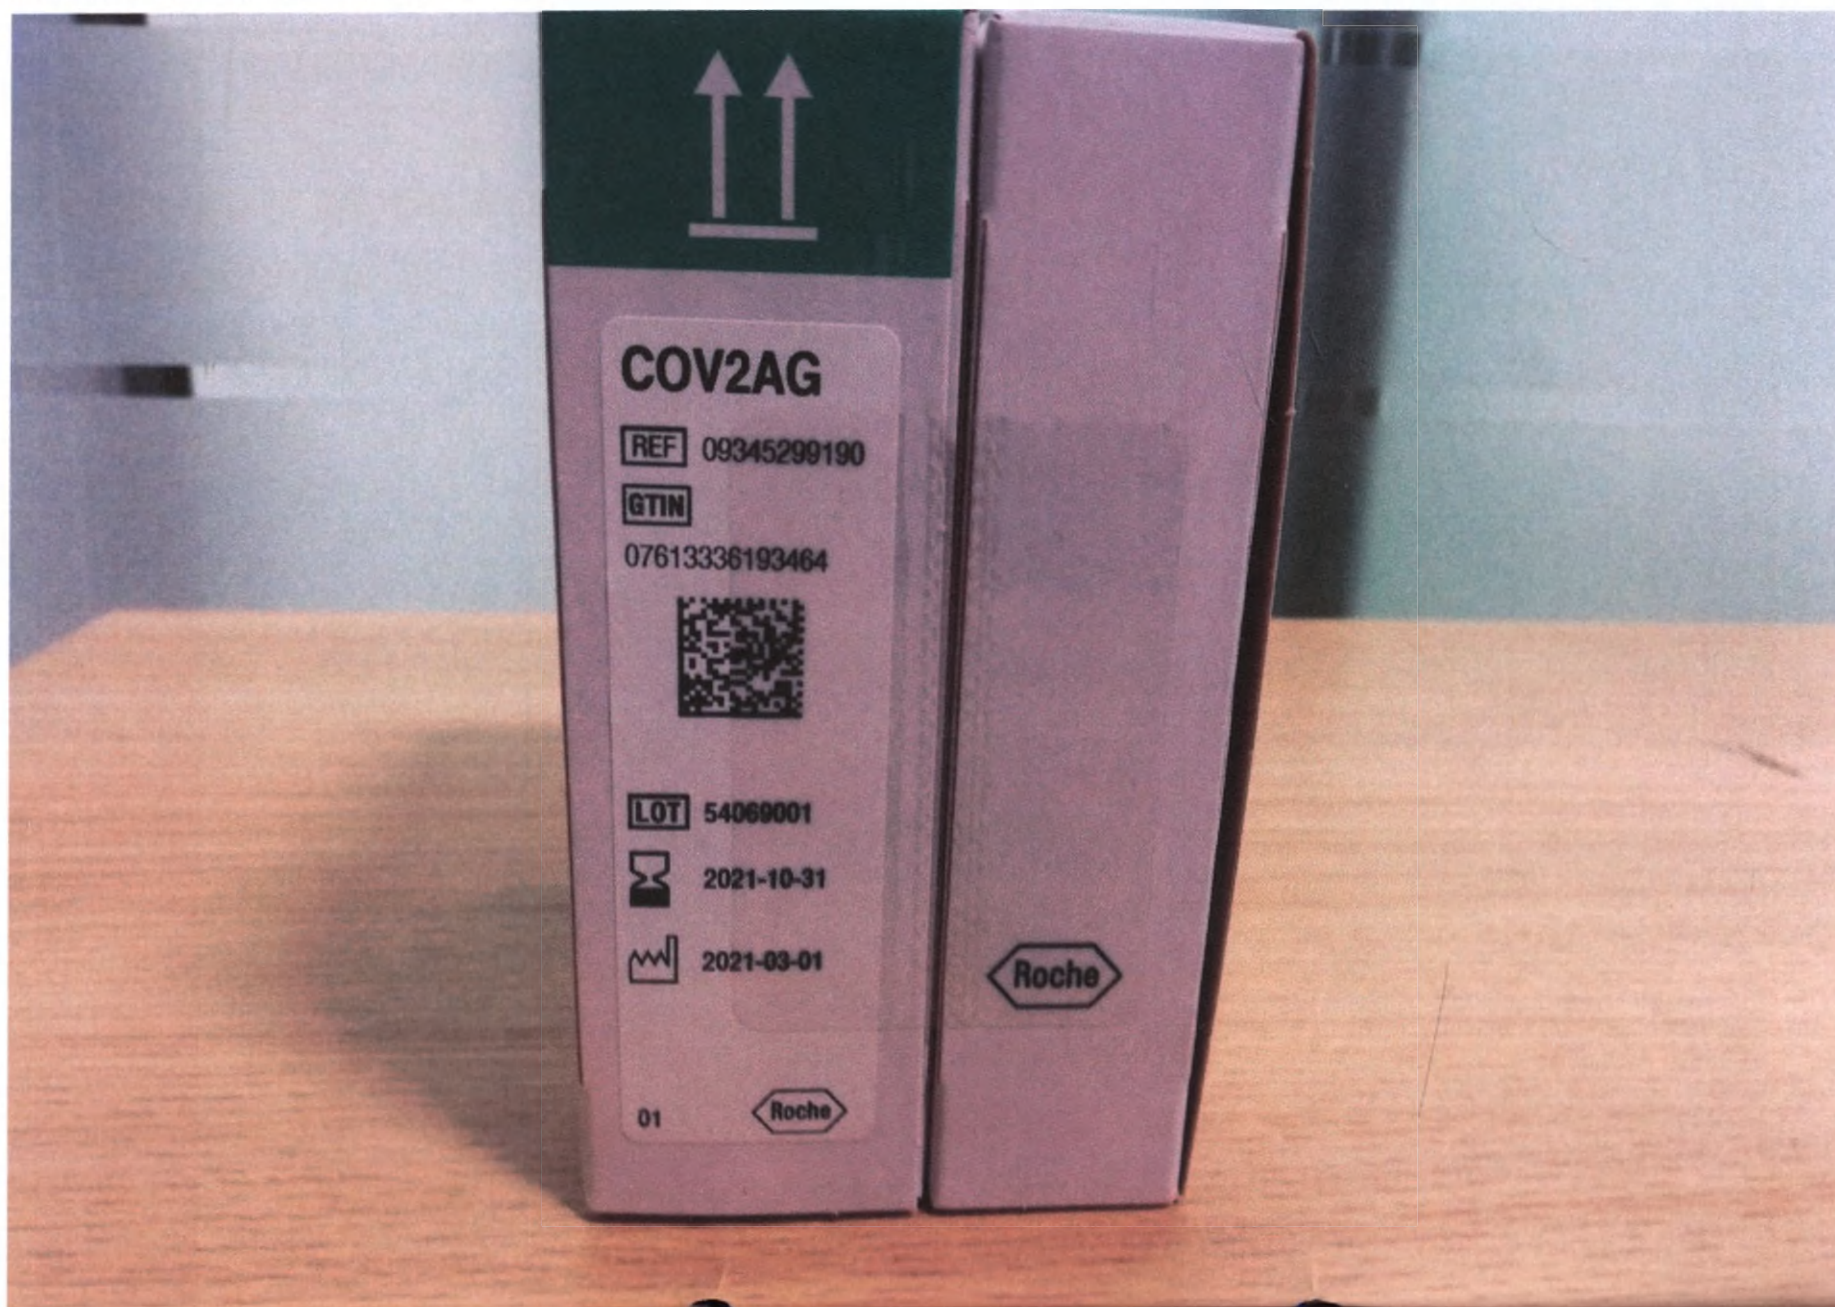

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 300 тестов. Лот 54069001

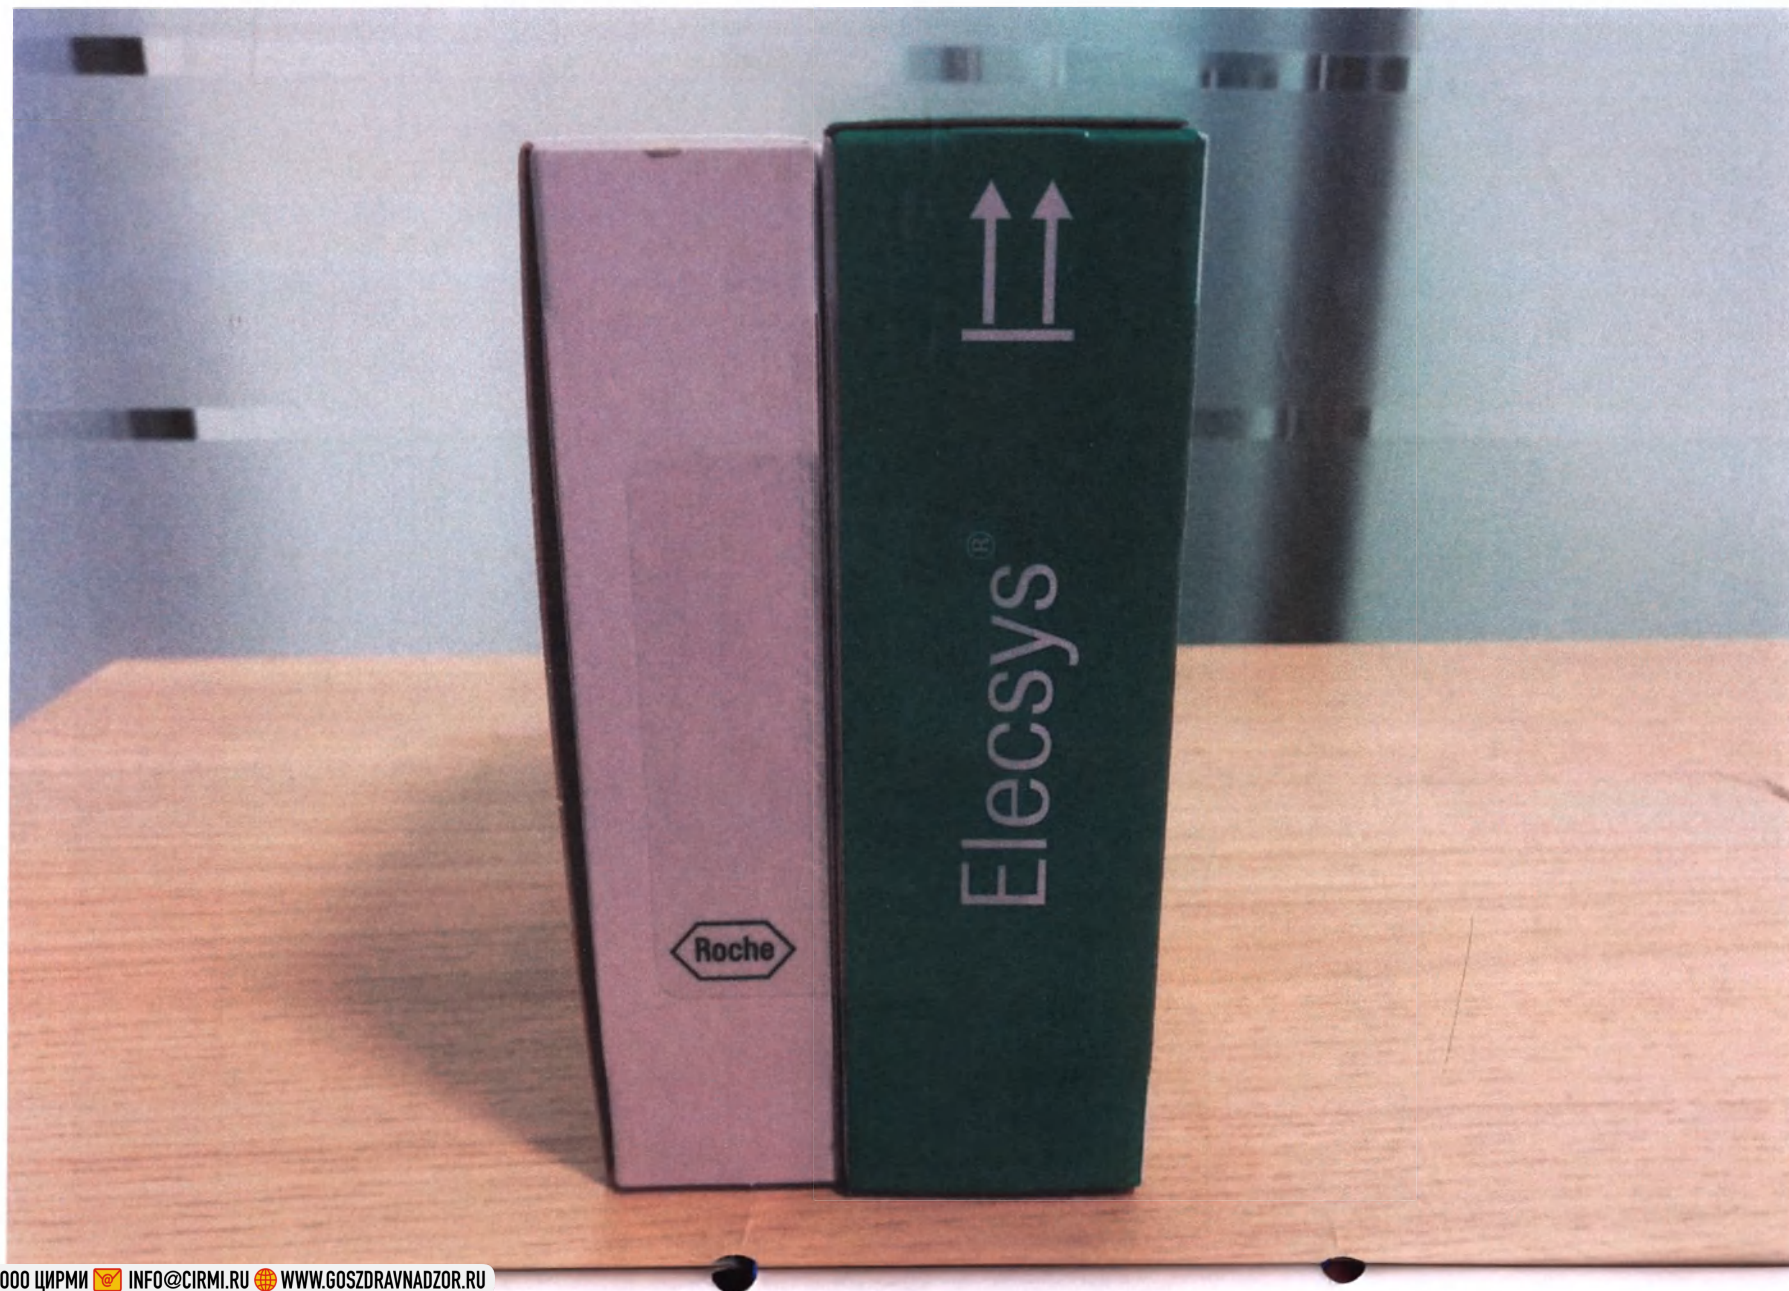

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 300 тестов. Лот 54069001



Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 300 тестов. Лот 54069001

1. Кассета с реагентами на три отделения (флакона) COV2AG: M, R1, R2 – 1 шт.;



Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 300 тестов. Лот 54069001

1. Кассета с реагентами на три отделения (флакона) COV2AG: M, R1, R2 – 1 шт.;



Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 300 тестов. Лот 54069001

2. Калибратор 1 (COV2AG Cal1), флакон, объем 1 мл – 2 шт.;




Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 300 тестов. Лот 54069001

3. Калибратор 2 (COV2AG Cal2), флакон, объем 1 мл – 2 шт.;



Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 300 тестов. Лот 54069001

4. Флакон пустой – 4 шт.;

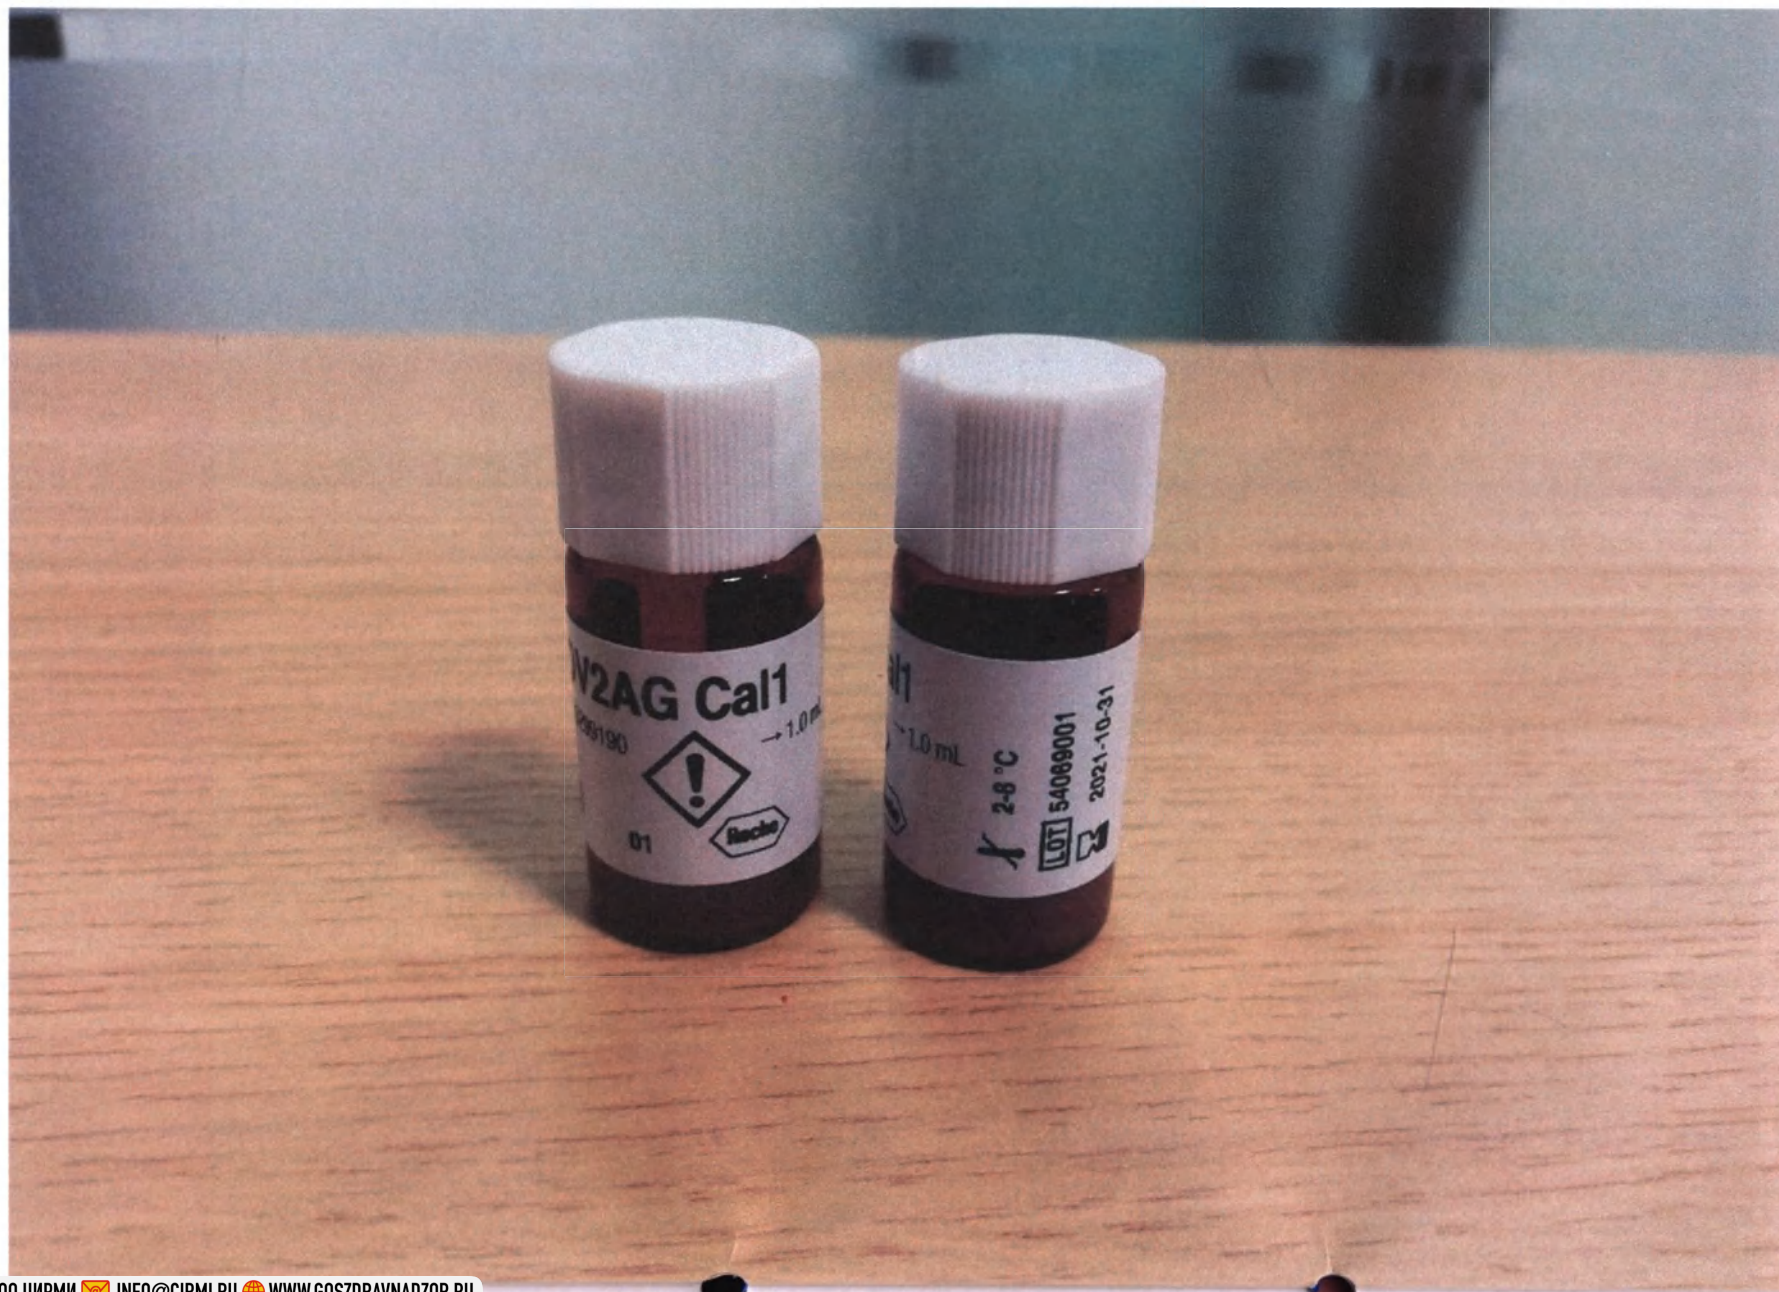

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 300 тестов. Лот 54069001

4. Флакон пустой – 4 шт.;



Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 300 тестов. Лот 54069001

5. Этикетка для флакона – 12 шт.;



Набор реагентов и калибраторов для качественного определения нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys SARS-CoV-2 Antigen cobas e analyzers/COV2AG), 300 тестов. Лот 54069001

6. Инструкция по применению.

## Elecsys SARS-CoV-2 Antigen

### cobas®

084827100 084827250 200 085110

обода e 411  
обода e 071  
обода e 072

**Русский**

**Системная информация**

Для анализа теста в 111, время теста 30/60  
для анализа теста в 307 и обода e 072, время теста 72

**Назначение**

Тест для в-итро диагностики. Тест Elecsys SARS-CoV-2 Antigen предназначен для выявления нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки, собранных у пациентов с признаками и симптомами, соответствующими у пациентов COVID-19, или с симптомами или признаками, соответствующими у пациентов SARS-CoV-2. Тест предназначен для выявления нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2. Тест предназначен для использования на иммунохимическом анализаторе cobas e.

**Вероятность обнаружения**

Взвесь SARS-CoV-2, которую можно обнаружить в коронавиральной культуре SARS-CoV-2, содержащаяся в 100 мкл образца, 1:2 (минимум 7 колоний/полюс, выявляющих инфекционный материал) и 1:10 (минимум 1 колония/полюс, выявляющих инфекционный материал) в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки, собранных у пациентов с признаками и симптомами, соответствующими у пациентов COVID-19, или с симптомами или признаками, соответствующими у пациентов SARS-CoV-2, может быть обнаружена с помощью теста Elecsys SARS-CoV-2 Antigen. Тест предназначен для выявления нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2. Тест предназначен для использования на иммунохимическом анализаторе cobas e.

**Преимущества**

Тест предназначен для выявления нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2. Тест предназначен для использования на иммунохимическом анализаторе cobas e.

**Область применения**

Область применения теста Elecsys SARS-CoV-2 Antigen — выявление нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки, собранных у пациентов с признаками и симптомами, соответствующими у пациентов COVID-19, или с симптомами или признаками, соответствующими у пациентов SARS-CoV-2. Тест предназначен для выявления нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2. Тест предназначен для использования на иммунохимическом анализаторе cobas e.

**Преимущества**

Тест предназначен для выявления нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2. Тест предназначен для использования на иммунохимическом анализаторе cobas e.

**Результаты**

Результаты теста Elecsys SARS-CoV-2 Antigen — выявление нуклеокапсидного антигена коронавируса SARS-CoV-2 в образцах мазков из носоглотки и ротоглотки, собранных у пациентов с признаками и симптомами, соответствующими у пациентов COVID-19, или с симптомами или признаками, соответствующими у пациентов SARS-CoV-2. Тест предназначен для выявления нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2. Тест предназначен для использования на иммунохимическом анализаторе cobas e.

**Упаковка**

Тест предназначен для выявления нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2. Тест предназначен для использования на иммунохимическом анализаторе cobas e.

**Упаковка**

Тест предназначен для выявления нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2. Тест предназначен для использования на иммунохимическом анализаторе cobas e.

**Упаковка**

Тест предназначен для выявления нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2. Тест предназначен для использования на иммунохимическом анализаторе cobas e.

Всего пронумеровано,  
прошнуровано и  
скреплено печатью  
15 листа (ов)



по доверенности  
от 04.02.2021