

SCINTOL

ООМ-500Л2

"М-Сорб-НК"

**Лизирующий раствор
ЛОР**

50 мл

С 050321 +2...+8 °С

в защищённом от света месте

Только для диагностики ин витро



SCINTOL

ООМ-500Л2

"М-Сорб-НК"

**Сорбирующий раствор
СР**

4 мл

С 050321 +2...+8 °С

Только для диагностики ин витро

SCINTOL

ООМ-500Л2

"М-Сорб-НК"

**Промывочный раствор
ПР-А4**

65 мл

С 050321 +2...+8 °С

Только для диагностики ин витро

SCINTOL

ООМ-500Л2

"М-Сорб-НК"

**Элюирующий раствор
ЭР**

18 мл

С 050321 +2...+8 °С

Только для диагностики ин витро

SCINTOL

ООМ-500Л2

**«М-Сорб-НК»
ОКО-В**

1 мл

С 050321 +2...+8°C

Только для диагностики ин витро

SCINTOL

серия 050321

«ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2»

РС-SARS-CoV-2-Л

12 стрипов по 8 микропробирок



Только для диагностики ин витро

SCINTOL

серия 050321

«ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2»

ПКО-nCoV

1 + 0,2 мл ОКО

2...8 °C

Только для диагностики ин витро

SCINTOL

серия 050321

«ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2»

РБ

1,6 мл

2...8 °C

Только для диагностики ин витро

SCINTOL

серия 050321

«ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2»

ВПК-В-РНК

1 мл

2...8 °C

Только для диагностики ин витро

SCINTOL

серия 050321

«ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2»

ОКО

1 мл

2...8 °C

Только для диагностики ин витро

SCINTOL

серия 050321

«ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2»

РС «SARS-CoV-2»

1,5 мл

-16...-20 °C

Только для диагностики ин витро

SCINTOL

серия 050321

«ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2»

ВПК-ОТ

0,02 мл

-16...-20 °C

Только для диагностики ин витро

SCINTOL

серия 050321



«ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2»

Е-Mix

1+0,11 мл РФ

-16...-20 °C

Только для диагностики ин витро

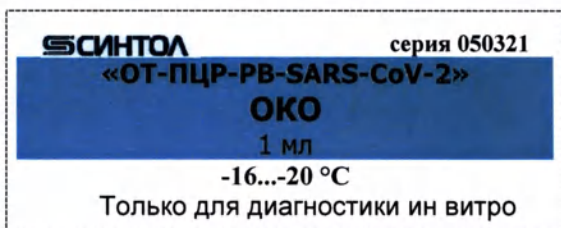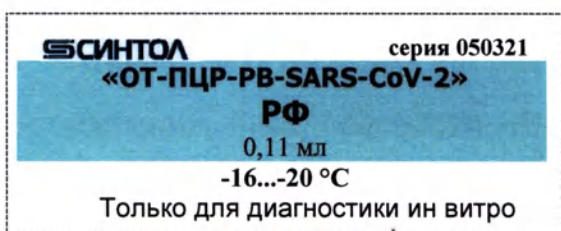

SCINTOL**REF**

OOM-500Л2

«ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2»**Набор реагентов для выявления РНК коронавируса
SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции
в реальном времени**

Комплект реагентов для выделения РНК ручным
способом и на автоматизированных станциях
KingFisher Flex System **«М-Сорб-НК»**

Лизирующий раствор 	ЛОР	50 мл	1 флакон
Сорбирующий раствор	СР	4 мл	1 флакон
Промывочный раствор	ПР-А4	65 мл	1 флакон
Элюирующий раствор	ЭР	18 мл	1 флакон
Отрицательный контрольный образец выделения	ОКО-В	1 мл	1 пробирка

Для профессионального применения

ТУ 21.20.23-003-97313483-2021

№ РЗН _____ от _____

125499, Москва, Кронштадтский б-р, 39к1

email: syntol@syntol.ruwww.syntol.ru**IVD**

2021-03



2022-08



050321



ООО ЦИРМИ



INFO@CIRMI.RU



WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

SCINTOL**REF**

OOM-135Л

«ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2»

**Набор реагентов для выявления РНК коронавируса
SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции
в реальном времени**

Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР-РВ
«ОТ-ПЦР-РВ- SARS-CoV-2-Л»

Реакционная смесь в стрипованных микропробирках	PC-SARS-CoV-2	-	12 стрипов по 8 микропробирок
Разбавитель	РБ	1,6 мл	1 пробирка
Положительный контрольный образец	ПКО-nCoV	-	1 пробирка
Раствор для разбавления ПКО	ОКО	1 мл	1 пробирка
Внутренний положительный контроль выделения	ВПК-В-РНК	1 мл	1 пробирка

FAM, ROX, Cy5

Для профессионального применения
ТУ 21.20.23-003-97313483-2021
№ РЗН _____ от _____



125499, Москва, Кронштадтский б-р, 39к1
email: syntol@syntol.ru
www.syntol.ru

IVD

2021-03



2022-08

LOT

050321

**SCINTOL****REF**

OOM-135

«ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2»

**Набор реагентов для выявления РНК коронавируса
SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции
в реальном времени**

Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР-РВ
«ОТ-ПЦР-РВ- SARS-CoV-2»

Реакционная смесь	PC-SARS-CoV-2	1,5 мл	1 пробирка
Внутренний положительный контроль обратной транскрипции	ВПК-ОТ	0,02 мл	1 пробирка
Смесь ферментов	Е-Mix	-	1 пробирка
Разбавитель фермента	РФ	0,11 мл	1 пробирка
Положительный контрольный образец	ПКО-nCoV	-	1 пробирка
Раствор для разбавления ПКО	ОКО	1 мл	1 пробирка
Внутренний положительный контроль выделения	ВПК-В-РНК	1 мл	1 пробирка

FAM, ROX, Cy5

Для профессионального применения
ТУ 21.20.23-003-97313483-2021
№ РЗН _____ от _____



125499, Москва, Кронштадтский б-р, 39к1
email: syntol@syntol.ru
www.syntol.ru

IVD

2021-03



2022-08

LOT

050321





«ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2»

REF

500Л2-135



НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РНК КОРОНАВИРУСА
SARS-CoV-2 МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
(ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2) ПО ТУ 21.20.23-003-97313483-2021

IVD

Форма выпуска 1

Комплект для выделения РНК ручным способом и на автоматизированных станциях King Fisher Flex System «М-Сорб-НК»				1 шт	Комплект для проведения ОТ-ПЦР-РВ * «ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2»				1 шт
Лизирующий раствор	ЛОР	50 мл	1 флакон	1 флакон	Реакционная смесь	PC-SARS-CoV-2	1,5 мл	1 пробирка	
Сорбирующий раствор	СР	4 мл	1 флакон	1 флакон	Внутренний положительный контроль обратной транскрипции	ВПК-ОТ	0,02 мл	1 пробирка	
Промывочный раствор	ПР-А4	65 мл	1 флакон	1 флакон	Смесь ферментов	Е-Mix	-	1 пробирка	
Элюирующий раствор	ЭР	18 мл	1 флакон	1 флакон	Разбавитель фермента	РФ	0,11 мл	1 пробирка	
Отрицательный контрольный образец выделения	ОКО-В	1 мл	1 пробирка	1 пробирка	Положительный контрольный образец	ПКО-нCoV	-	1 пробирка	
					Внутренний положительный контроль выделения	ВПК-В-РНК	1 мл	1 пробирка	
					Раствор для разбавления ПКО	ОКО	1 мл	1 пробирка	

* Комплект для проведения ОТ-ПЦР-РВ должен храниться при температуре от минус 16 до минус 20 °С

Внимание! После получения набор необходимо разукмплектовать на составляющие комплекты «М-Сорб-НК» и «ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2»
для дальнейшего хранения и использования.



2021-03



2022-08



050321



Для профессионального применения



125499, Москва, Кронштадтский бульвар, 39, корп.1

e-mail: syntol@syntol.ru www.syntol.ruТУ 21.20.23-003-97313483-2021
РУ № РЗН



«ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2»

REF

500Л2-135Л



НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РНК КОРОНАВИРУСА
SARS-CoV-2 МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
(ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2) ПО ТУ 21.20.23-003-97313483-2021

IVD

Форма выпуска 2

Комплект для выделения РНК ручным способом и на автоматизированных станциях King Fisher Flex System «М-Сорб-НК»			1 шт	Комплект для проведения ОТ-ПЦР-РВ «ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2-Л»			1 шт
Лизирующий раствор	ЛОР	50 мл	1 флакон	Реакционная смесь в стрипованных микропробирках	PC-SARS-CoV-2-Л	-	12 стрипов по 8 микропробирок
Сорбирующий раствор	СР	4 мл	1 флакон	Разбавитель	РБ	1,6 мл	1 пробирка
Промывочный раствор	ПР-А4	65 мл	1 флакон	Положительный контрольный образец	ПКО-нCoV	-	1 пробирка
Элюирующий раствор	ЭР	18 мл	1 флакон	Внутренний положительный контроль выделения	ВПК-В-РНК	1 мл	1 пробирка
Отрицательный контрольный образец выделения	ОКО-В	1 мл	1 пробирка	Раствор для разбавления ПКО	ОКО	1 мл	1 пробирка



2021-03



2022-08



050321



96



Для профессионального применения

125499, Москва, Кронштадтский бульвар, 39, корп.1

e-mail: syntol@syntol.ru www.syntol.ruТУ 21.20.23-003-97313483-2021
РУ № РЗН

«ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2» REF 500.12-135

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РНК КОРОНАВИРУСА SARS-CoV-2 МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ (ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2) ПО ТУ 21.20.23-003-97313483-2021

ИД

Форма выпуска 1

Комплект для выделения РНК ручным способом и на автоматизированных станциях King Fisher Flex System «М-Сорб-НК»				Комплект для проведения ОТ-ПЦР-РВ «ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2»			
1 шт				1 шт			
Лизирующий раствор	ЛОР	50 мл	1 флакон	Реакционная смесь	PC-SARS-CoV-2	1,5 мл	1 пробирка
Сорбирующий раствор	СР	4 мл	1 флакон	Внутренний положительный контроль обратной транскрипции	ВПК-ОТ	0,02 мл	1 пробирка
Промывочный раствор	ПР-А4	65 мл	1 флакон	Смесь ферментов	E-Mix	-	1 пробирка
Экспонирующий раствор	ЭР	18 мл	1 флакон	Разбавитель фермента	РФ	0,11 мл	1 пробирка
Отрицательный контрольный образец выделения	ОКО-В	1 мл	1 пробирка	Положительный контрольный образец	ПКО-в-CoV	-	1 пробирка
				Внутренний положительный контроль выделения	ВПК-В-РНК	1 мл	1 пробирка
				Раствор для разбавления ПКО	ОКО	1 мл	1 пробирка

* Комплект для проведения ОТ-ПЦР-РВ должен храниться при температуре от +2 до +8 °С.

Внимание! После получения набор необходимо разукрупнить на составляющие комплексы «М-Сорб-НК» и «ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2» для дальнейшего хранения и использования.

125499, Москва, Кронштадтский бульвар, 39, корпус 1

2021-03 2022-08

LOT 050321

Для профессионального применения

ТУ 21.20.23-003-97313483-2021

РУ № РЗН

«ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2» REF OOM-500.12

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени

Комплект реагентов для выделения РНК ручным способом и на автоматизированных станциях King Fisher Flex System «М-Сорб-НК»

Лизирующий раствор	ЛОР	50 мл	1 флакон
Сорбирующий раствор	СР	4 мл	1 флакон
Промывочный раствор	ПР-А4	65 мл	1 флакон
Экспонирующий раствор	ЭР	18 мл	1 флакон
Отрицательный контрольный образец выделения	ОКО-В	1 мл	1 пробирка

Для профессионального применения

ТУ 21.20.23-003-97313483-2021

125499, Москва, Кронштадтский б-р, 39к1

ИД

2021-03 2022-08

LOT 050321

«ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2» REF OOM-135

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени

Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР-РВ «ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2»

Реакционная смесь	PC-SARS-CoV-2	1,5 мл	1 пробирка
Внутренний положительный контроль обратной транскрипции	ВПК-ОТ	0,02 мл	1 пробирка
Смесь ферментов	E-Mix	-	1 пробирка
Разбавитель фермента	РФ	0,11 мл	1 пробирка
Положительный контрольный образец	ПКО-в-CoV	-	1 пробирка
Раствор для разбавления ПКО	ОКО	1 мл	1 пробирка
Внутренний положительный контроль выделения	ВПК-В-РНК	1 мл	1 пробирка

ИД

2021-03 2022-08

LOT 050321

Для профессионального применения

ТУ 21.20.23-003-97313483-2021

125499, Москва, Кронштадтский б-р, 39к1

ИД

№1

КУЗУБОВ А.В.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



КОПИЯ
ВЕРНА

SCINTOLA REF 500.12-135.1

«ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2»

НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РНК КОРОНАВИРУСА SARS-CoV-2 МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ (ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2) ПО ТУ 21.20.23-003-97313483-2021

ИД

Форма выпуска 2

Комплект для выделения РНК ручным способом и на автоматизированных станциях King Fisher Flex System «М-Сеп-НК»			1 шт	Комплект для проведения ОТ-ПЦР-РВ «ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2-Л»			1 шт
Лизированный раствор	ЛОР	50 мл	1 флакон	Реакционная смесь в сгущенном виде	PC-SARS-CoV-2-Л	-	12 суспензий по 8 микролитров
Стерилизующий раствор	СР	4 мл	1 флакон	Разбавитель	РБ	1,5 мл	1 пробирка
Промывочный раствор	ПР-А4	65 мл	1 флакон	Положительный контрольный образец	ПКО-«С»	-	1 пробирка
Лизированный раствор	ЭР	18 мл	1 флакон	Внутренний положительный контроль выделения	ВПК-В-РНК	1 мл	1 пробирка
Отрицательный контрольный образец выделения	ОКО-В	1 мл	1 пробирка	Раствор для разбавления ПКО	ОКО	1 мл	1 пробирка

125499, Москва, Кронштадтский бульвар, 39, стр.1 e-mail: info@scintola.ru www.scintola.ru

2021-03 2022-06 050321

Для профессионального применения ТУ 21.20.23-003-97313483-2021 Р.У. № Р.511

SCINTOLA REF 00M-00012

«ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2»

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени

Комплект реагентов для выделения РНК ручным способом и на автоматизированных станциях King Fisher Flex System «М-Сеп-НК»

Лизированный раствор	ЛОР	50 мл	1 флакон
Стерилизующий раствор	СР	4 мл	1 флакон
Промывочный раствор	ПР-А4	65 мл	1 флакон
Лизированный раствор	ЭР	18 мл	1 флакон
Отрицательный контрольный образец	ОКО-В	1 мл	1 пробирка

Для профессионального применения ТУ 21.20.23-003-97313483-2021

125499, Москва, Кронштадтский б-р, 39-1 e-mail: info@scintola.ru www.scintola.ru

ИД 2021-03 2022-06

SCINTOLA серия 050321 REF 00M-135.1

«ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2»

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени

Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР-РВ «ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2-Л»

Реакционная смесь в сгущенном виде	PC-SARS-CoV-2-Л	12 суспензий по 8 микролитров
Разбавитель	РБ	1,5 мл 1 пробирка
Положительный контрольный образец	ПКО-«С»	1 пробирка
Внутренний положительный контроль выделения	ВПК-В-РНК	1 мл 1 пробирка
Раствор для разбавления ПКО	ОКО	1 мл 1 пробирка

ТМ, РОУ, СУБ

Для профессионального применения ТУ 21.20.23-003-97313483-2021

125499, Москва, Кронштадтский б-р, 39-1 e-mail: info@scintola.ru www.scintola.ru

ИД 2021-03 2022-06

N/2

КУЗУБОВ А.В.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



КОПИЯ
ВЕРНА

SCINTOLA REF OOM-500/2






«ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2»
 Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени

Комплект реагентов для выделения РНК ручным способом и на автоматизированных станциях KingFisher Flex System «М-Сорб-НК»

Лизирующий раствор	ЛОР	50 мл	1 флакон
Сорбирующий раствор	СР	4 мл	1 флакон
Промывочный раствор	ПР-А4	65 мл	1 флакон
Элюирующий раствор	ЭР	18 мл	1 флакон
Отрицательный контрольный образец выделения	ОКО-В	1 мл	1 пробирка

Для профессионального применения
 ТУ 21.20.23-003-97313483-2021
 № РЗН _____ от _____
 125499, Москва, Кронштадтский б-р, 39к1
 email: scintola@scintola.ru
www.scintola.ru

IVD 2021-03 2022-08
 LOT 050321

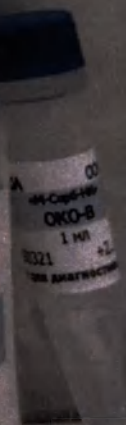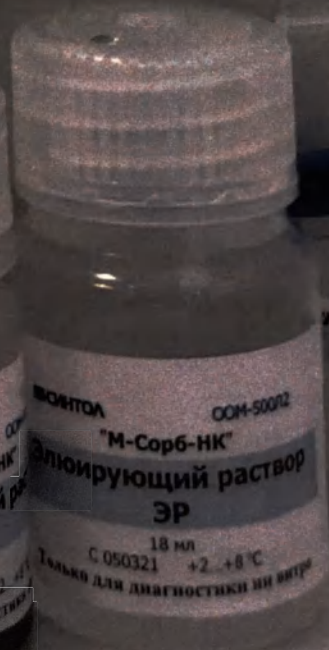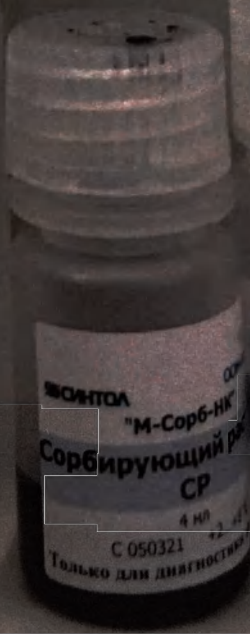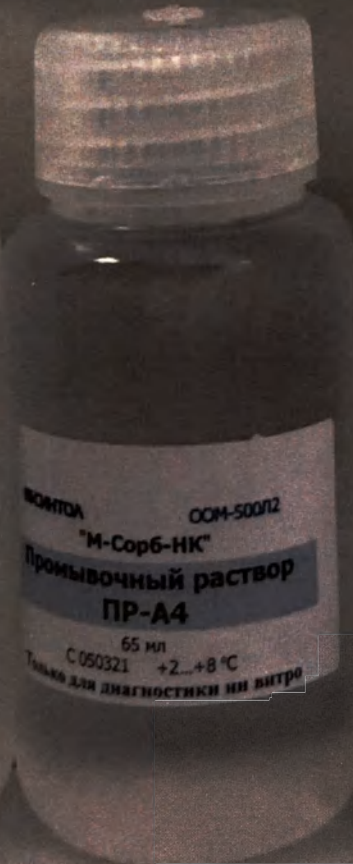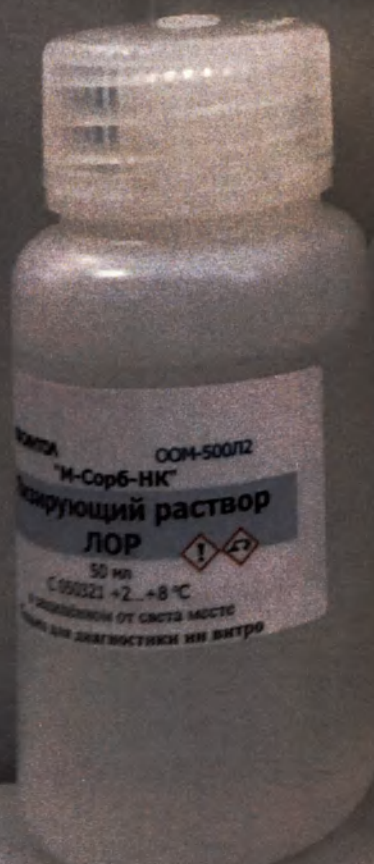

№ 3

КУЗУБОВ А.В.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



КОПИЯ
ВЕРНА


БСИНТОЛ

ООМ-500Л2

"М-Сорб-НК"

Лизирующий раствор

ЛОР



50 мл

С 050321 +2...+8 °С

в защищённом от света месте


Только для диагностики in vitro

N4

КУЗУБОВ А.В.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



КОПИЯ
ВЕРНА

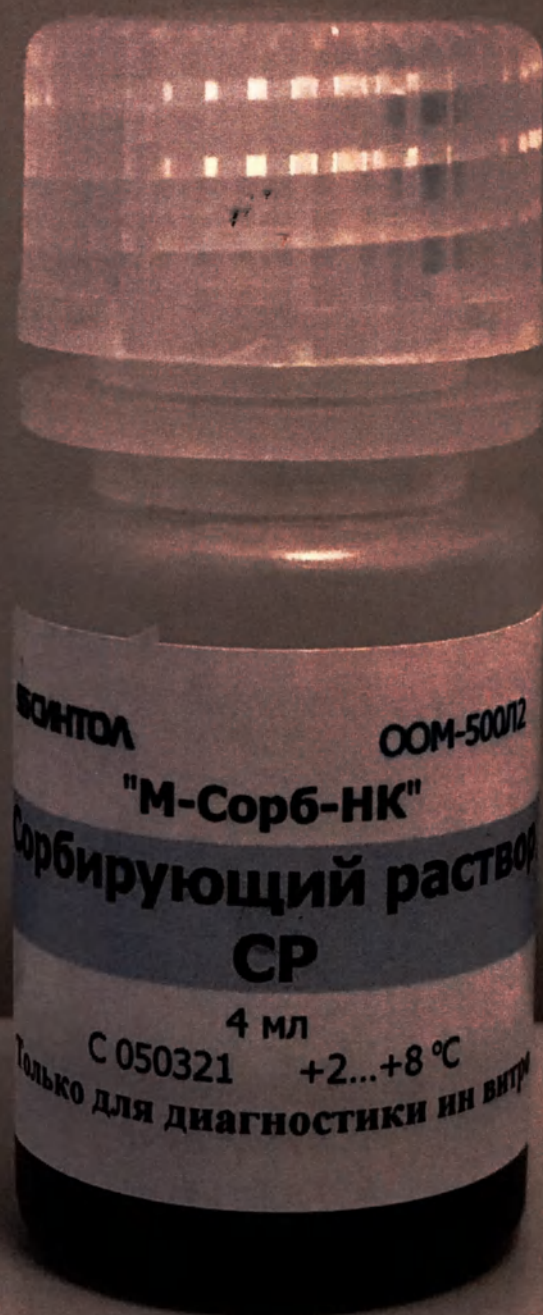

N 5

КУЗУБОВ А.В.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



КОПИЯ
ВЕРНА

БИНТОЛ

ООМ-500Л2

"М-Сорб-НК"

**Промывочный раствор
ПР-А4**

65 мл

С 050321 +2...+8 °С


Только для диагностики ин витро

N6

КУЗУБОВ А.В.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



КОПИЯ
ВЕРНА

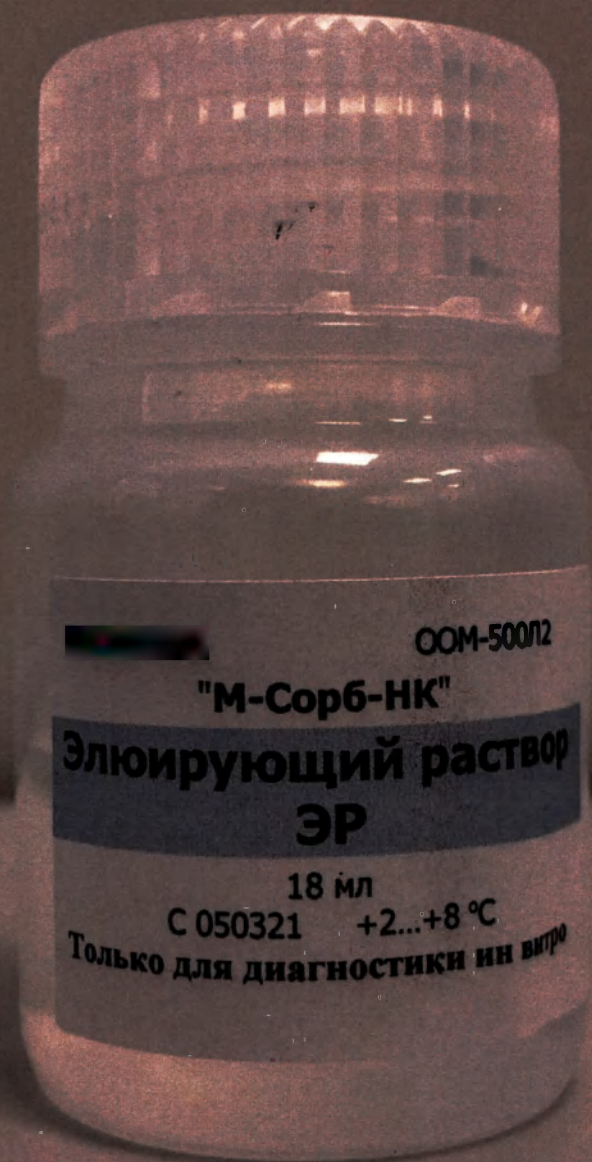

ООН-500Л2

"М-Сорб-НК"

Элюирующий раствор
ЭР

18 мл

С 050321

+2...+8 °C

Только для диагностики in vitro

N7

КУЗУБОВ А.Б.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



КОПИЯ
ВЕРНА



N 8

КУЗУБОВ А.В.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



КОПИЯ
ВЕРНА

SCINTOA REF OOM-135A

«ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2»

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени

Комплект реагентов для проведения ОТ-ПЦР-РВ «ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2-Л»

Реагентный блок 1 (применяется для 12 проб)	PC-SARS-CoV-2-Л	2,2 мл	2 пробирки
Реагентный блок 2 (применяется для 12 проб)	РВ	2,2 мл	2 пробирки
Положительный контрольный образец	1000-крат	1 мл	1 пробирка
Реагент для разбавления РНК	1000-крат	1 мл	1 пробирка
Вспомогательный реактив	1000-крат	1 мл	1 пробирка

FAM, ROX, Cy5

Для профессионального применения
ТУ 21.30.33-003-9733483-2021
№ РНВ _____ ИР _____

125408, Москва, Крюковский б-р, 39А
e-mail: scintoa@scintoa.ru
www.scintoa.ru

IVD 2021-03 2023-08

LOT 00021

SCINTOA серия 050321

«ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2»

PC-SARS-CoV-2-Л

12 пробирок по 2 мл микропробирок

Только для диагностики in vitro



№ 9.

КУЗУБОВ А.В.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



КОПИЯ
ВЕРНА

SCINTOL

серия 050321

«ОТ-ПЦР-РВ-SARS-CoV-2»

РС-SARS-CoV-2-Л

12 стрипов по 8 микропробирок




Только для диагностики in vitro

N 10

КУЗУБОВ А.В.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



КОПИЯ
ВЕРНА

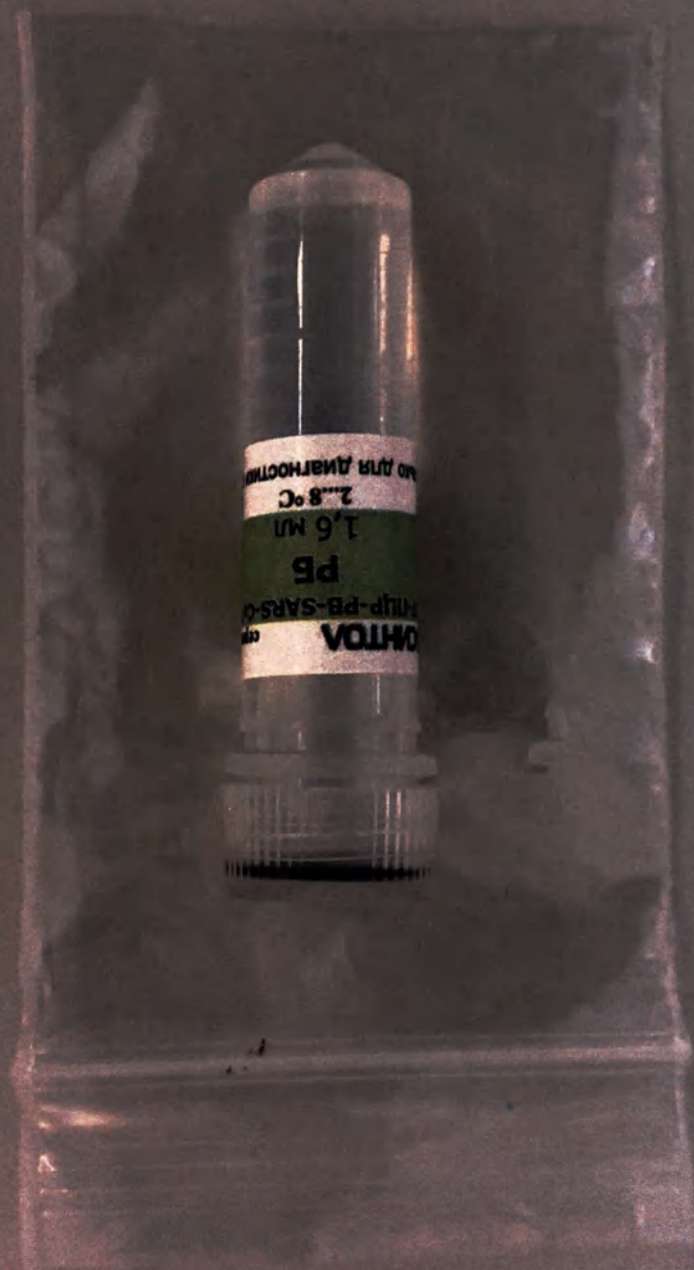

N 11

КУЗУБОР А.В.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



КОПИЯ
ВЕРНА



N 12

КУЗУБОВ А.В.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР




КОПИЯ
ВЕРНА



N 13

КУЗУБОВ А.В.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



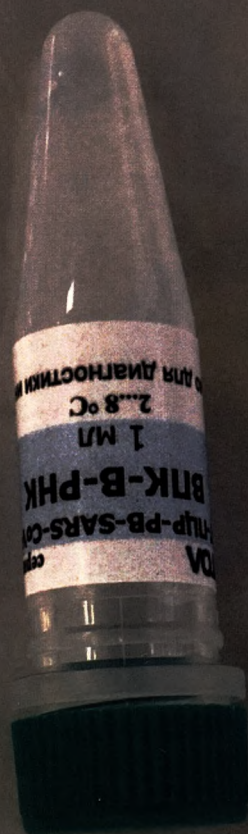

N14

КУЗУБОВ А.В.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



КОПИЯ
ВЕРНА



SCANTVA
REF OOM-135

Набор реагентов для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции
в пачке с заменой ОТ-НП-РБ

Комплект реагентов для проведения ОТ-НП-РБ
«ОТ-НП-РБ-SARS-CoV-2»

Реакционная смесь	1.5 мл	1 пробирка
Внутренний положительный контроль	0.02 мл	1 пробирка
Смесь ферментов	0.11 мл	1 пробирка
Разбавитель фермента	-	1 пробирка
Плазмидный контроль	-	1 пробирка
Образец	-	1 пробирка
Реагент для разбавления ТКО	1 мл	1 пробирка
Внутренний положительный контроль	1 мл	1 пробирка

ВКР-Б-РНК 1 мл 1 пробирка

ОМО 1 мл 1 пробирка

ТКО-н-ОВ 1 мл 1 пробирка

РФ 0.11 мл 1 пробирка

Е-МБ 0.02 мл 1 пробирка

ВКР-ОТ 0.02 мл 1 пробирка

PCSA-2-SARS-CoV-2 1.5 мл 1 пробирка

ИД 2021-03 2022-08

LOT 050321

135409, Москва, Космонавтов Б-9, 2041

№ РН

ТН 21.20.23-003-97313483-2021

Для профессионального применения

email: info@scantva.ru

N15

КУЗУБОВ А.В.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



КОПИЯ
ВЕРНА




N 16

КУЗУБОВ А.В.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



КОПИЯ
ВЕРНА

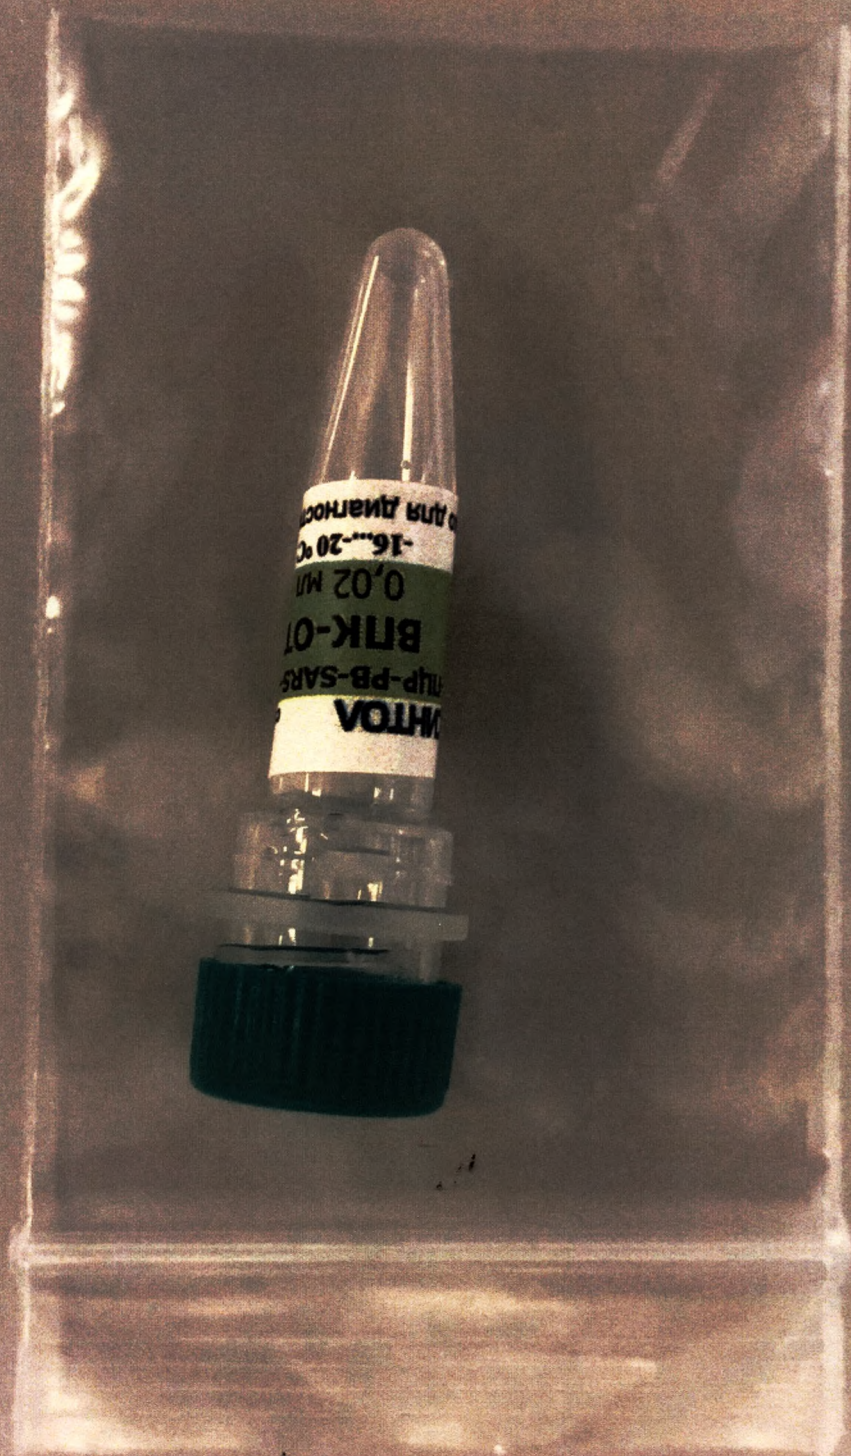

N 17

КУЗУБОВ А.В.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР




КОПИЯ
ВЕРНА



N 18

КУЗУБОВ А.В.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



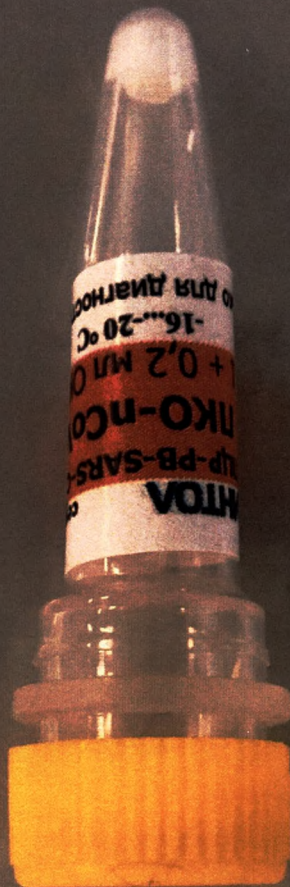


N 19

КУЗУБОВ А.В.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР




КОПИЯ
ВЕРНА

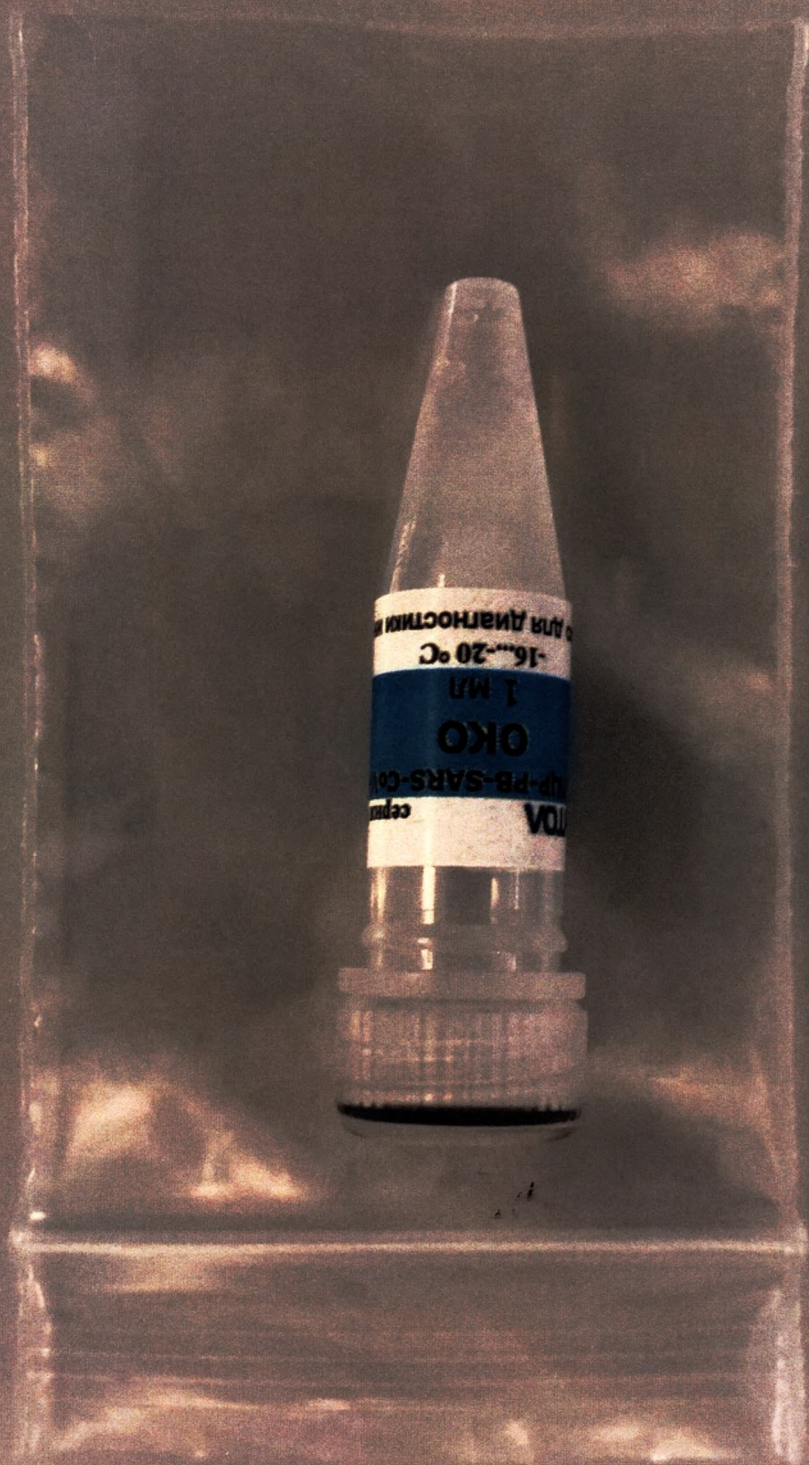

N 20

КУЗУБОВ А.В.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



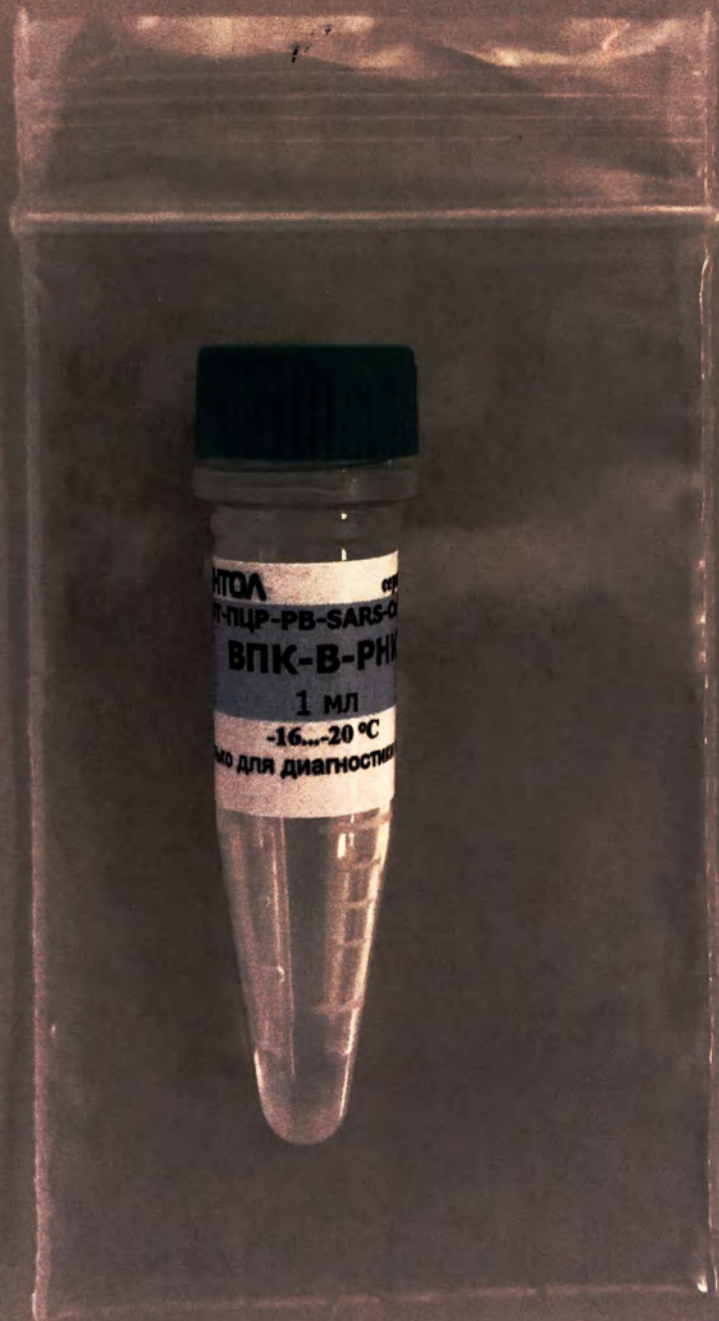

N 21

КУЗУБОВ А.В.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР



КОПИЯ
ВЕРНА