

Canon

АО «Канон Медикал Системз»

Made For life

Фотографические изображения
медицинского изделия

**Система диагностическая ультразвуковая XARIO 200
(модель TUS-X200) с принадлежностями**

УТВЕРЖДАЮ


Генеральный директор

АО «Канон Медикал Системз»

А.В. Чабаненко



Система диагностическая ультразвуковая XARIO 200 (модель TUS-X200) с принадлежностями

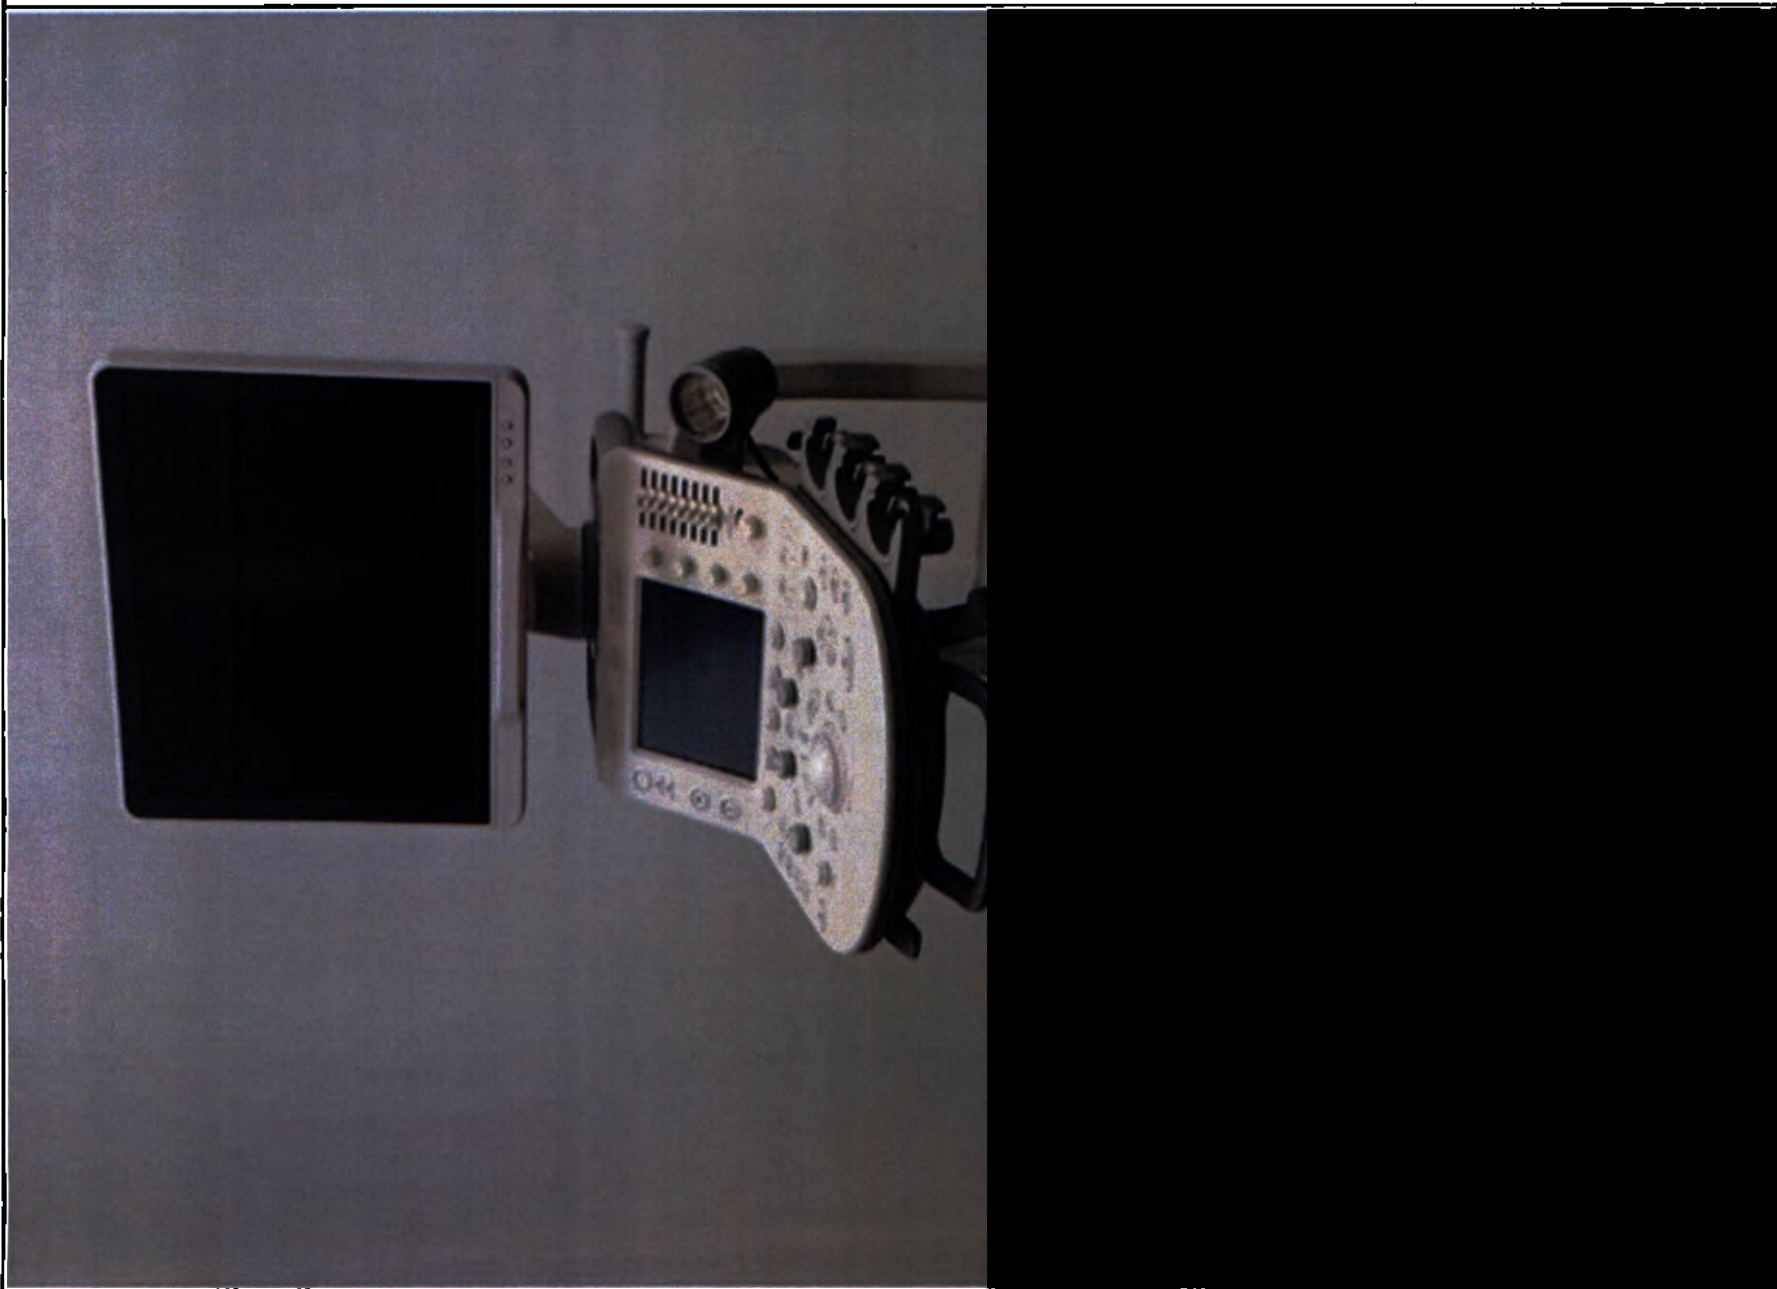

Система диагностическая ультразвуковая XARIO 200 (модель TUS-X200) с принадлежностями в составе
(Пример маркировки на русском языке)



CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION
1385 SHMOISHIGAMI, OTAWARA-SHI, TOCHIGI,
324-8550, JAPAN

СИСТЕМА ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ
XARIO 200 (TUS-X200) С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

РУ № _____ ОТ _____

Уполномоченный представитель производителя в России:
АО "Канон Медикал Системз"
123242, Россия, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, пом. II,
ком. 15, эт. 6, тел. +7(495)6265809, +7(495)2843254

Сделано в Японии


Система диагностическая ультразвуковая XARIO 200 (модель TUS-X200) с принадлежностями, в составе:
1. Основной блок системы




2. Программное обеспечение системы базовое.




3. Монитор цветной жидкокристаллический.

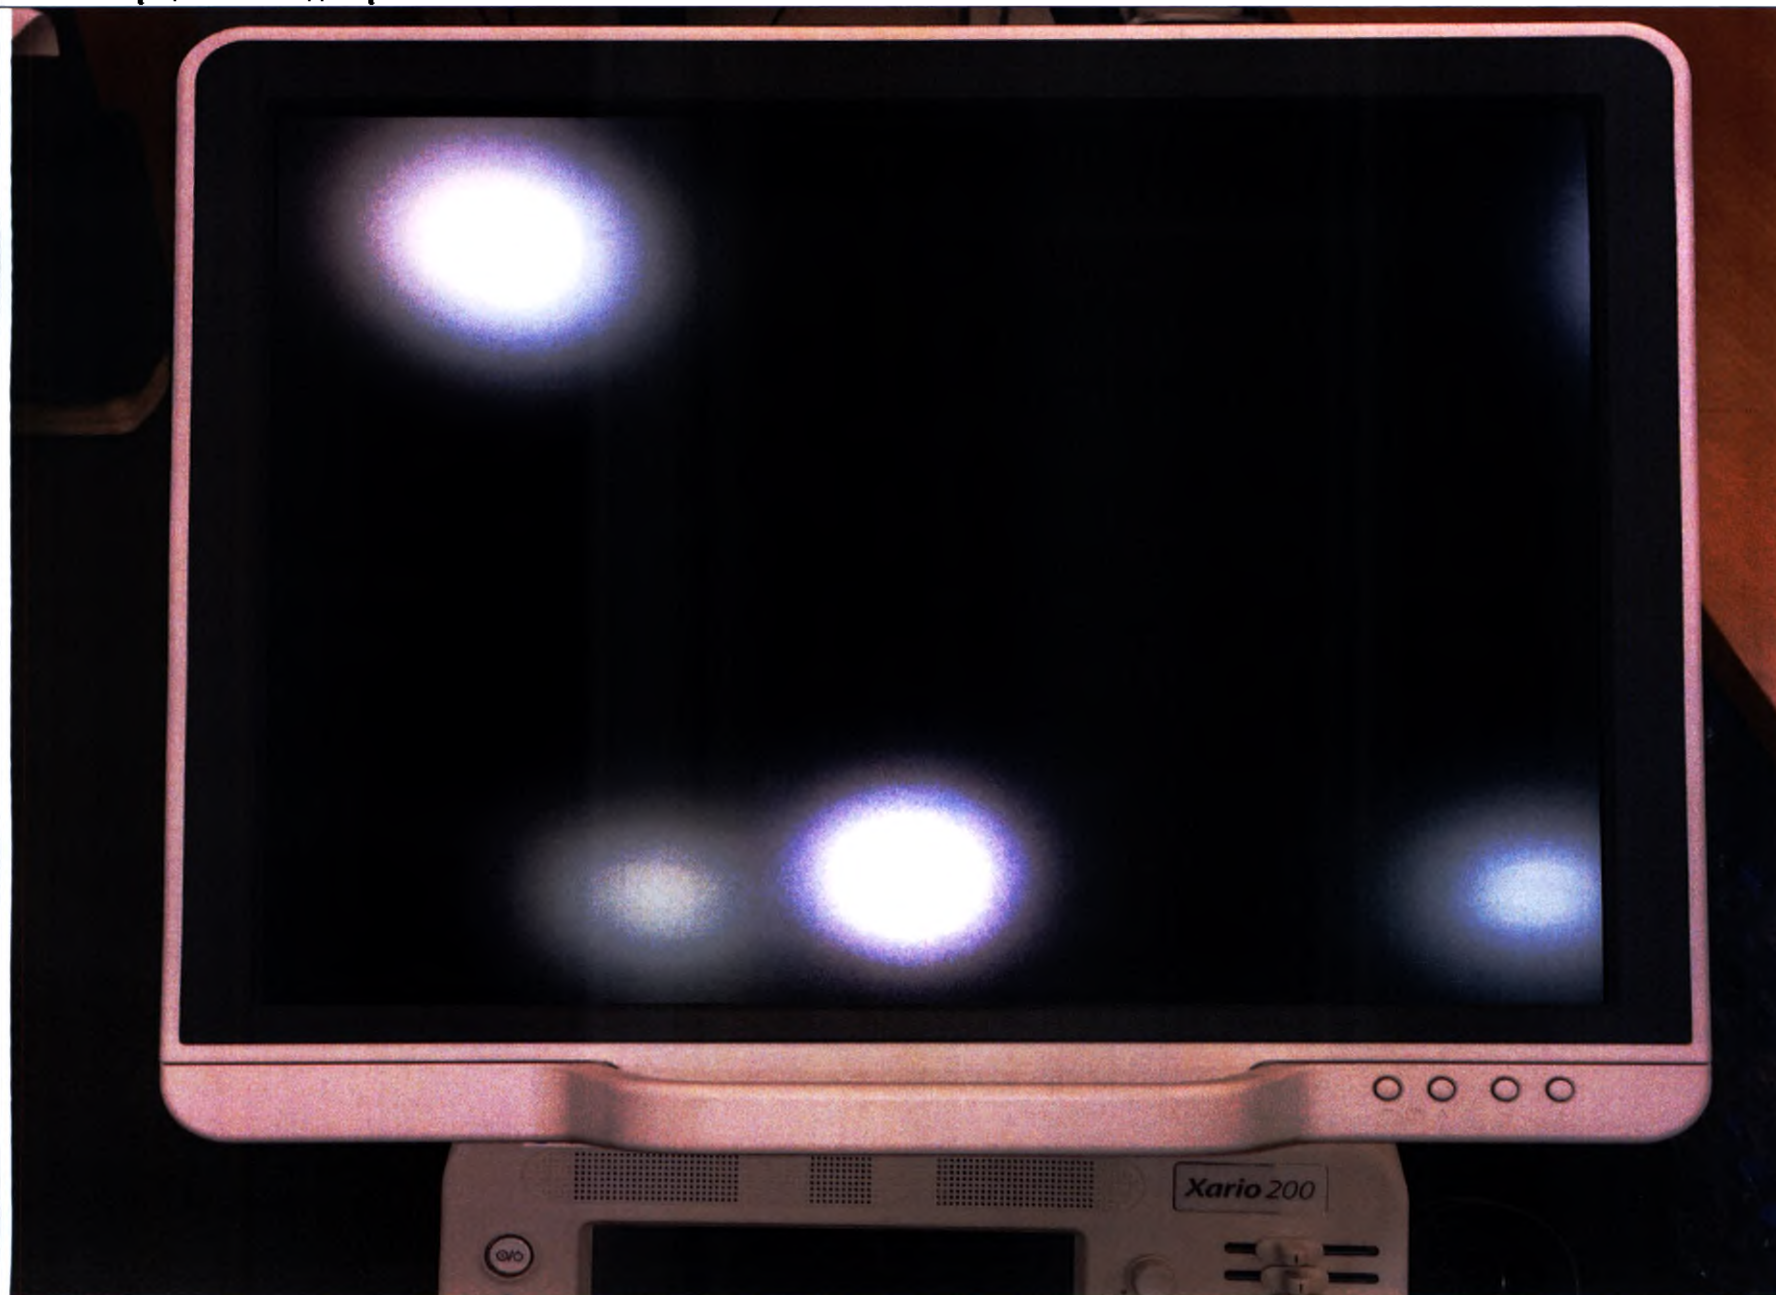

4. Датчик секторный, модель PSU-25BT (при необходимости)

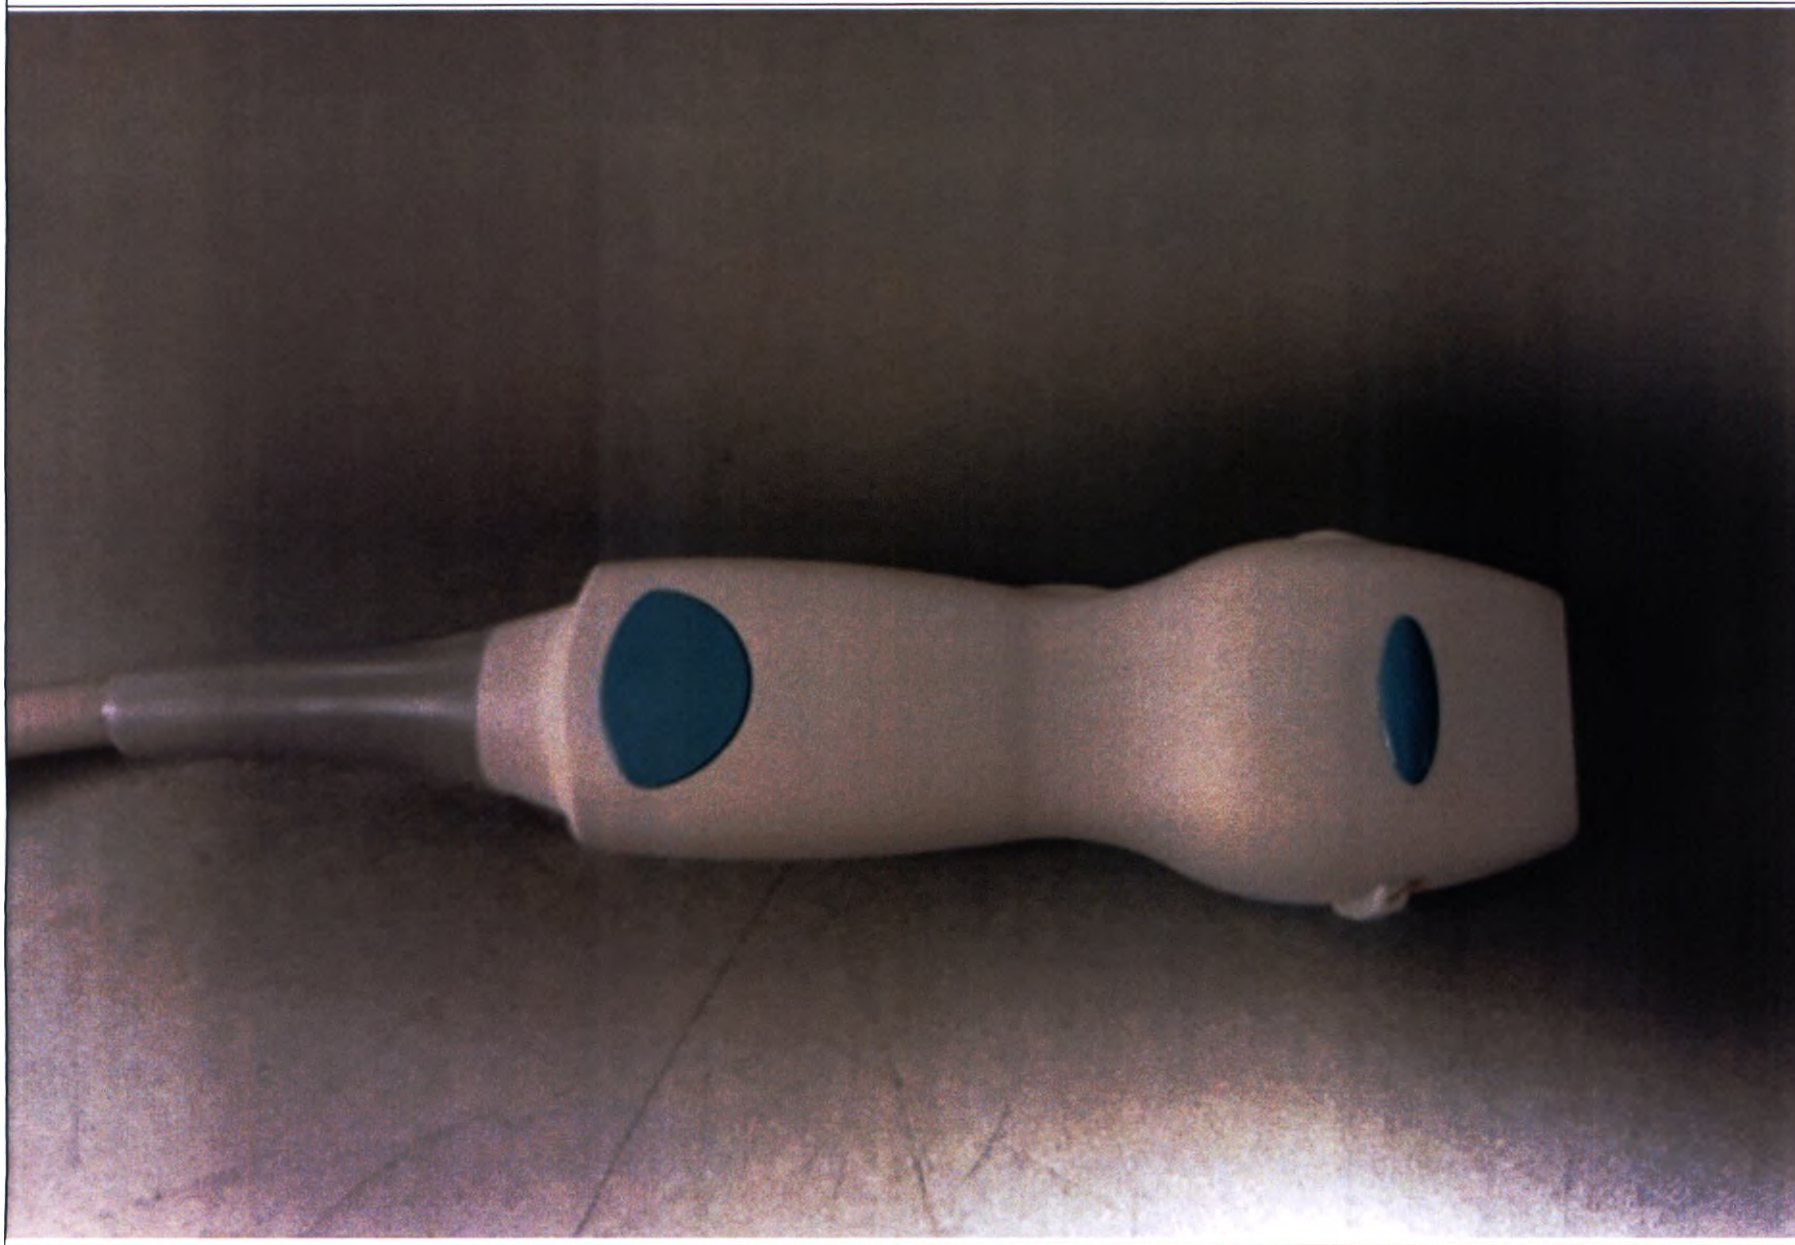


4. Датчик секторный, модель PSU-25BT (при необходимости)

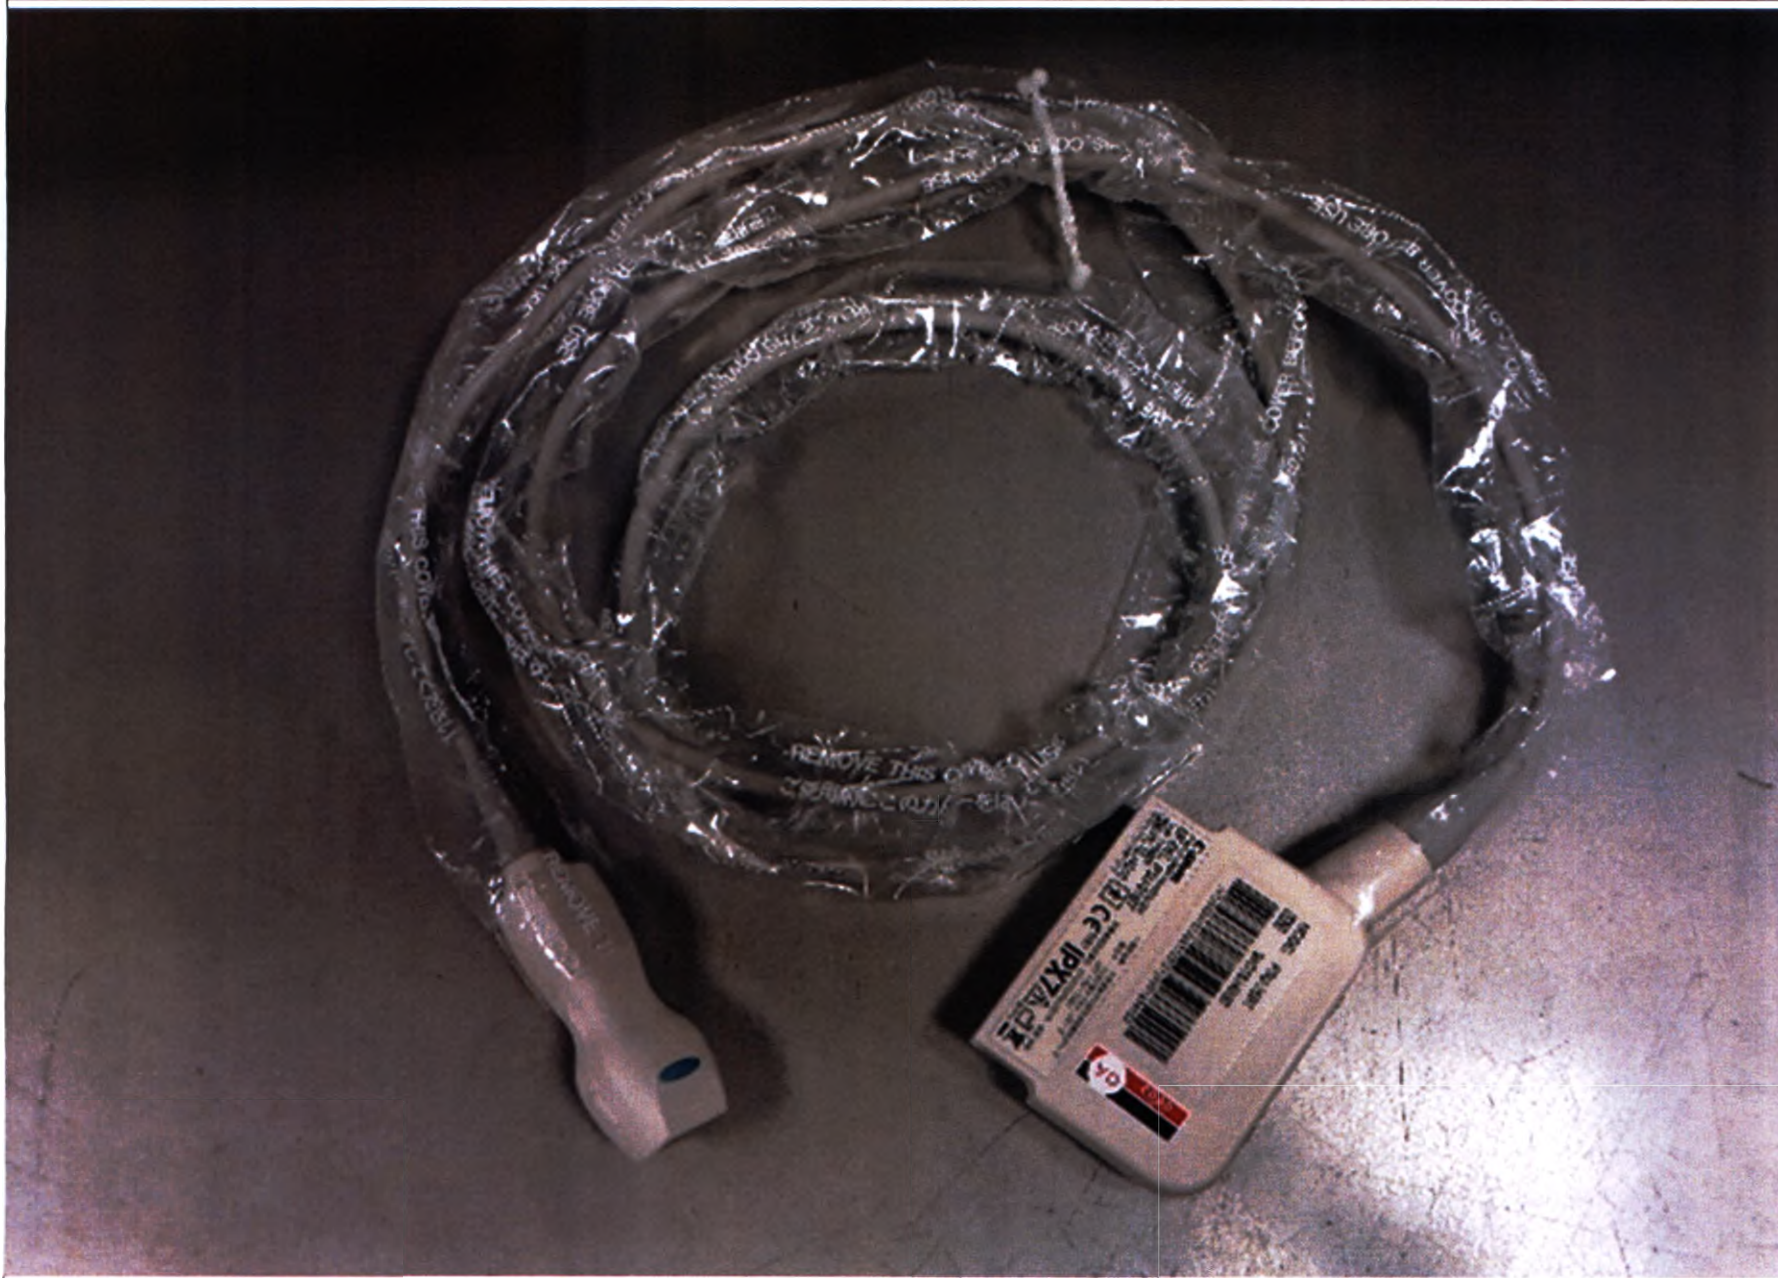


4. Датчик секторный, модель PSU-25BT (при необходимости)




5. Датчик секторный, модель PSU-30BT (при необходимости).

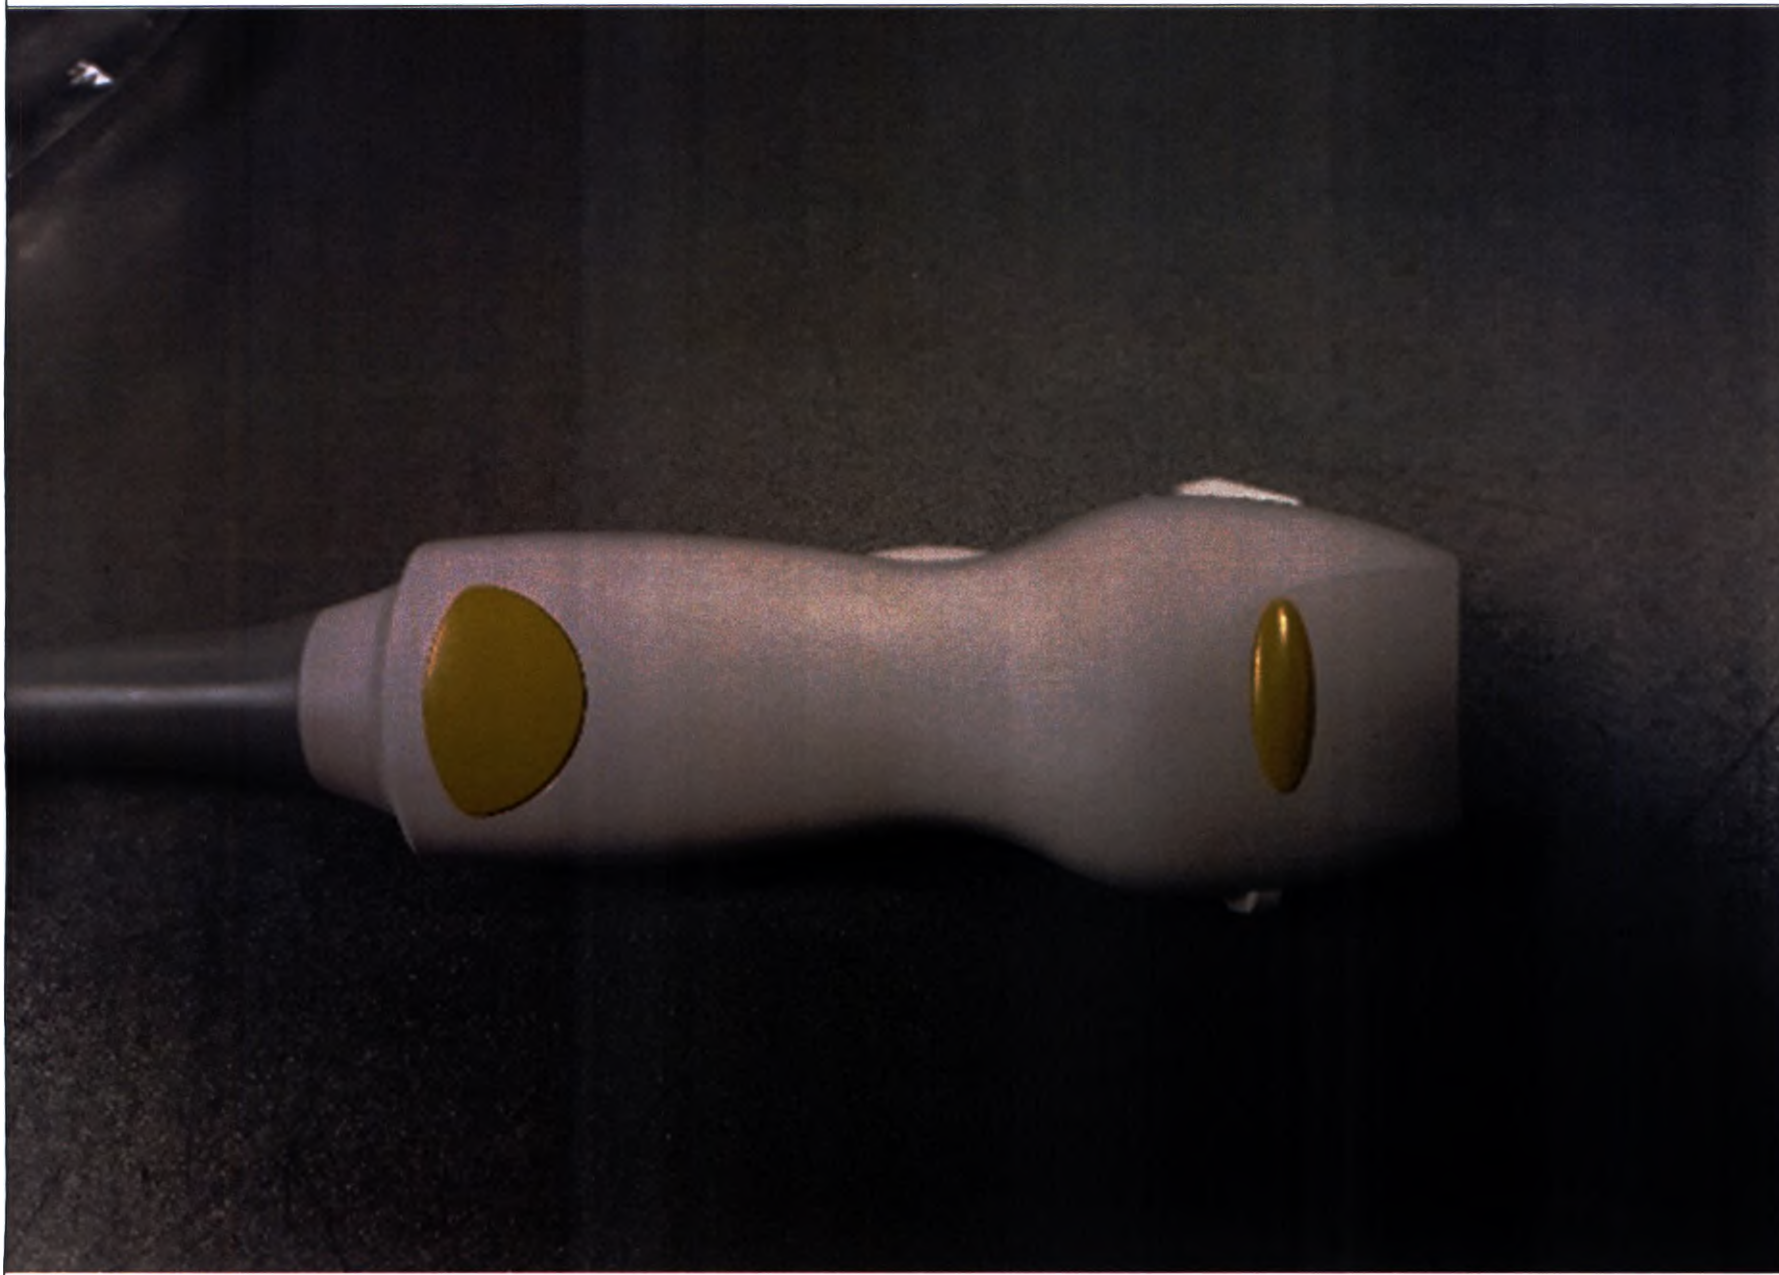


5. Датчик секторный, модель PSU-30BT (при необходимости).

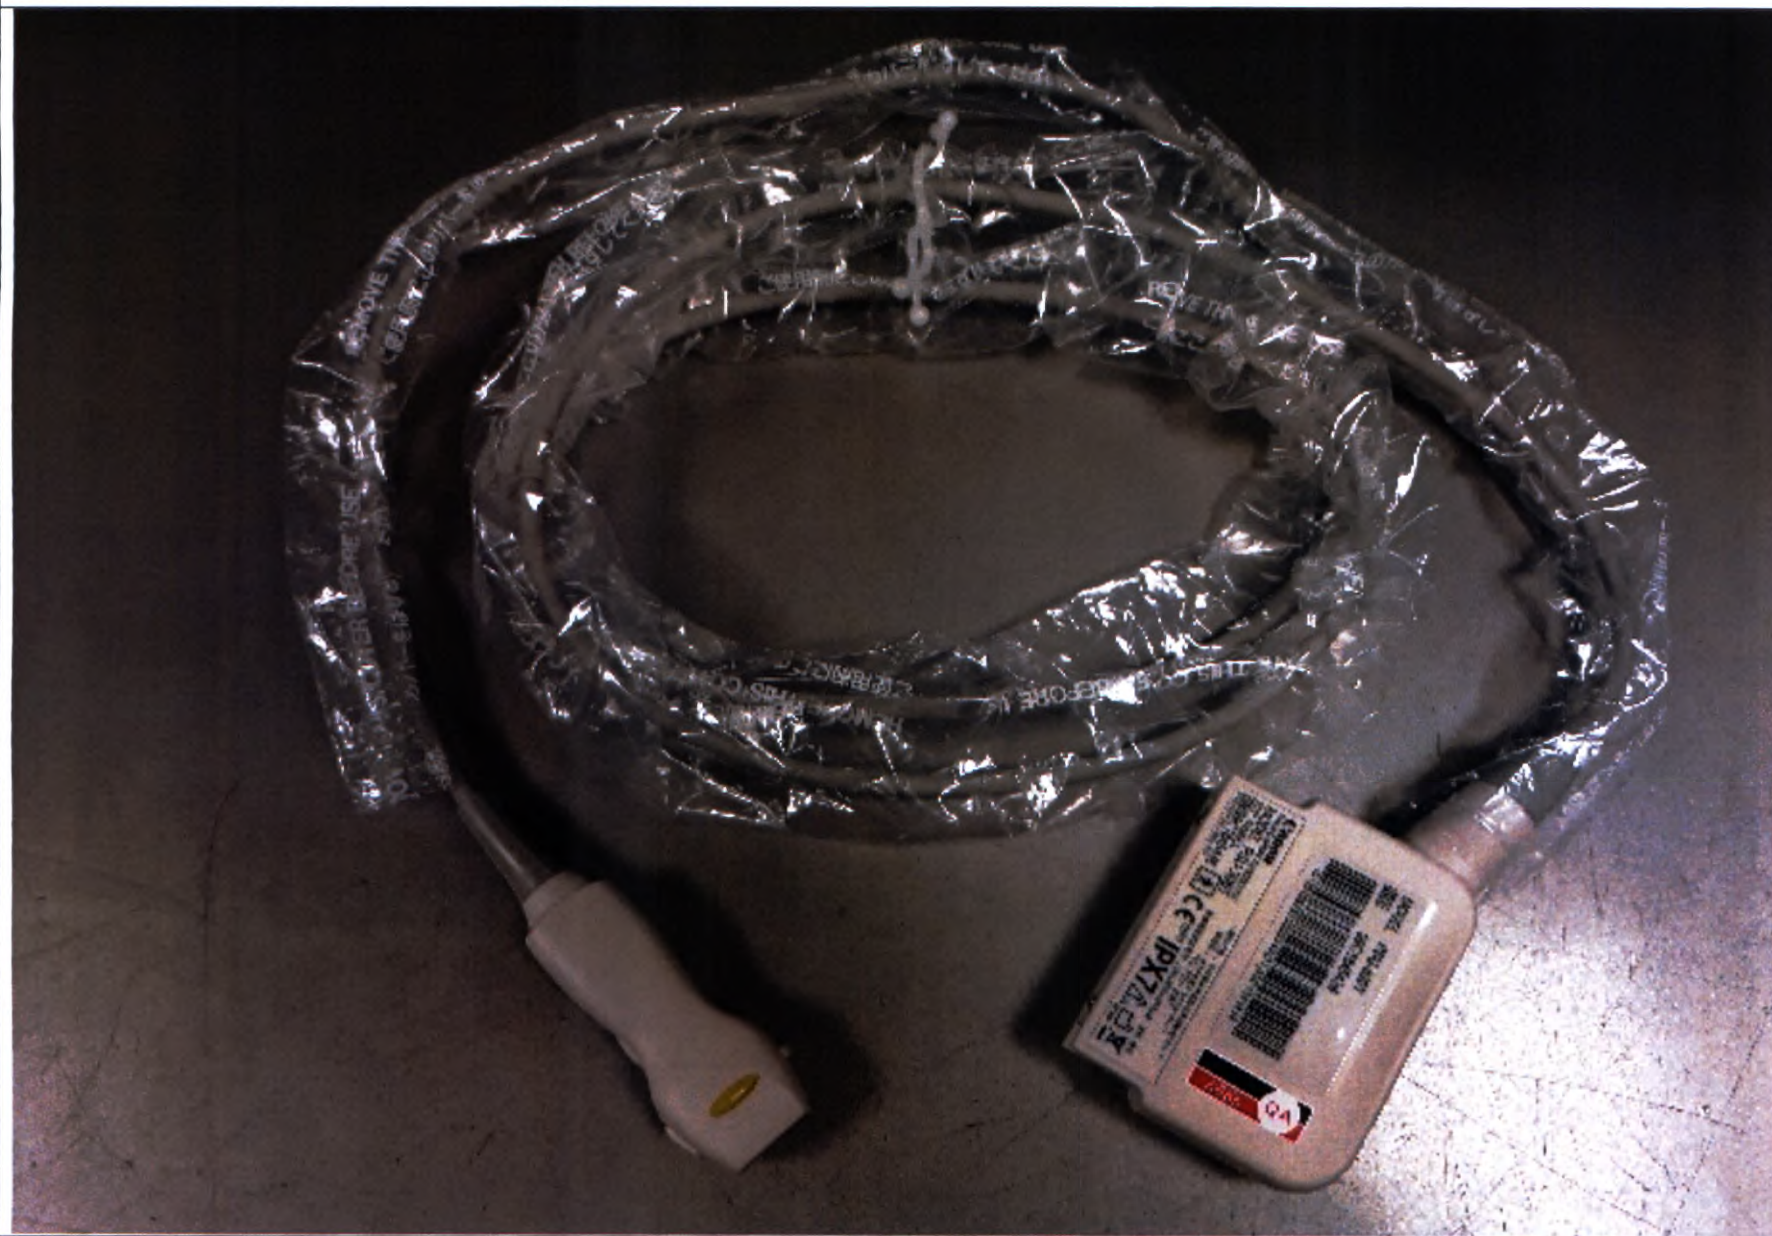

5. Датчик секторный, модель PSU-30BT (при необходимости).

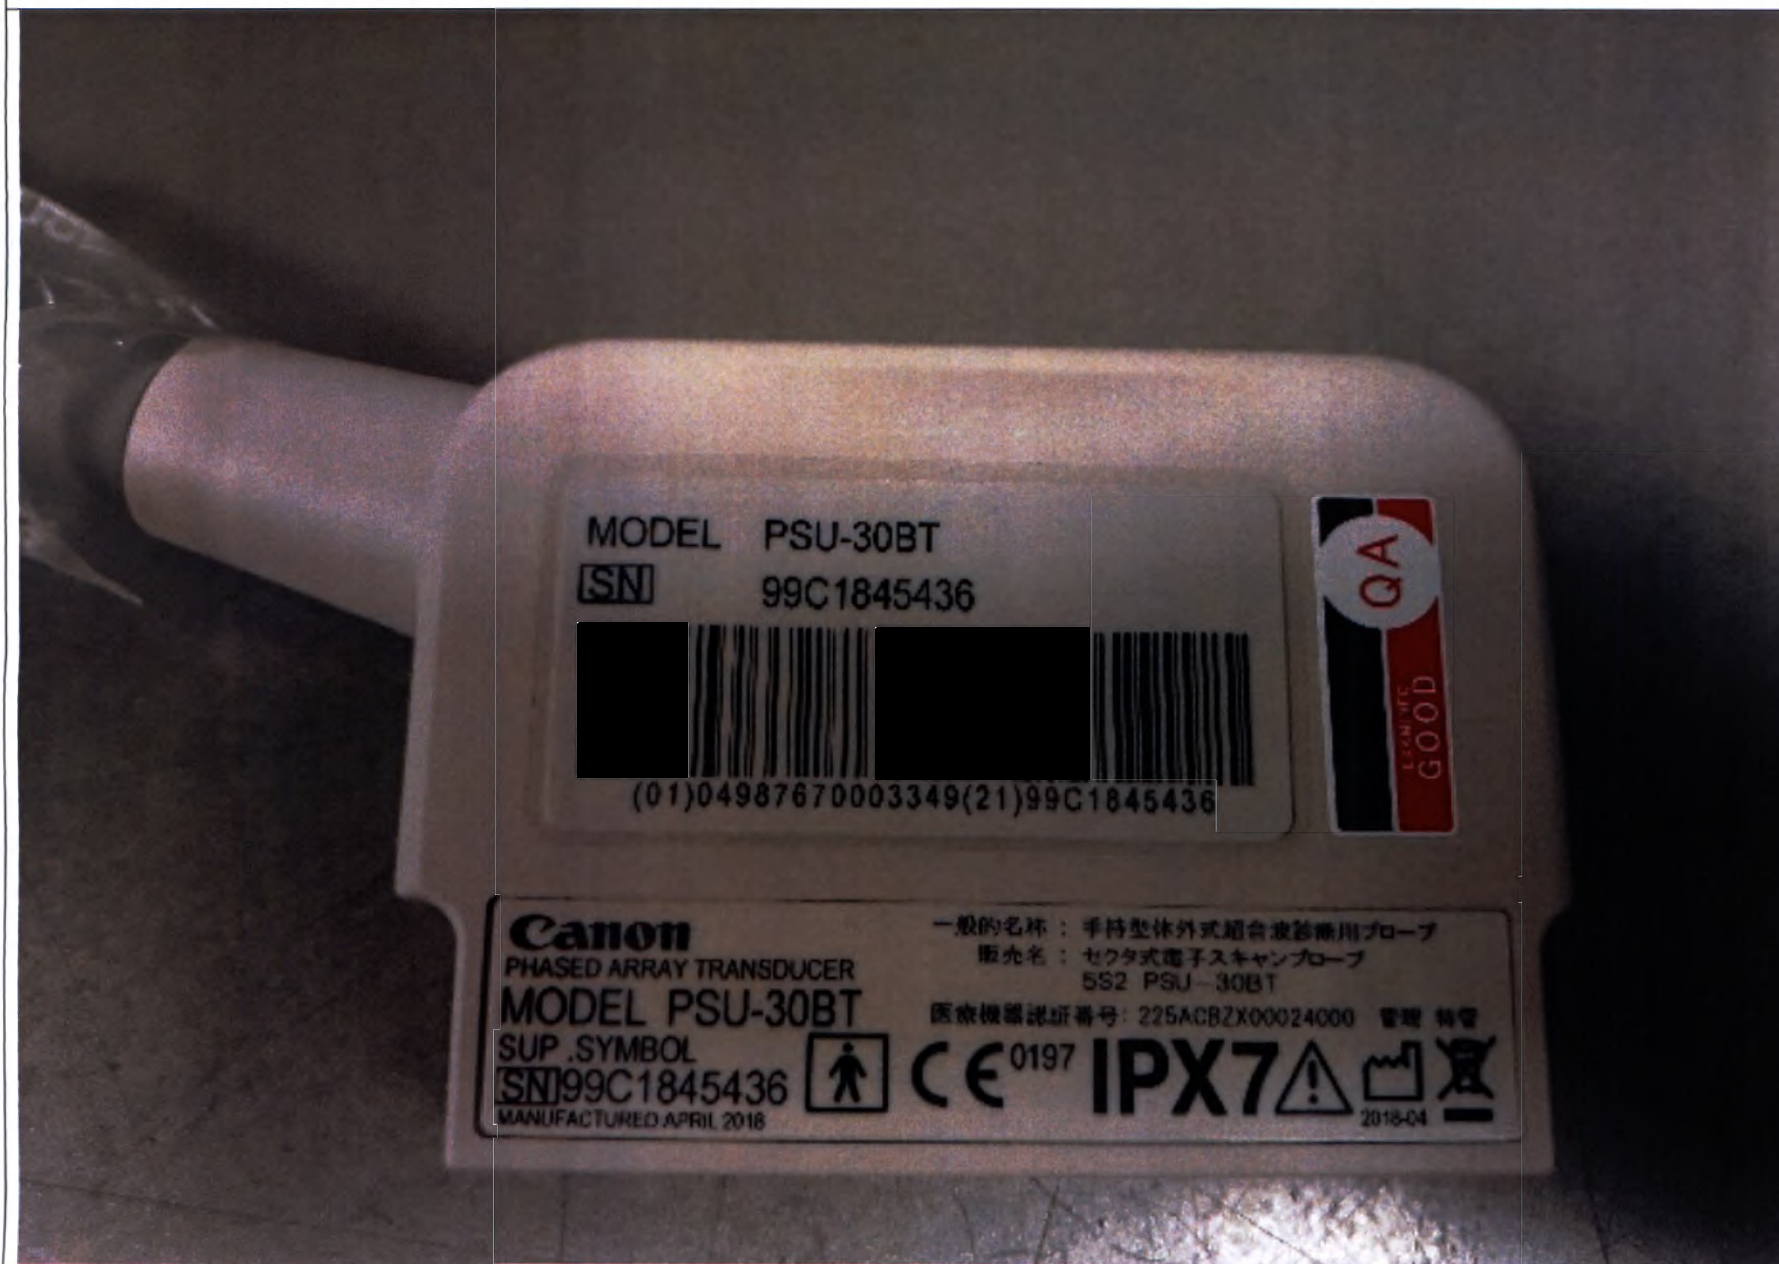


6. Датчик секторный, модель PSU-50BT (при необходимости).

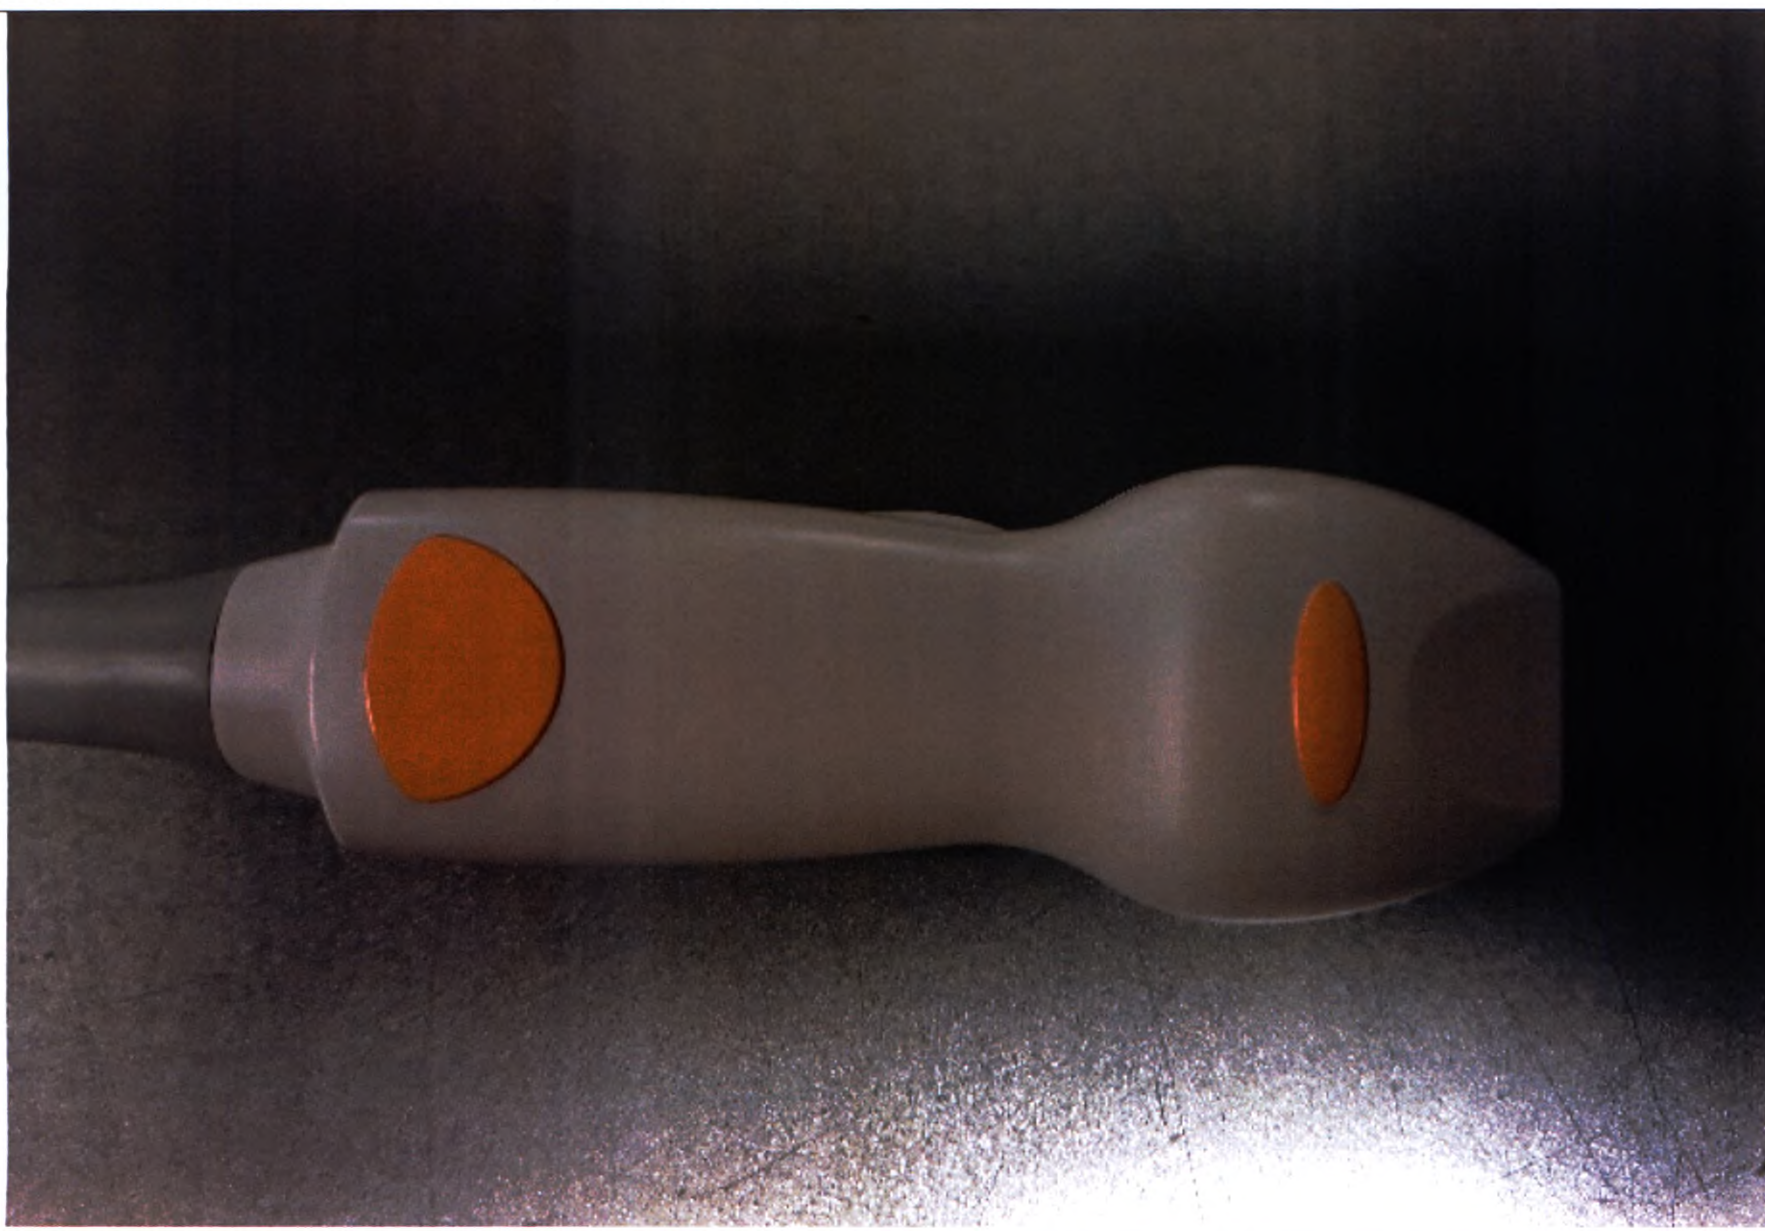


6. Датчик секторный, модель PSU-50BT (при необходимости).



6. Датчик секторный, модель PSU-50BT (при необходимости).

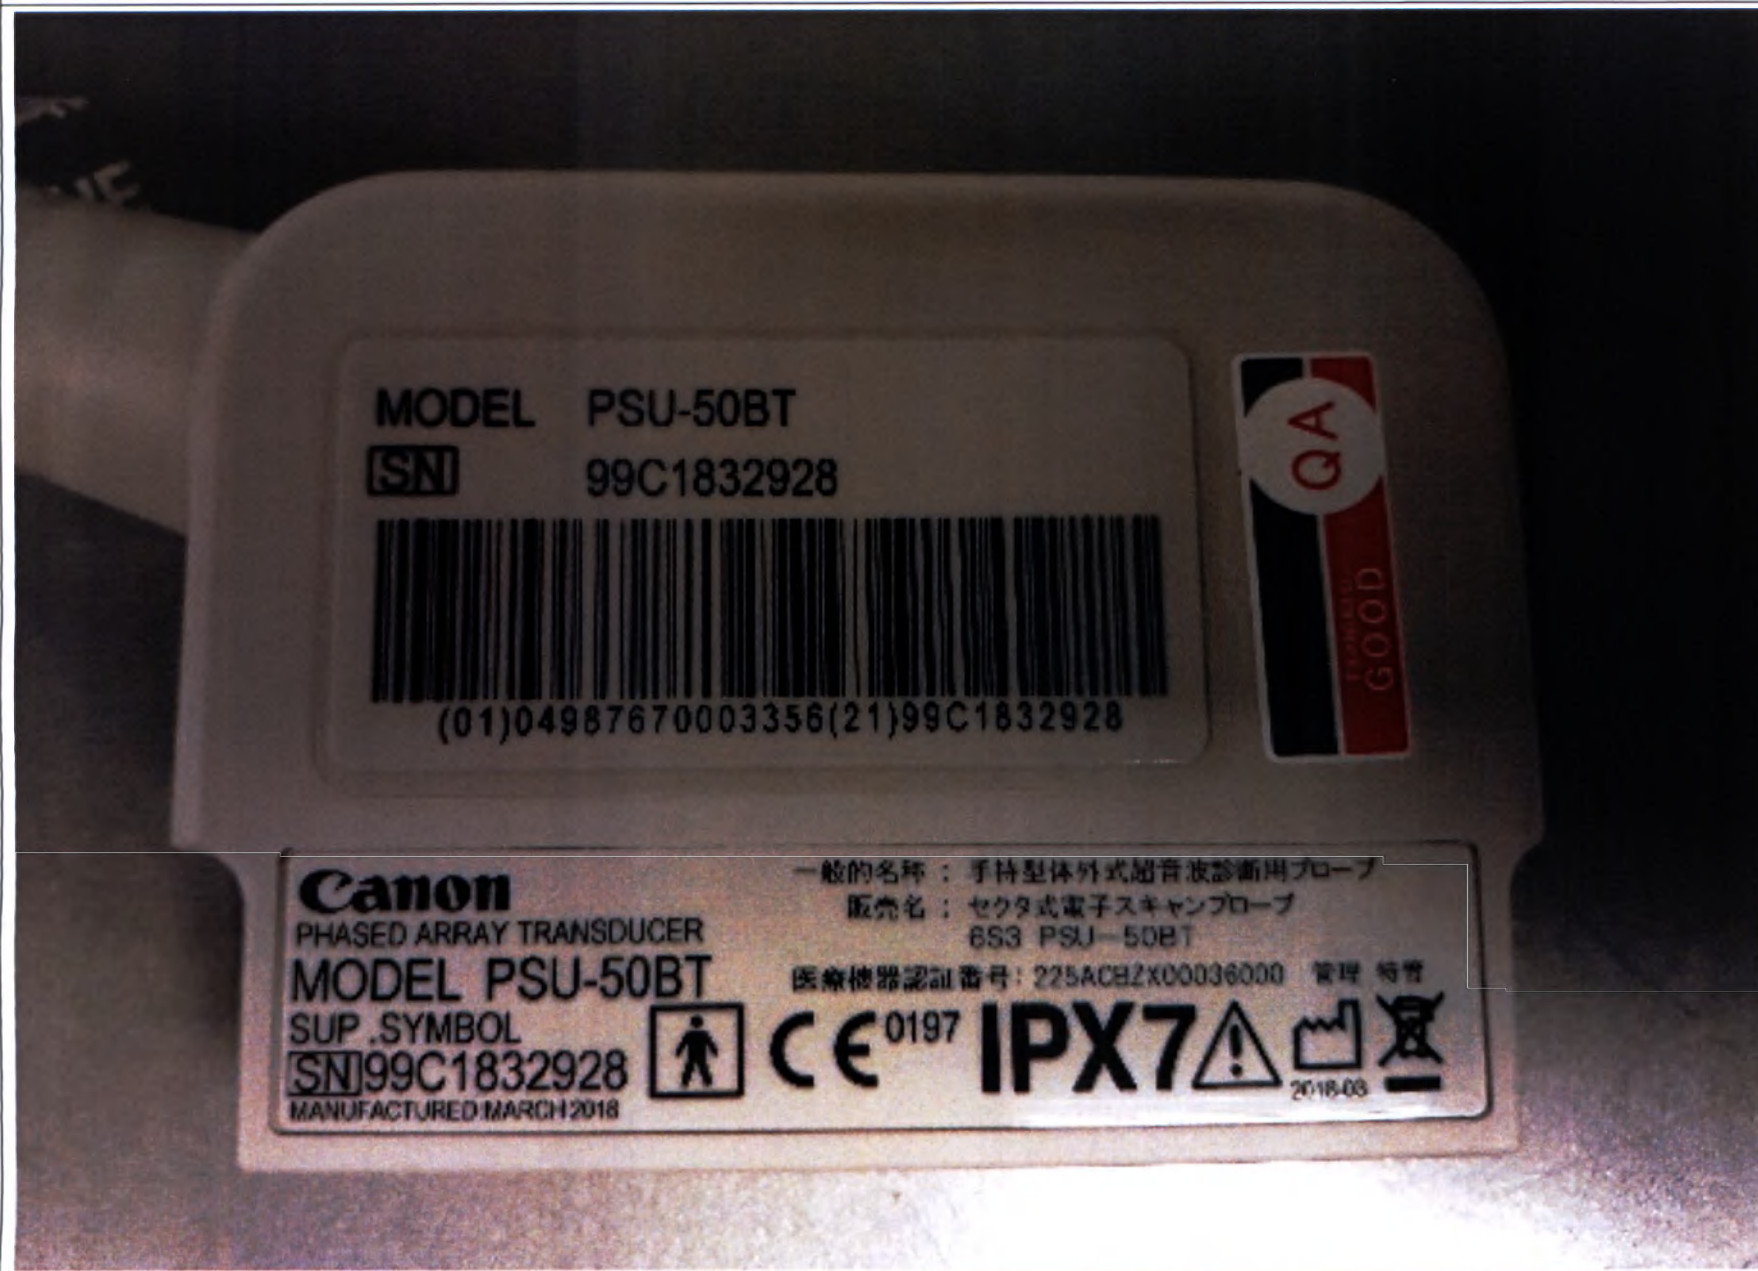

7. Датчик секторный, модель PSU-70BT (при необходимости).

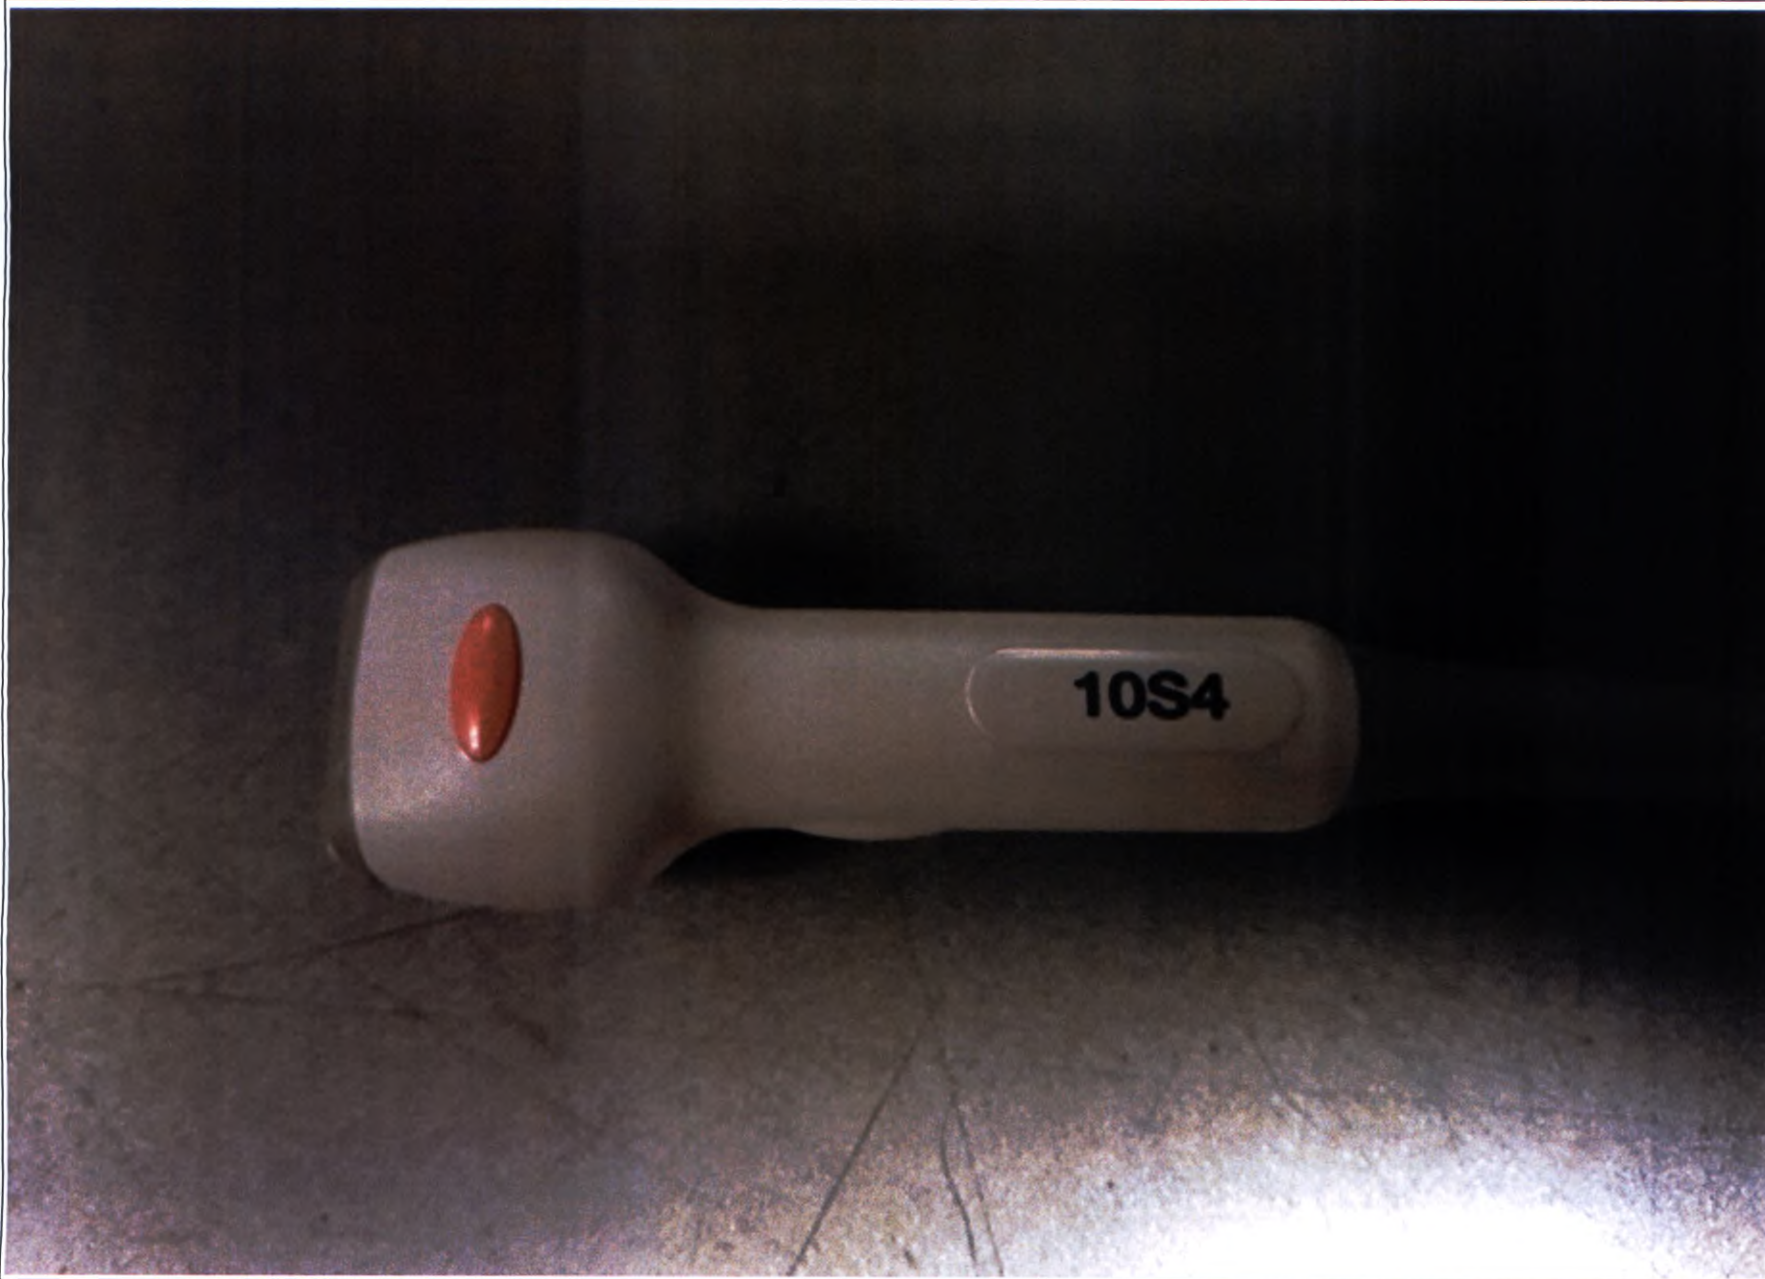


7. Датчик секторный, модель PSU-70BT (при необходимости).




7. Датчик секторный, модель PSU-70BT (при необходимости).




8. Датчик конвексный, модель PVU-375BT (при необходимости).

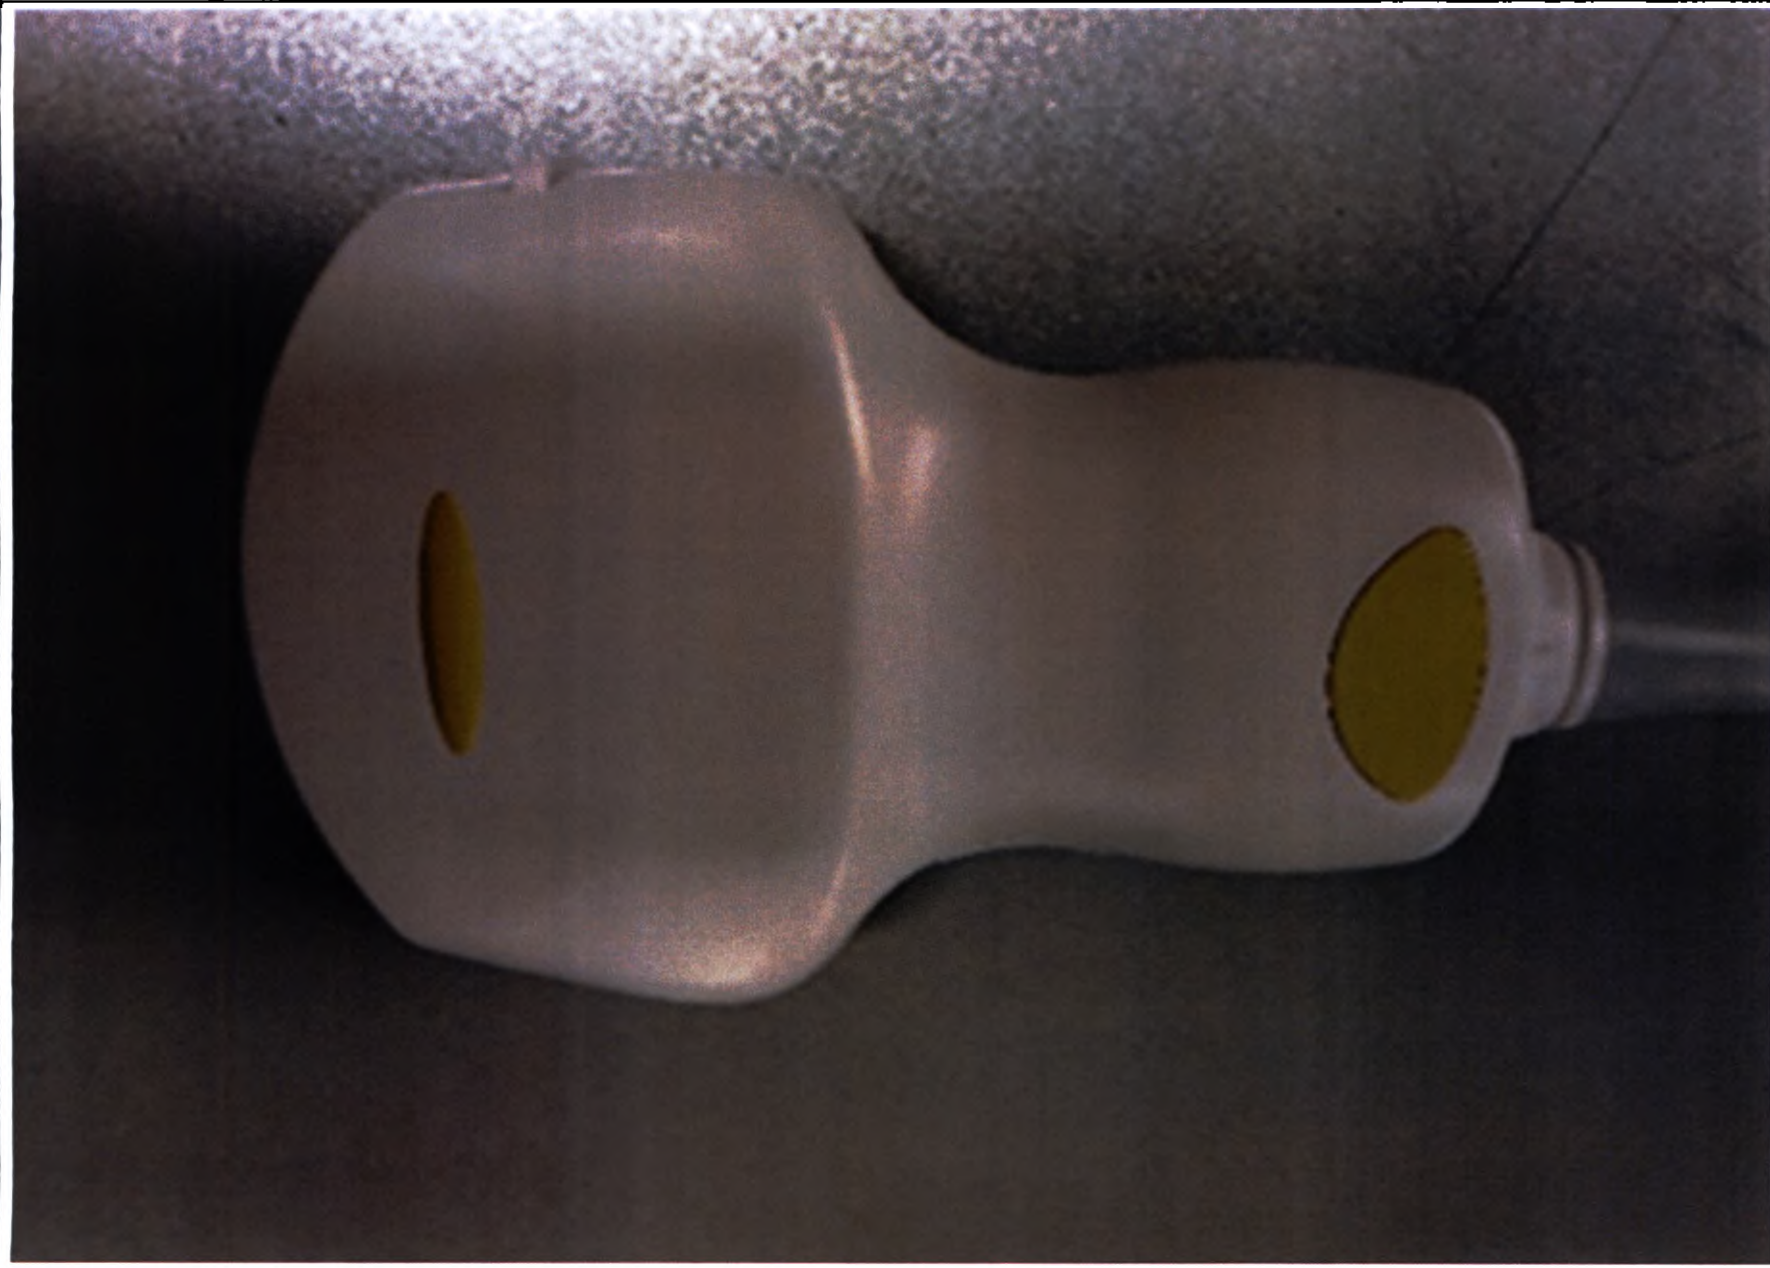


8. Датчик конвексный, модель PVU-375BT (при необходимости).

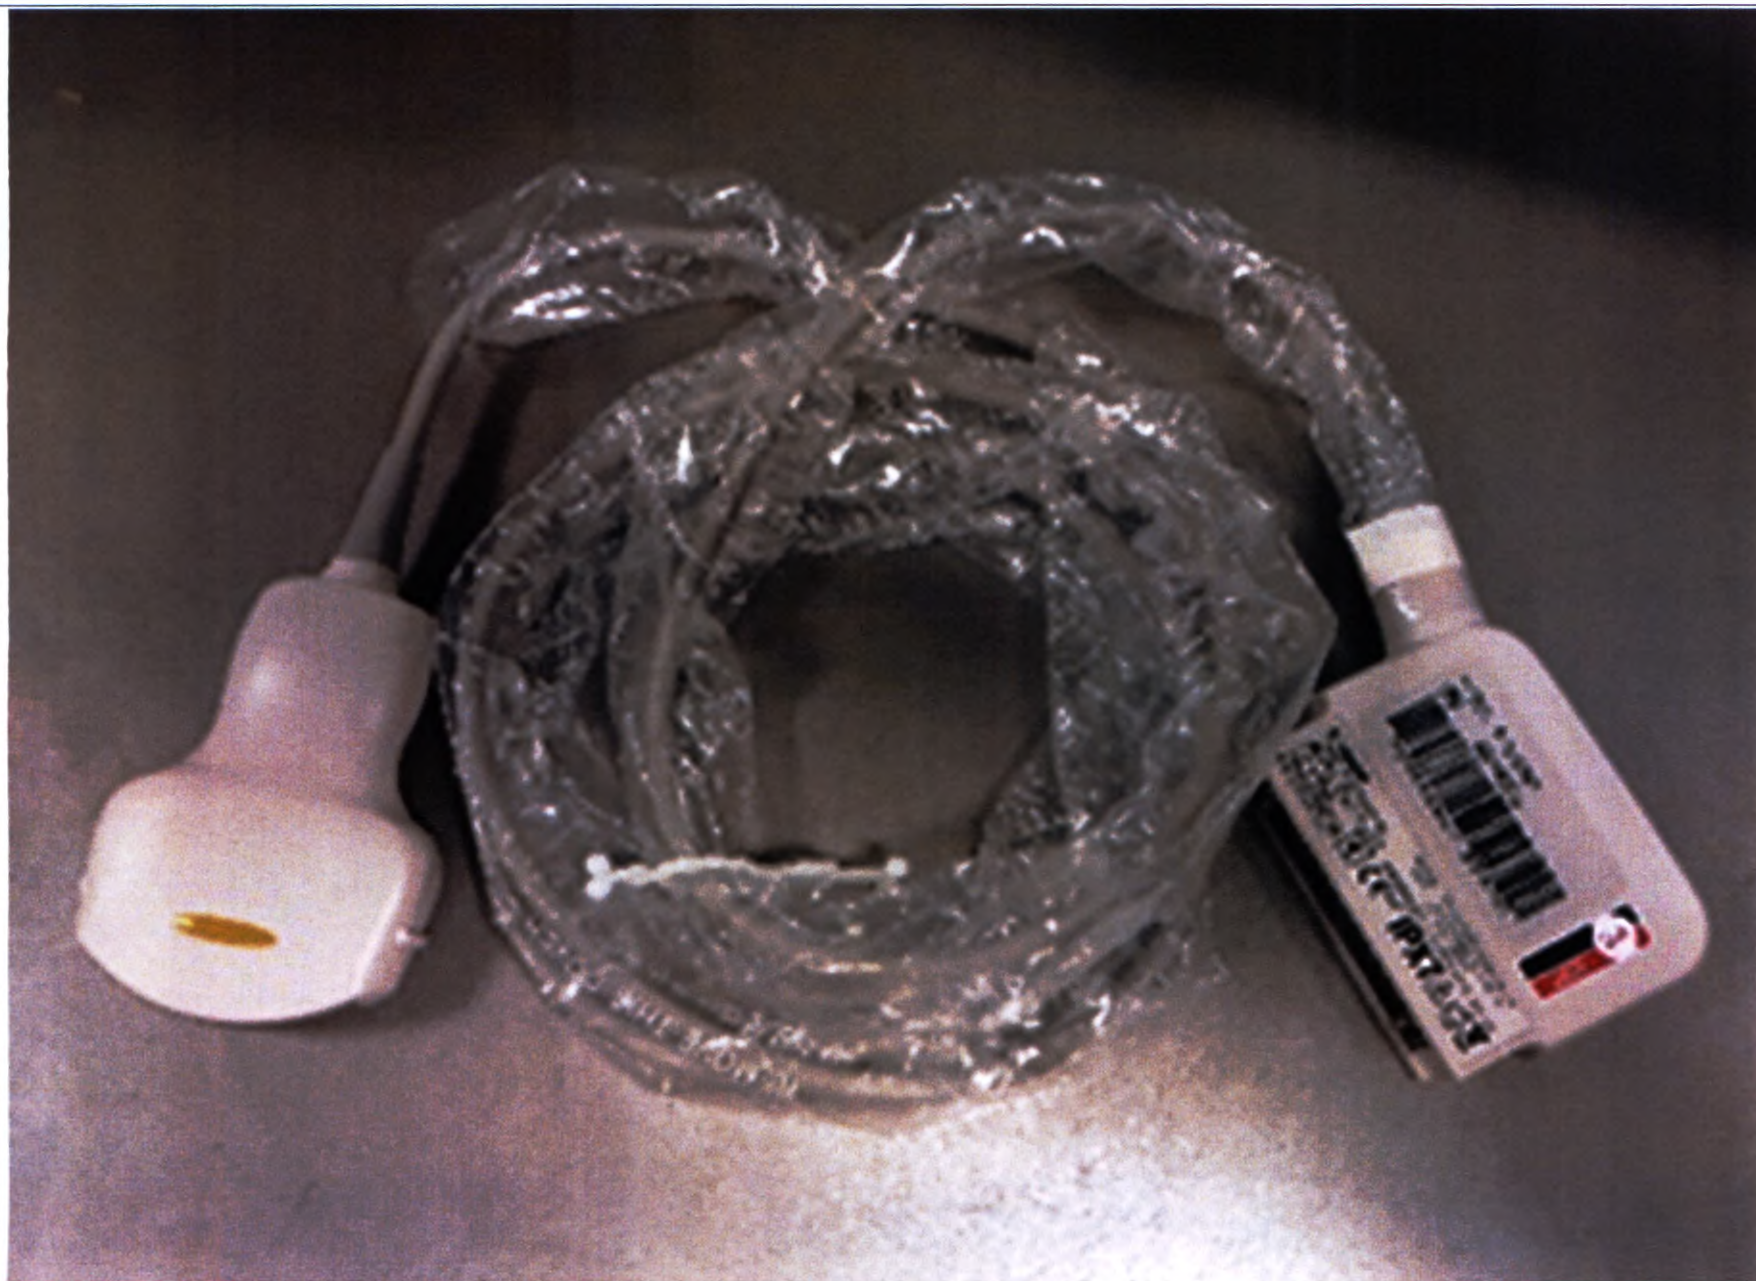

8. Датчик конвексный, модель PVU-375BT (при необходимости).

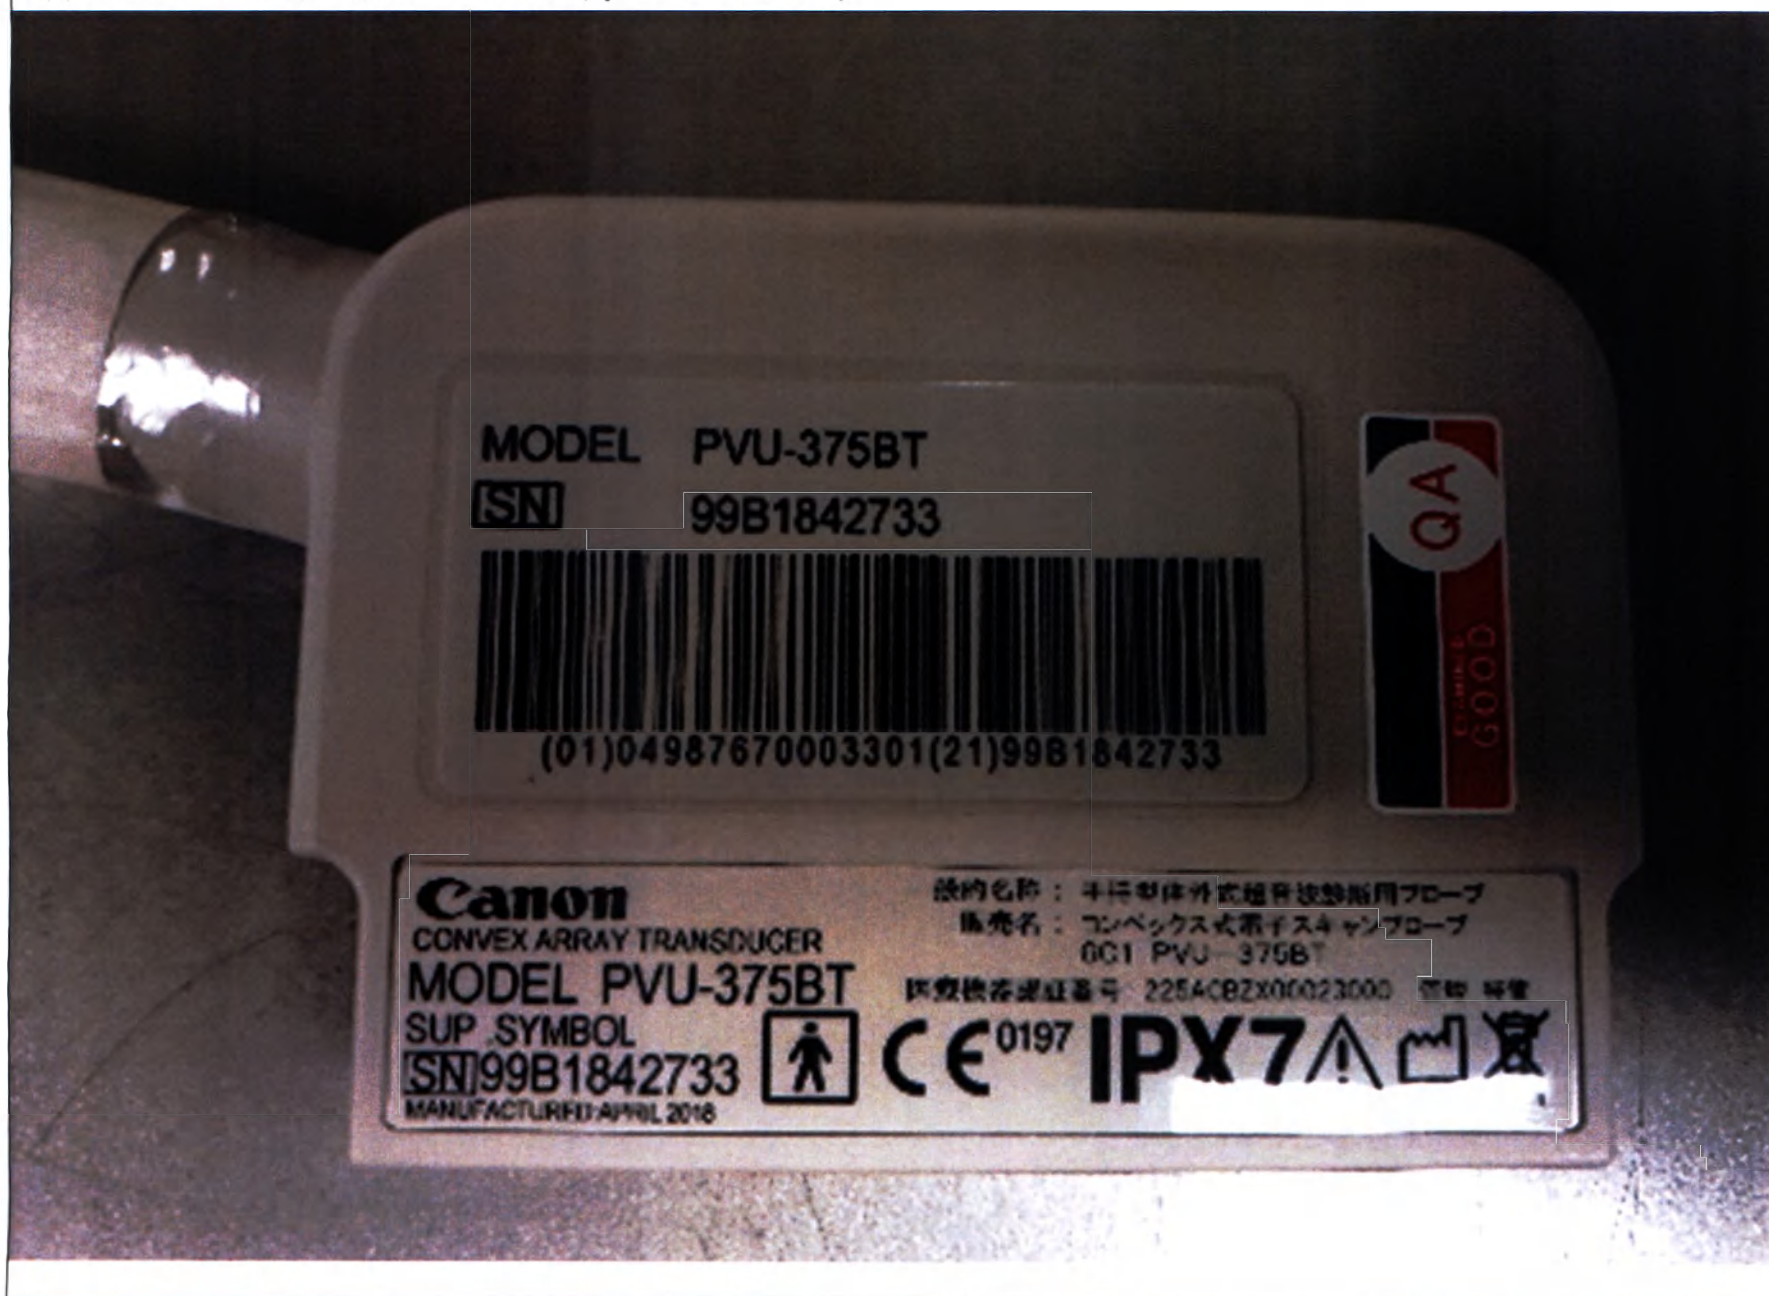


9. Датчик конвексный, модель PVU-382BT (при необходимости).

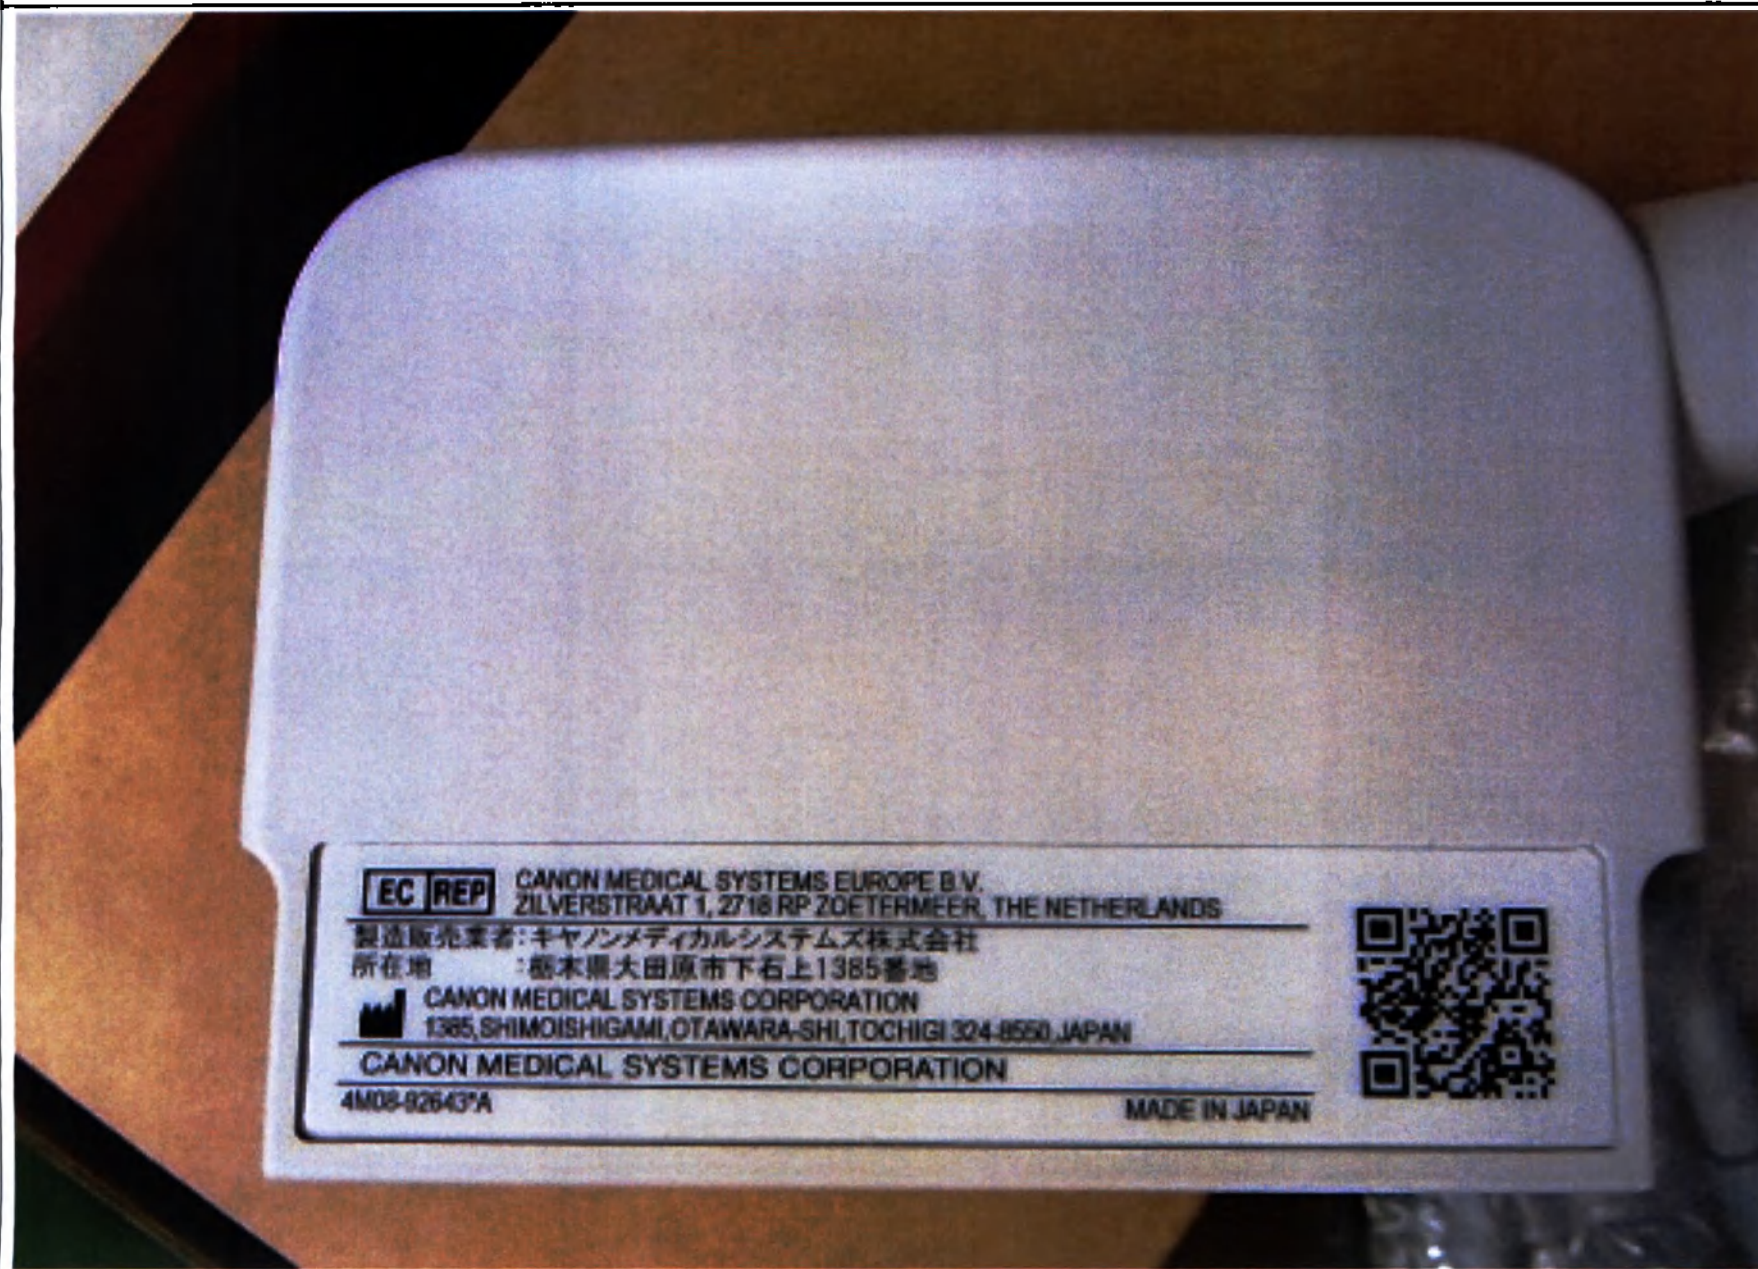

9. Датчик конвексный, модель PVU-382BT (при необходимости).



9. Датчик конвексный, модель PVU-382BT (при необходимости).

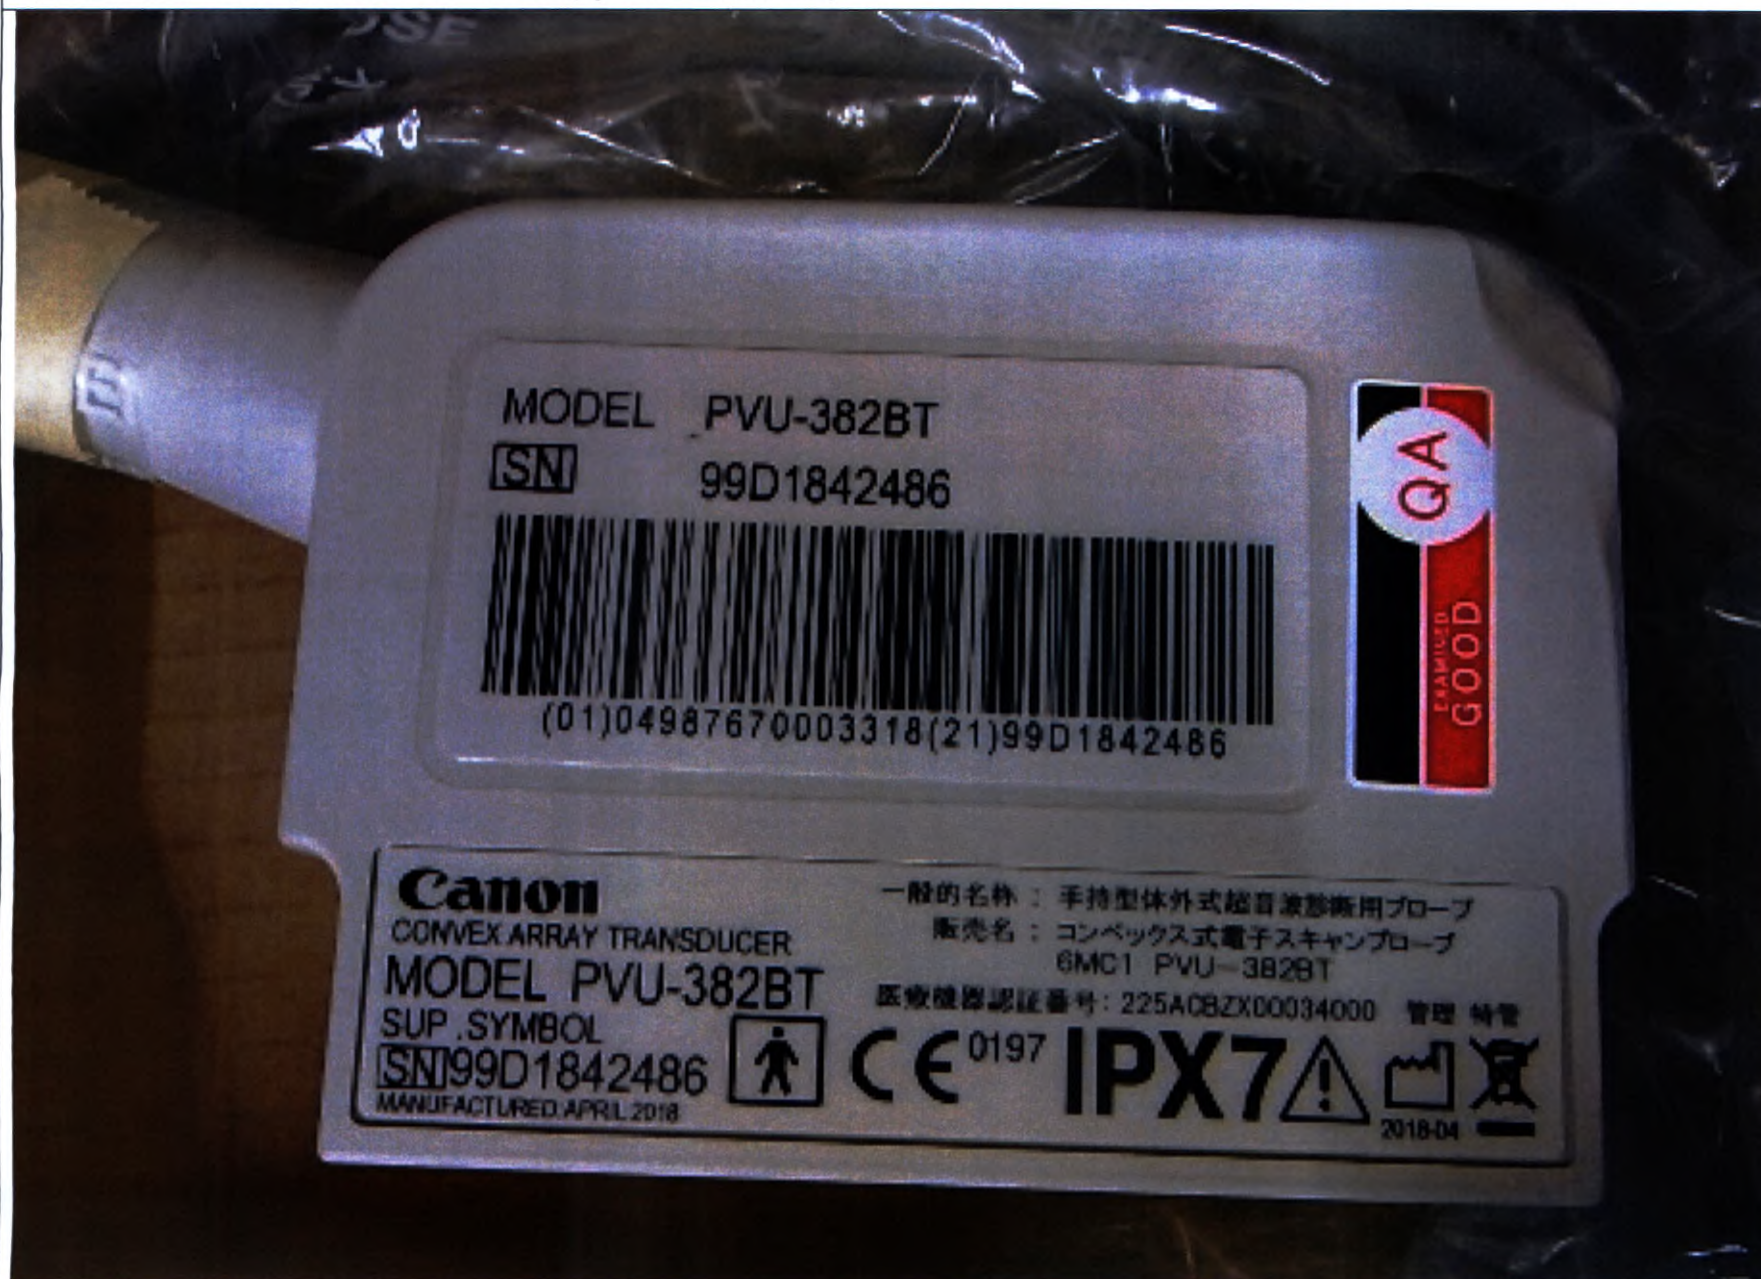

10. Датчик конвексный, модель PVU-674BT (при необходимости).




10. Датчик конвексный, модель PVU-674BT (при необходимости).



10. Датчик конвексный, модель PVU-674BT (при необходимости).




11. Датчик конвексный, модель PVU-674MV (при необходимости).

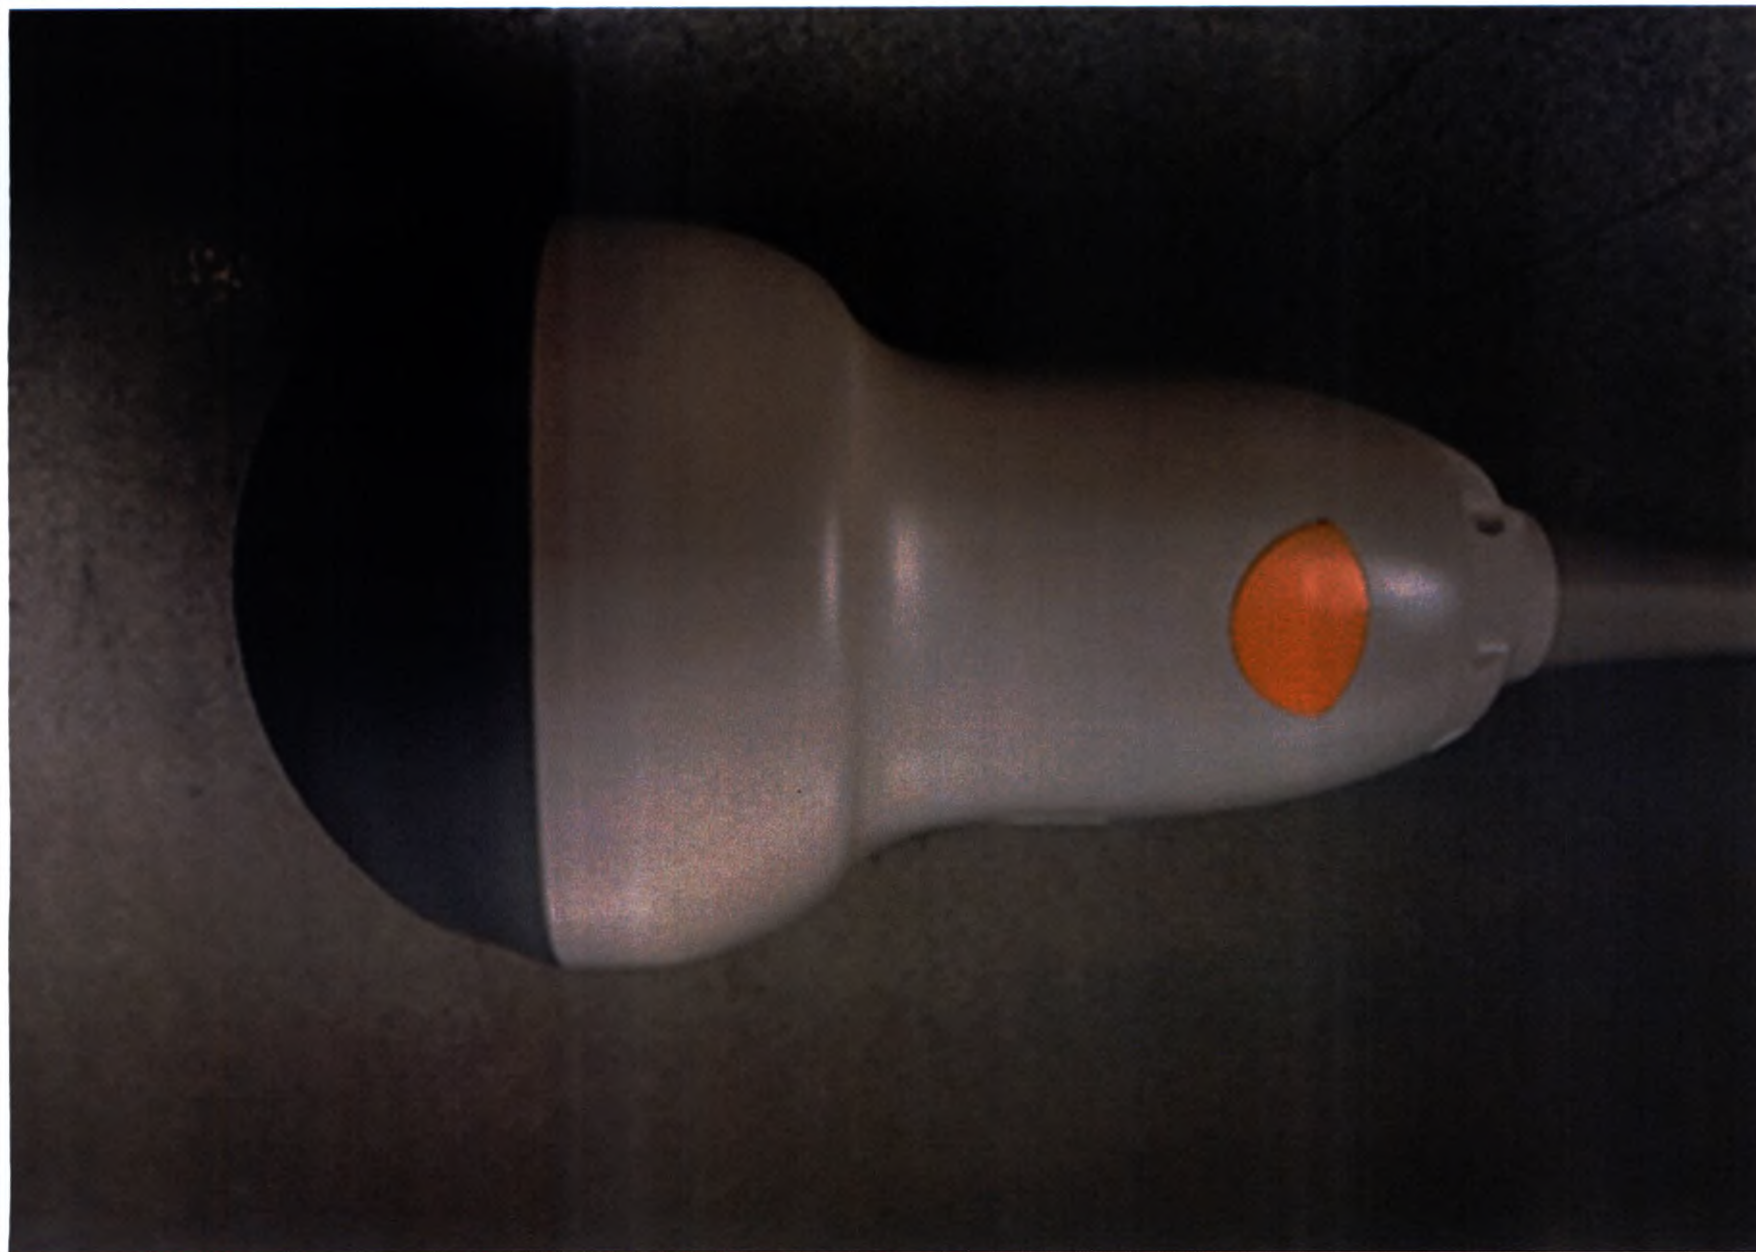


11. Датчик конвексный, модель PVU-674MV (при необходимости).




11. Датчик конвексный, модель PVU-674MV (при необходимости).

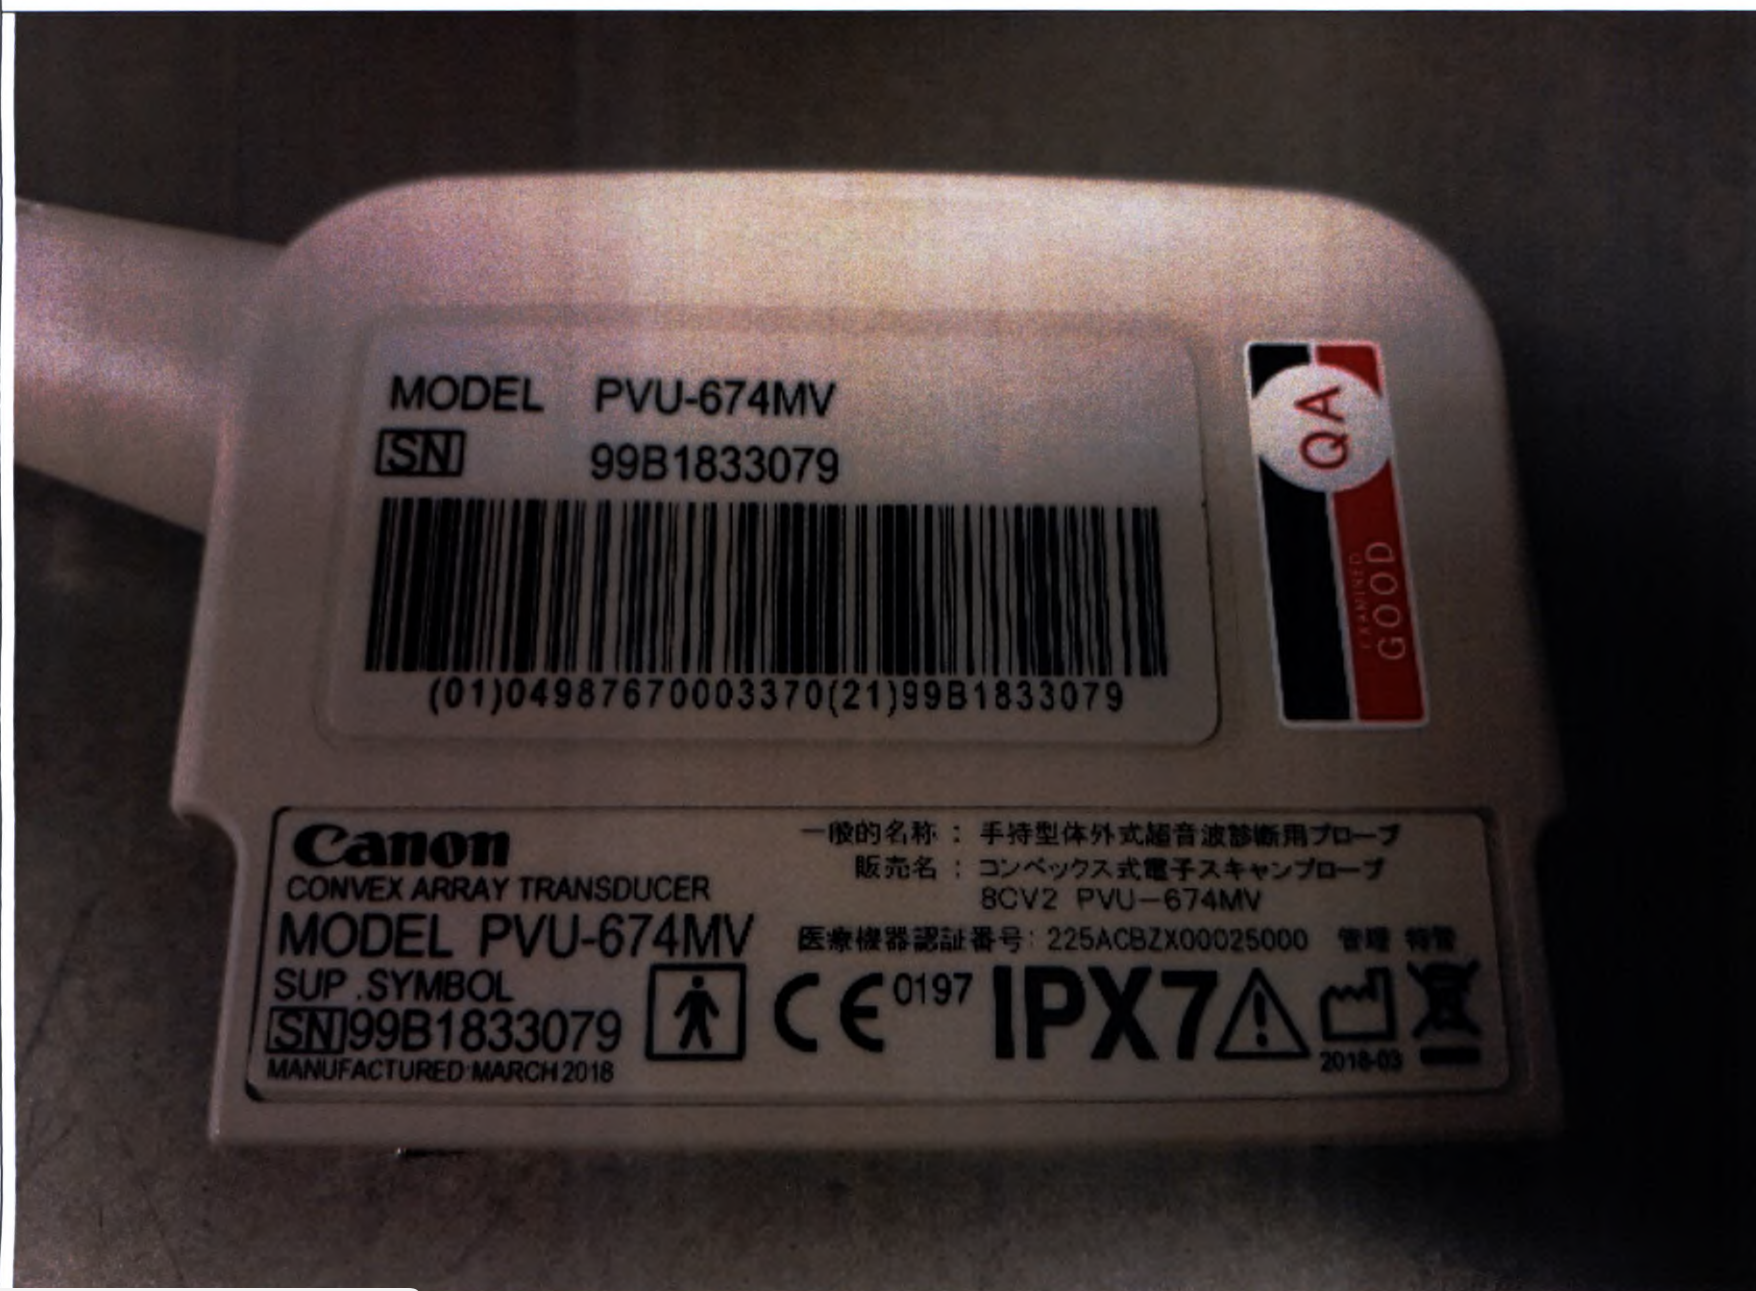

12. Датчик внутривидеолостной, модель PVU-681MVL (при необходимости).

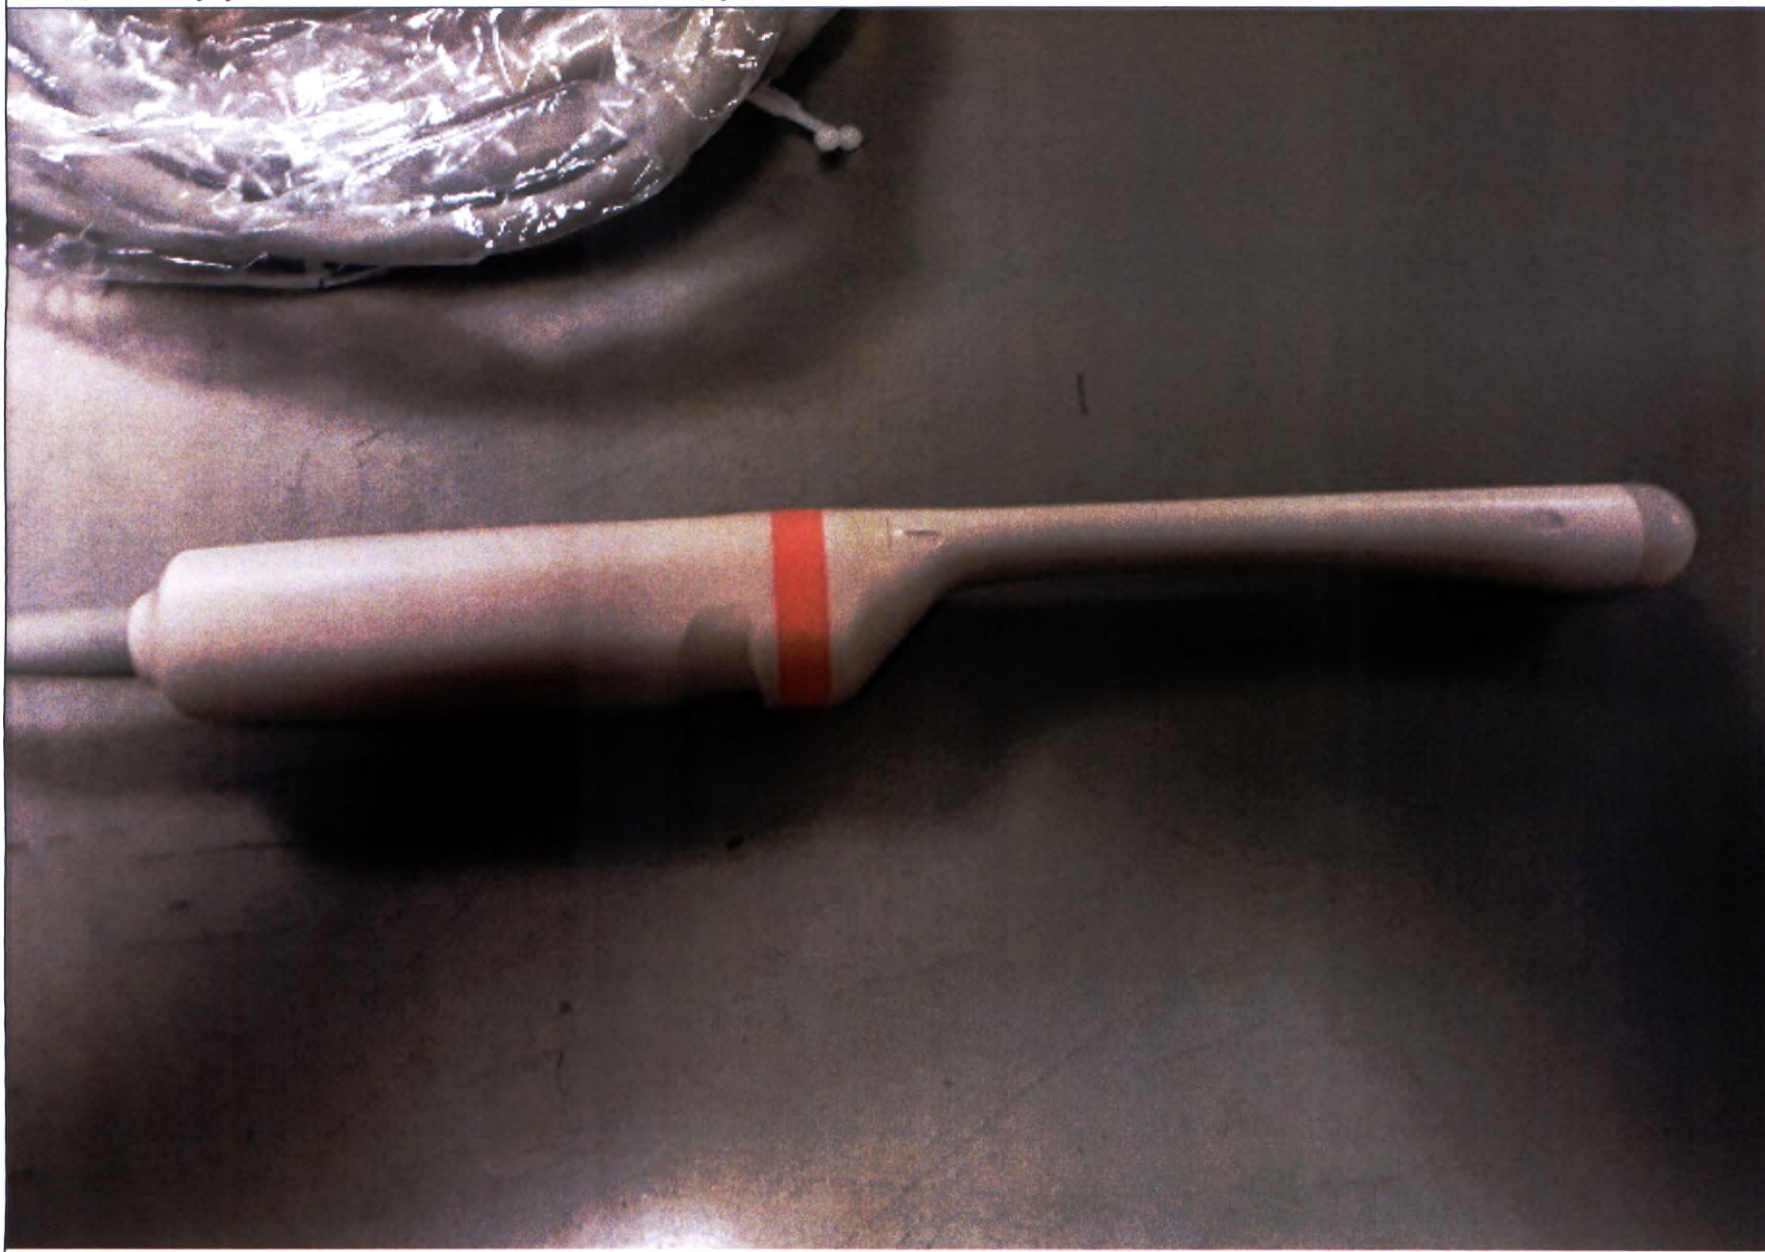


12. Датчик внутрисполостной, модель PVU-681MVL (при необходимости).

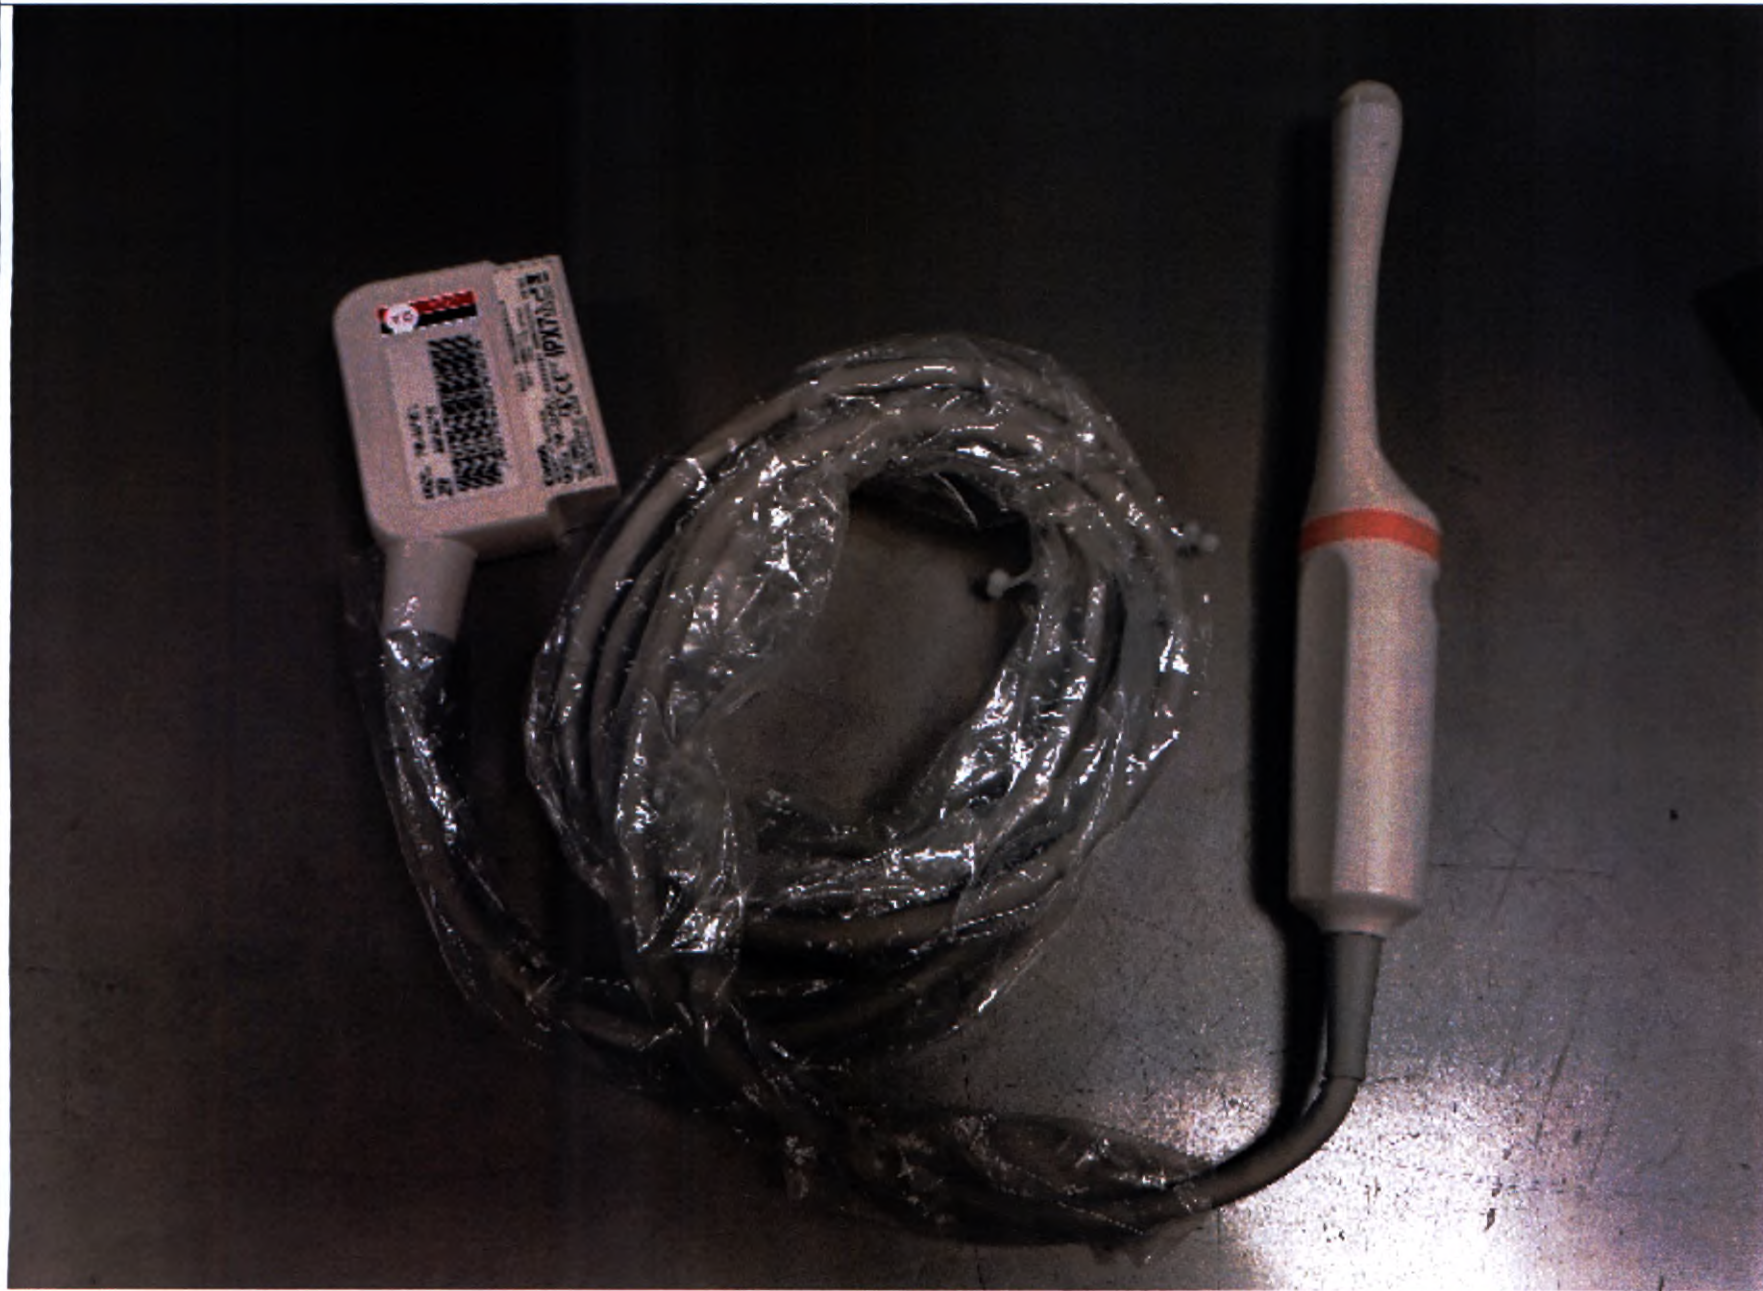

12. Датчик внутриполостной, модель PVU-681MVL (при необходимости).



13. Датчик конвексный, модель PVU-712BT (при необходимости).

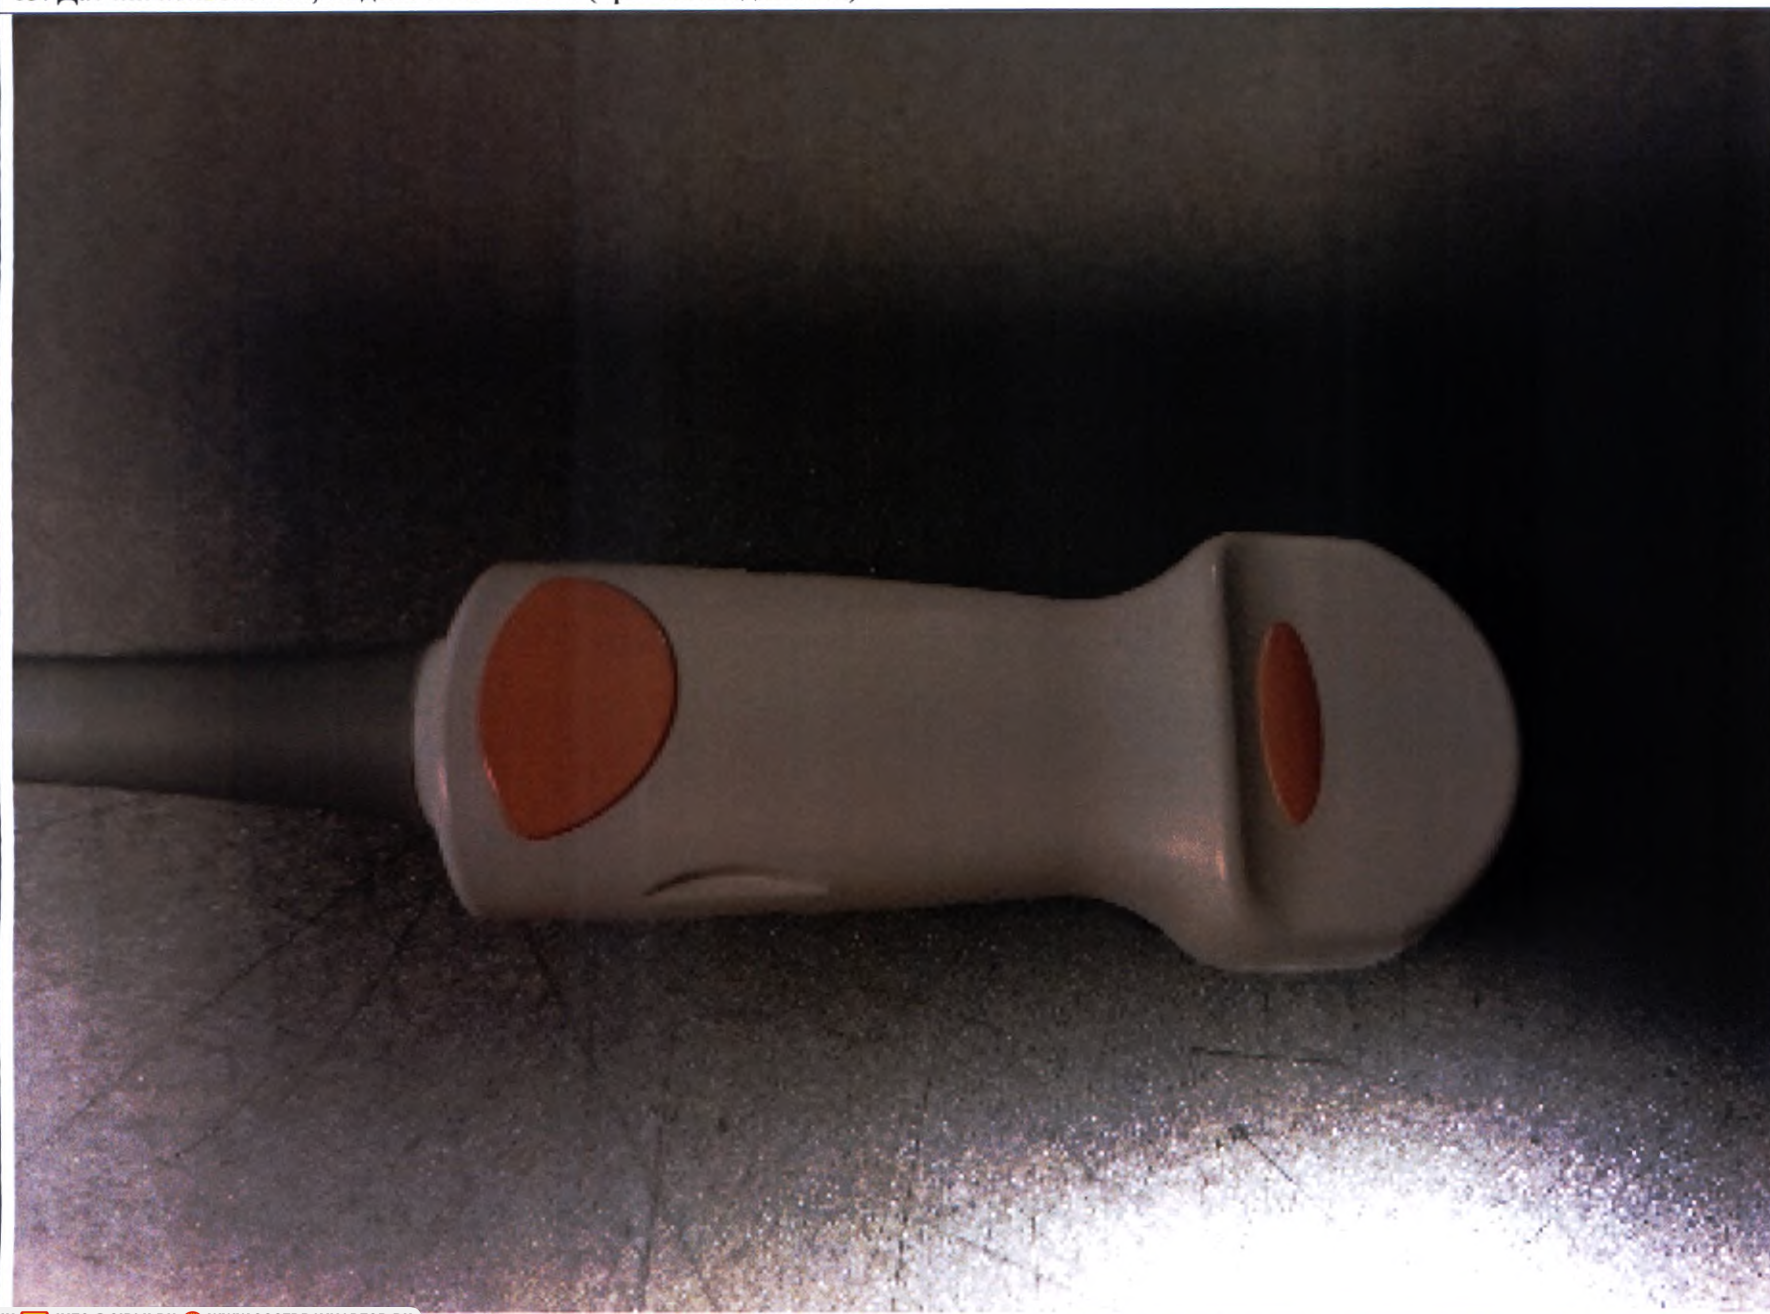

13. Датчик конвексный, модель PVU-712BT (при необходимости).



13. Датчик конвексный, модель PVU-712BT (при необходимости).



14. Датчик конвексный, модель PVU-745BTH (при необходимости).



14. Датчик конвексный, модель PVU-745BTH (при необходимости).



14. Датчик конвексный, модель PVU-745BTH (при необходимости).

MODEL PVU-745BTH

[SN]

99B1842125



(01)04987670004230(21)99B1842125



Canon

CONVEX ARRAY TRANSDUCER

MODEL PVU-745BTH

SUP. SYMBOL

[SN] 99B1842125

MANUFACTURED APRIL 2018

一般の名称：非血管系手術向け超音波診断用プローブ

販売名：コンベックス式電子スキャンプローブ

11CM PVU-745BTH

医療機器認証番号：226ADBZX00180000 管理 特管




CE 0197

IPX7



2018-04


15. Датчик конвексный, модель PVU-745BTF (при необходимости).

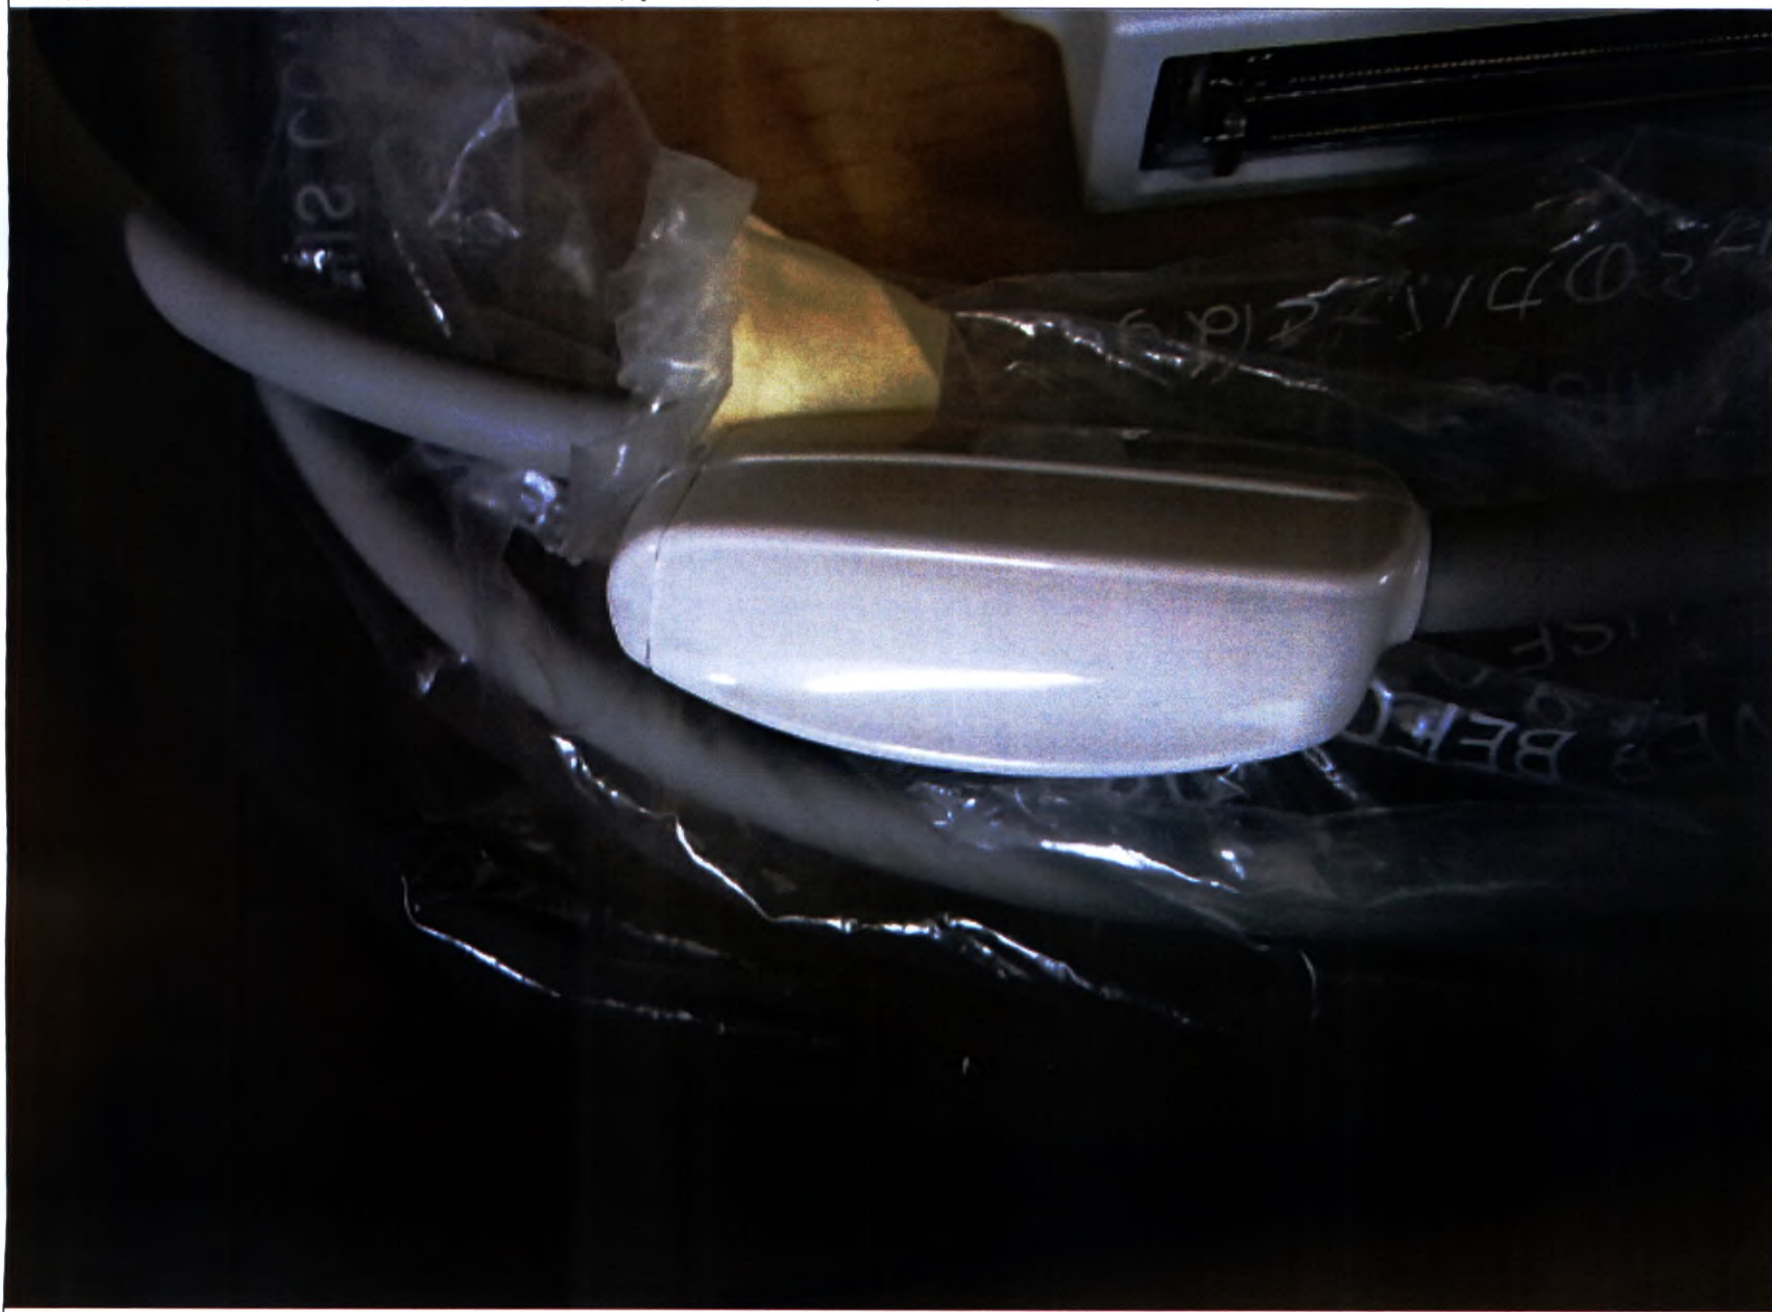


15. Датчик конвексный, модель PVU-745BTF (при необходимости).




15. Датчик конвексный, модель PVU-745BTF (при необходимости).

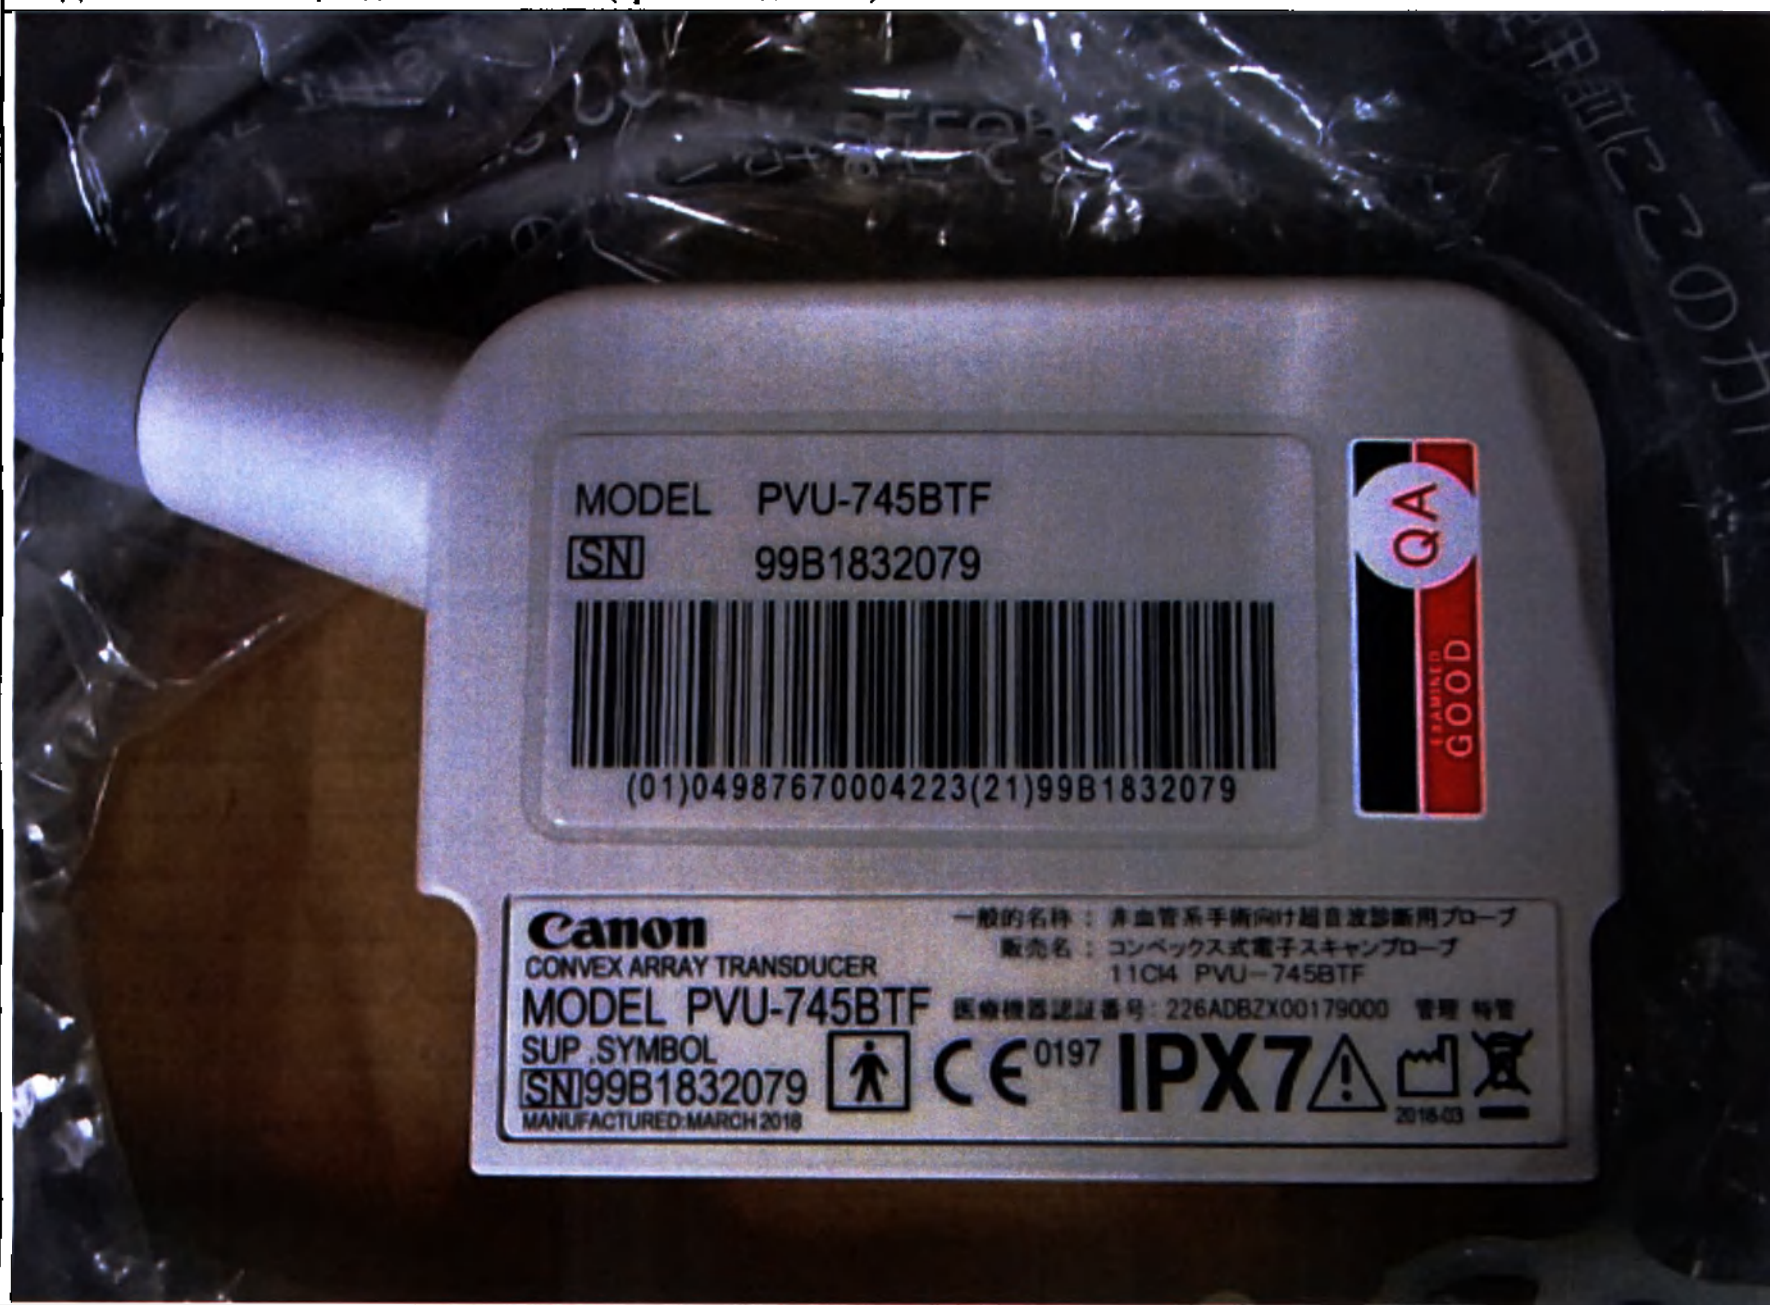

16. Датчик внутривидеолостной, модель PVU-770ST (при необходимости).

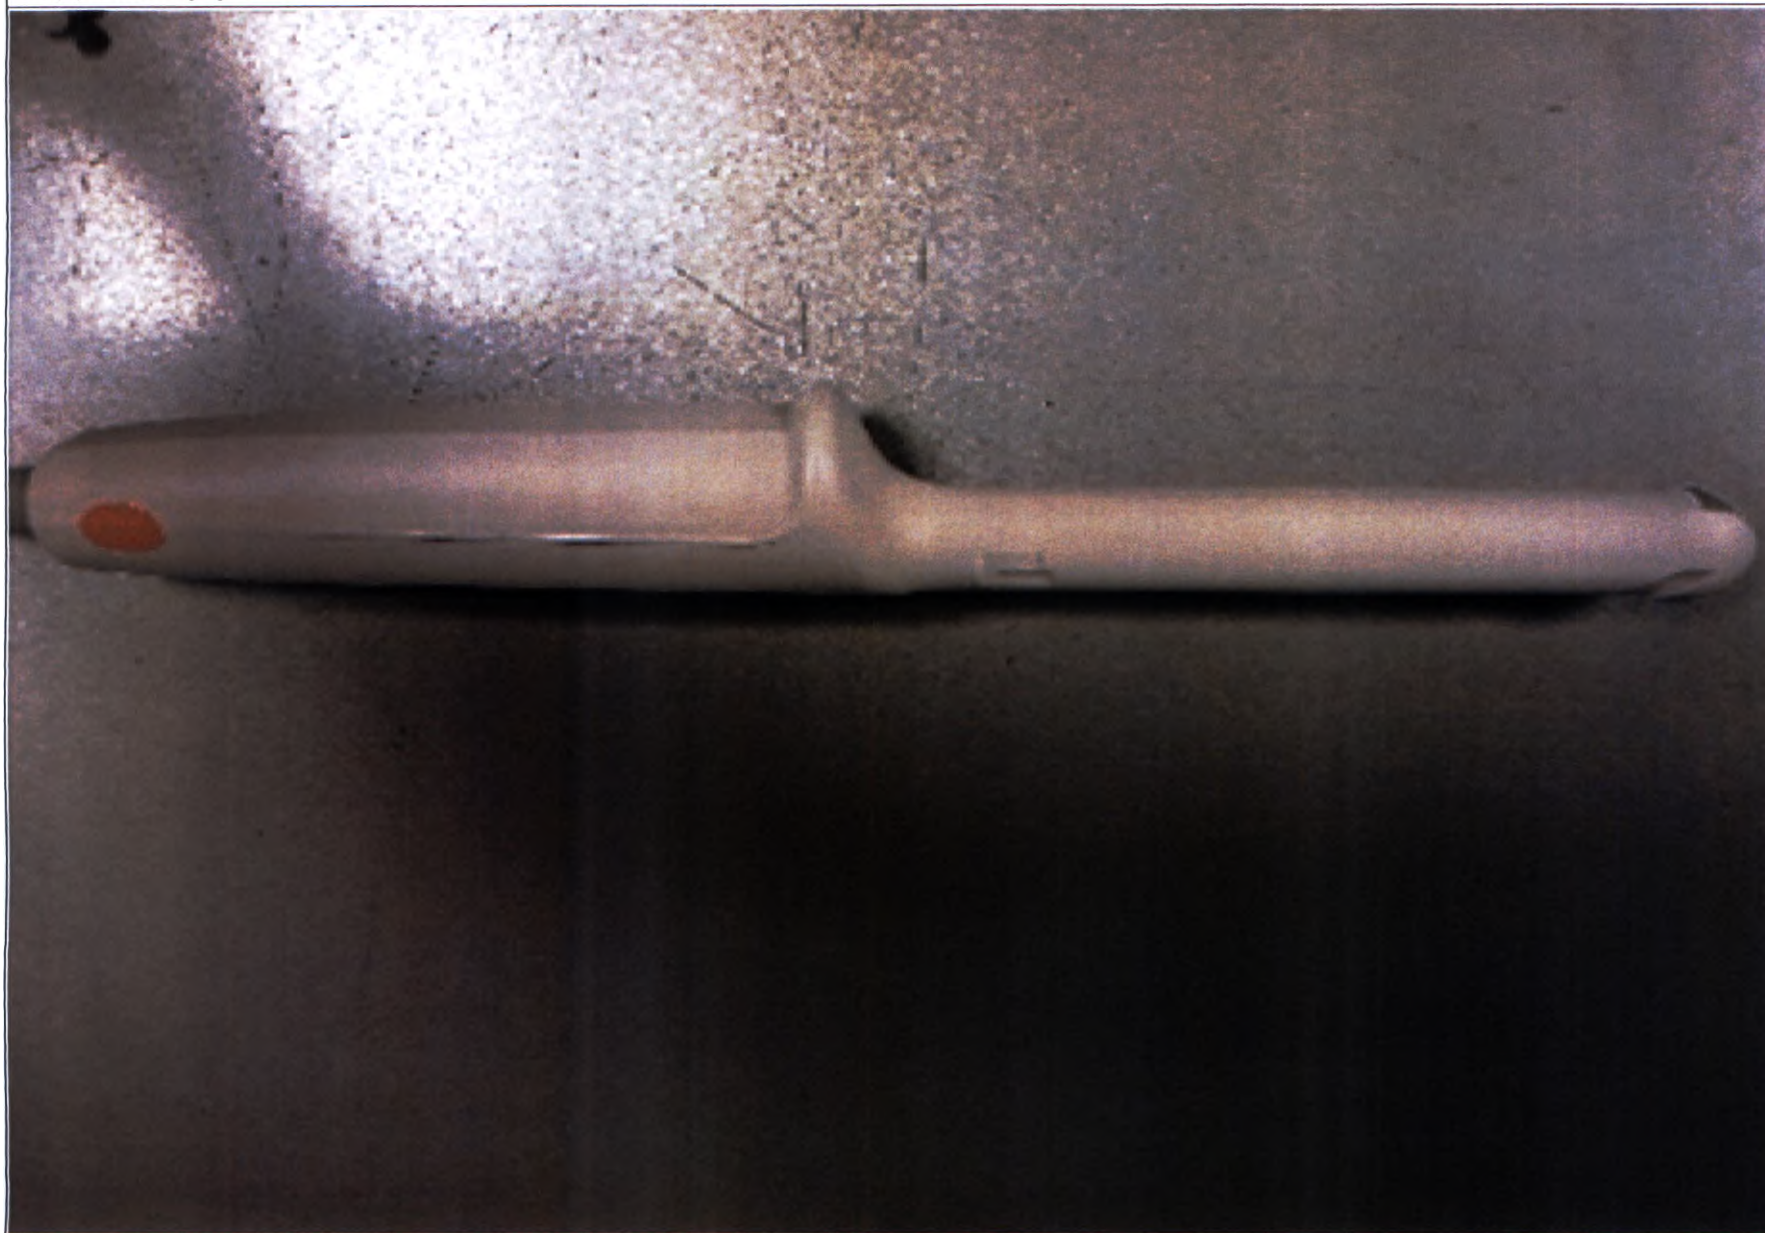

16. Датчик внутрисполостной, модель PVU-770ST (при необходимости).

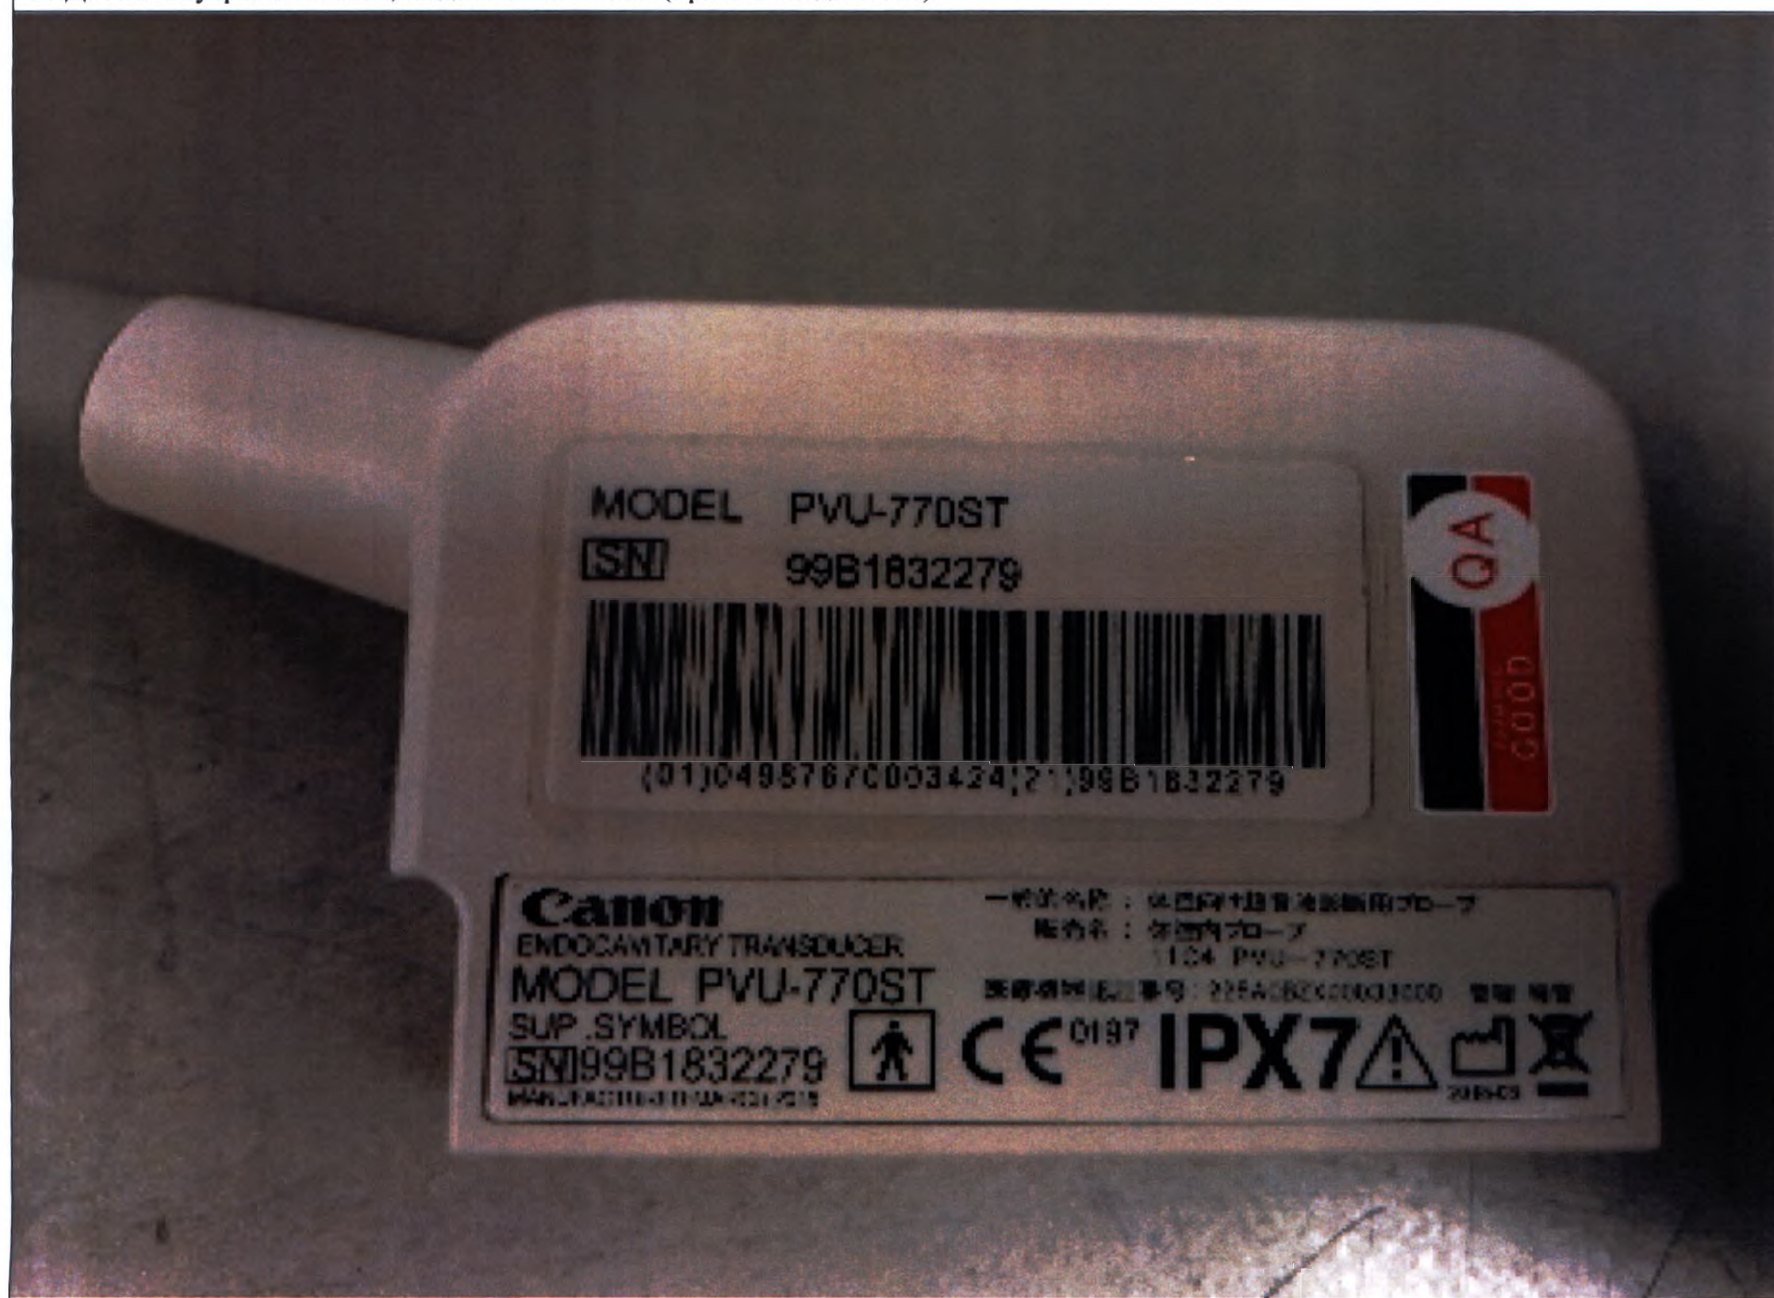

17. Датчик внутриматочный, модель PVU-781VT (при необходимости).



17. Датчик внутрисполостной, модель PVU-781VT (при необходимости).




17. Датчик внутрисполостной, модель PVU-781VT (при необходимости).



18. Датчик внутривидеоскопический, модель PVU-781VTE (при необходимости).




18. Датчик внутриполостной, модель PVU-781VTE (при необходимости).

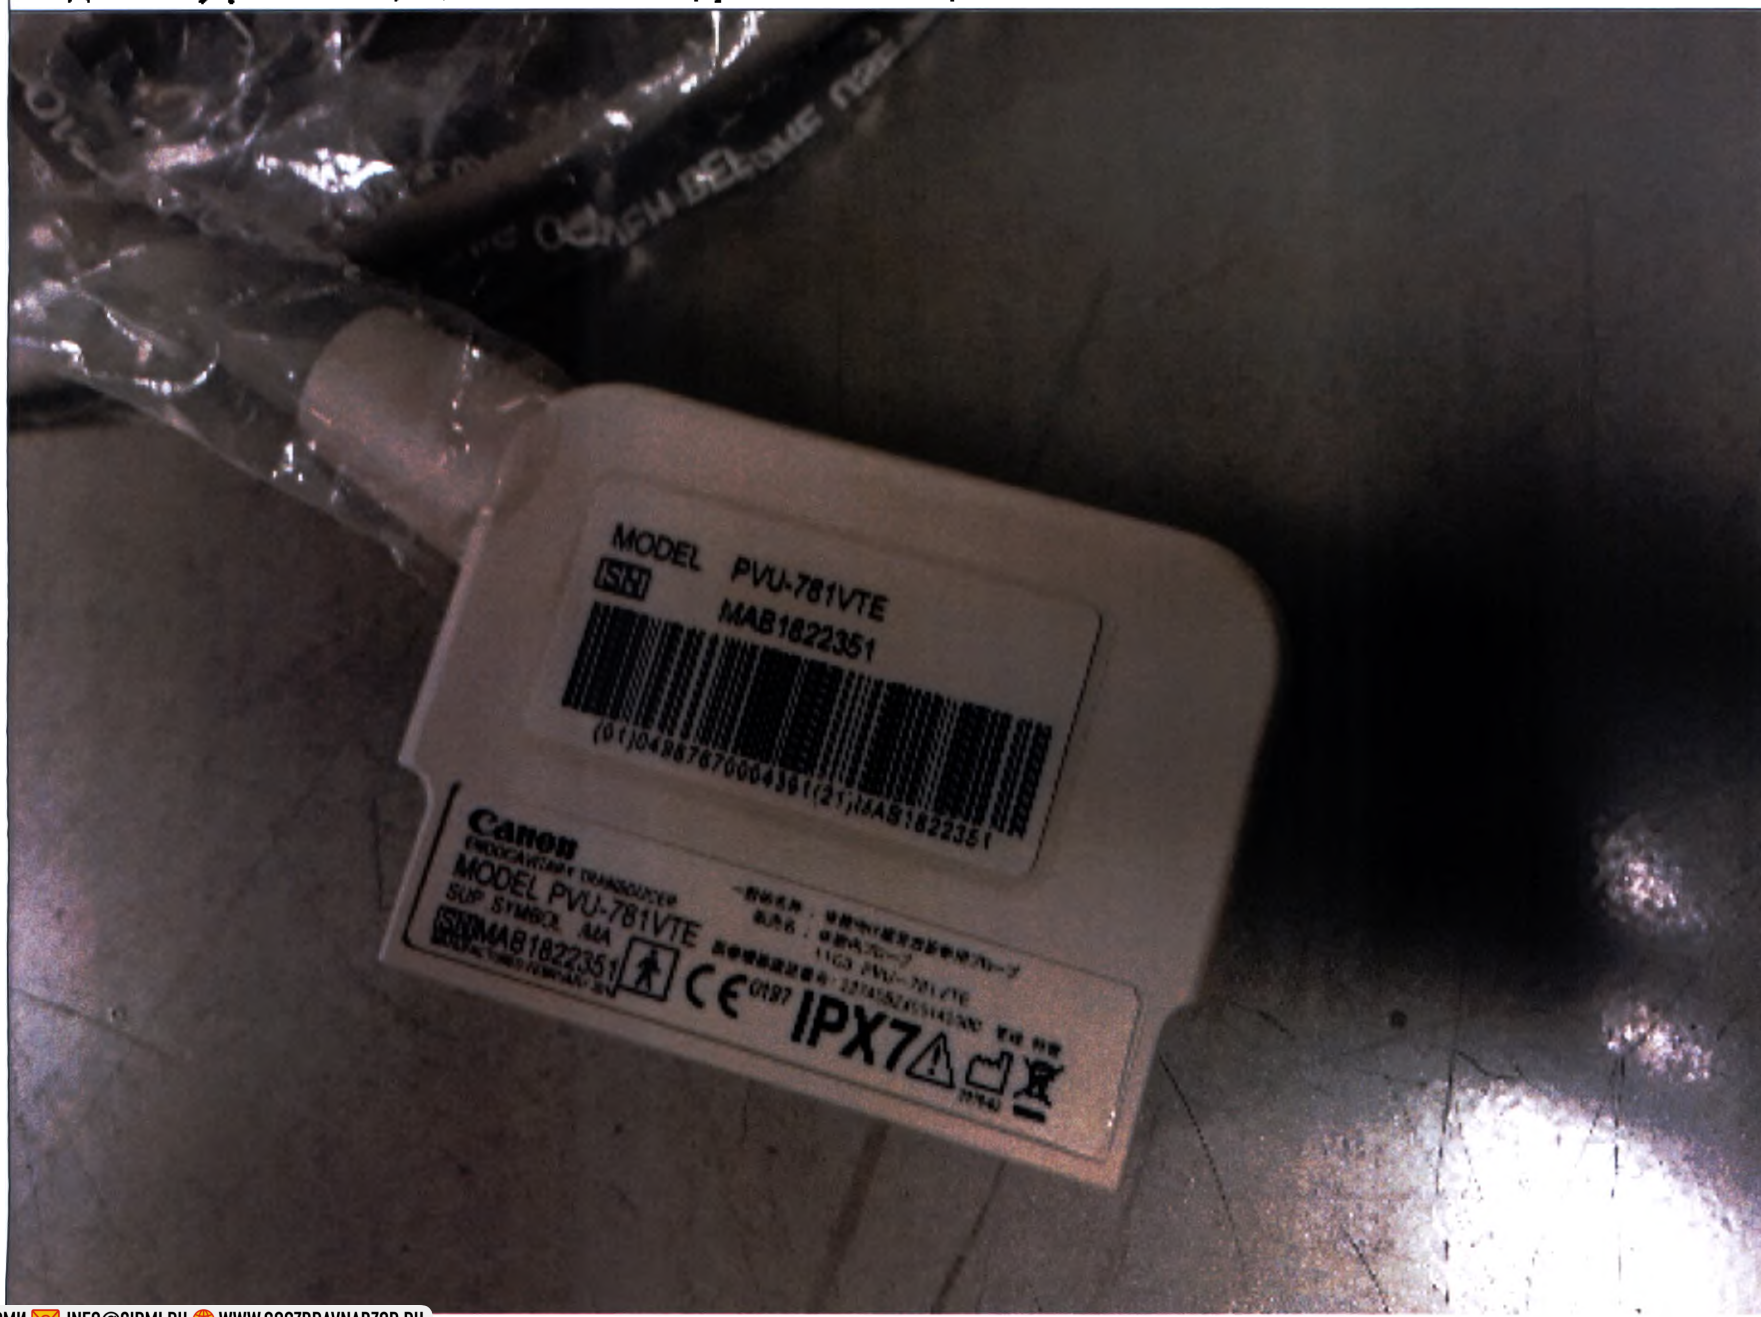

18. Датчик внутривидеолостной, модель PVU-781VTE (при необходимости).



19. Датчик внутривидеолостной, модель PVL-715RS (при необходимости).

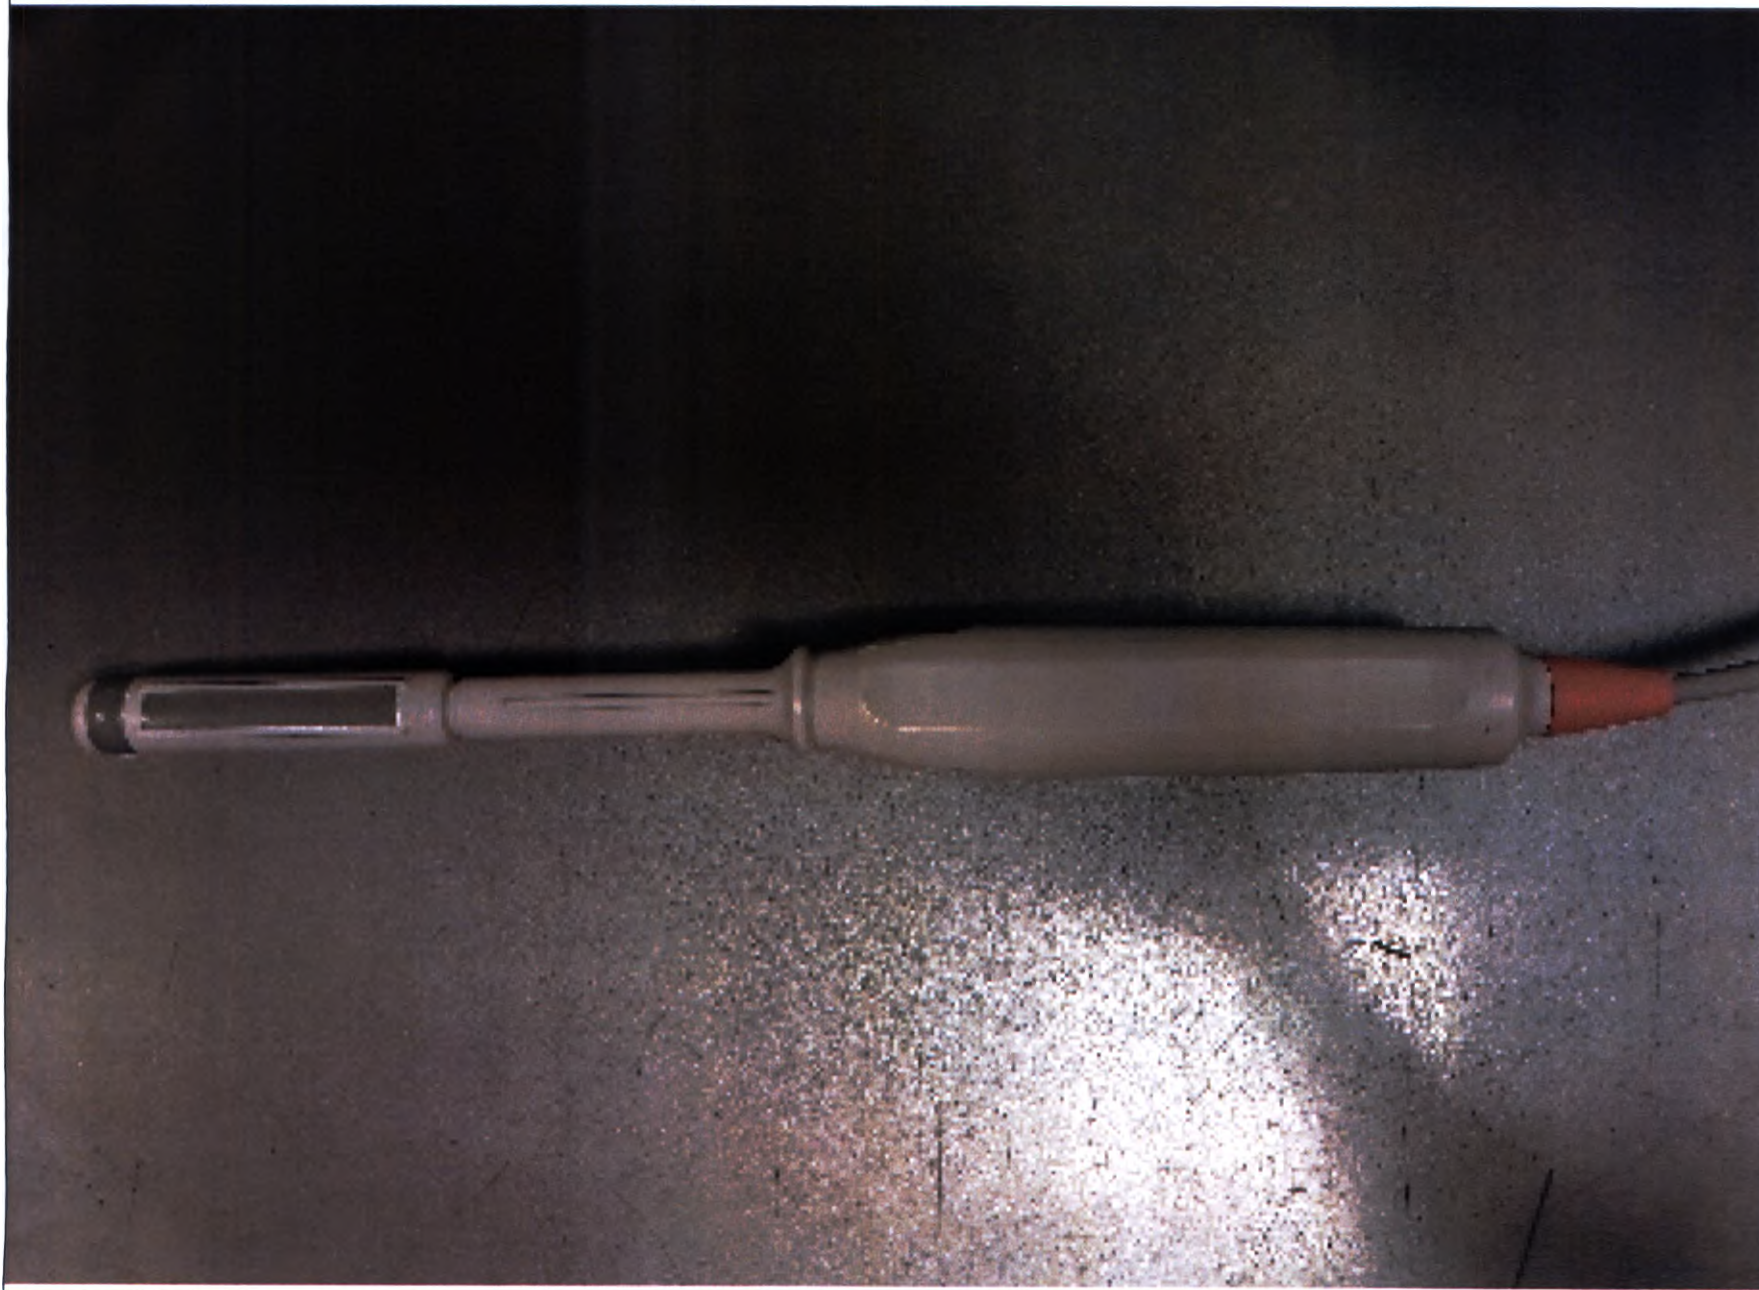

19. Датчик внутрископической, модель PVL-715RS (при необходимости).

MODEL PVL-715RS
[SN] 99B1832193



(01)04987670004216(21)99B1832193



Canon

ENDOCAVITARY TRANSDUCER

MODEL PVL-715RS

SUP. SYMBOL

[SN] 99B1832193

MANUFACTURED: MARCH 2018

一般名称: 直腸向け超音波診断用プローブ

販売名: 体腔内プローブ

11CL4 PVL-715RS

医療機器認証番号: 226ADBZX00181000 管理 特管



CE 0197

IPX7



2018 03


20. Датчик линейный биопсийный, модель PLU-308BTP (при необходимости).



20. Датчик линейный биопсийный, модель PLU-308BTP (при необходимости).




20. Датчик линейный биопсийный, модель PLU-308BTP (при необходимости).

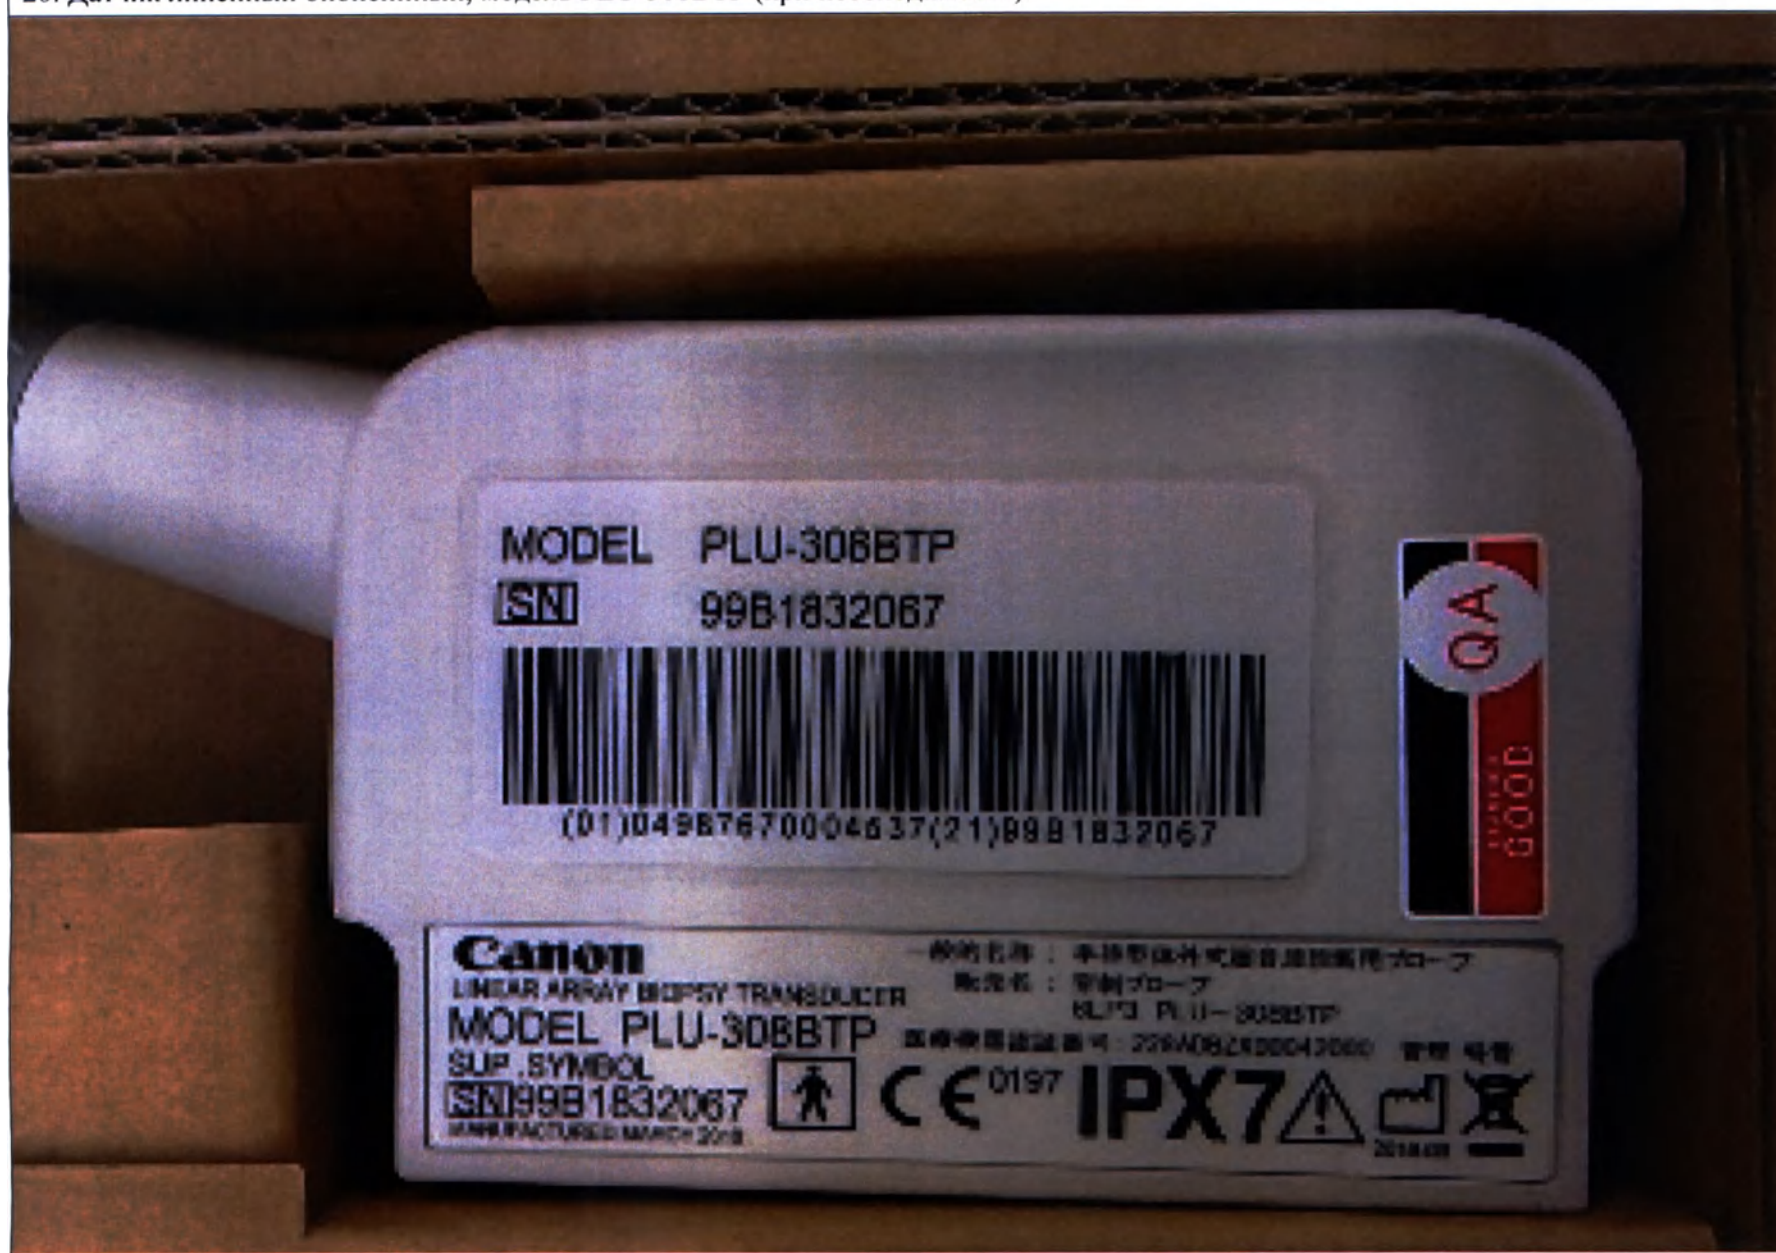


20. Датчик линейный биопсийный, модель PLU-308BTP (при необходимости).



21. Датчик линейный, модель PLU-704BT (при необходимости).

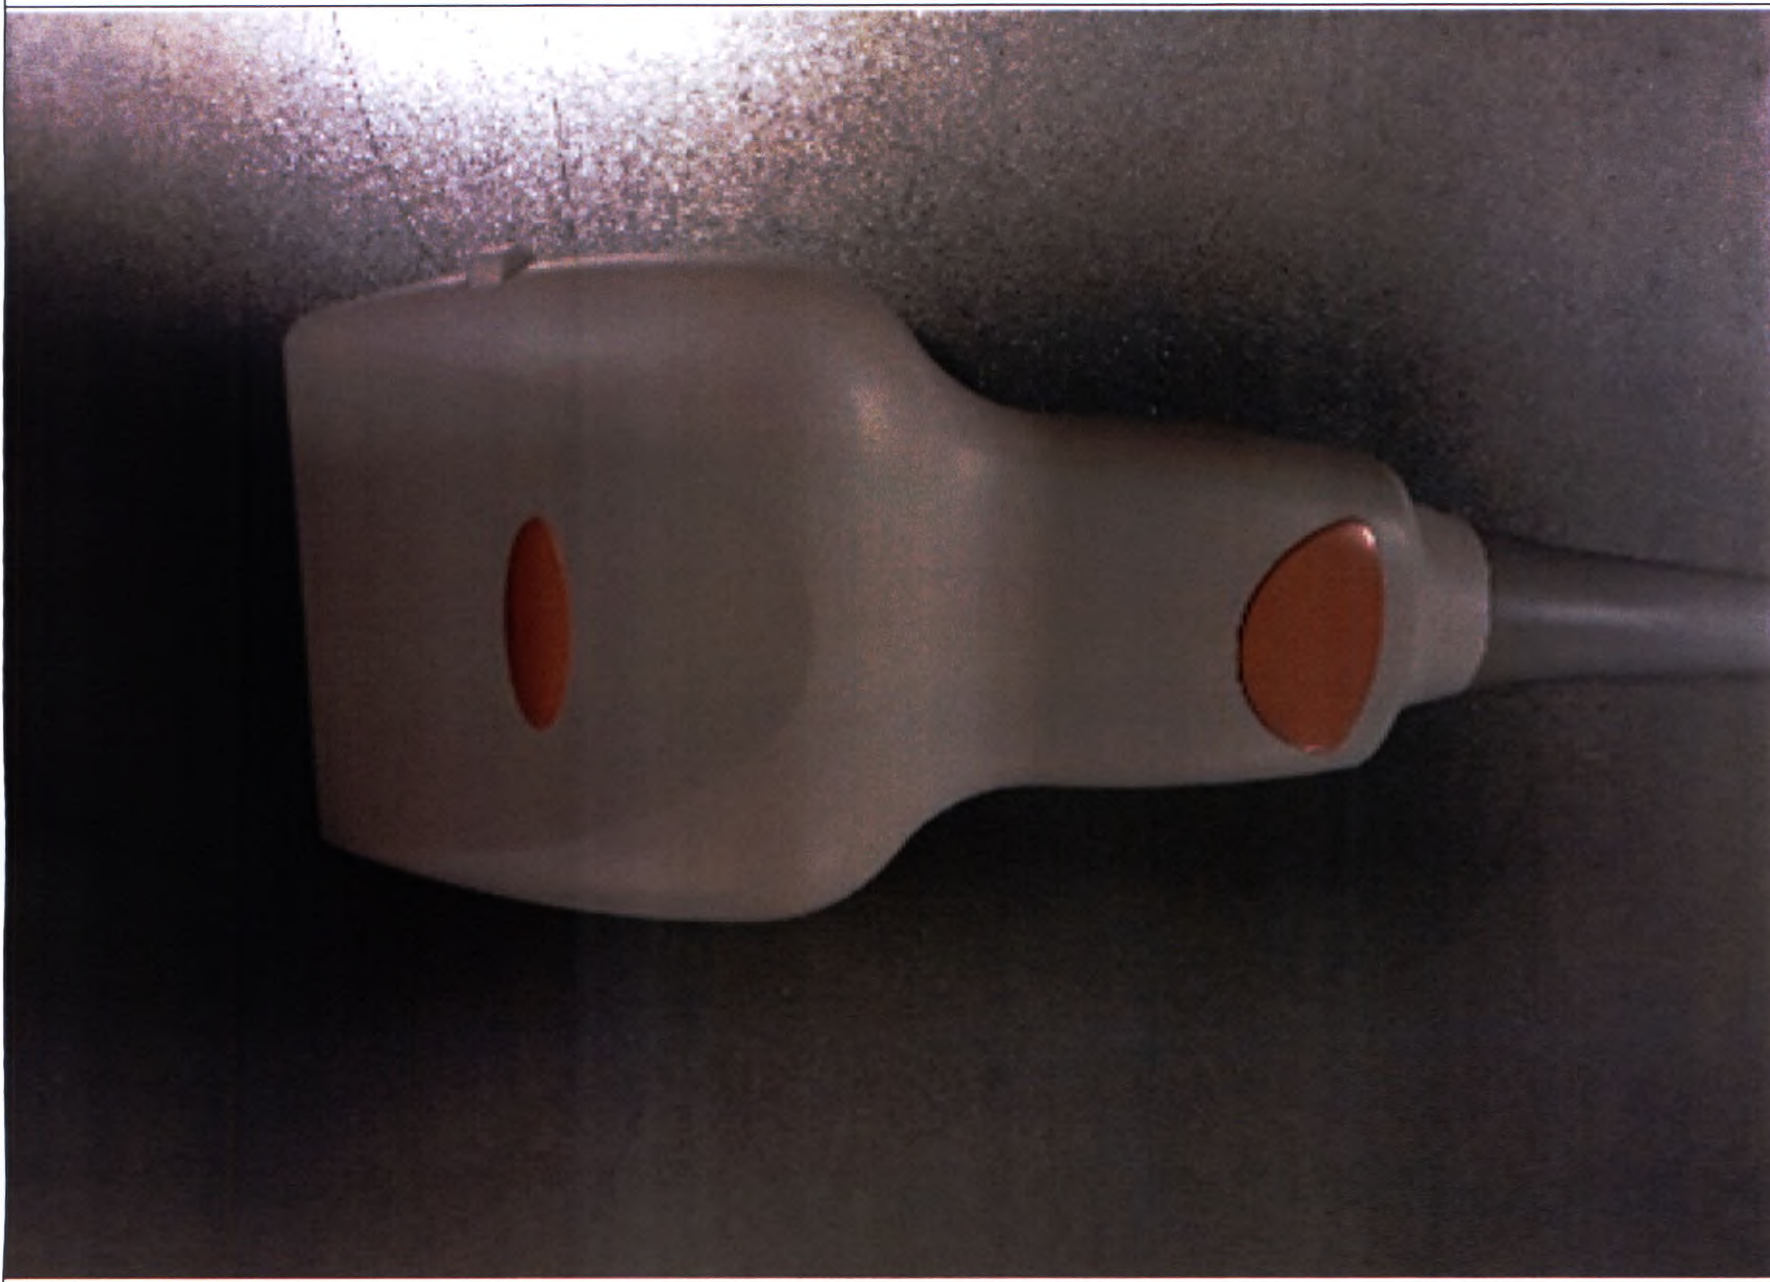


21. Датчик линейный, модель PLU-704BT (при необходимости).

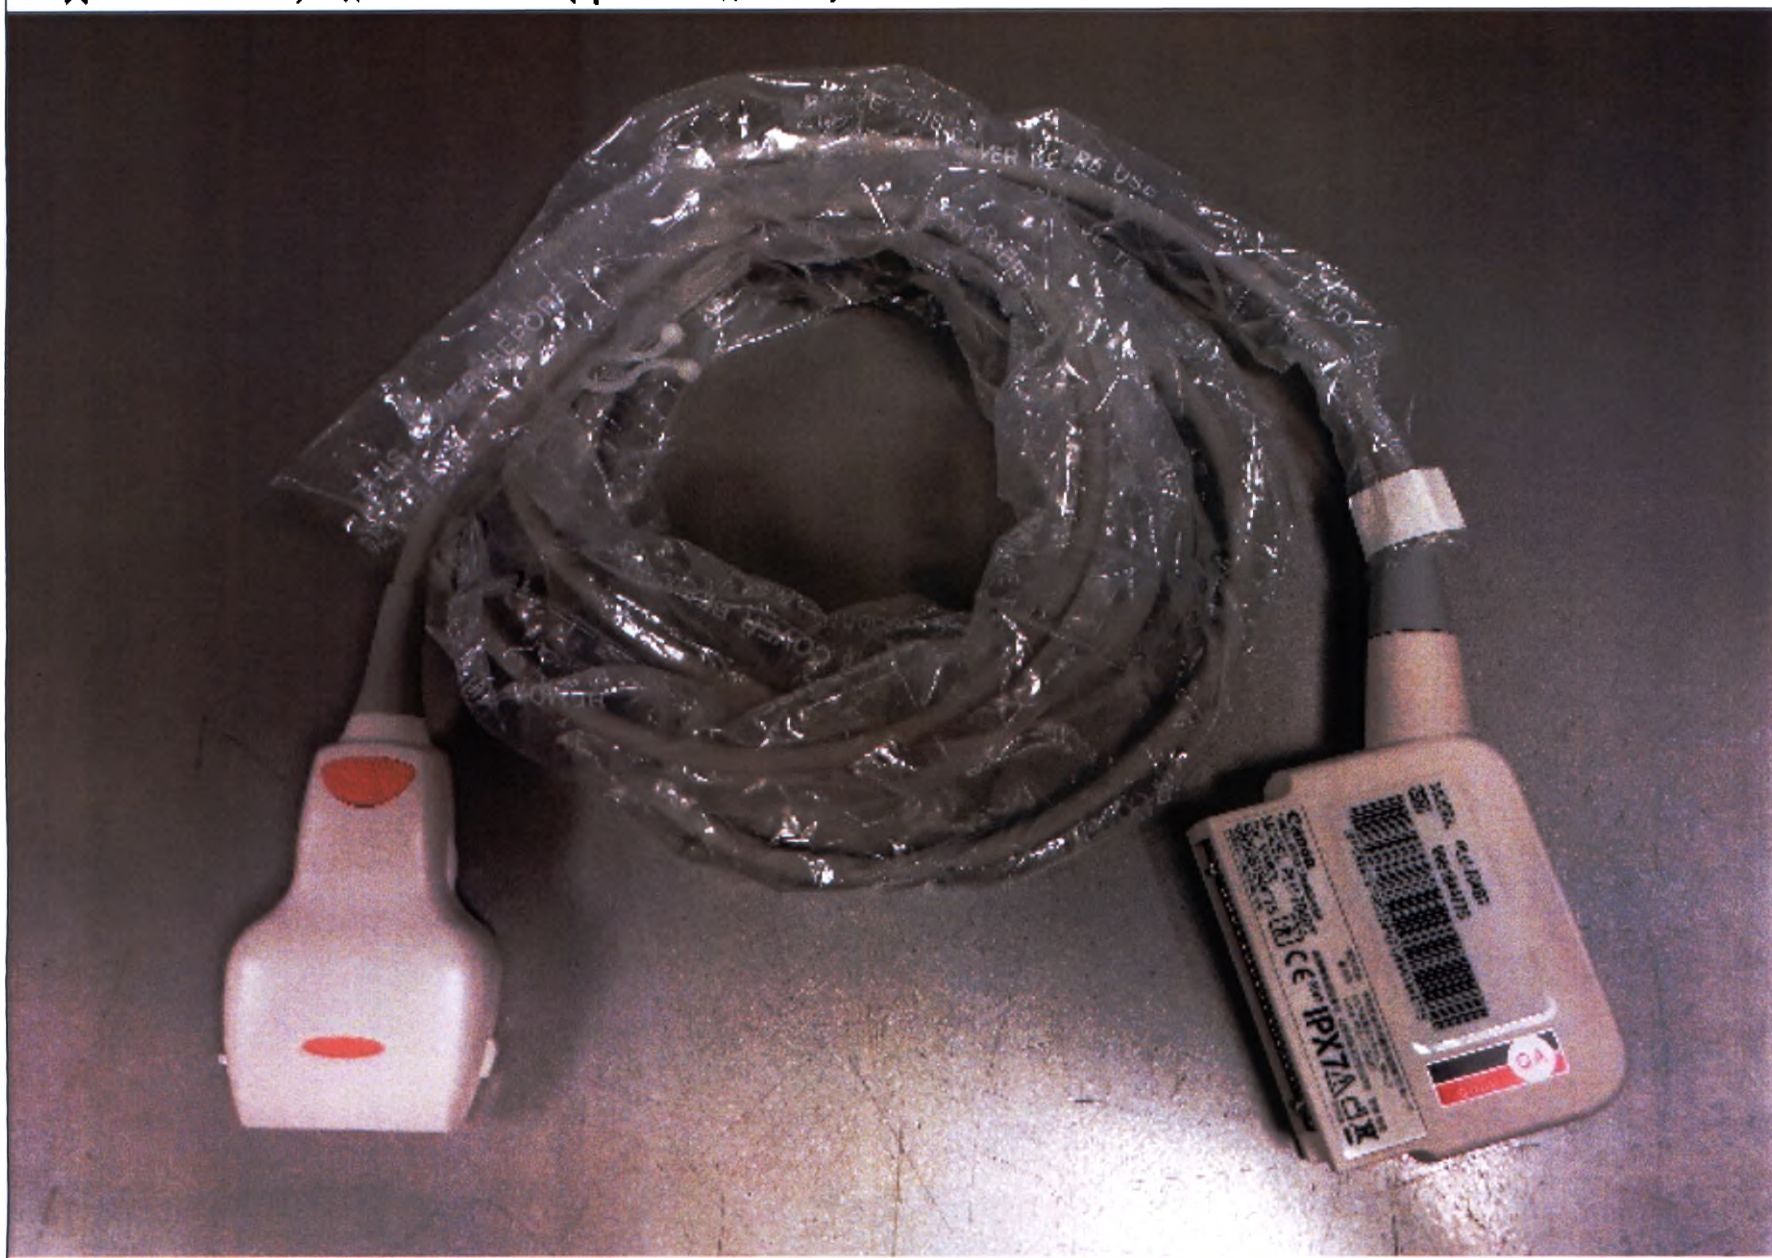


21. Датчик линейный, модель PLU-704BT (при необходимости).




22. Датчик линейный, модель PLU-1005BT (при необходимости).

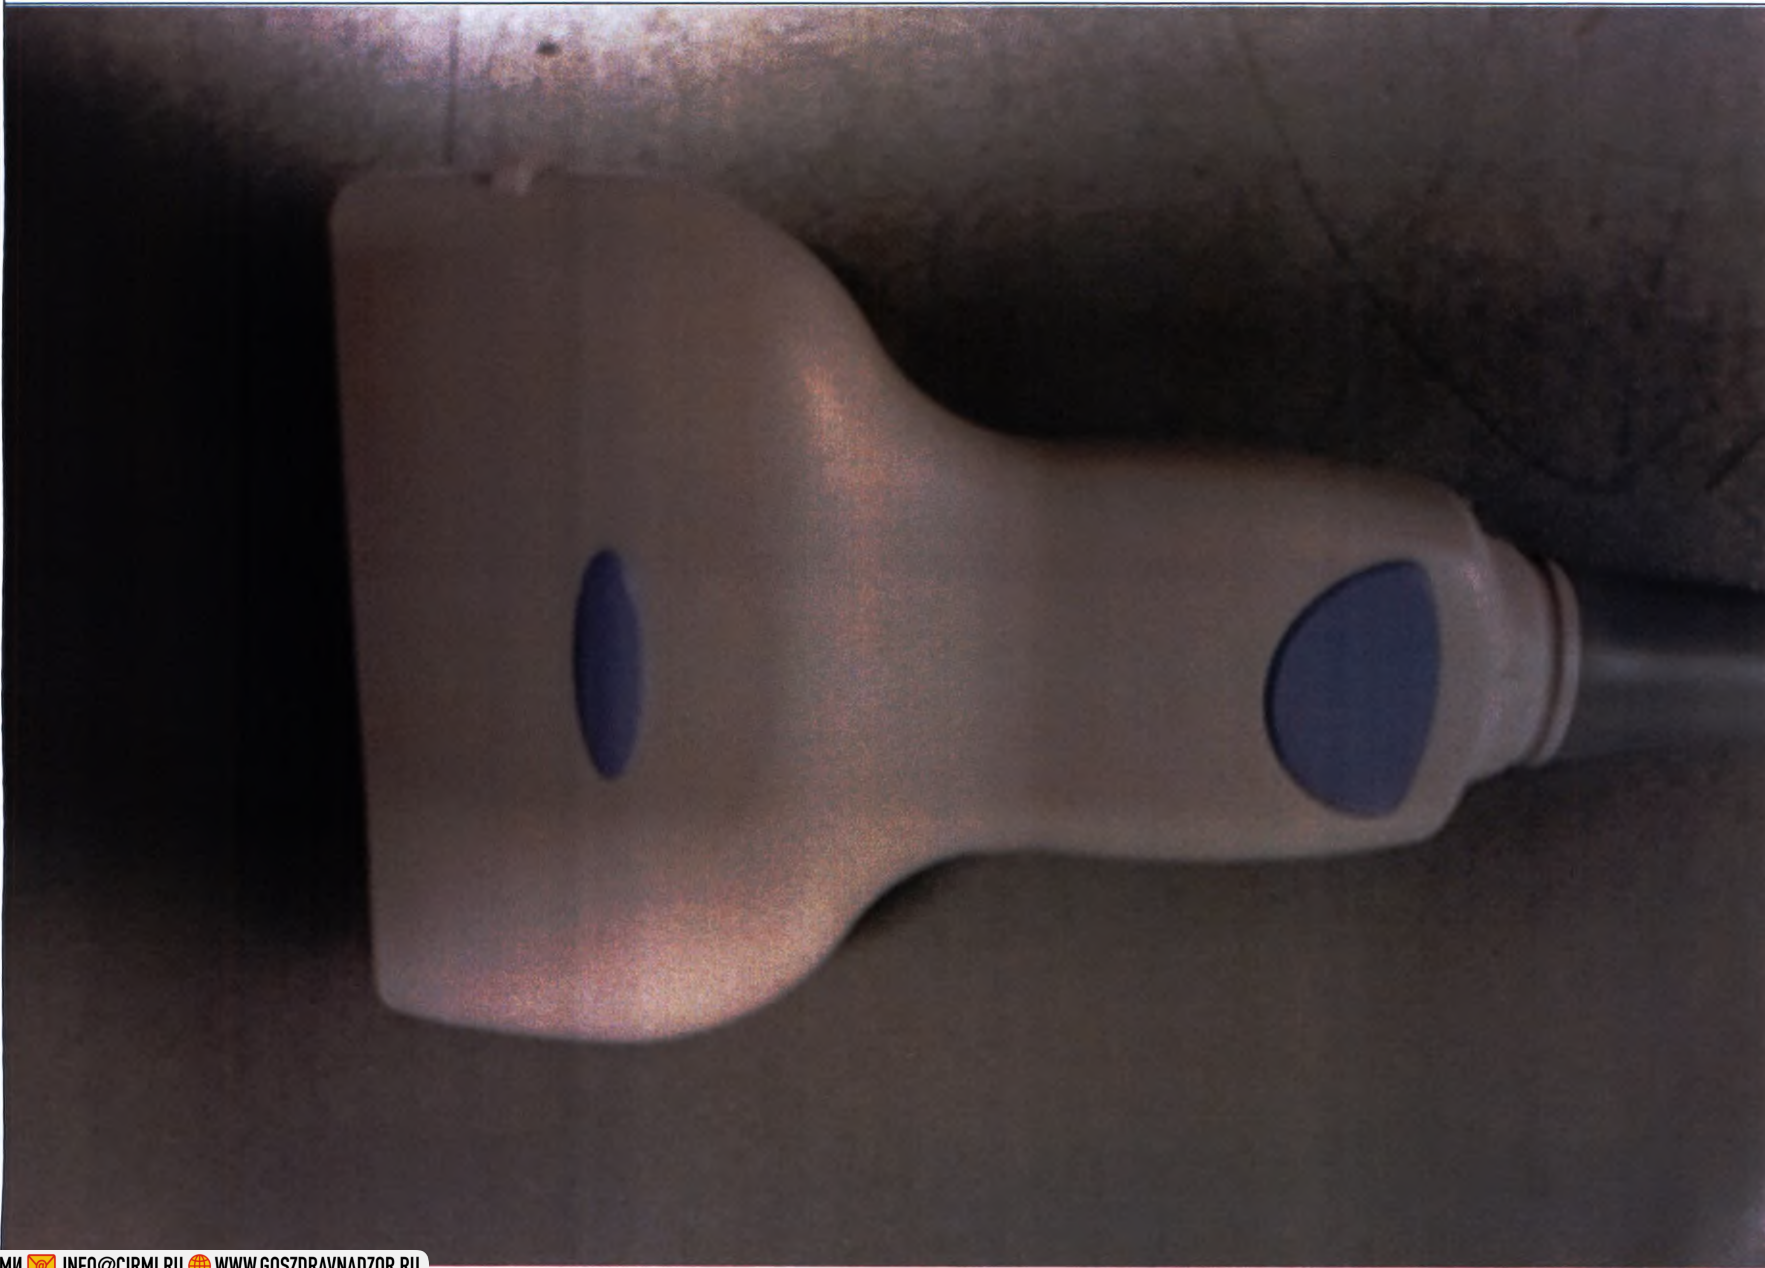

22. Датчик линейный, модель PLU-1005BT (при необходимости).

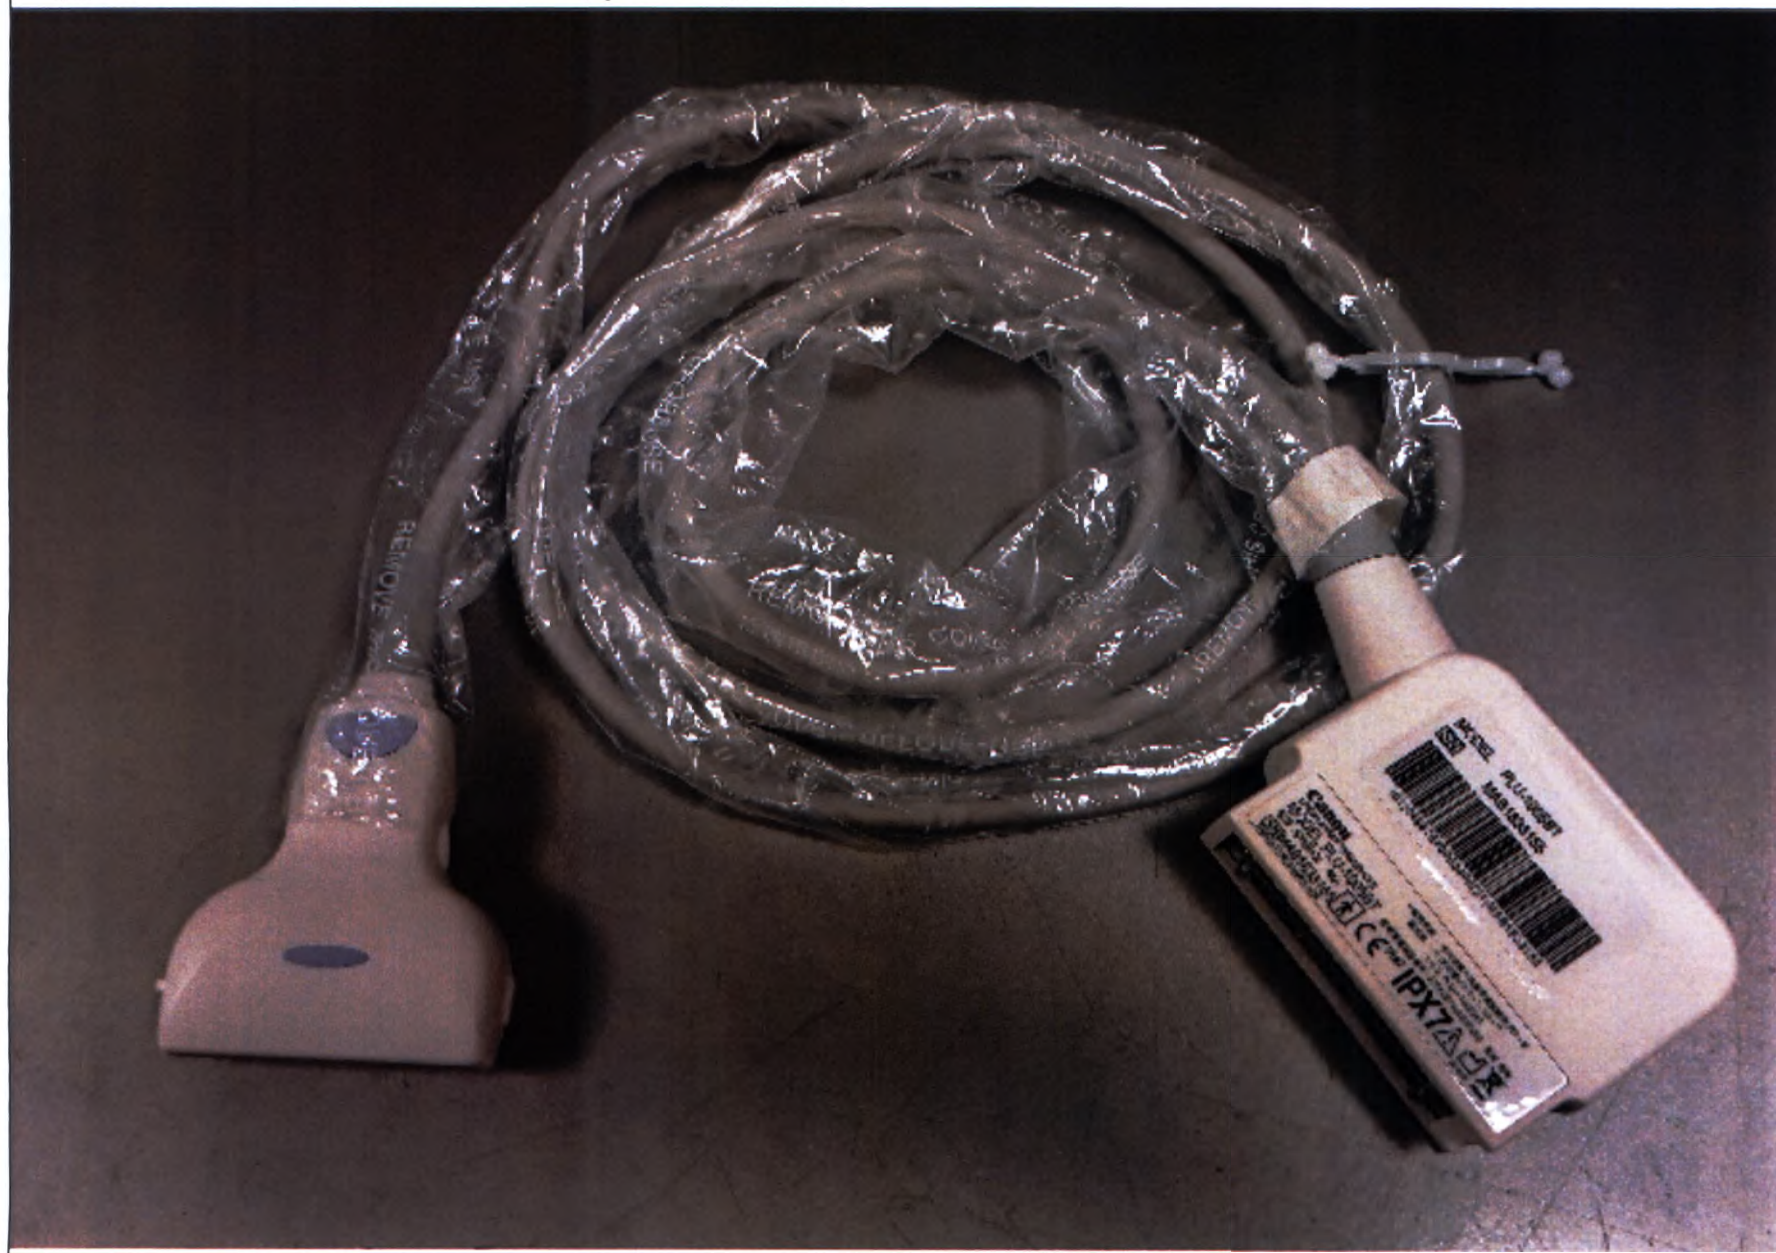


22. Датчик линейный, модель PLU-1005BT (при необходимости).

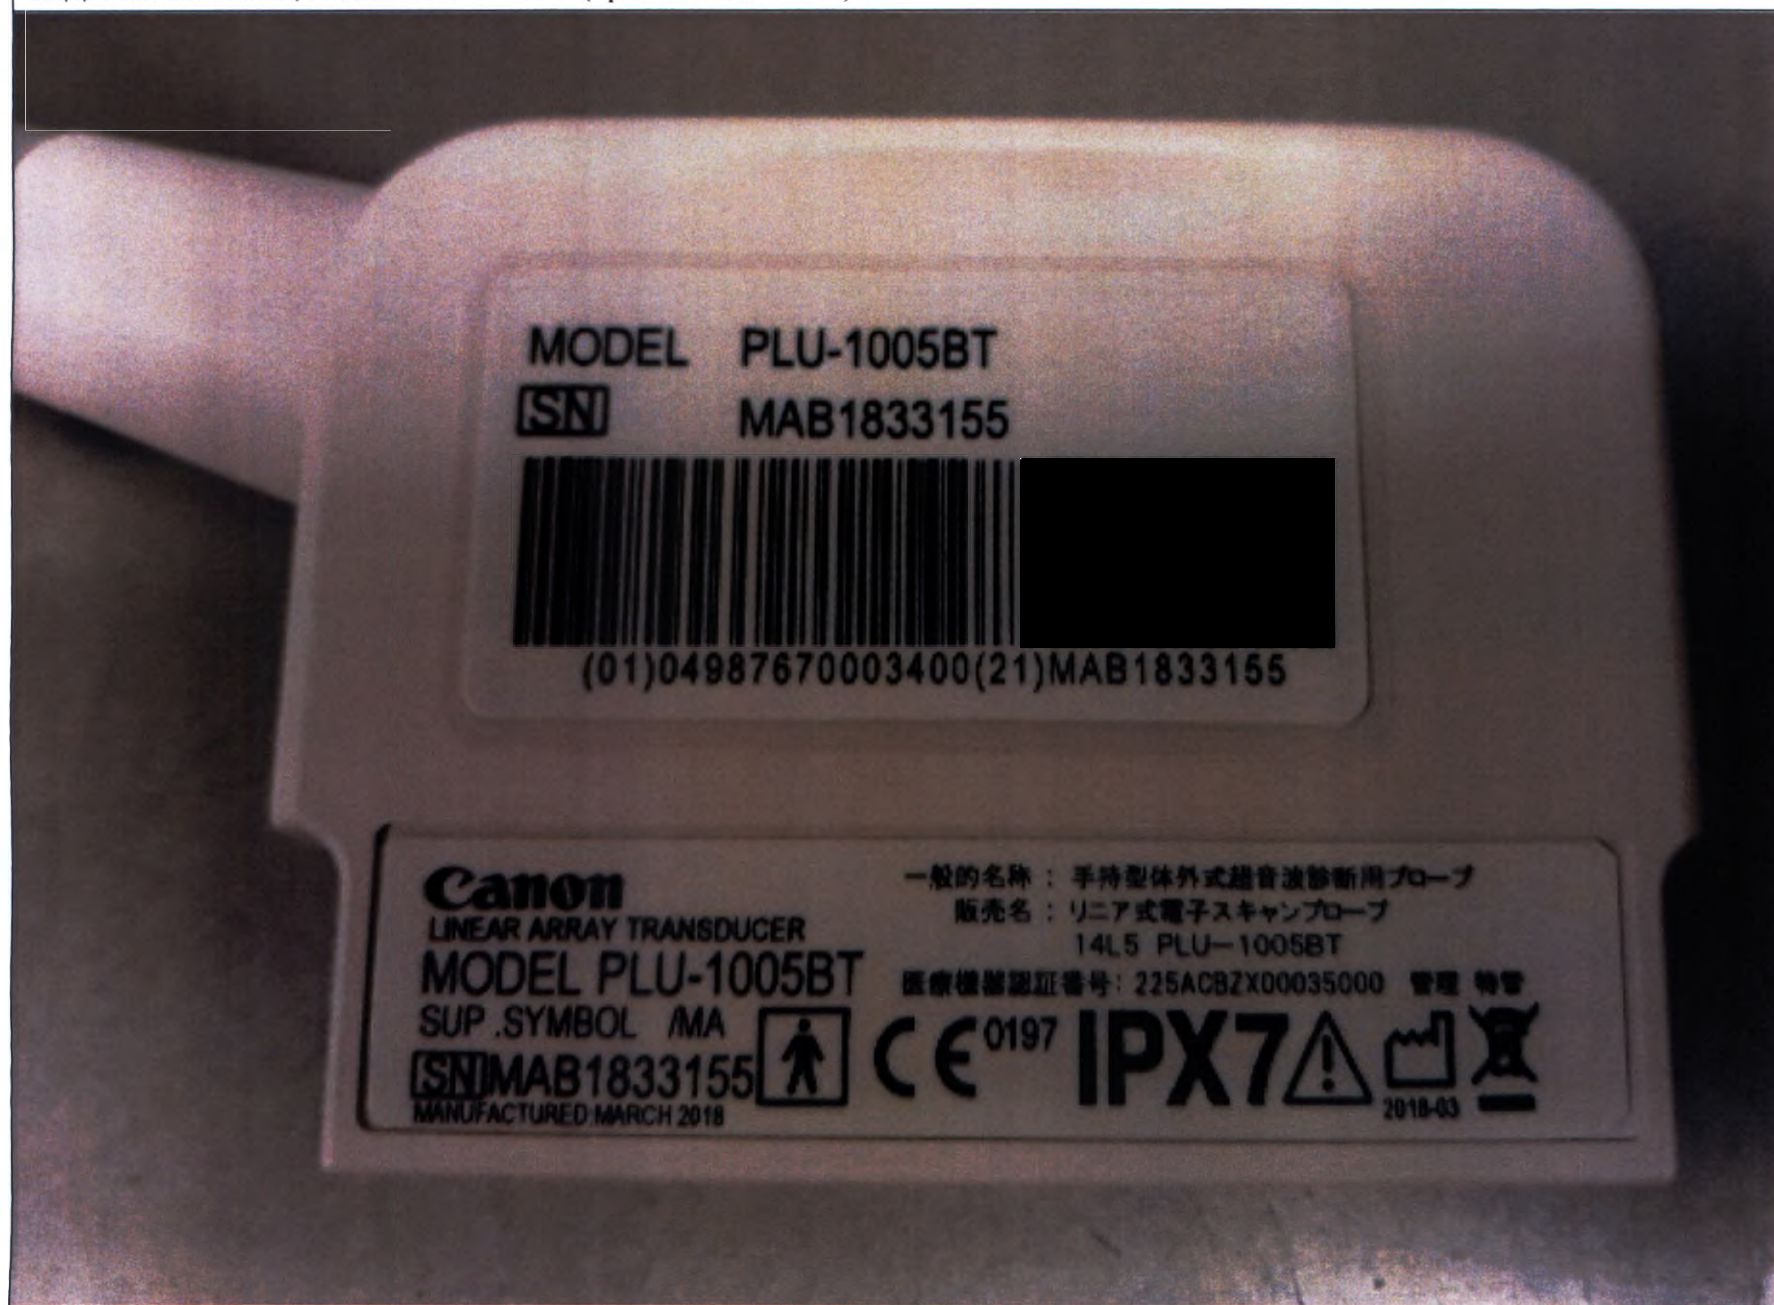

23. Датчик линейный, модель PLU-1202BT (при необходимости).




23. Датчик линейный, модель PLU-1202BT (при необходимости).

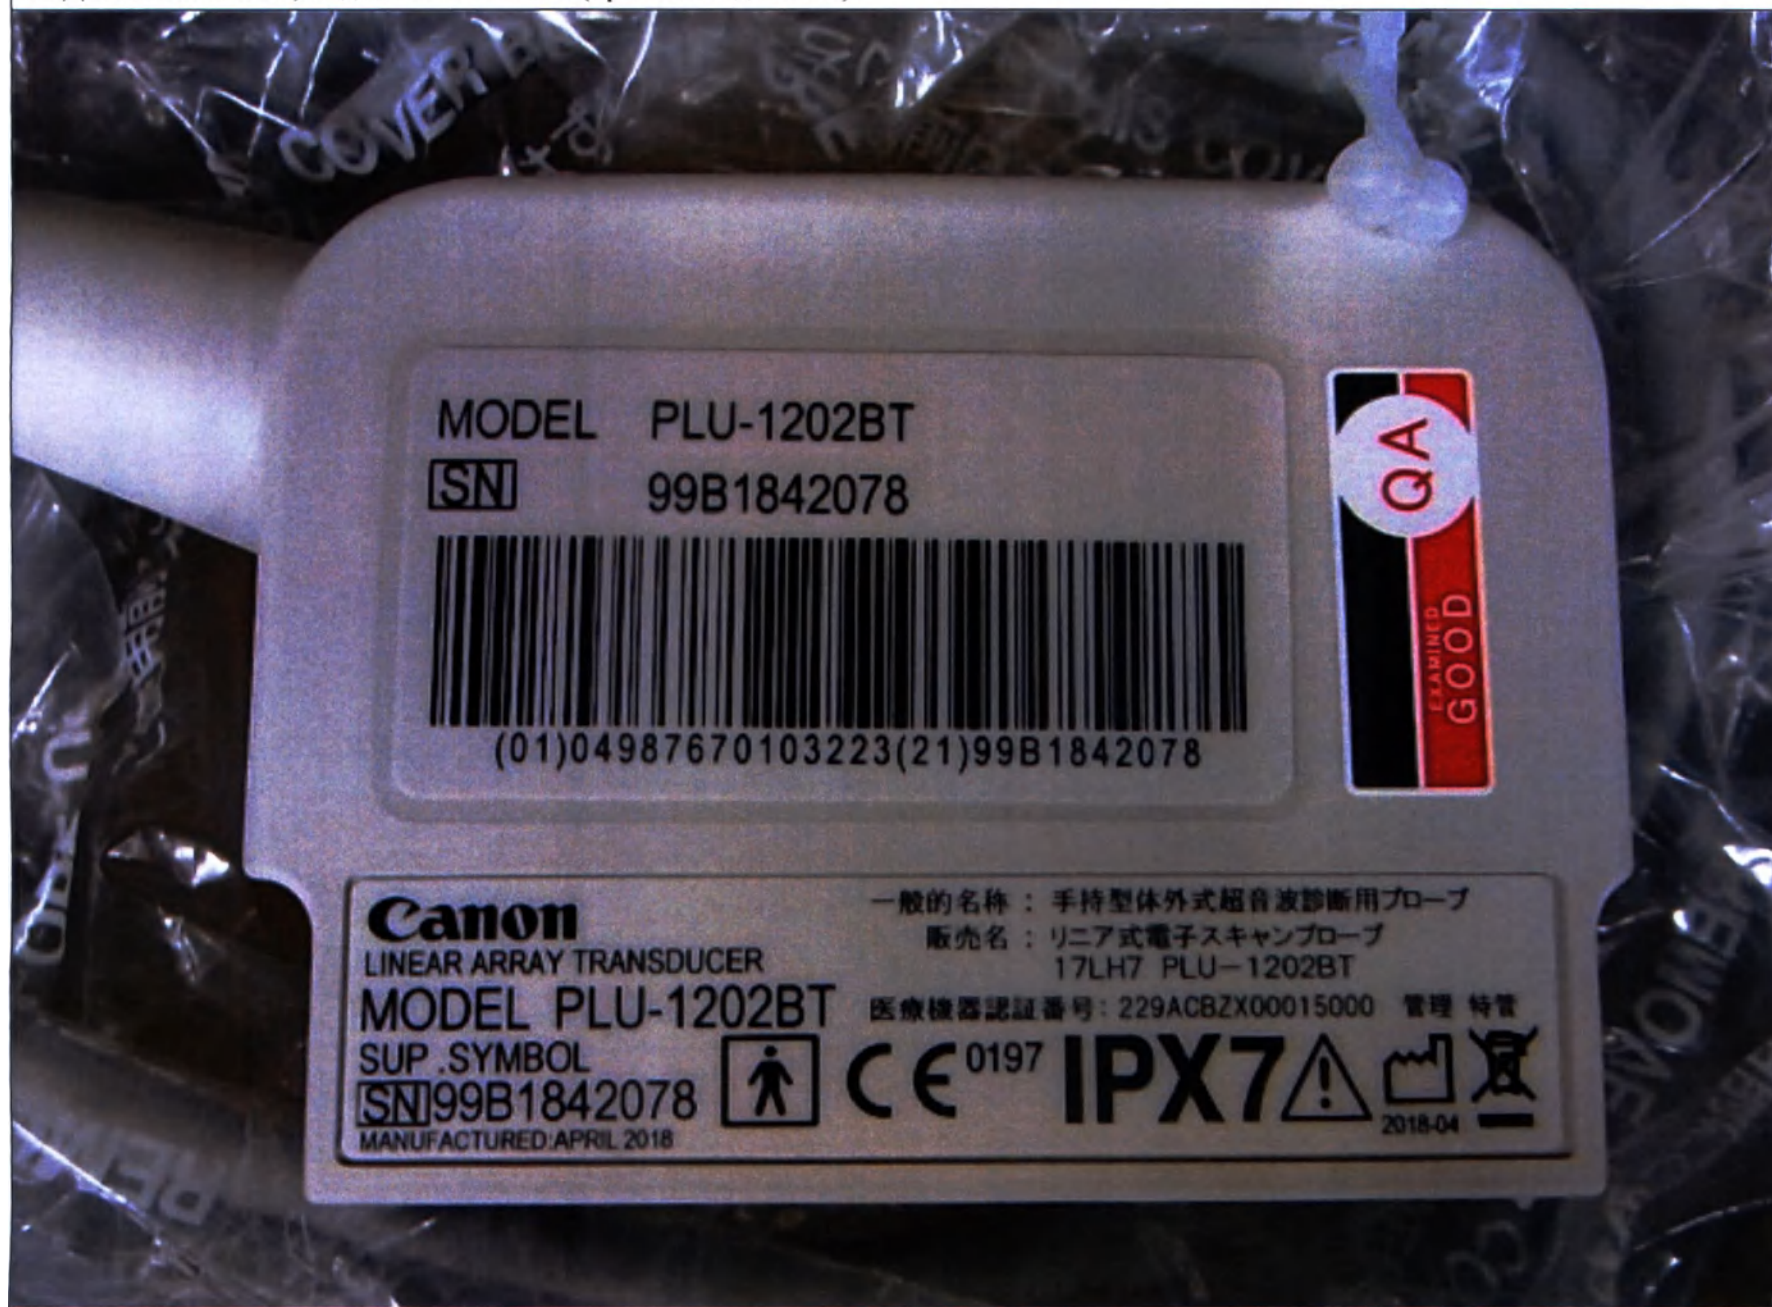

23. Датчик линейный, модель PLU-1202BT (при необходимости).




24. Датчик линейный, модель PLU-1204BT (при необходимости).

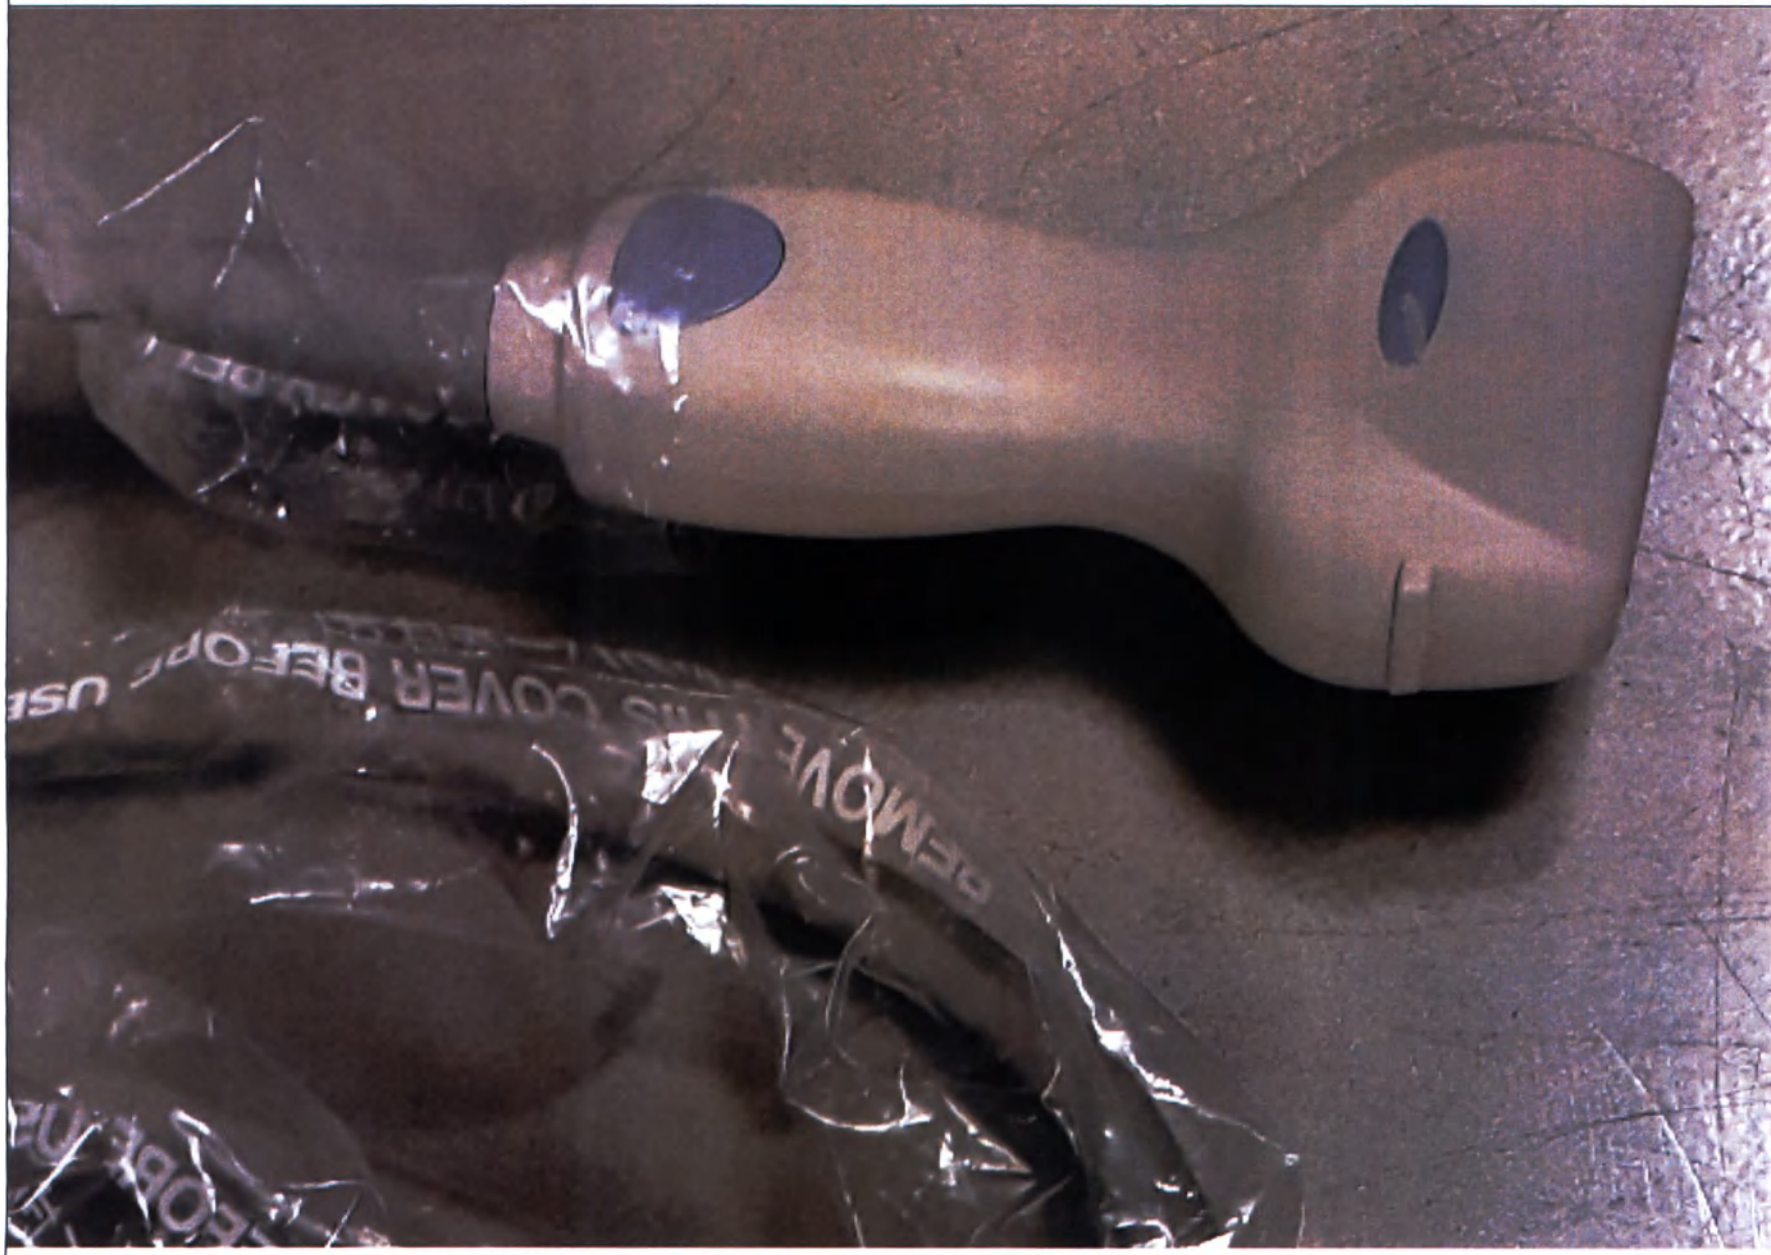

24. Датчик линейный, модель PLU-1204BT (при необходимости).




25. Датчик транспищеводный мультиплановый, модель РЕТ-512MD (при необходимости).

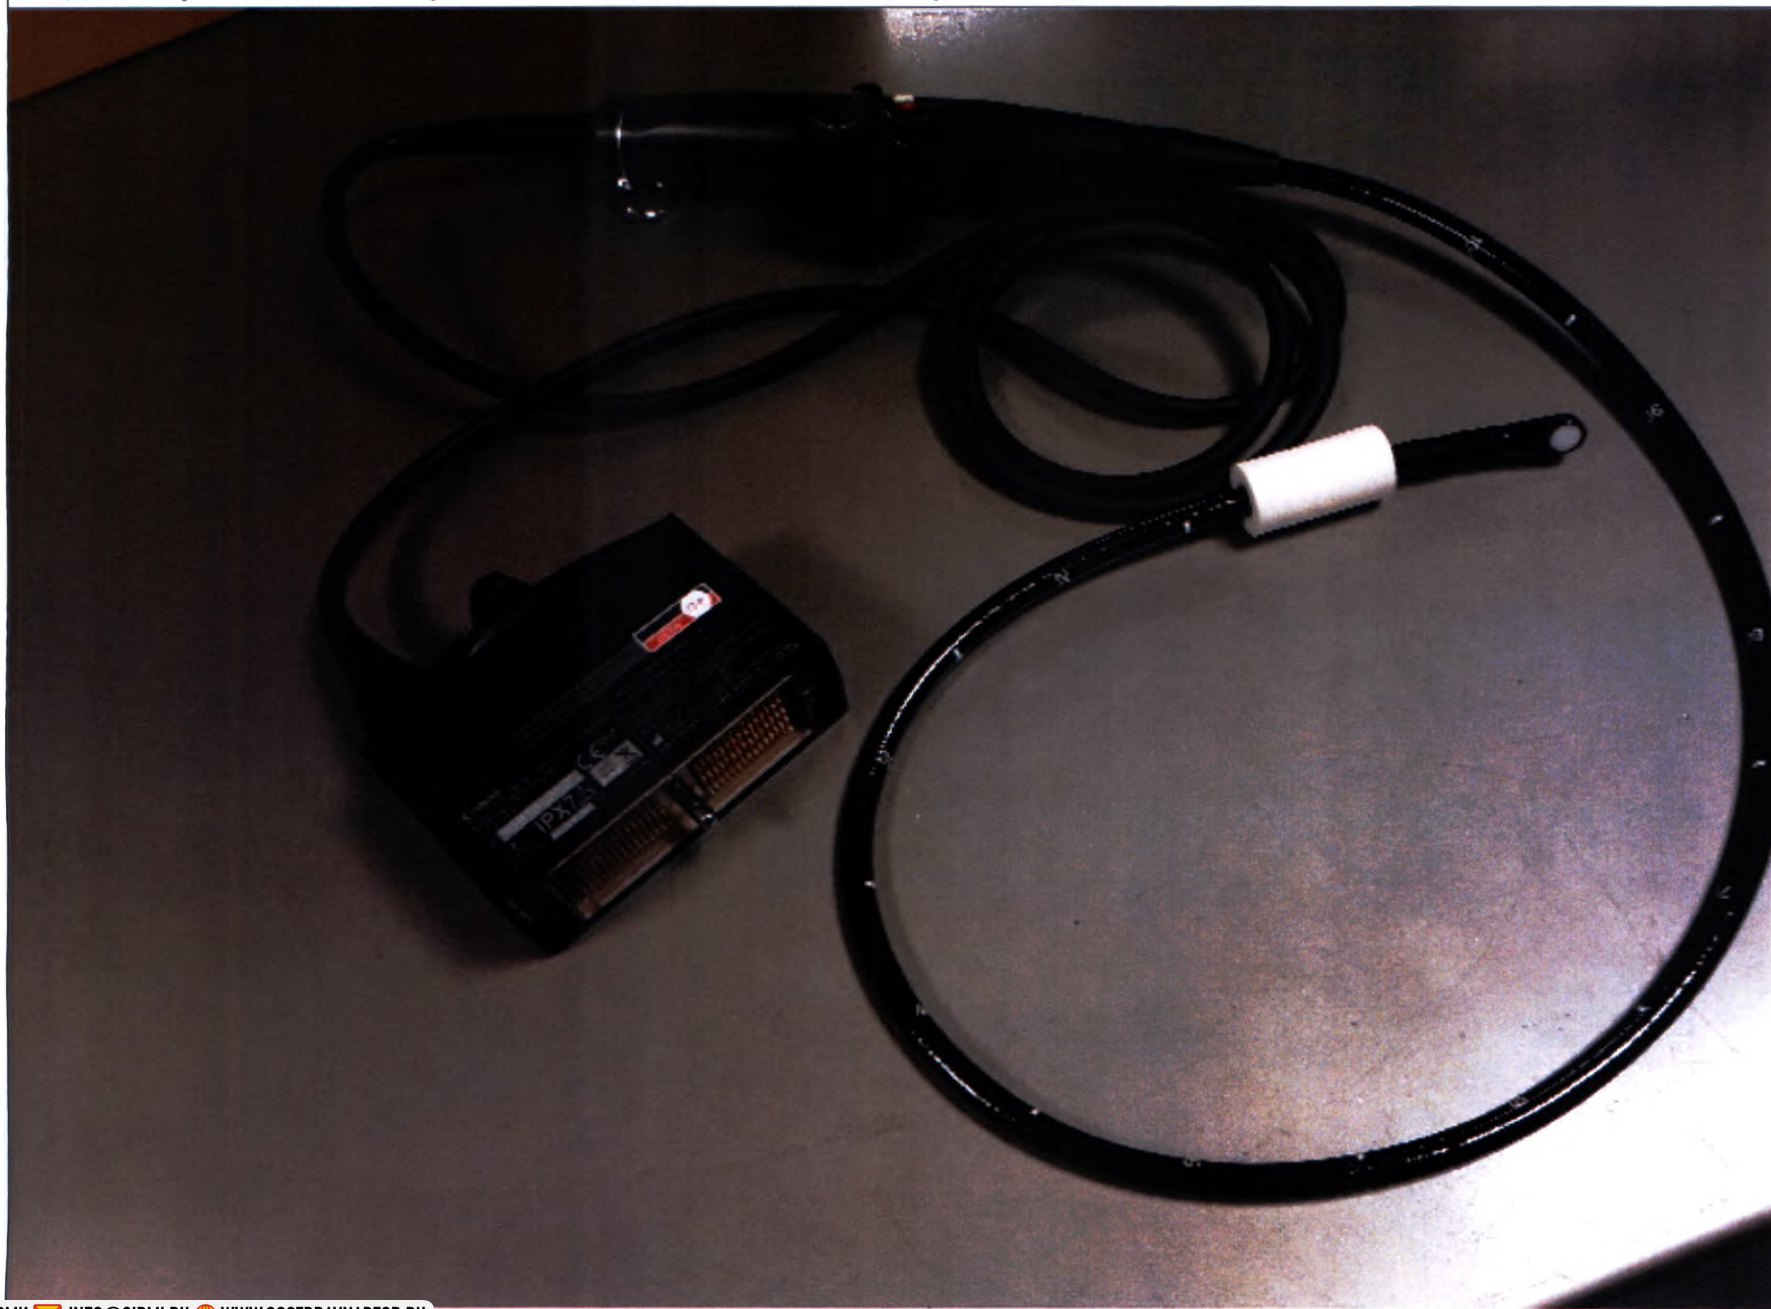

25. Датчик транспищеводный мультиплановый, модель PET-512MD (при необходимости).




26. Датчик линейный, модель PET-805LA (при необходимости).

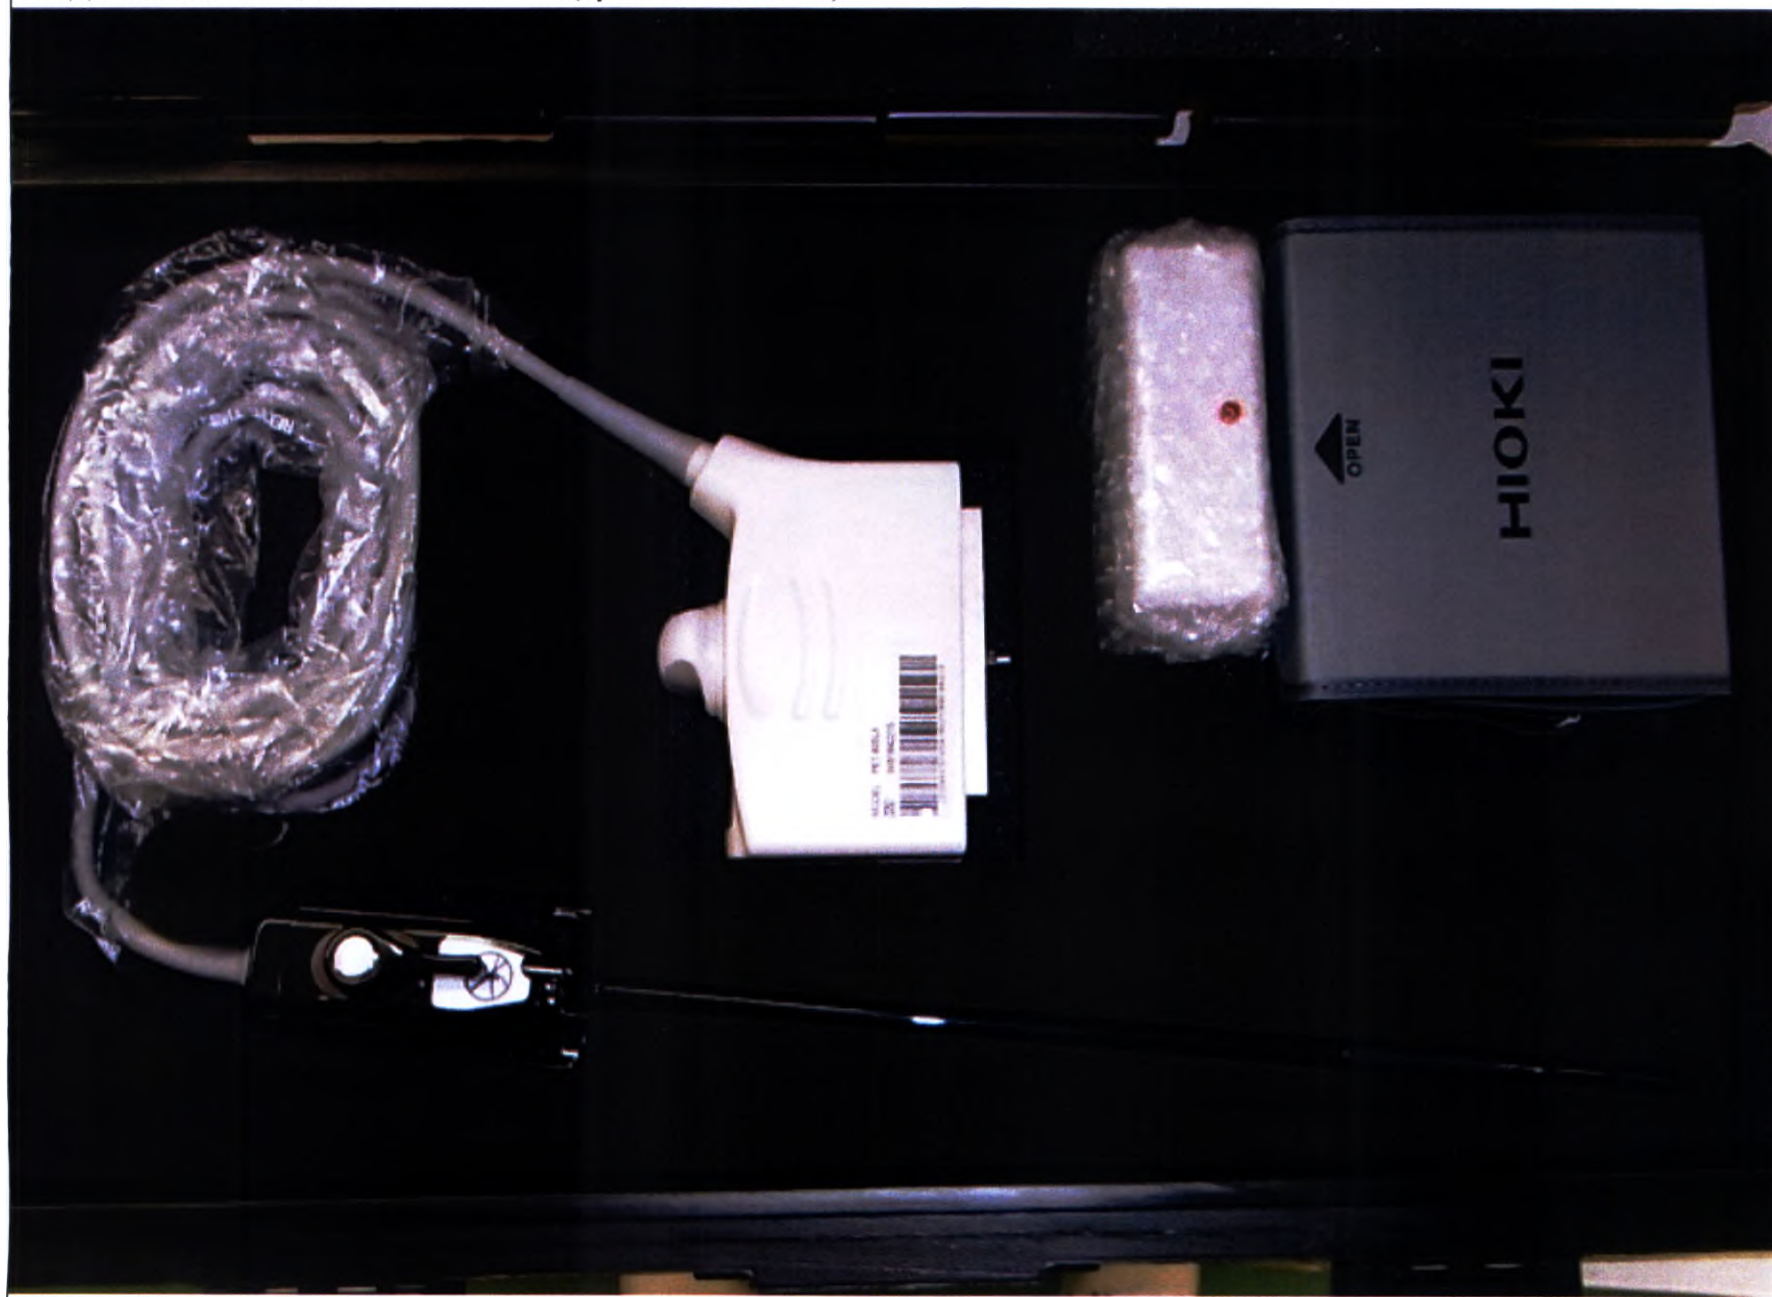


26. Датчик линейный, модель PET-805LA (при необходимости).




27. Датчик карандашный, модель РС-20М (при необходимости).

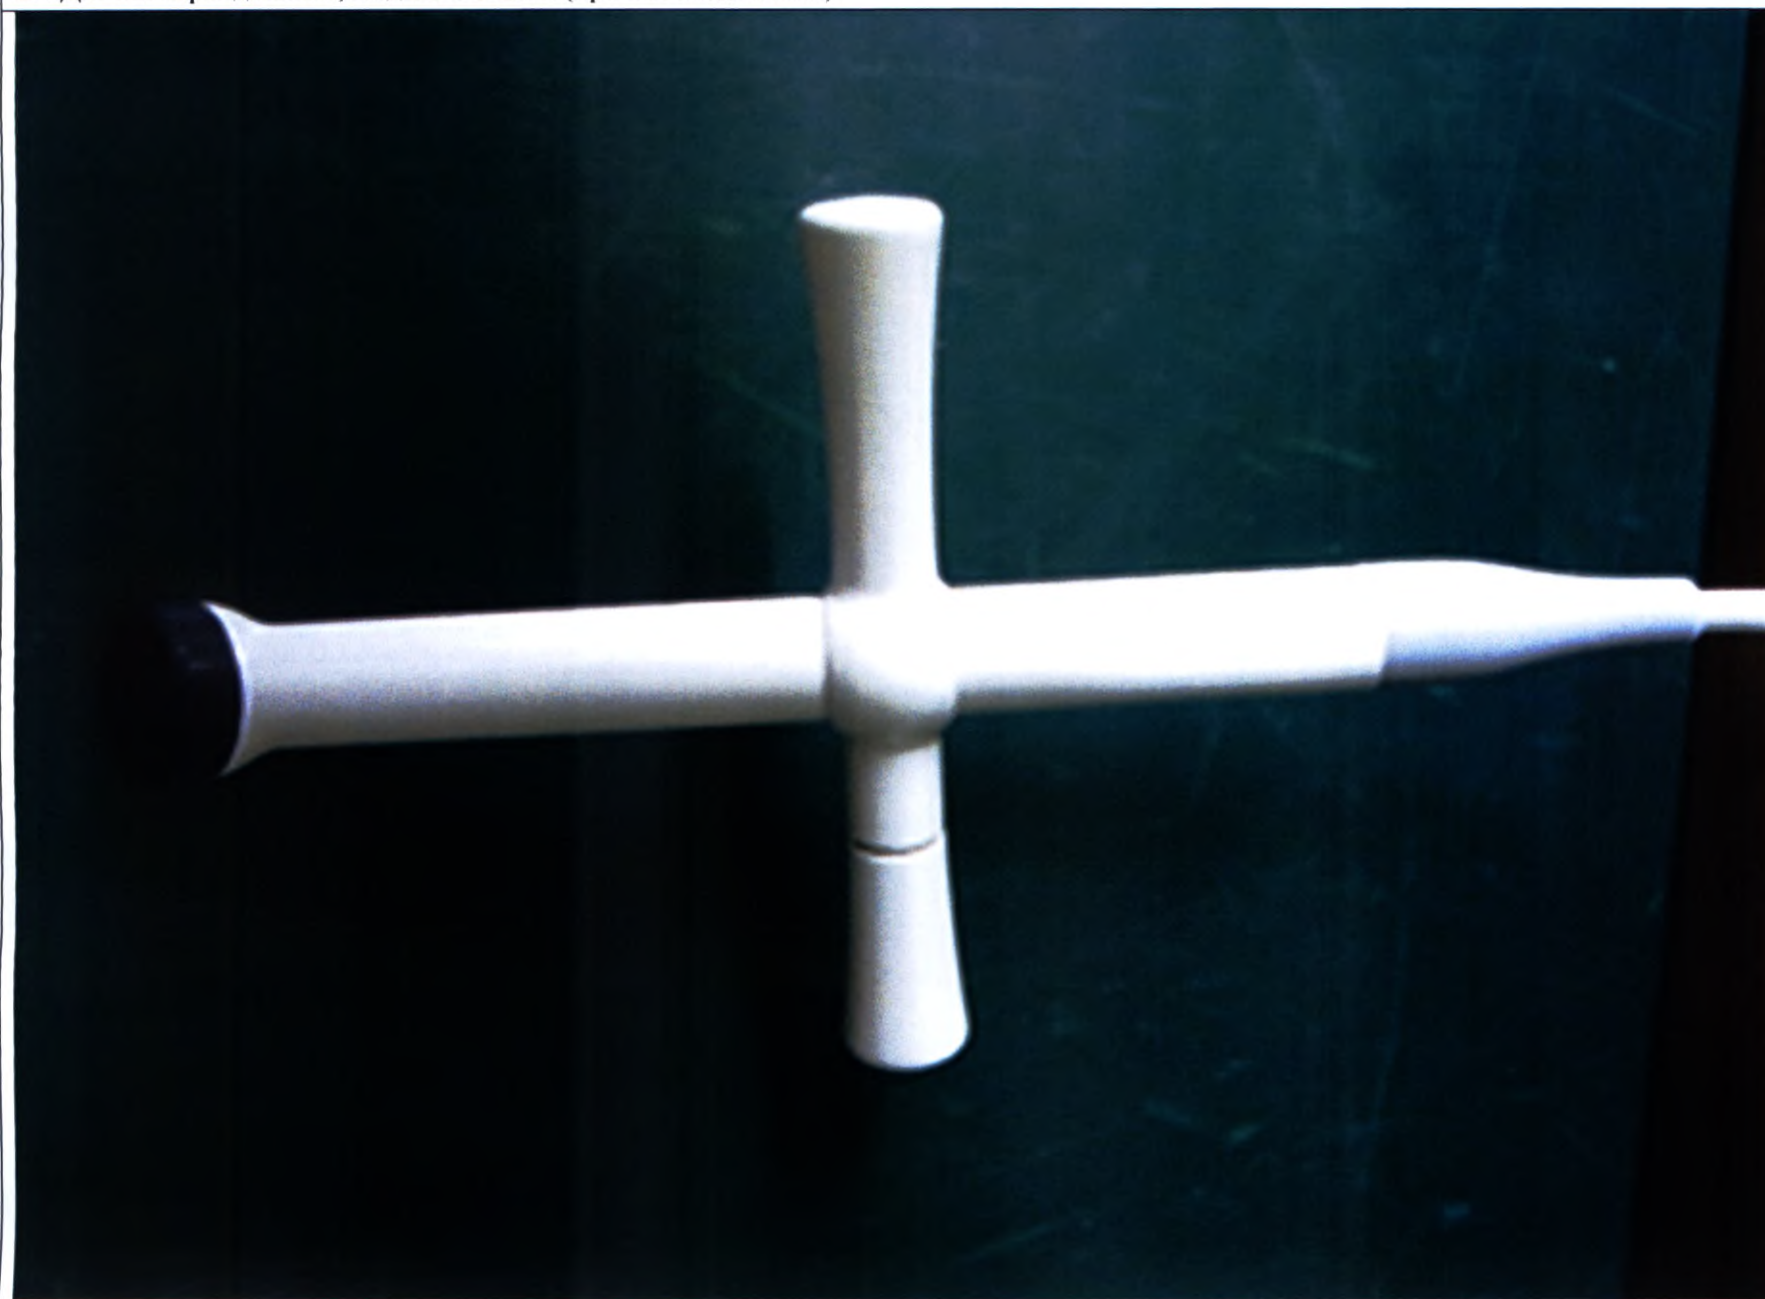

27. Датчик карандашный, модель PC-20M (при необходимости).

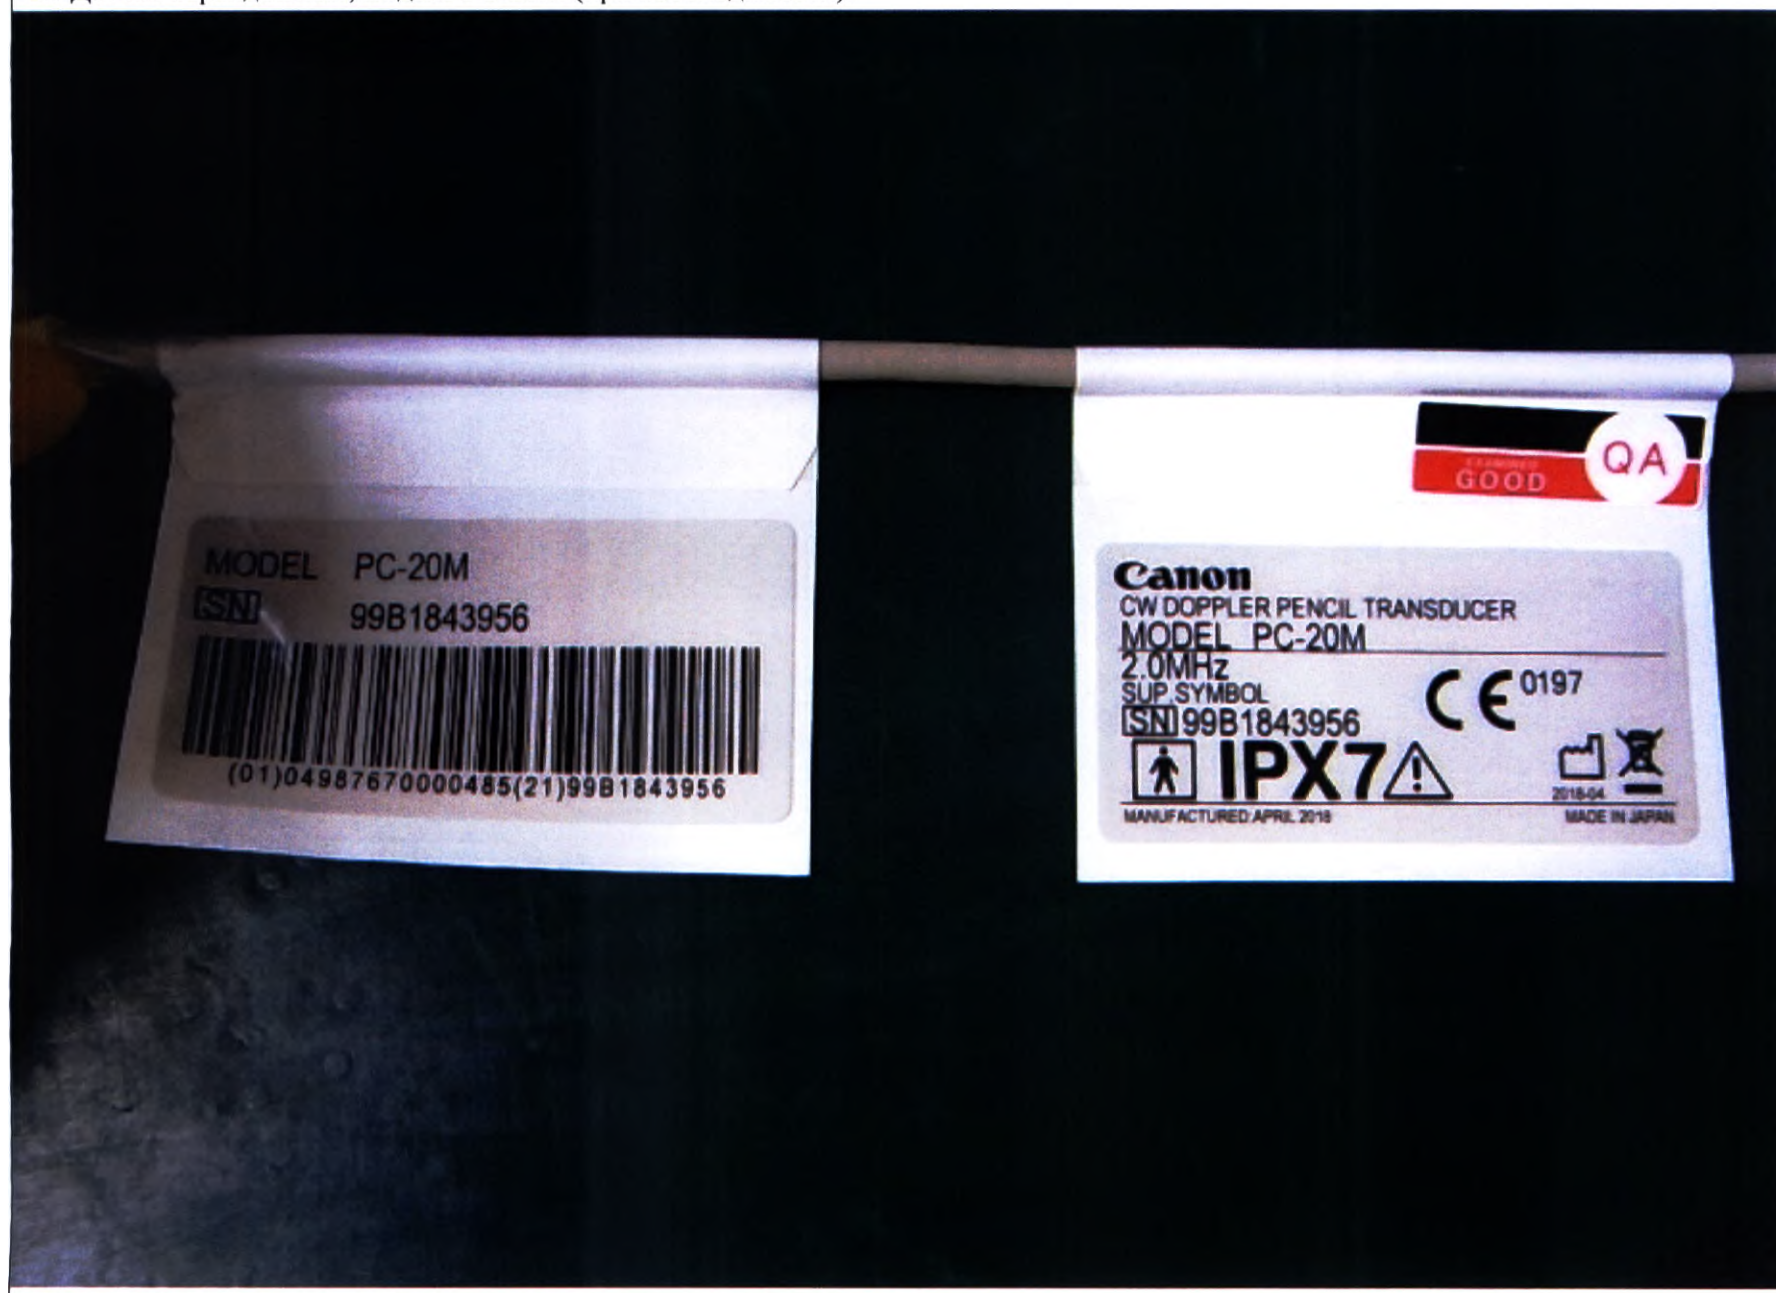

27. Датчик карандашный, модель РС-20М (при необходимости).

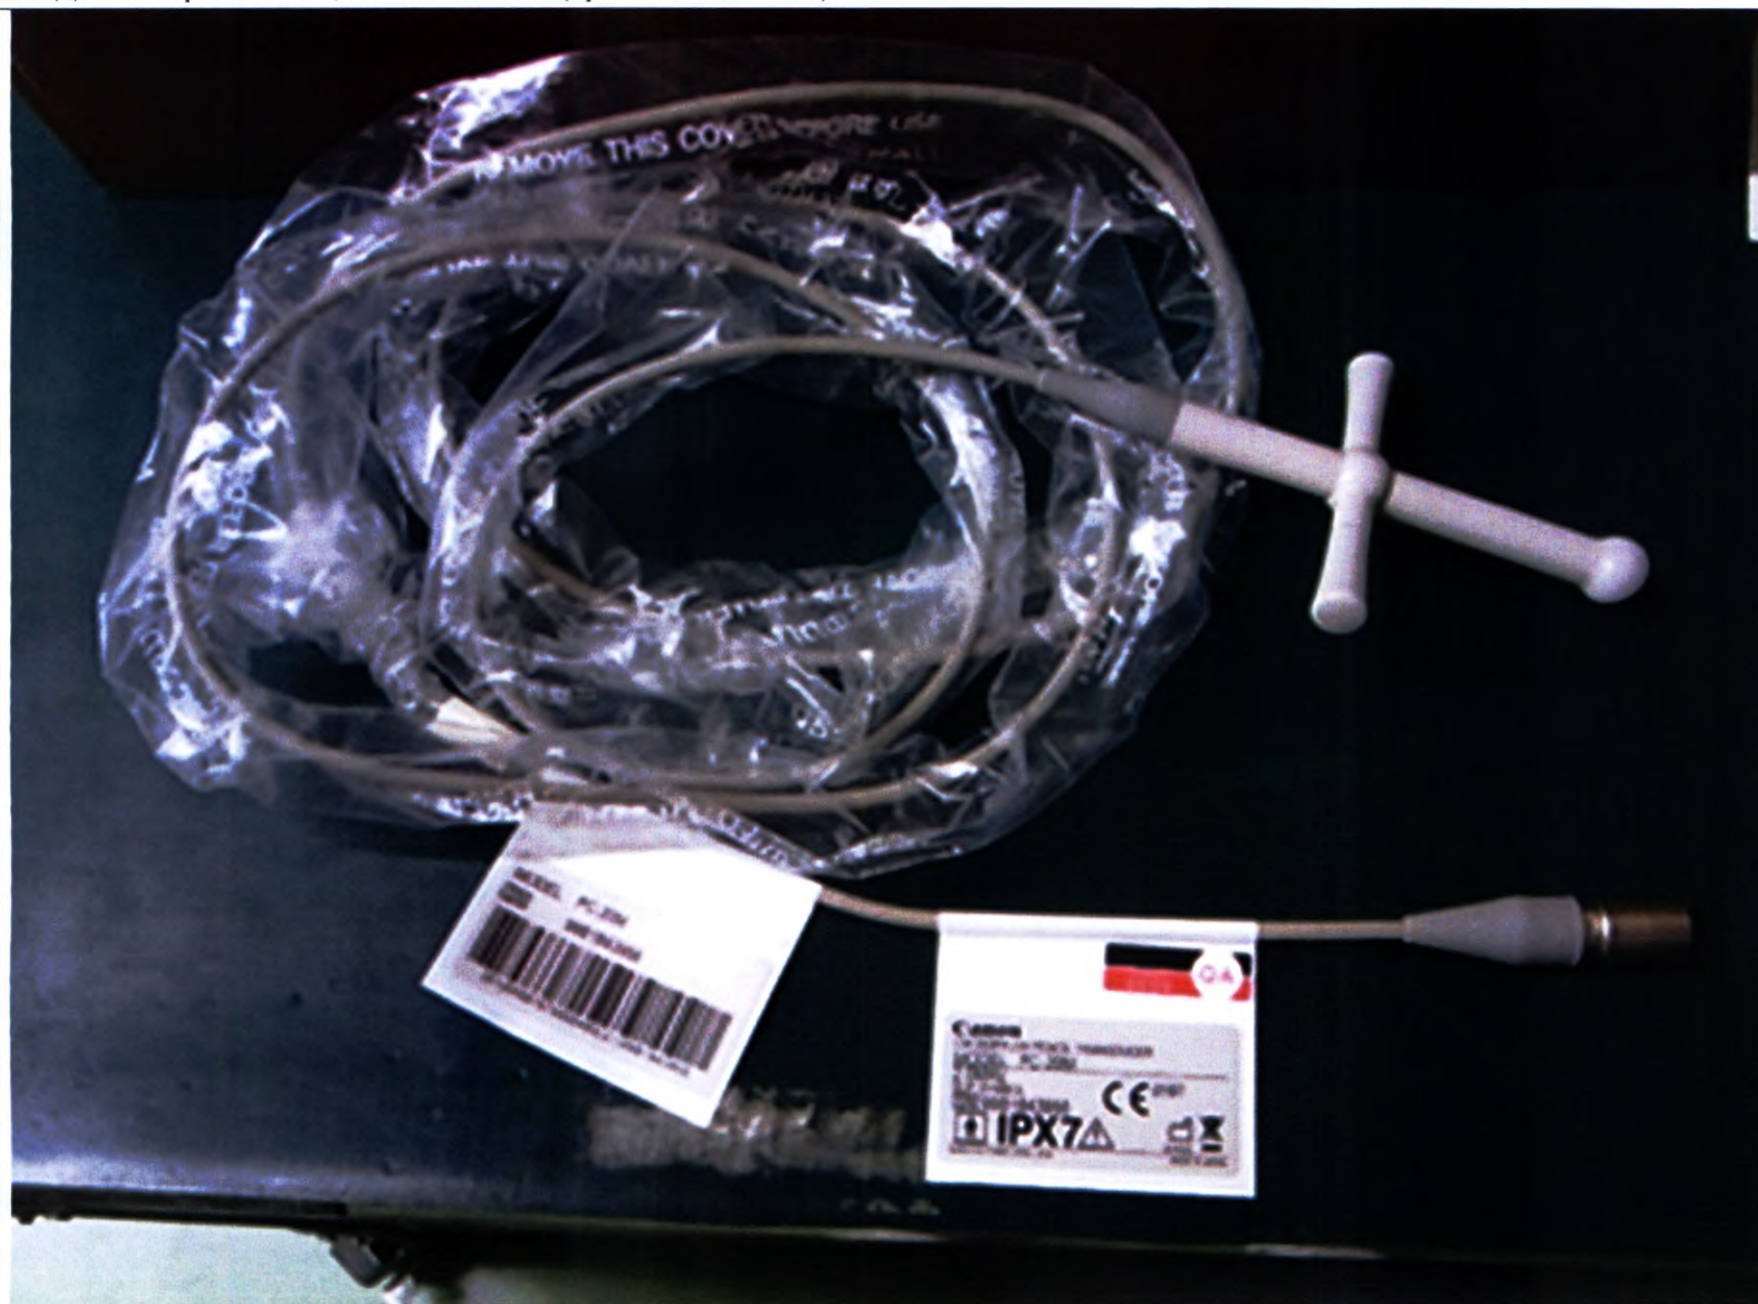


28. Датчик карандашный, модель РС-50М (при необходимости)




28. Датчик карандашный, модель РС-50М (при необходимости)



28. Датчик карандашный, модель РС-50М (при необходимости)

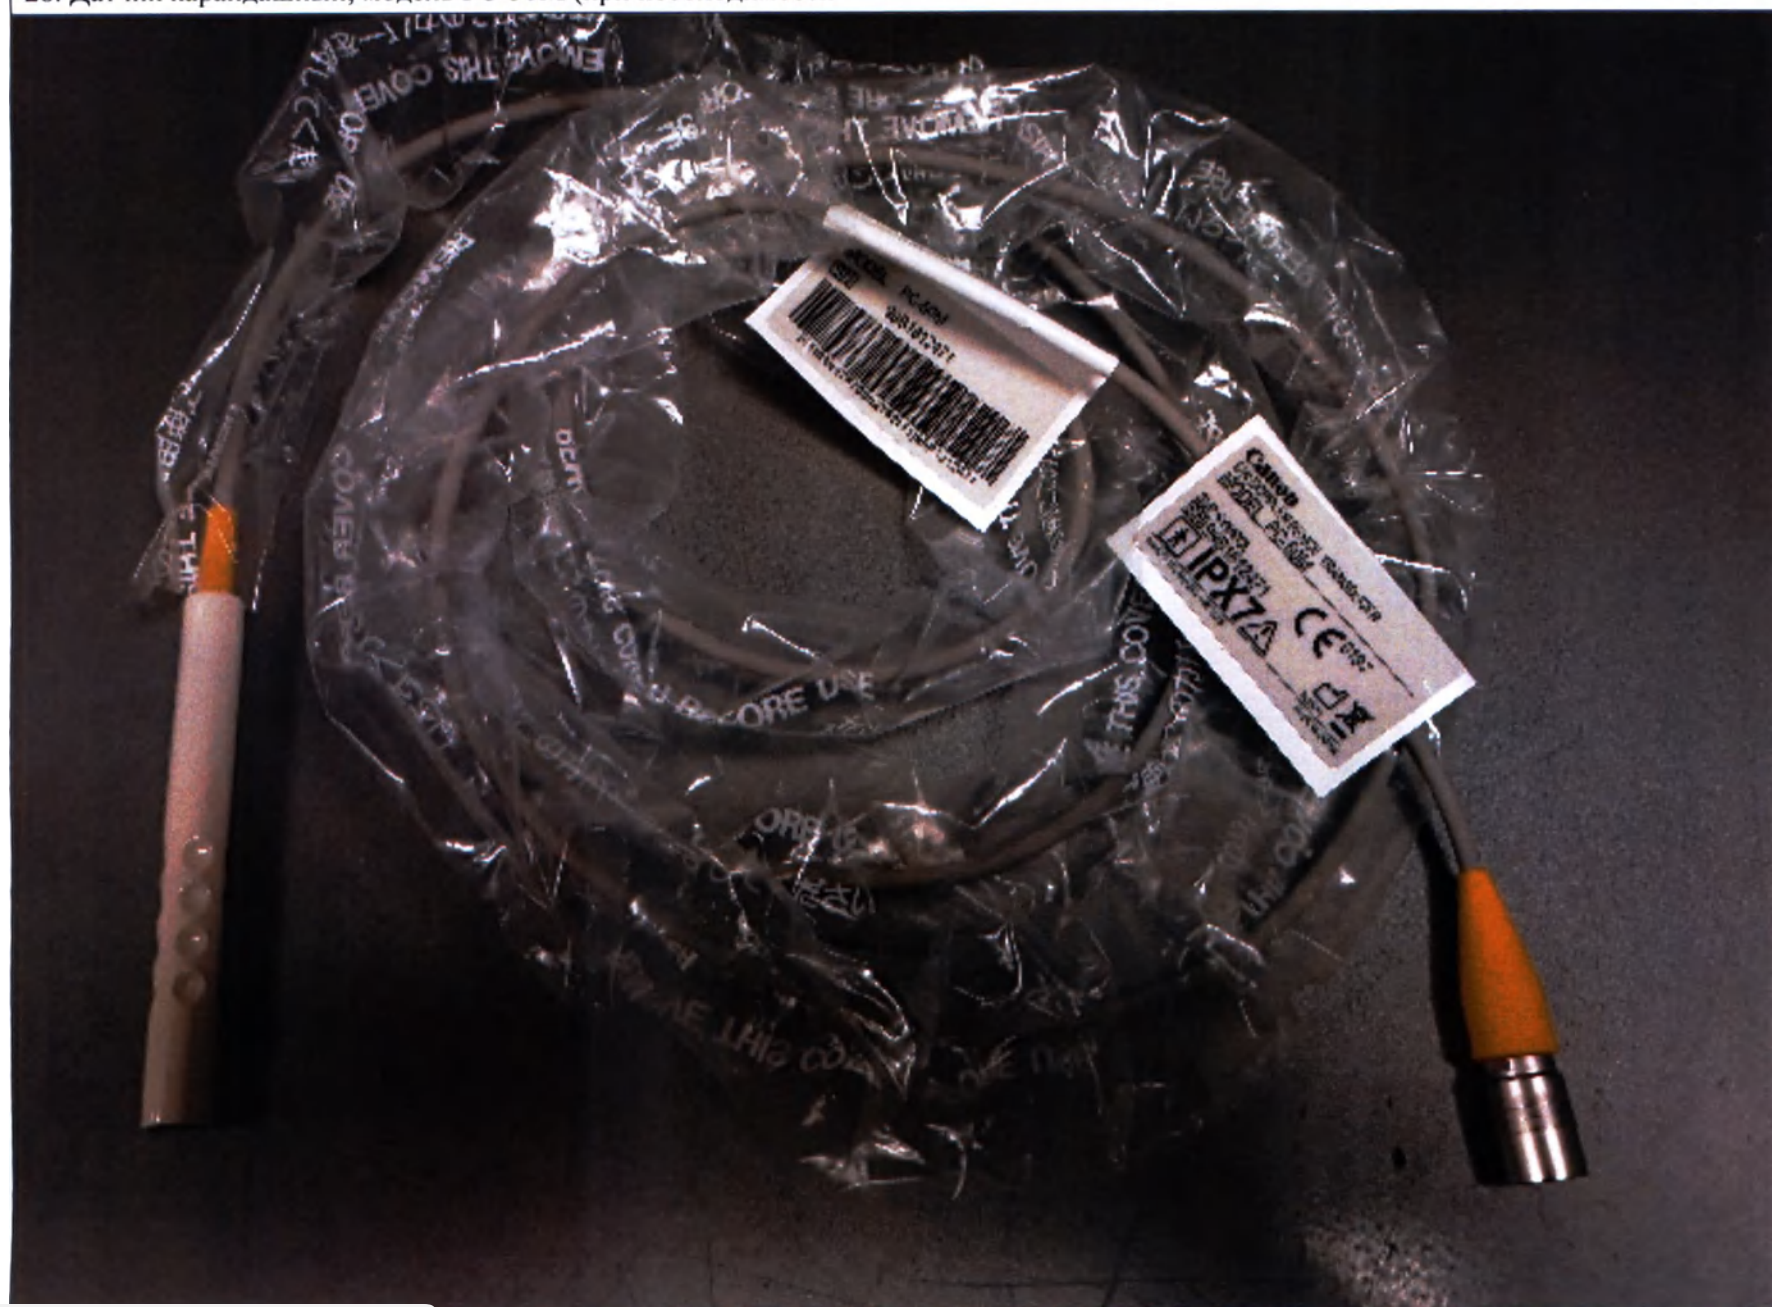

29. Кабель питания.

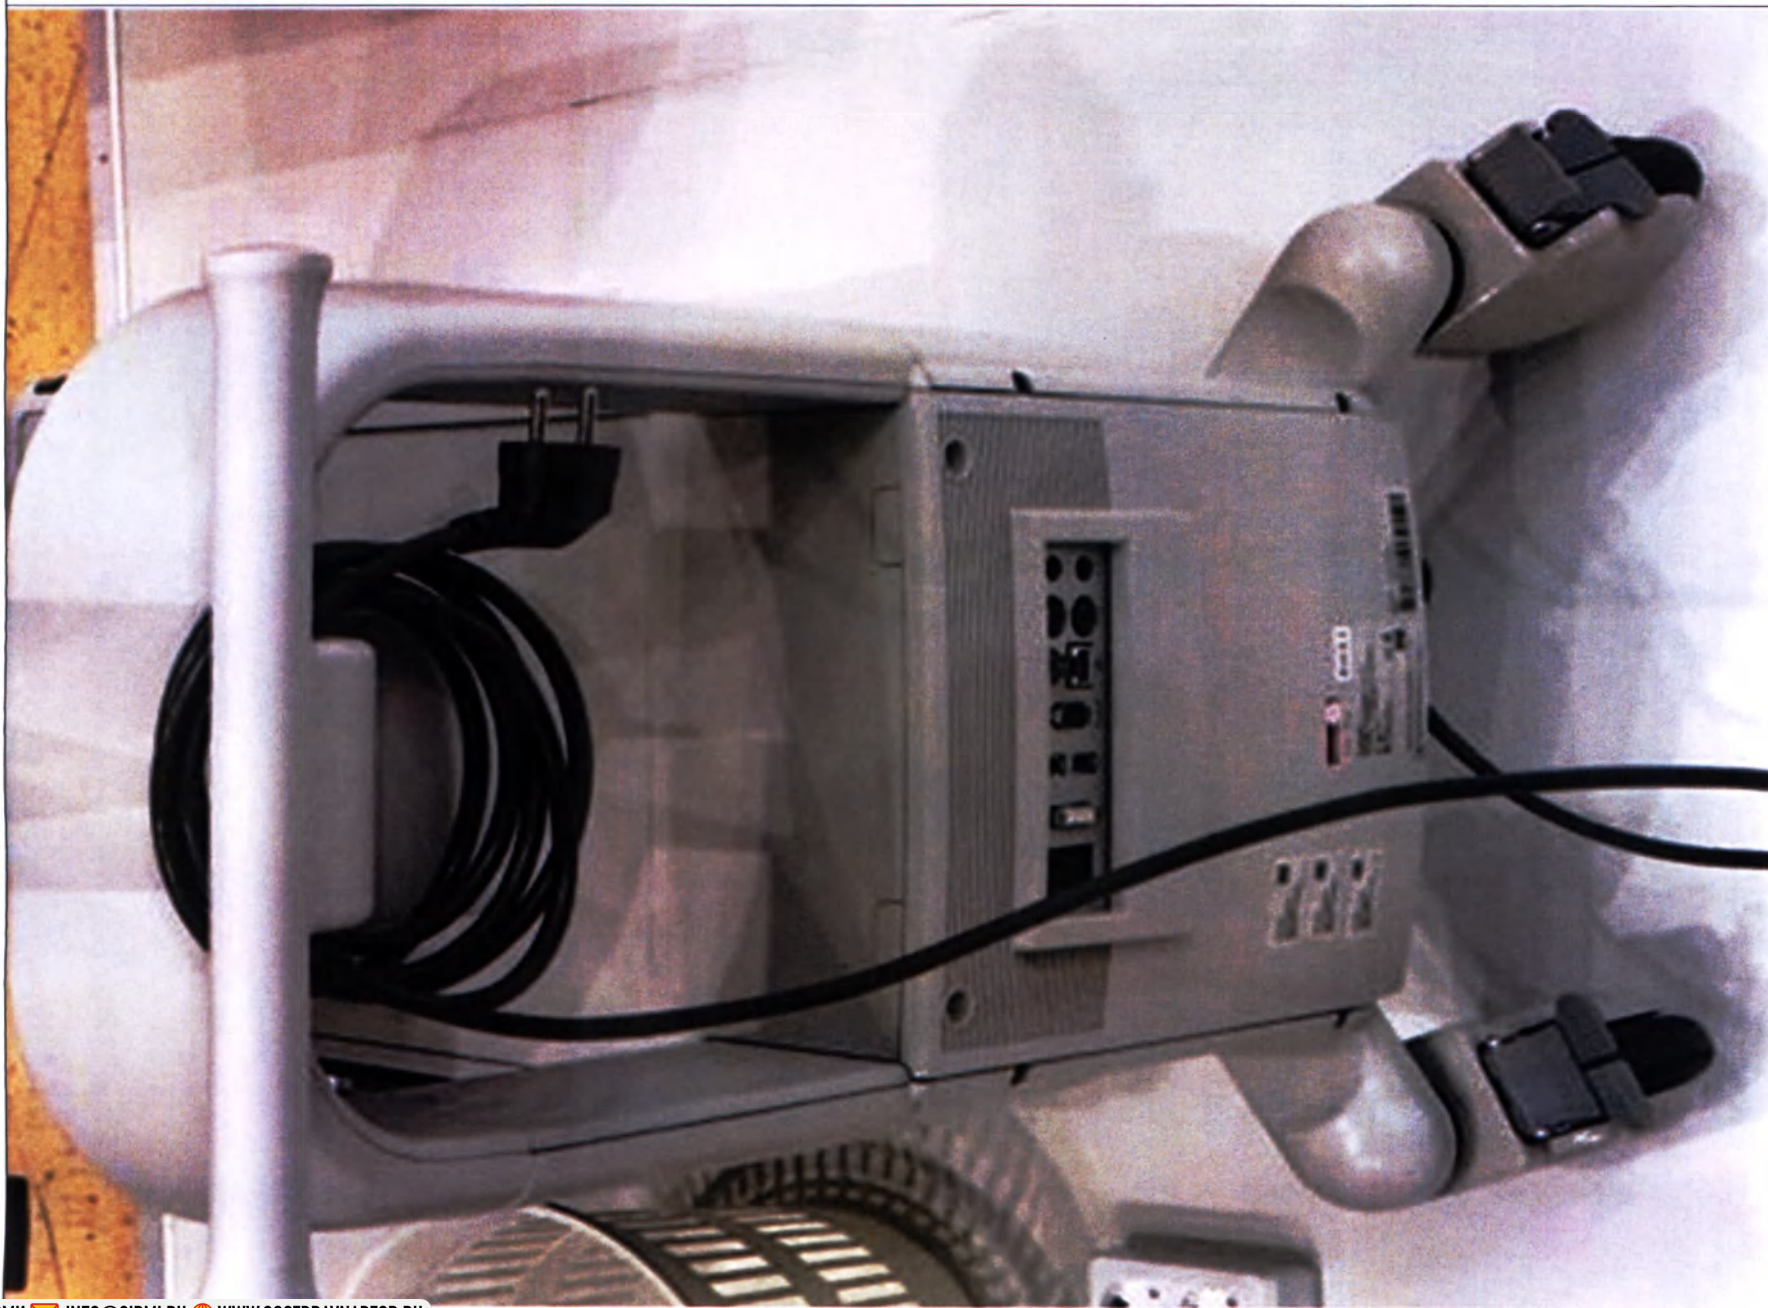

Canon

№ 2B771-390RU

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СИСТЕМЫ

Xario 200

МОДЕЛИ TUS-X200

[ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ]

(2B771-390RU)

ВНИМАНИЕ!

Федеральный закон США разрешает приобретение и использование этого устройства только врачом или по предписанию врача.

ВАЖНО!

Перед работой с оборудованием изучите и усвойте настоящее руководство. После прочтения держите руководство в легкодоступном месте.

CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION


©CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION 2018

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ


Выпущено: 2018-10

30. Эксплуатационная документация на бумажном и/или электронном носителе.


Принадлежности: 1. Модуль постоянно-волнового доплера (CW).

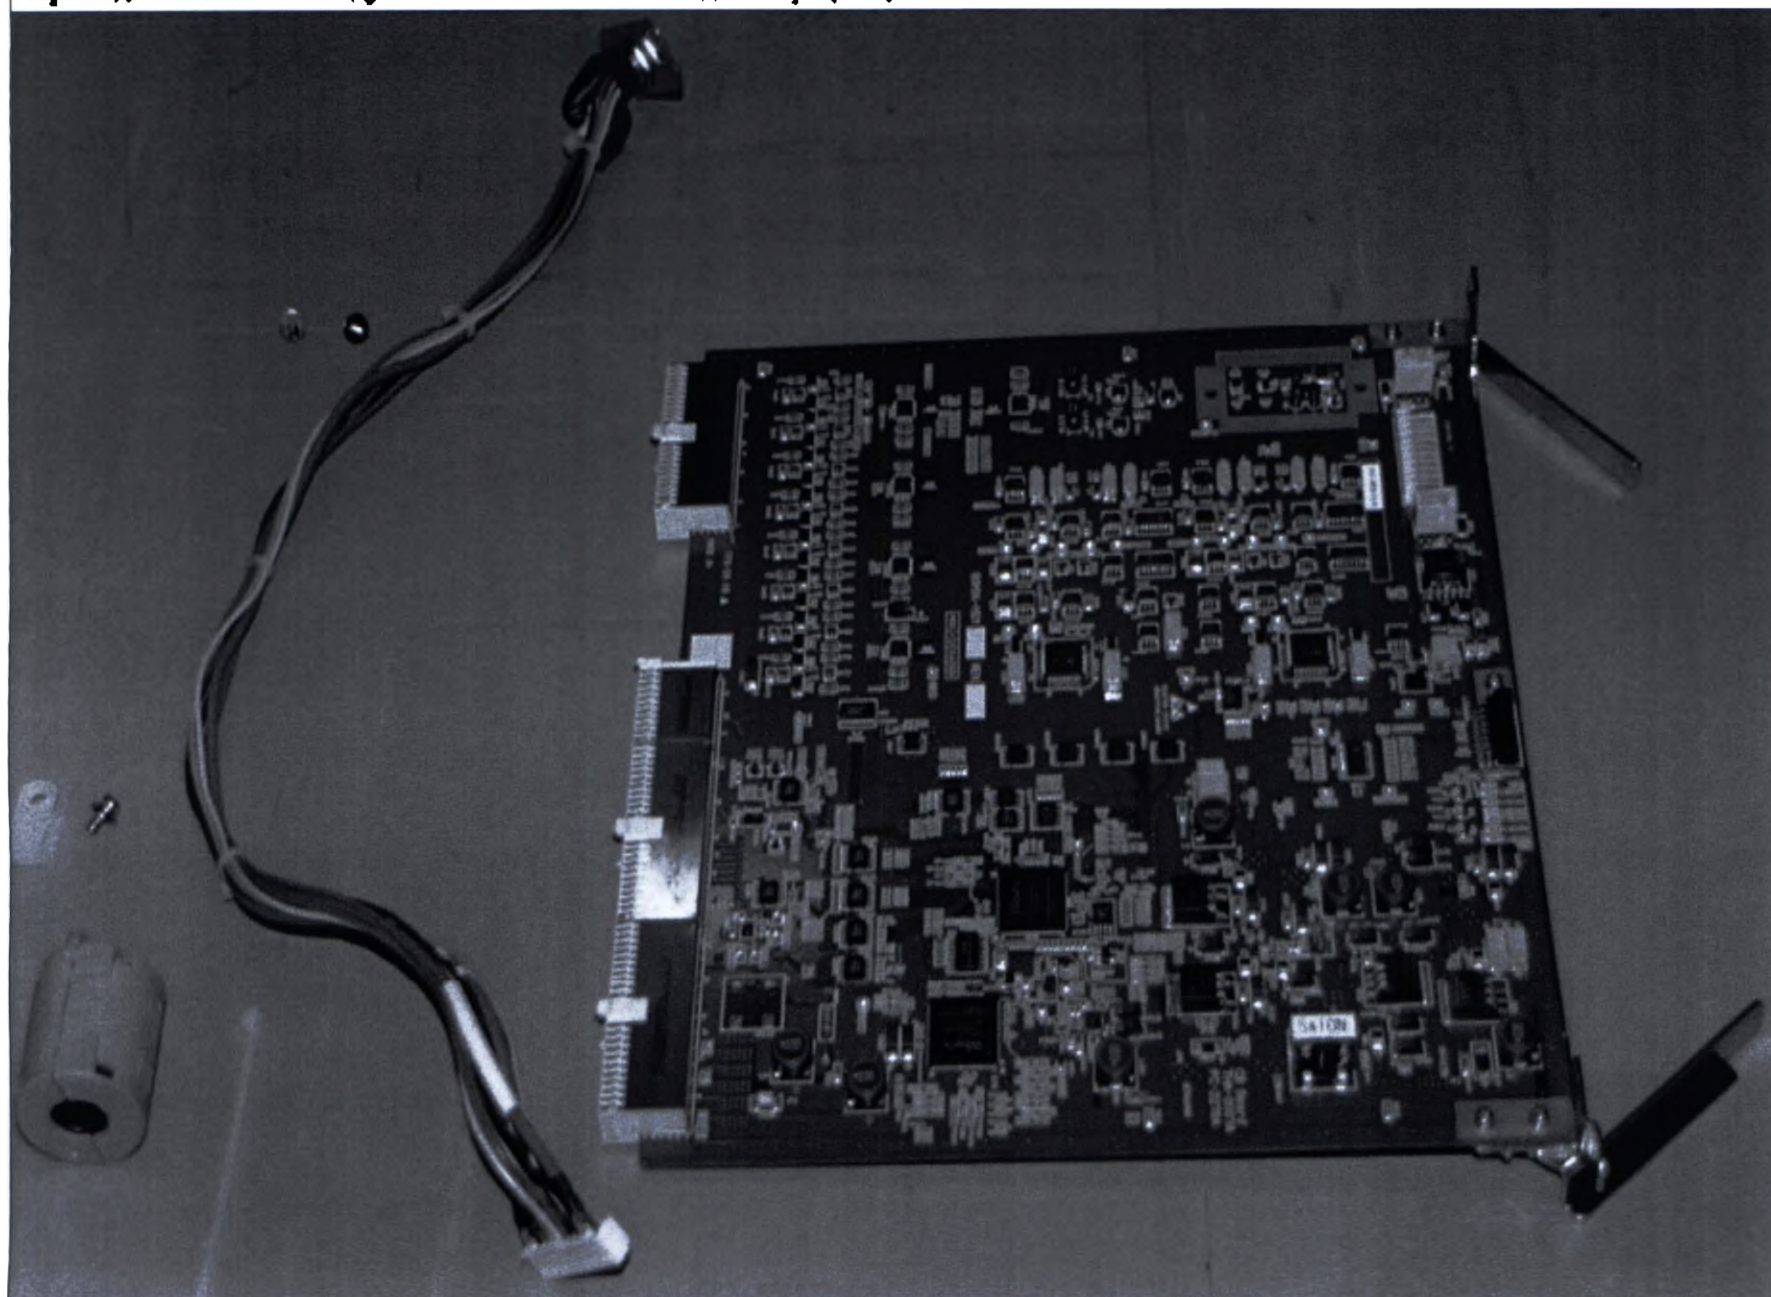


2.Модуль 4D.

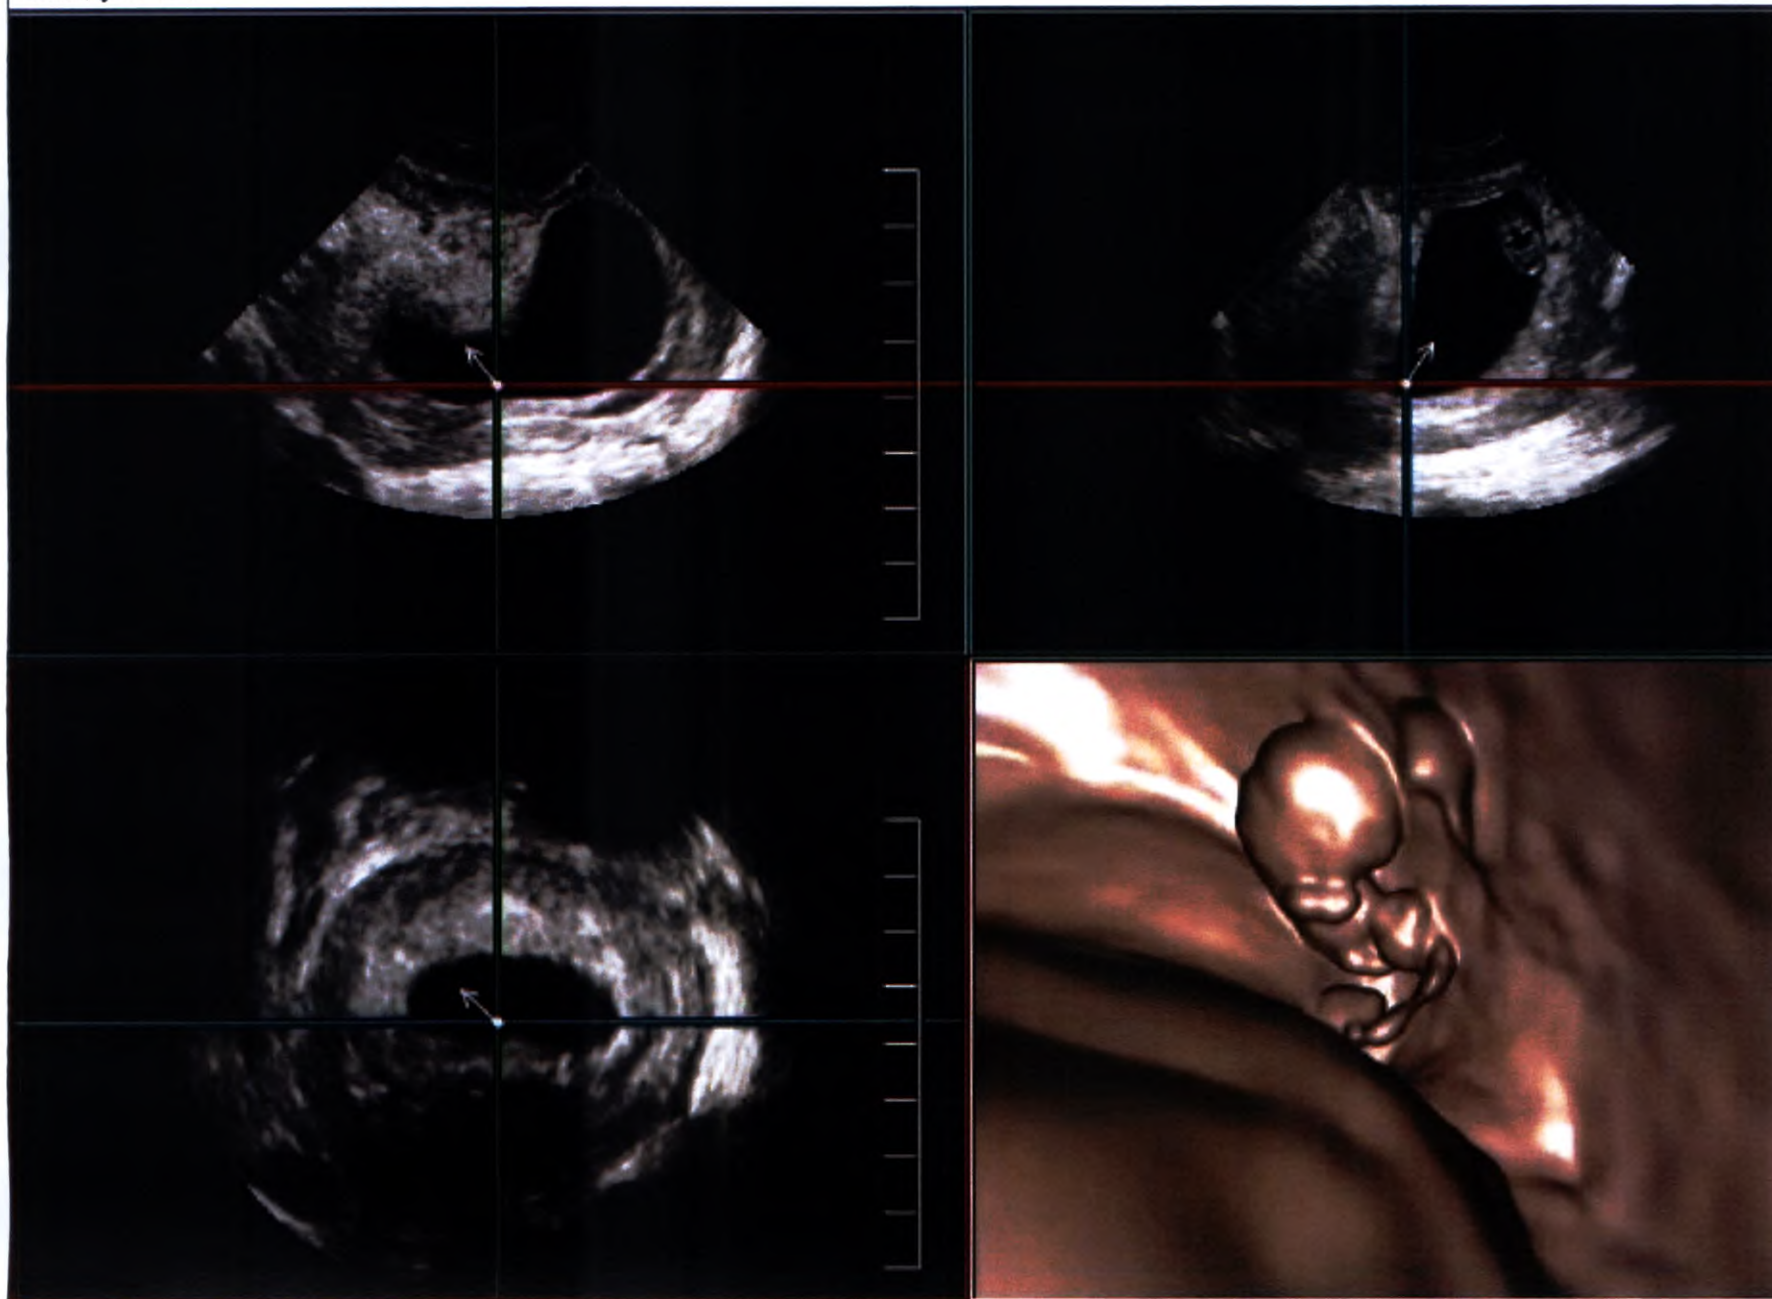


3.Модуль референсного сигнала.

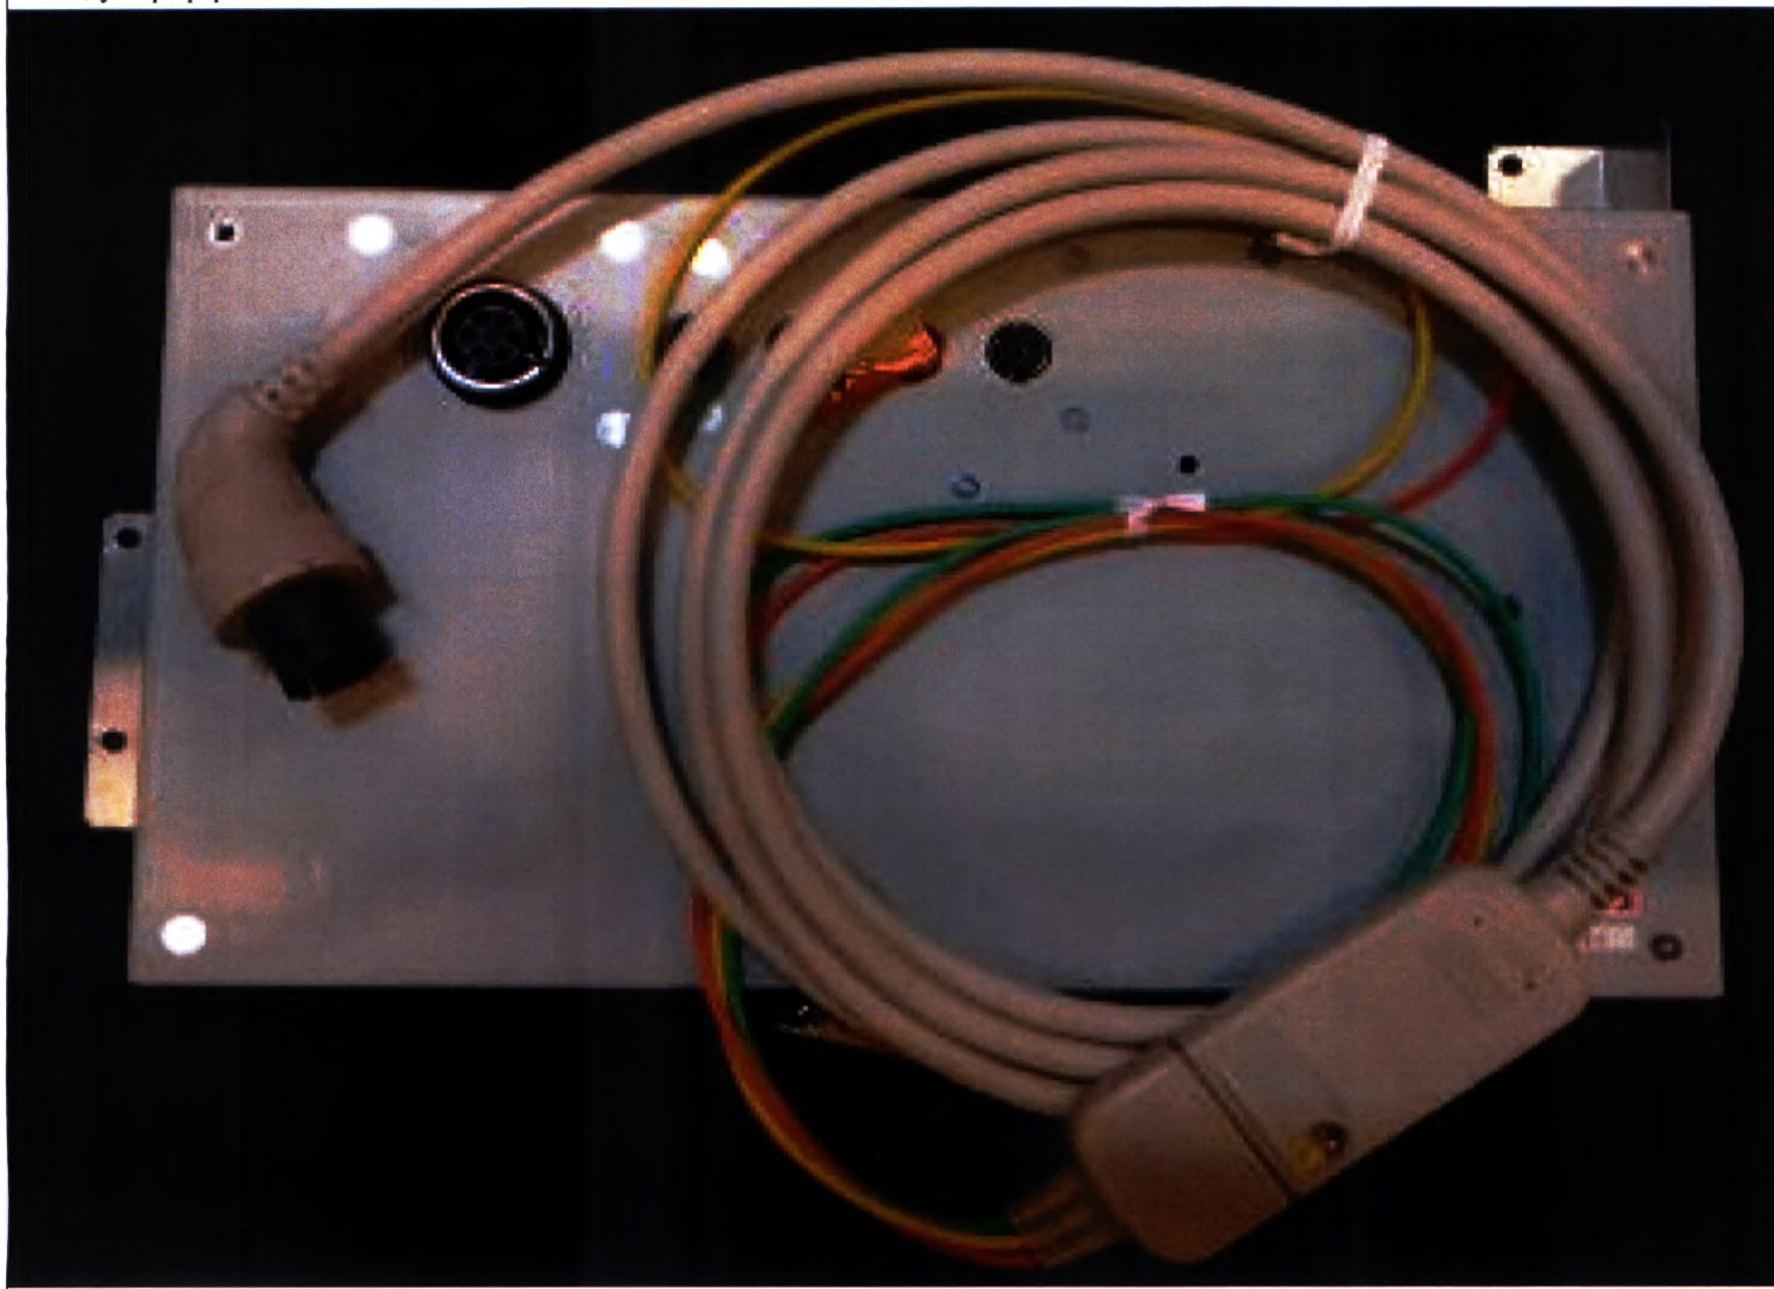


4. Модуль для создания сдвиговой волны

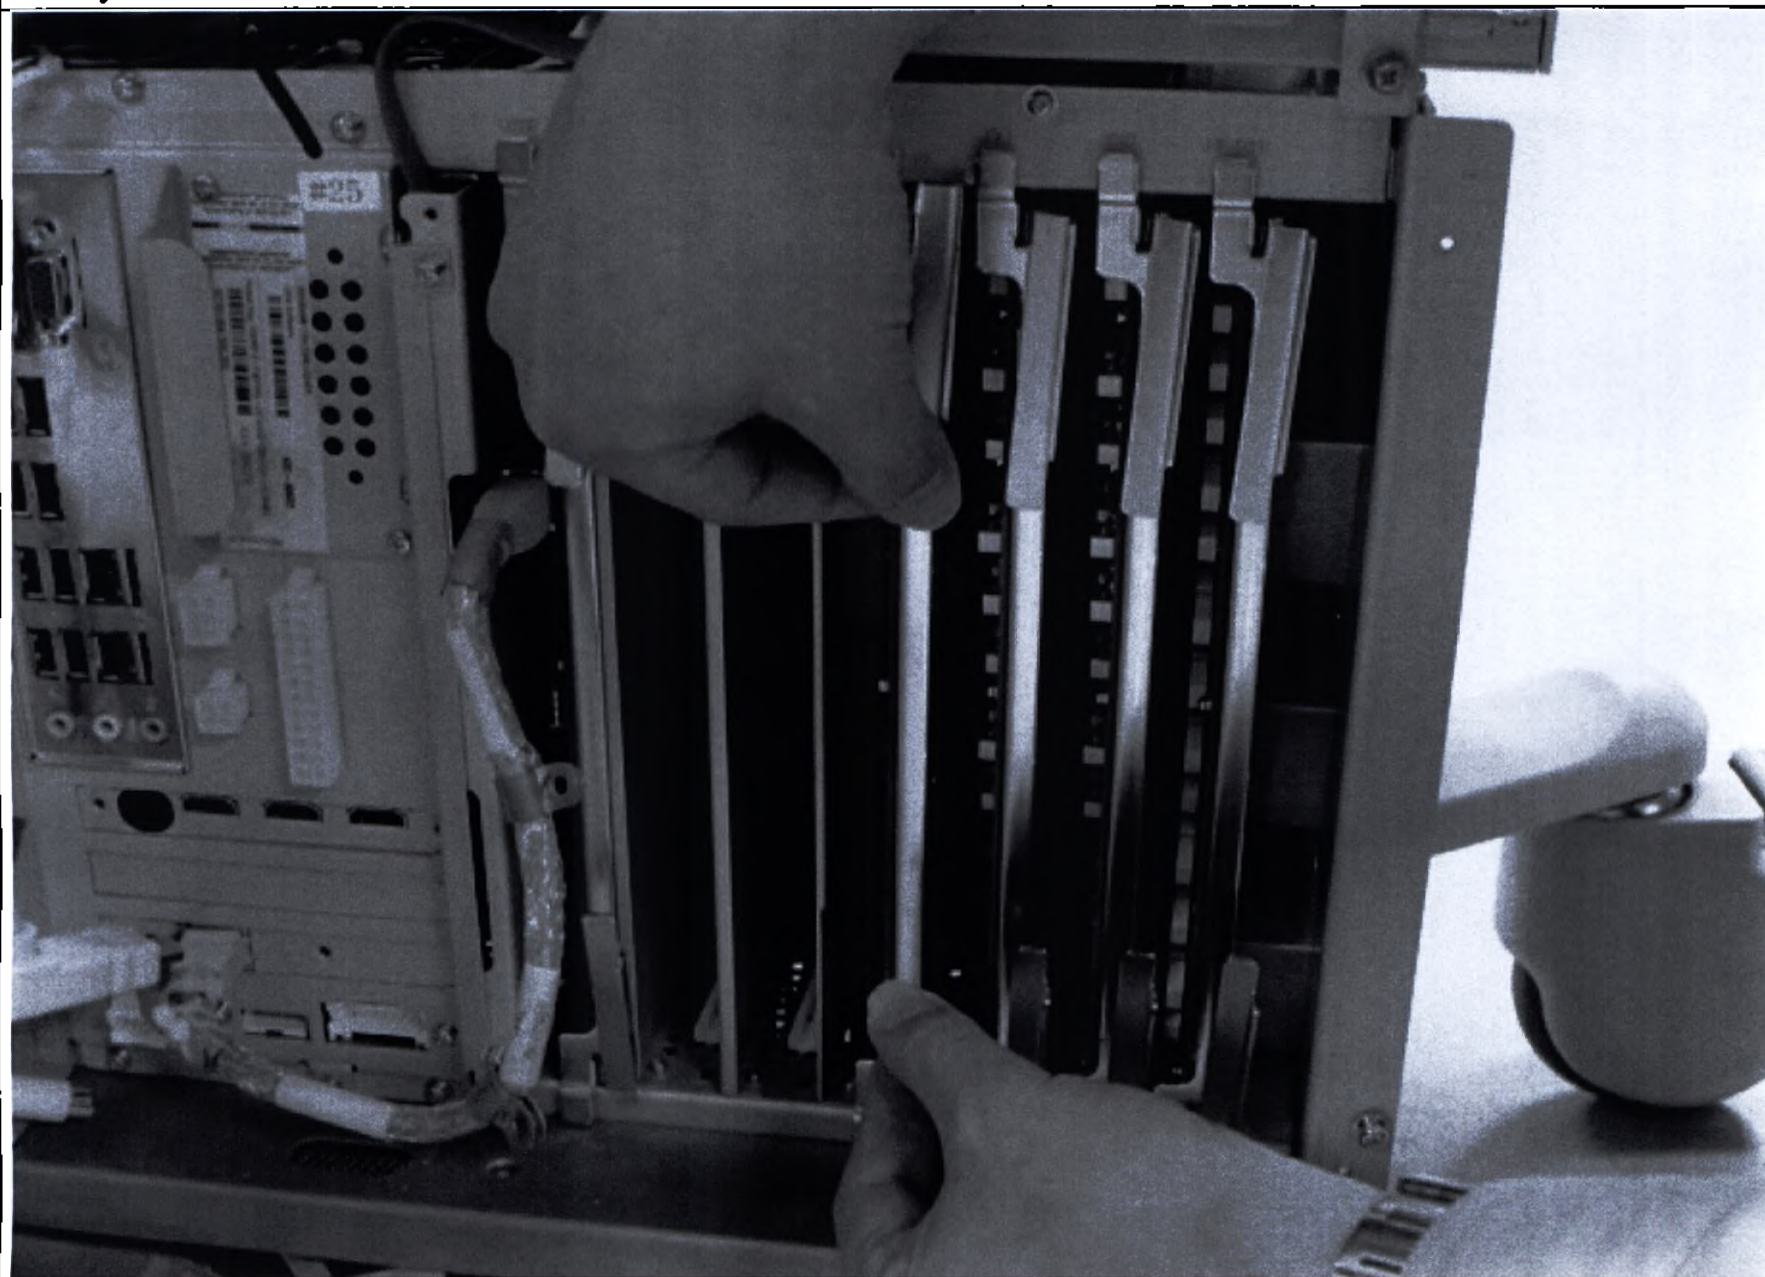


5. Модуль поддержки русского языка.

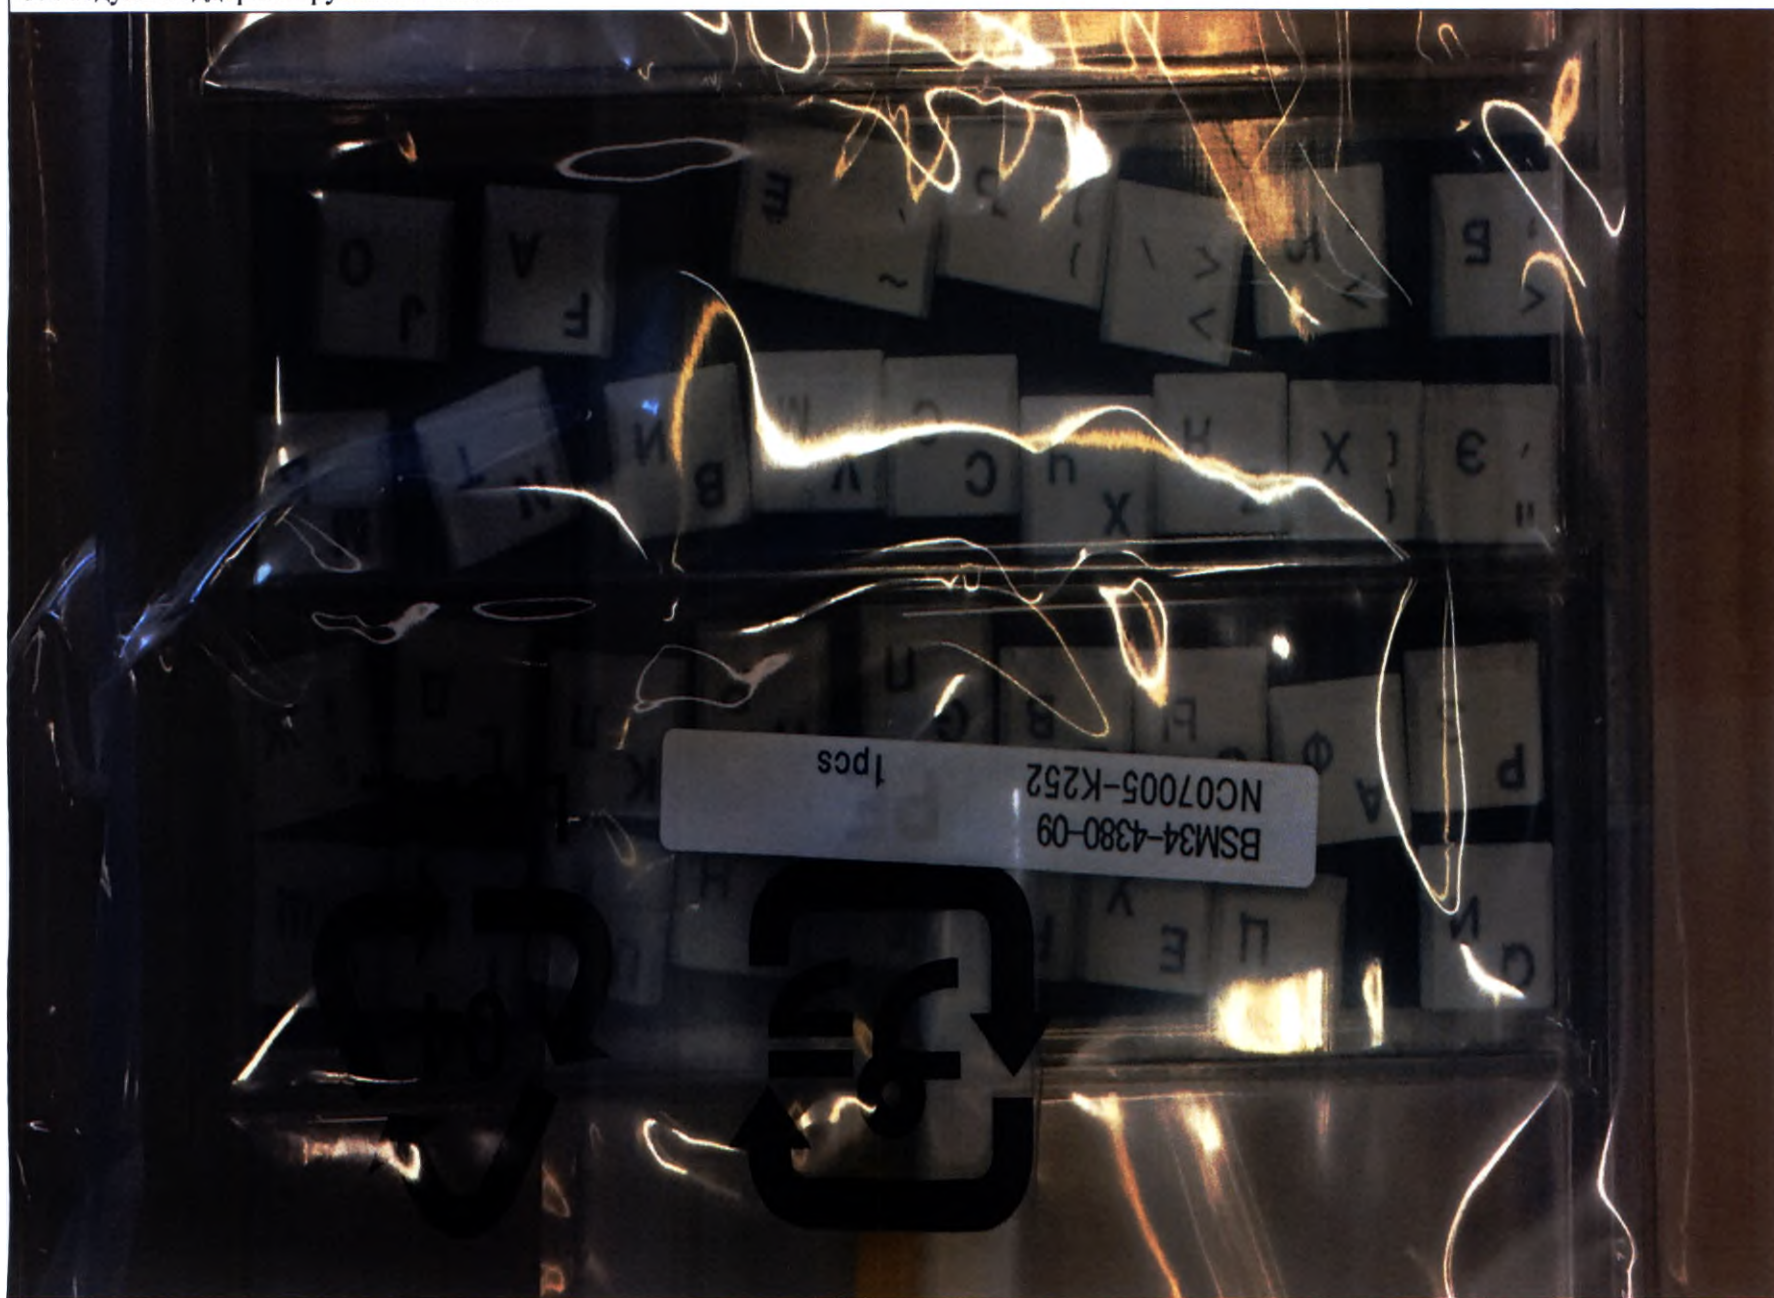


6. Программное приложение для исследования с контрастами (CHI).

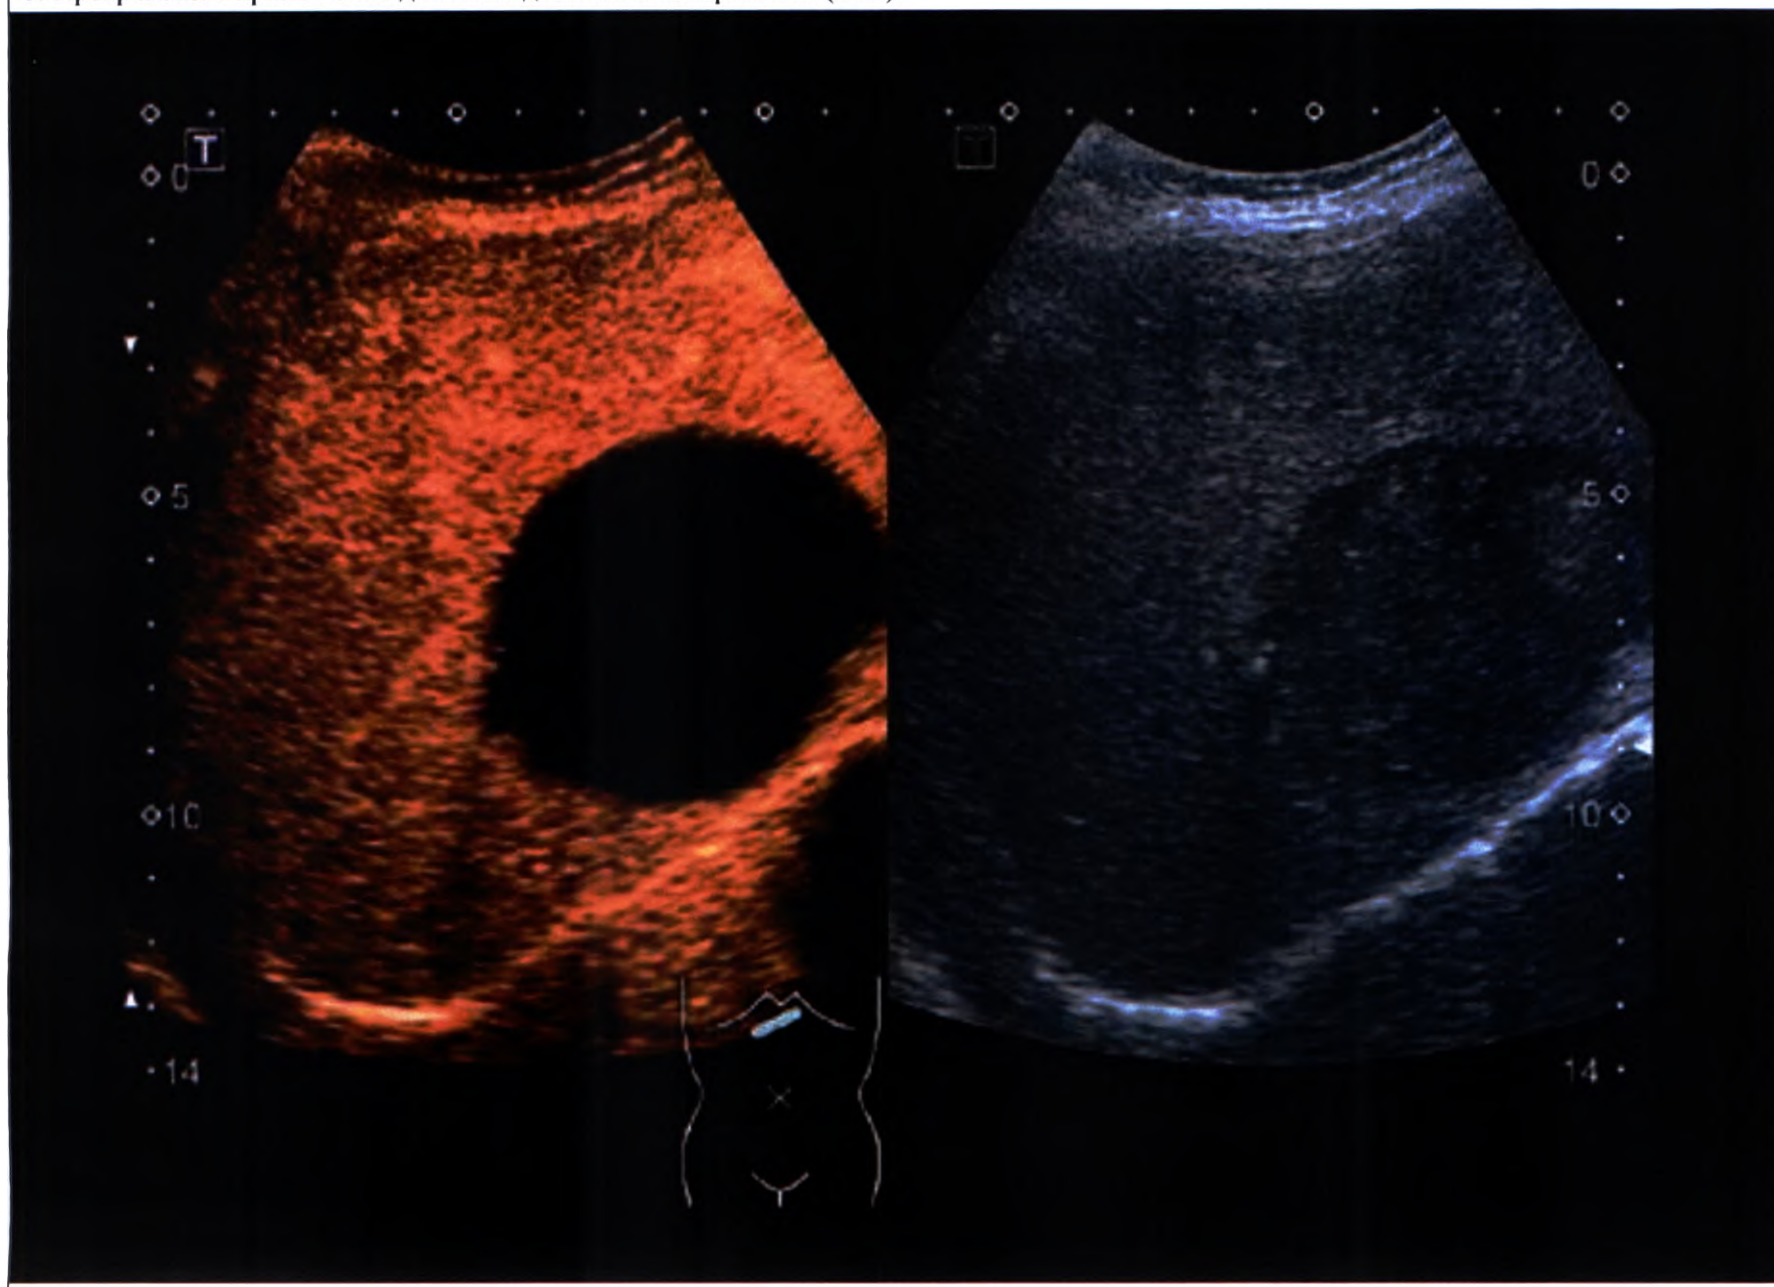

7. Программное приложения для панорамной реконструкции изображения (Panoramic View).

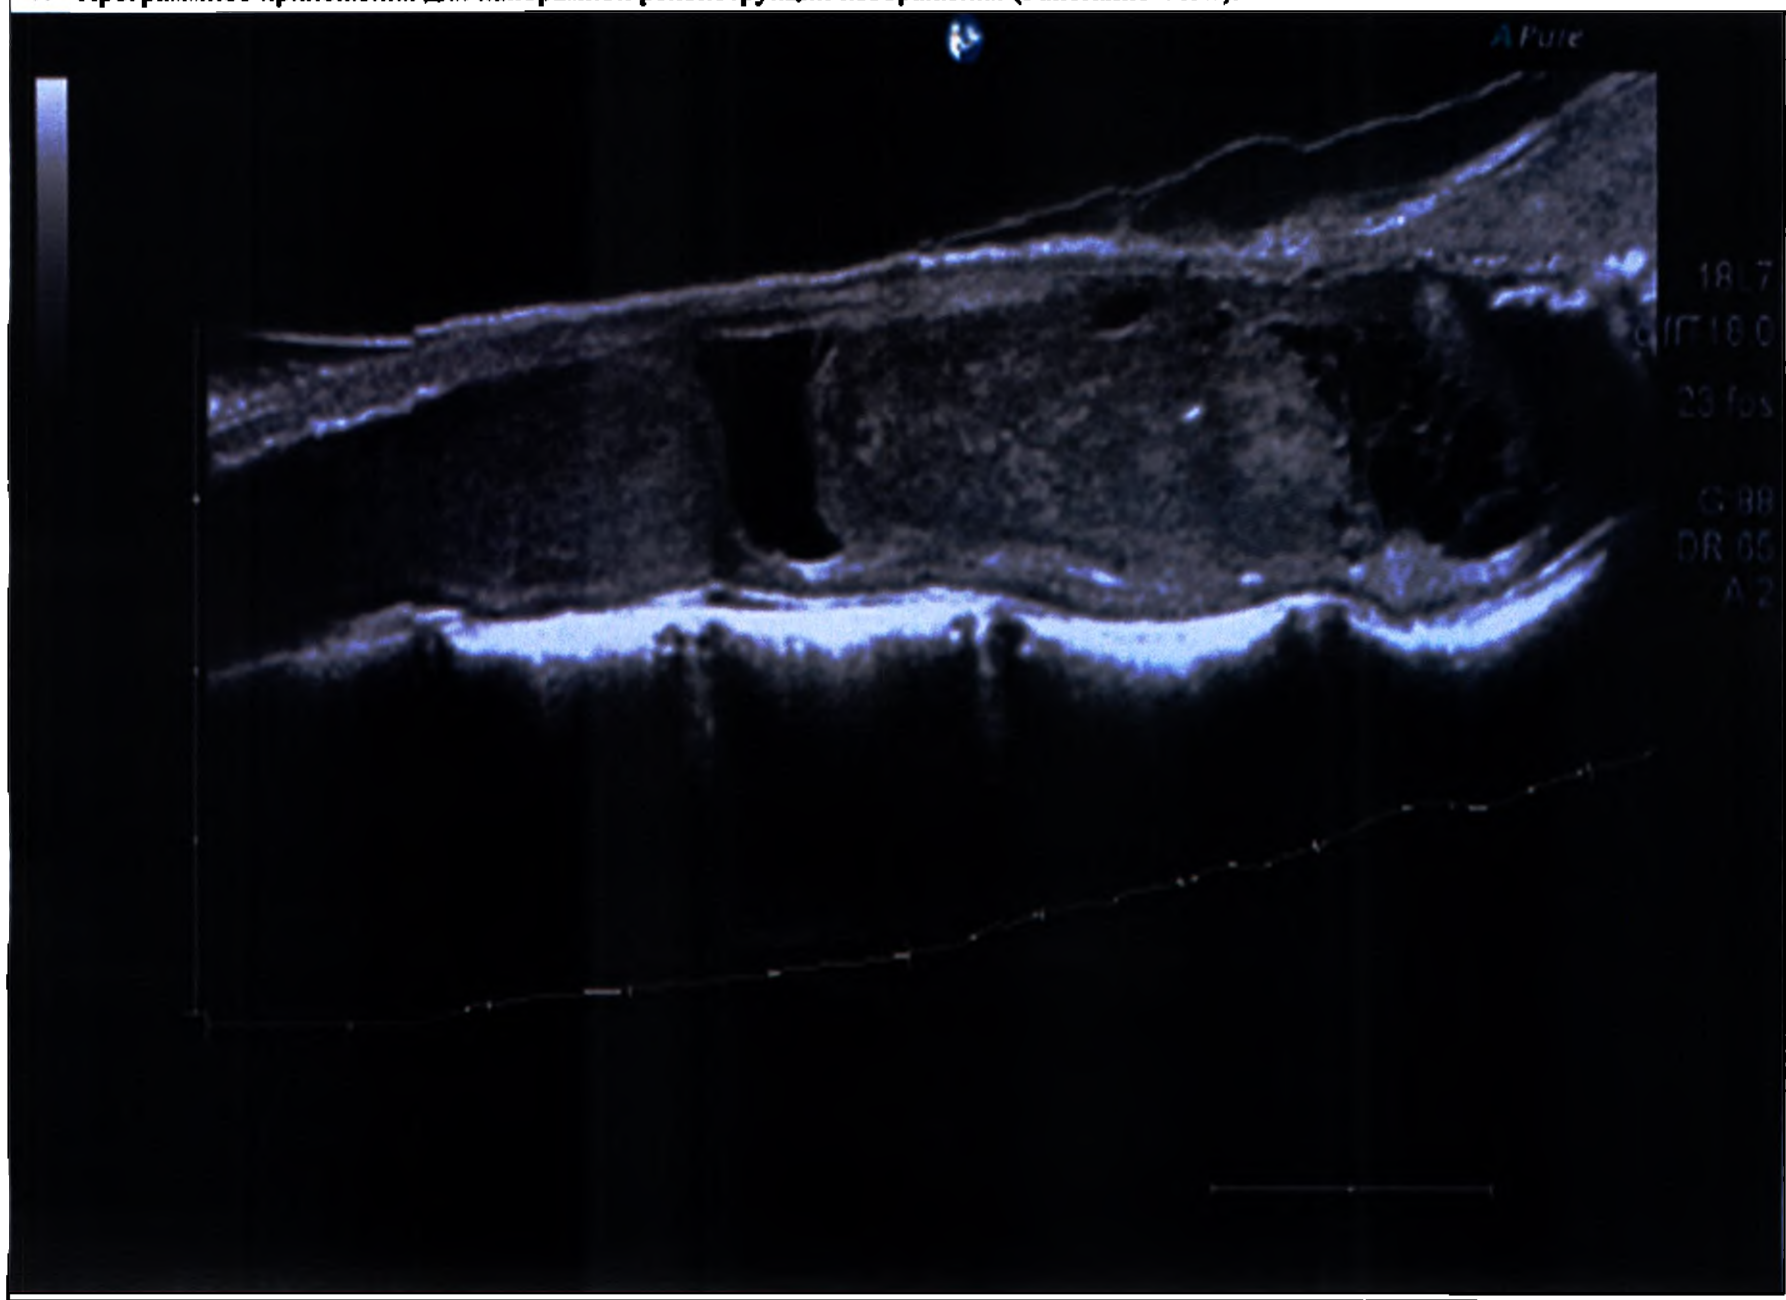

8. Программное приложение для стресс-эхокардиографии (Stress Echo).

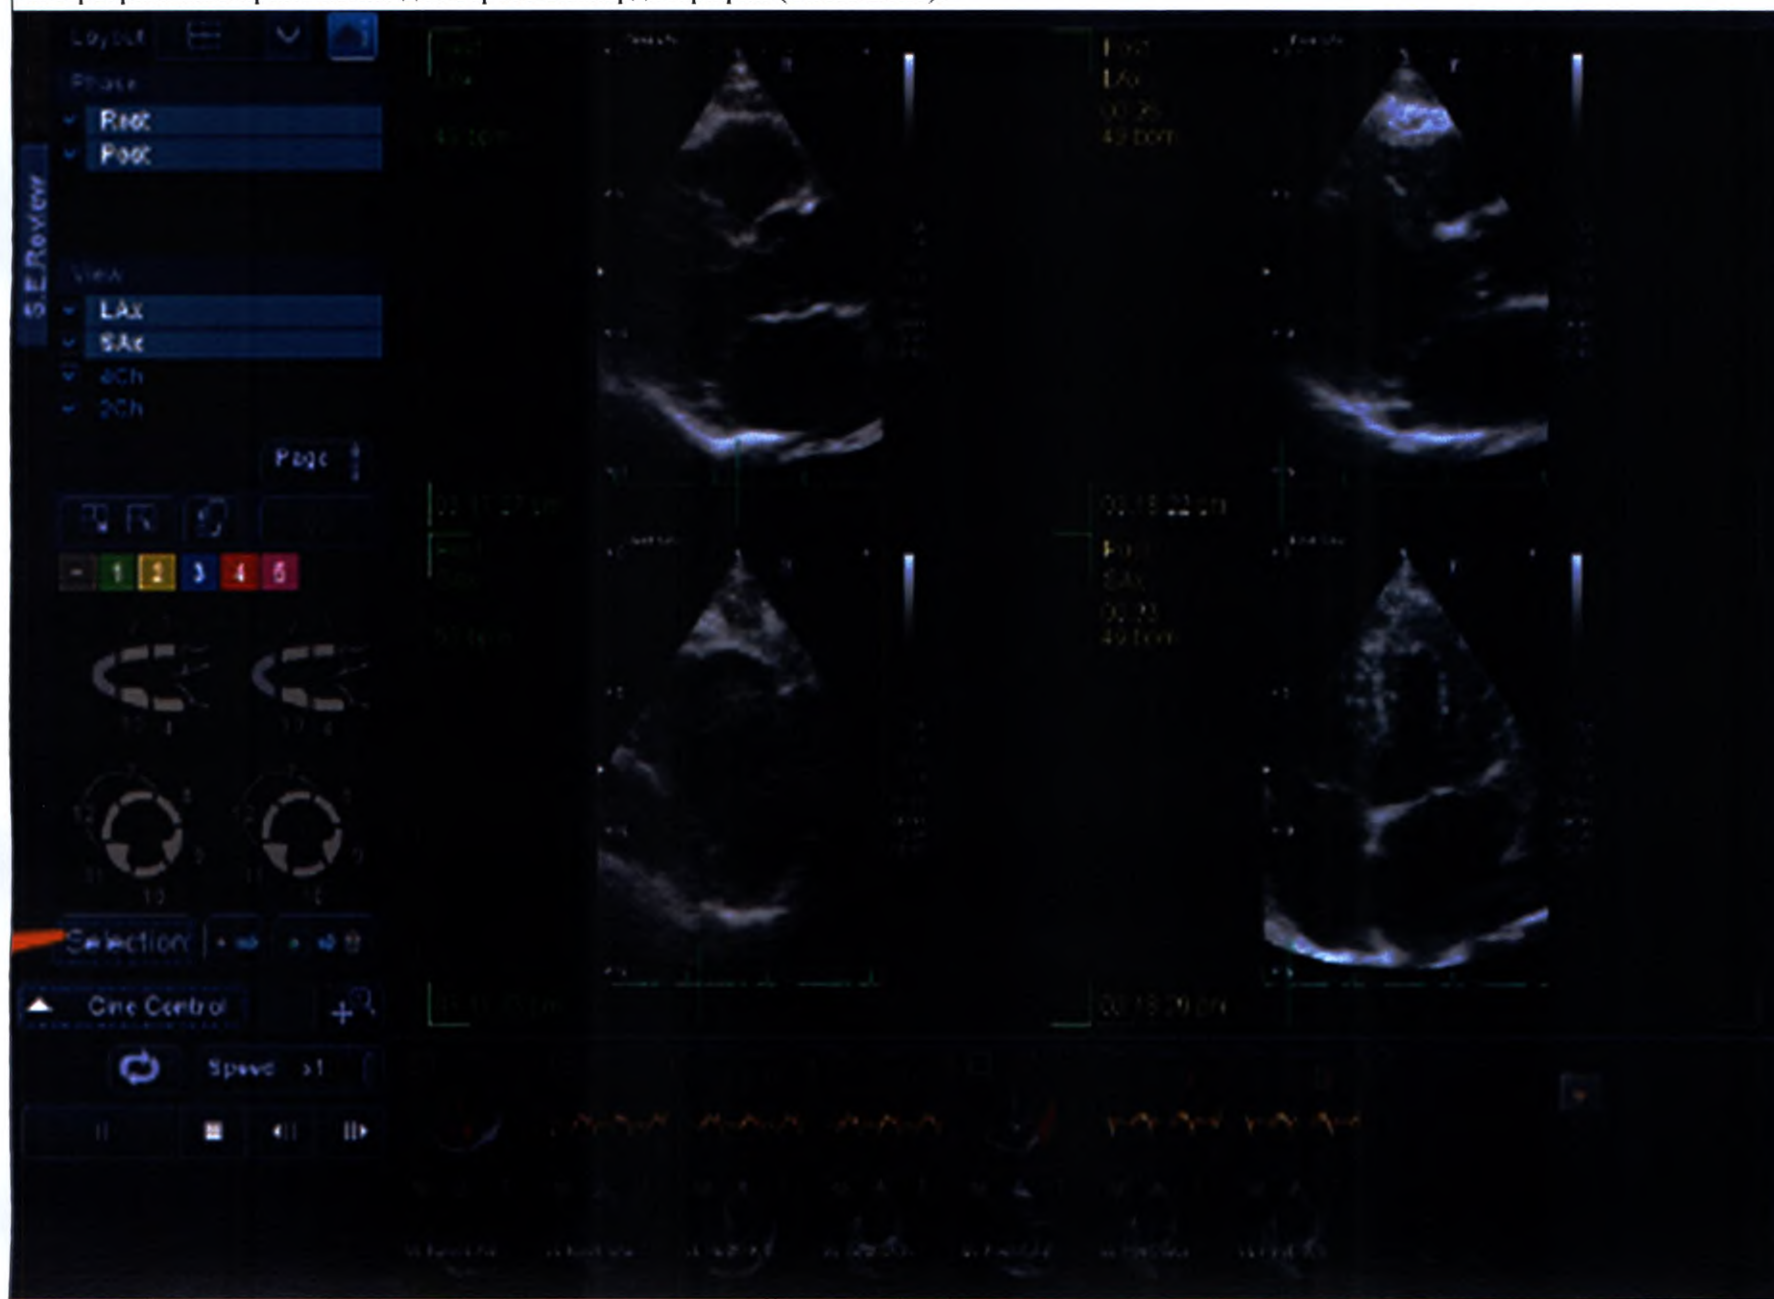


9. Программное приложение для поддержки стандарта DICOM



10. Программное приложение для дифференцированной тканевой гармонии (D-THI).




11. Программное приложение для улучшенного динамического потока (Dynamic Flow).

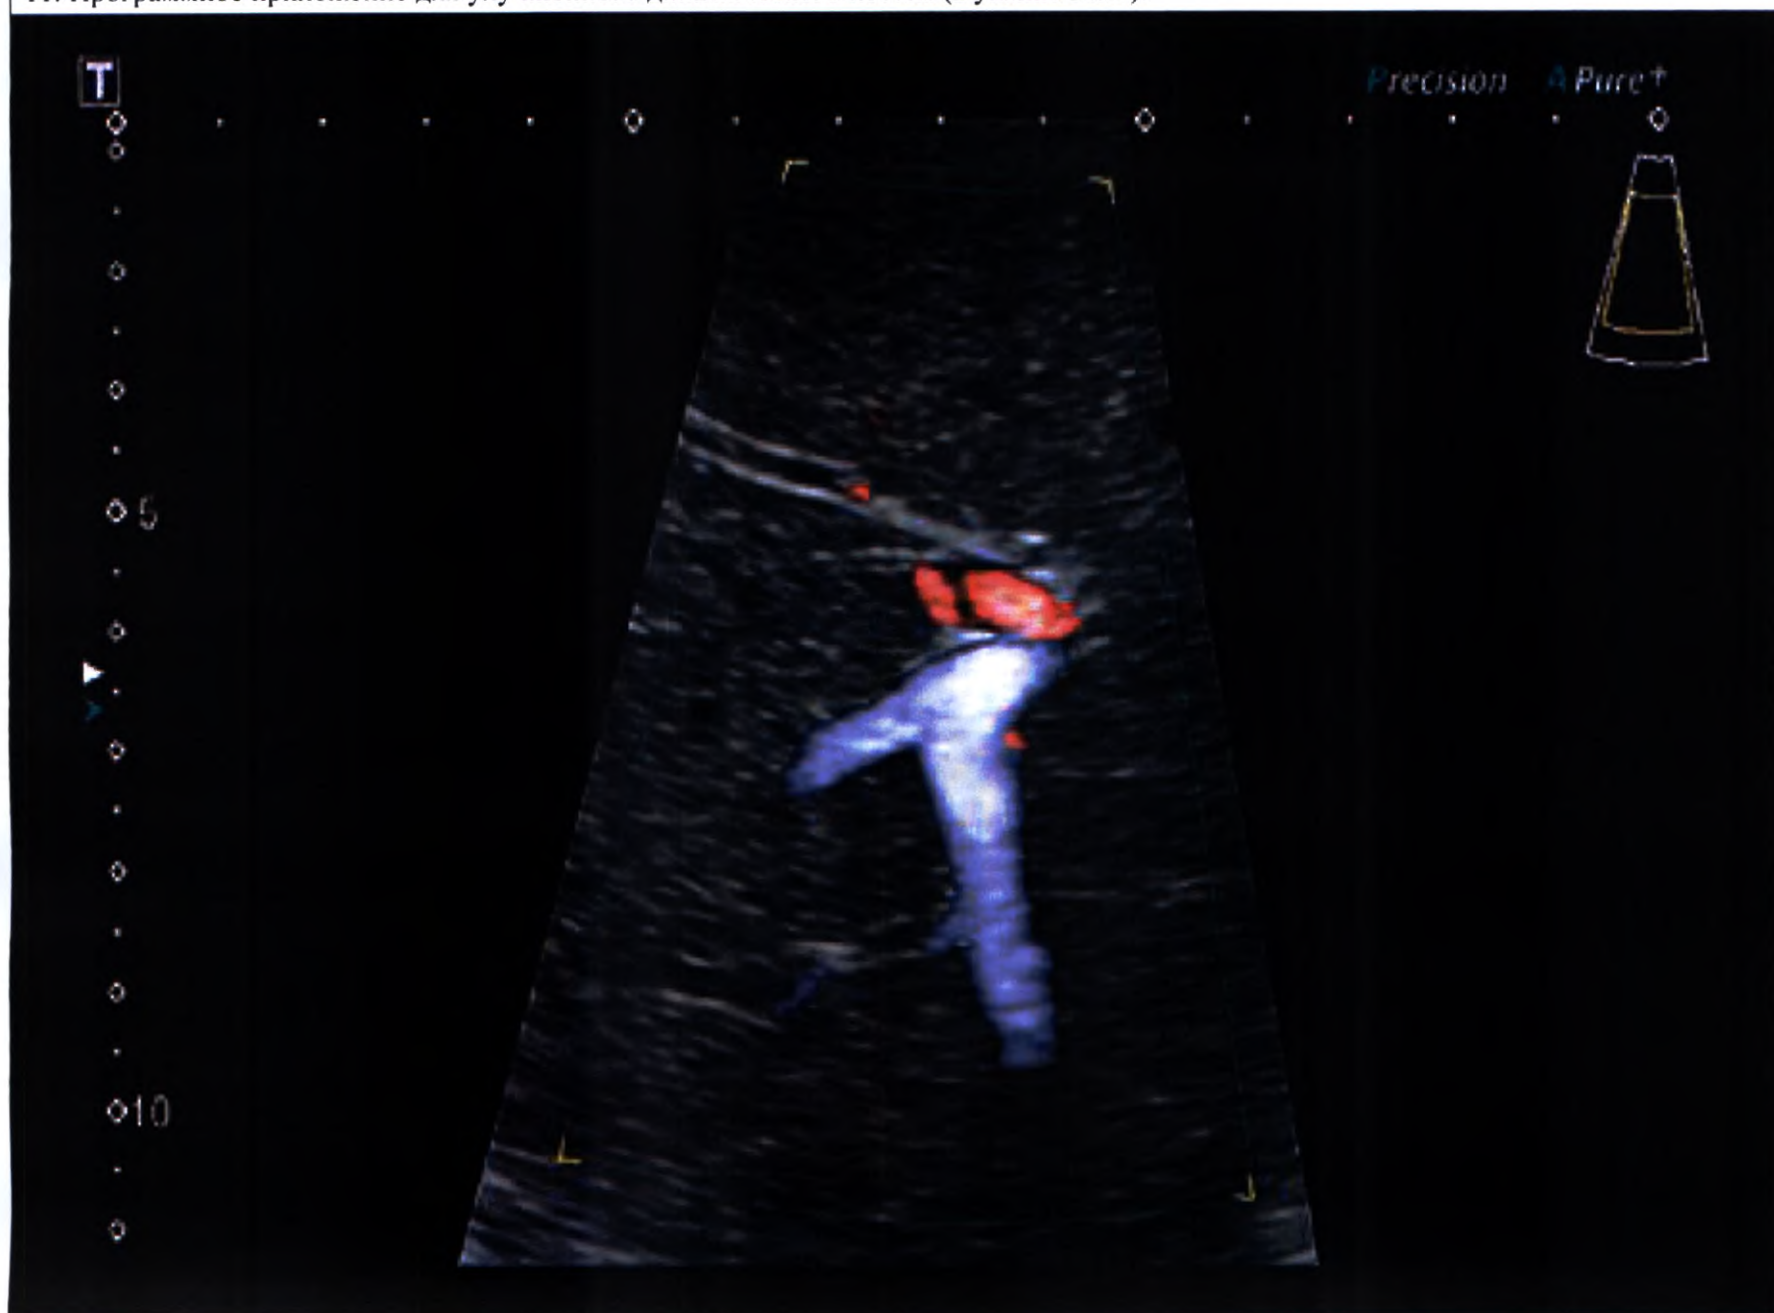


12. Программное приложение для формирования протокола исследования (Protocol Assistant).




13. Программное приложение для эластографии.

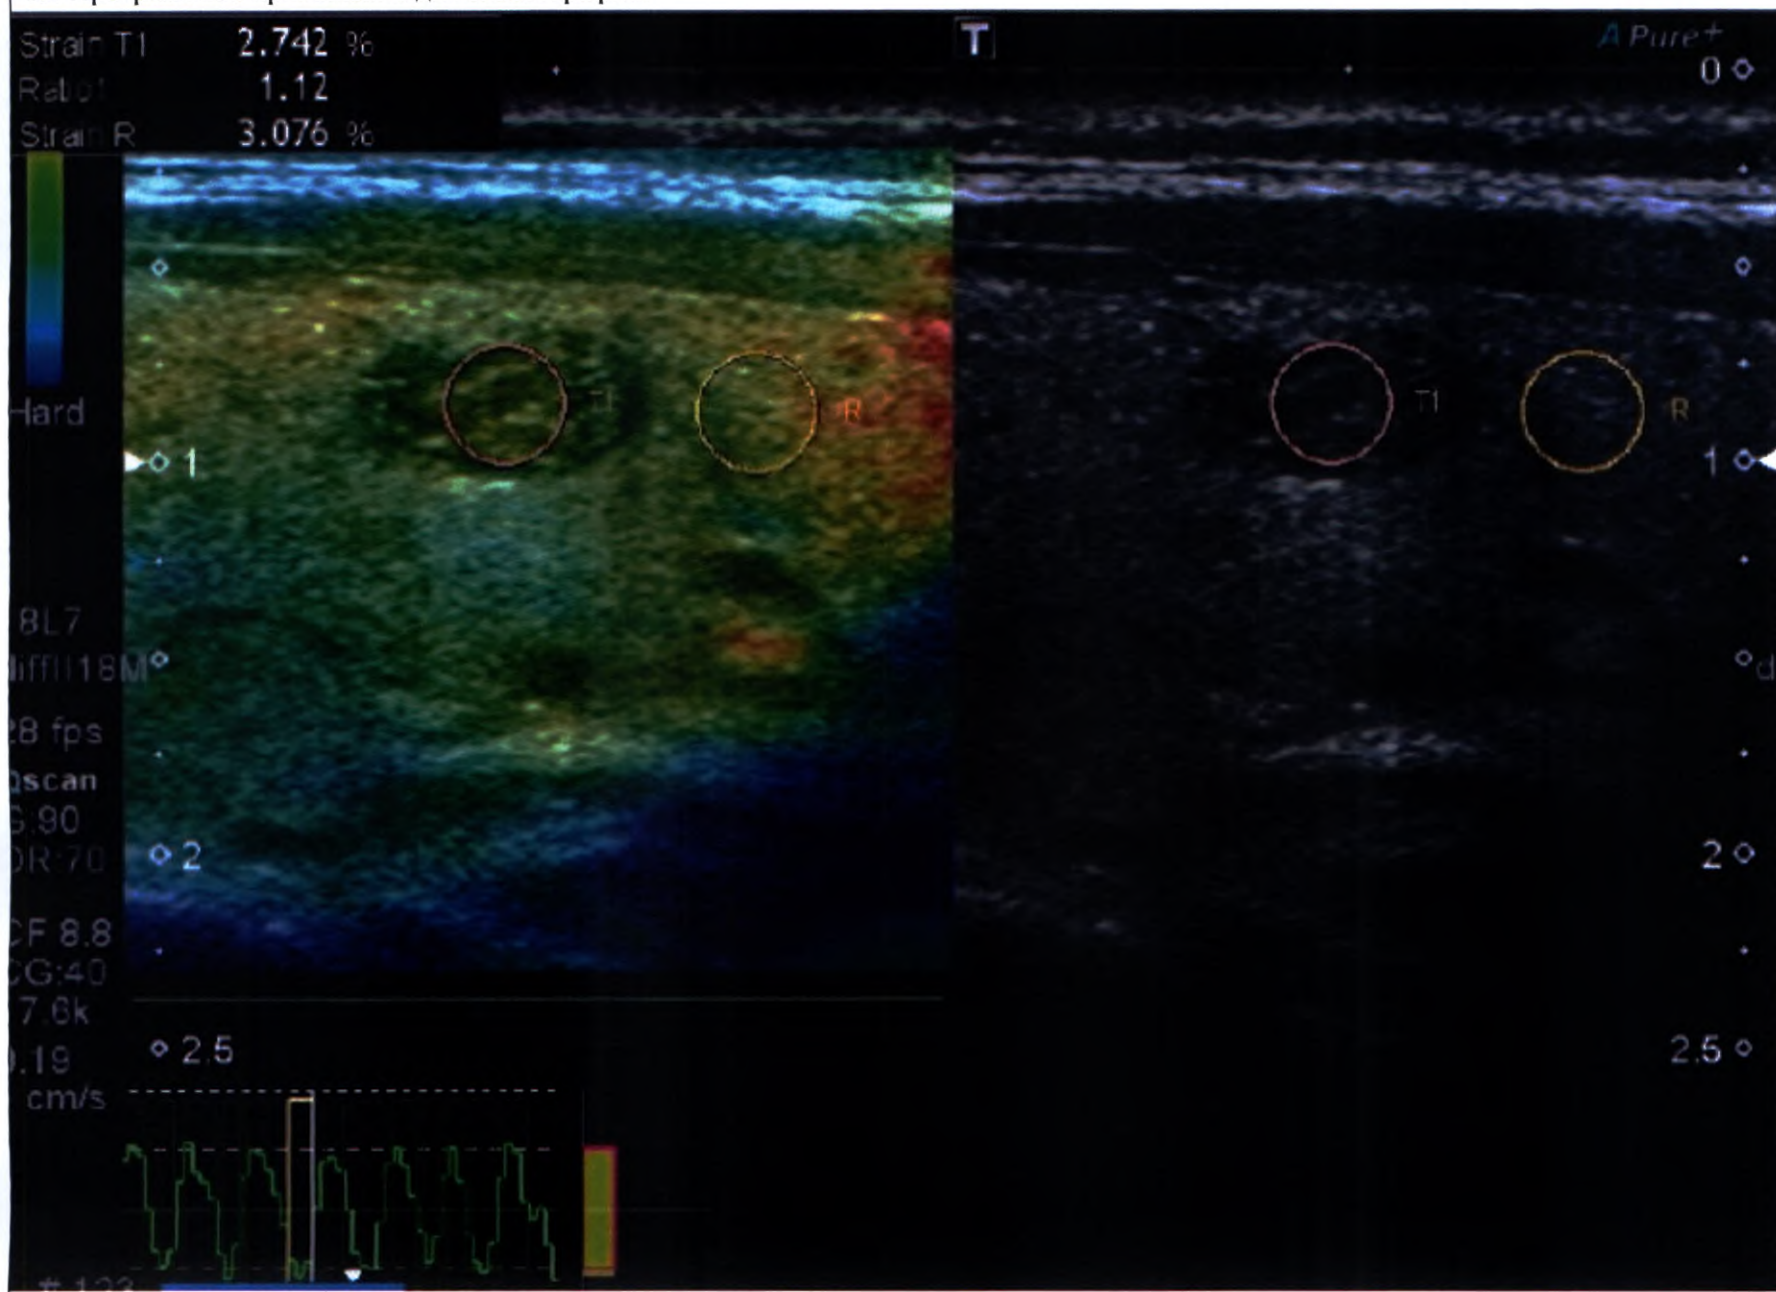

14. Программное приложение для эластографии сдвиговой волной.

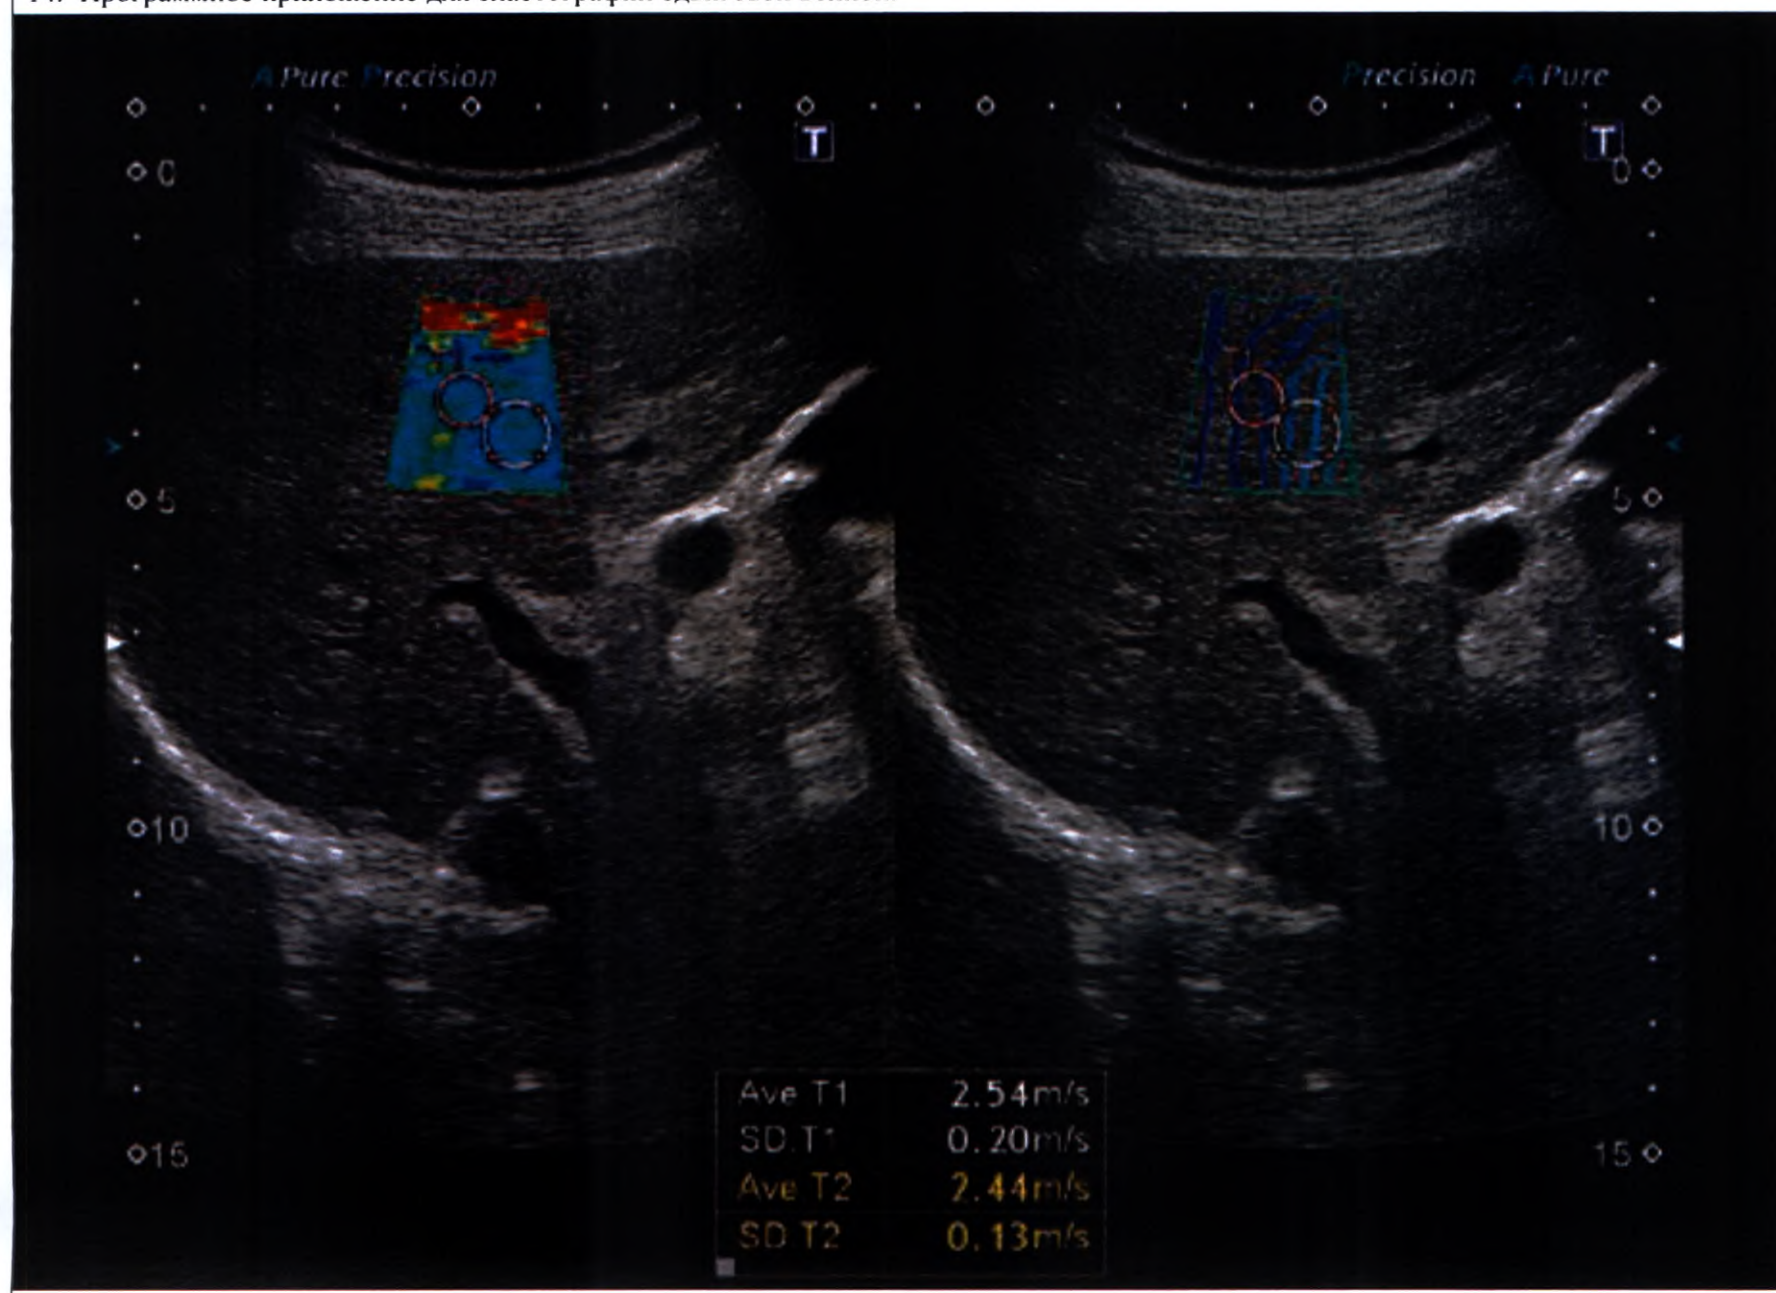


15. Программное приложение для анатомического М-режима (Flex-M).

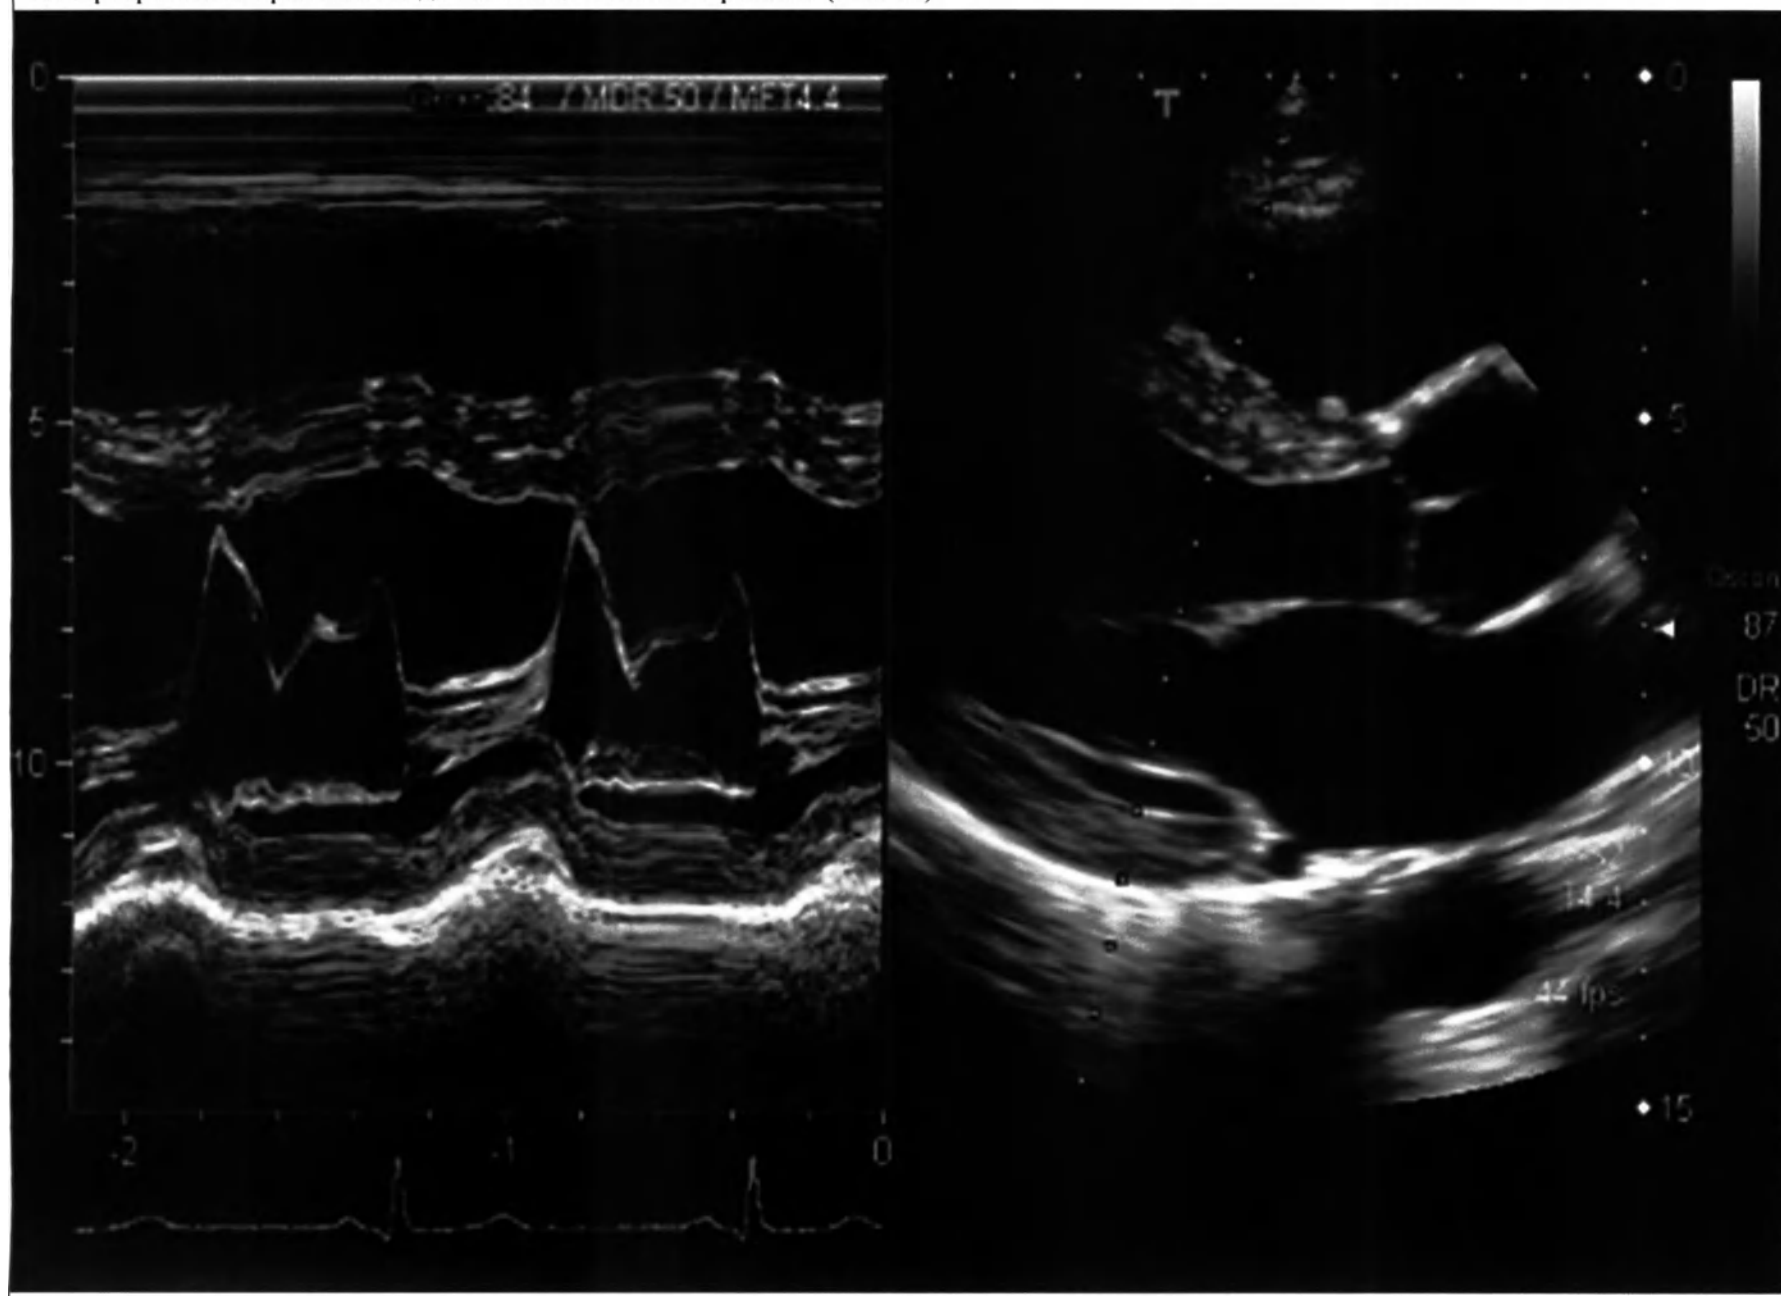





17. Программное приложение для трехмерной реконструкции изображения (Smart 3D).

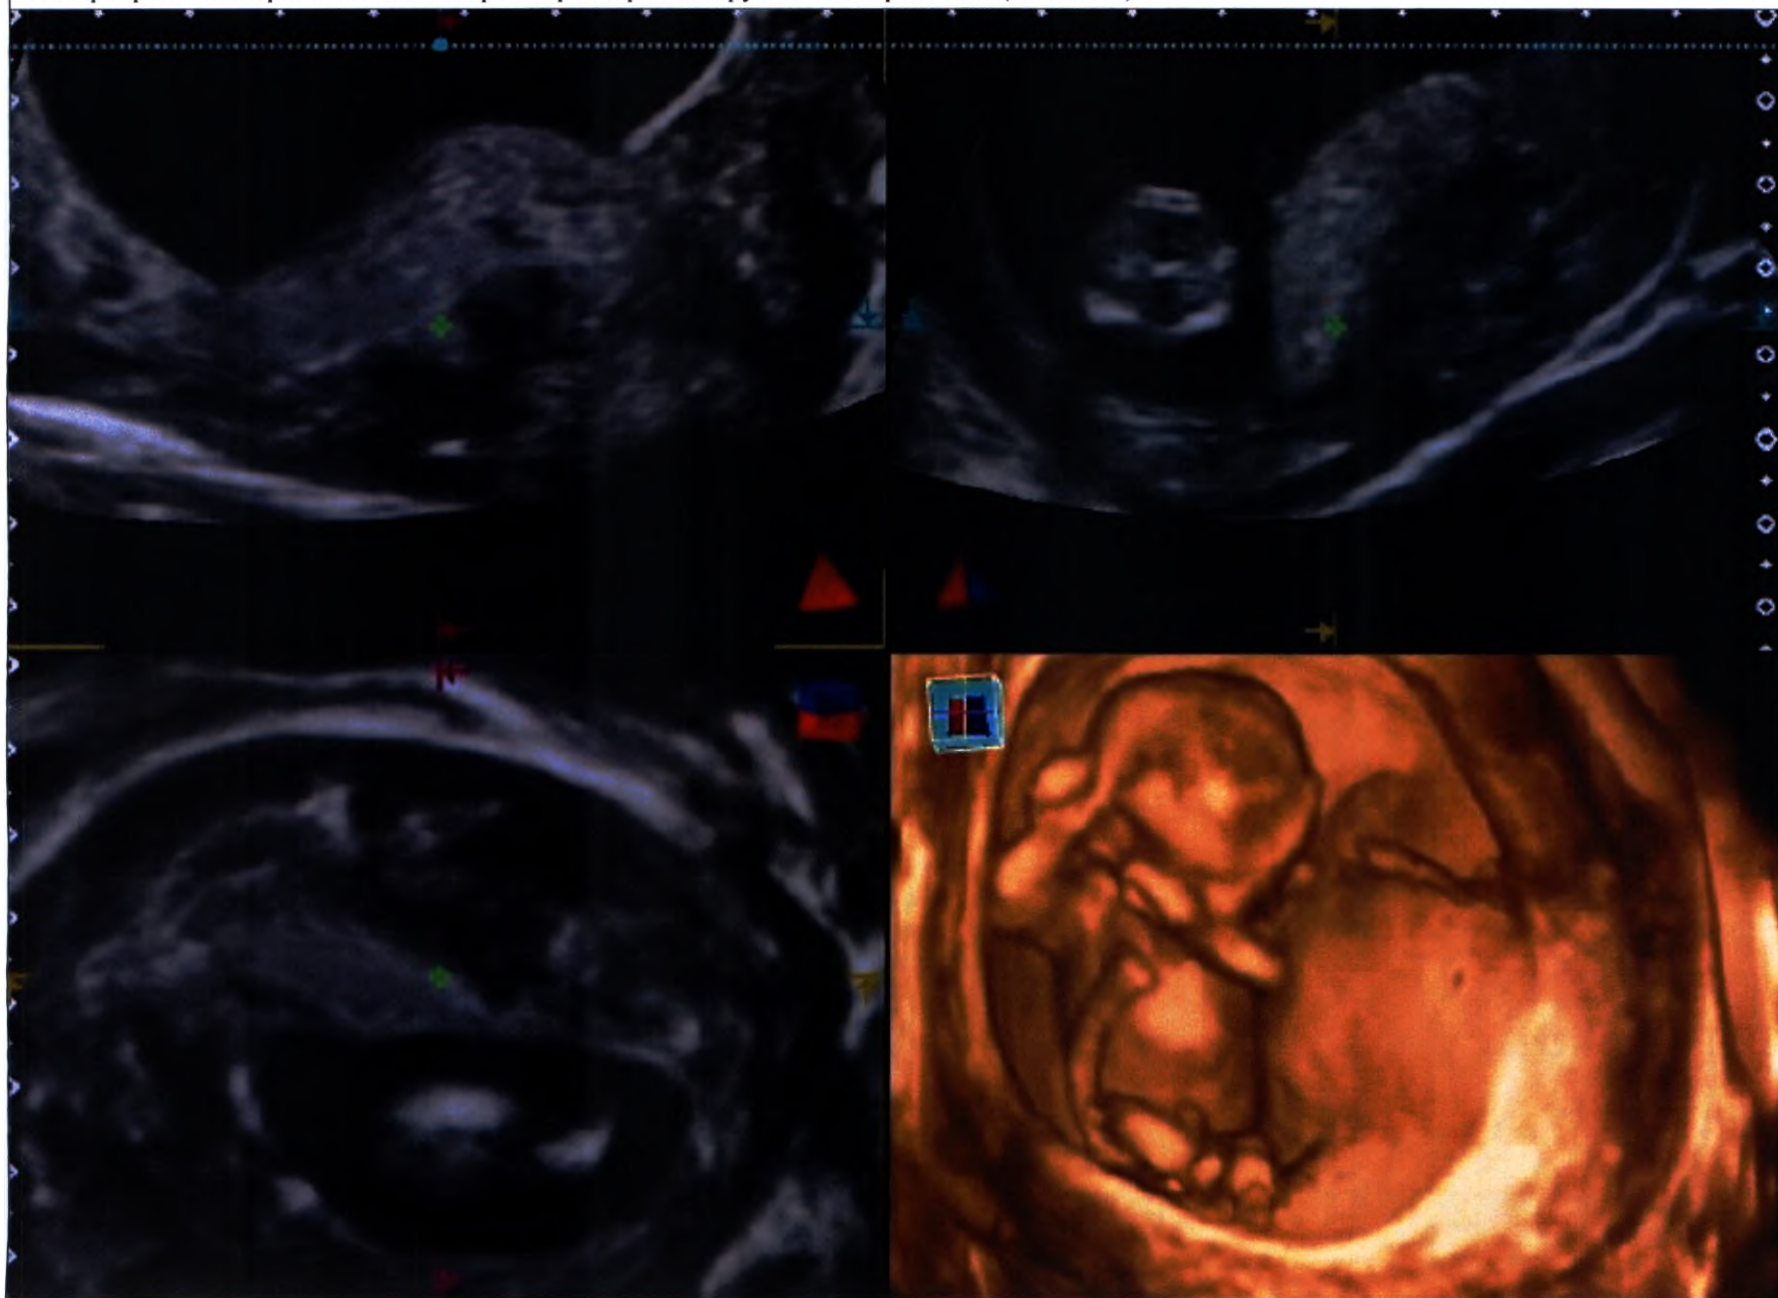

18. Программное приложение для высококачественной визуализации микрососудистого кровотока (Superb Micro Vascular Imaging).

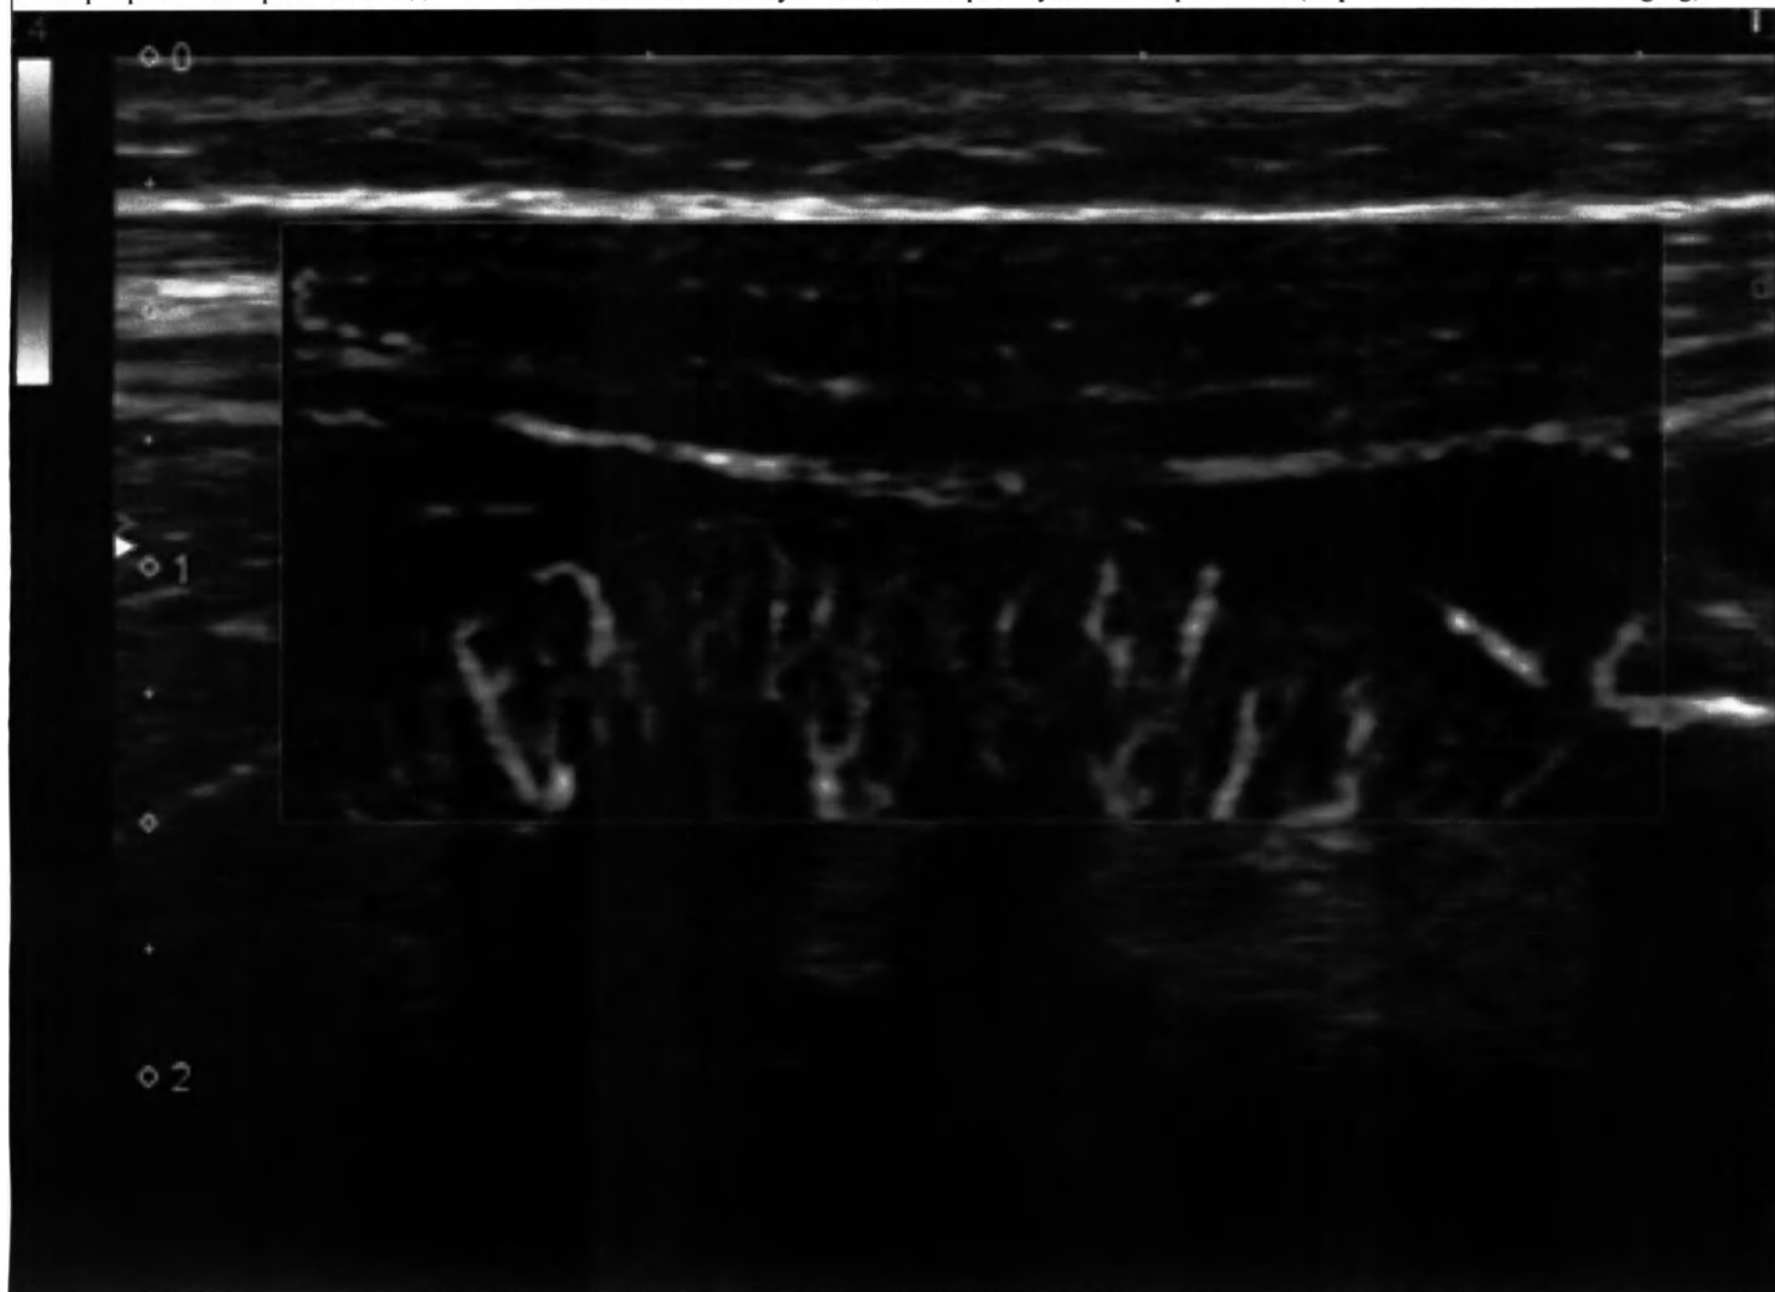

19. Программное приложение для виртуального освещения (Luminance).

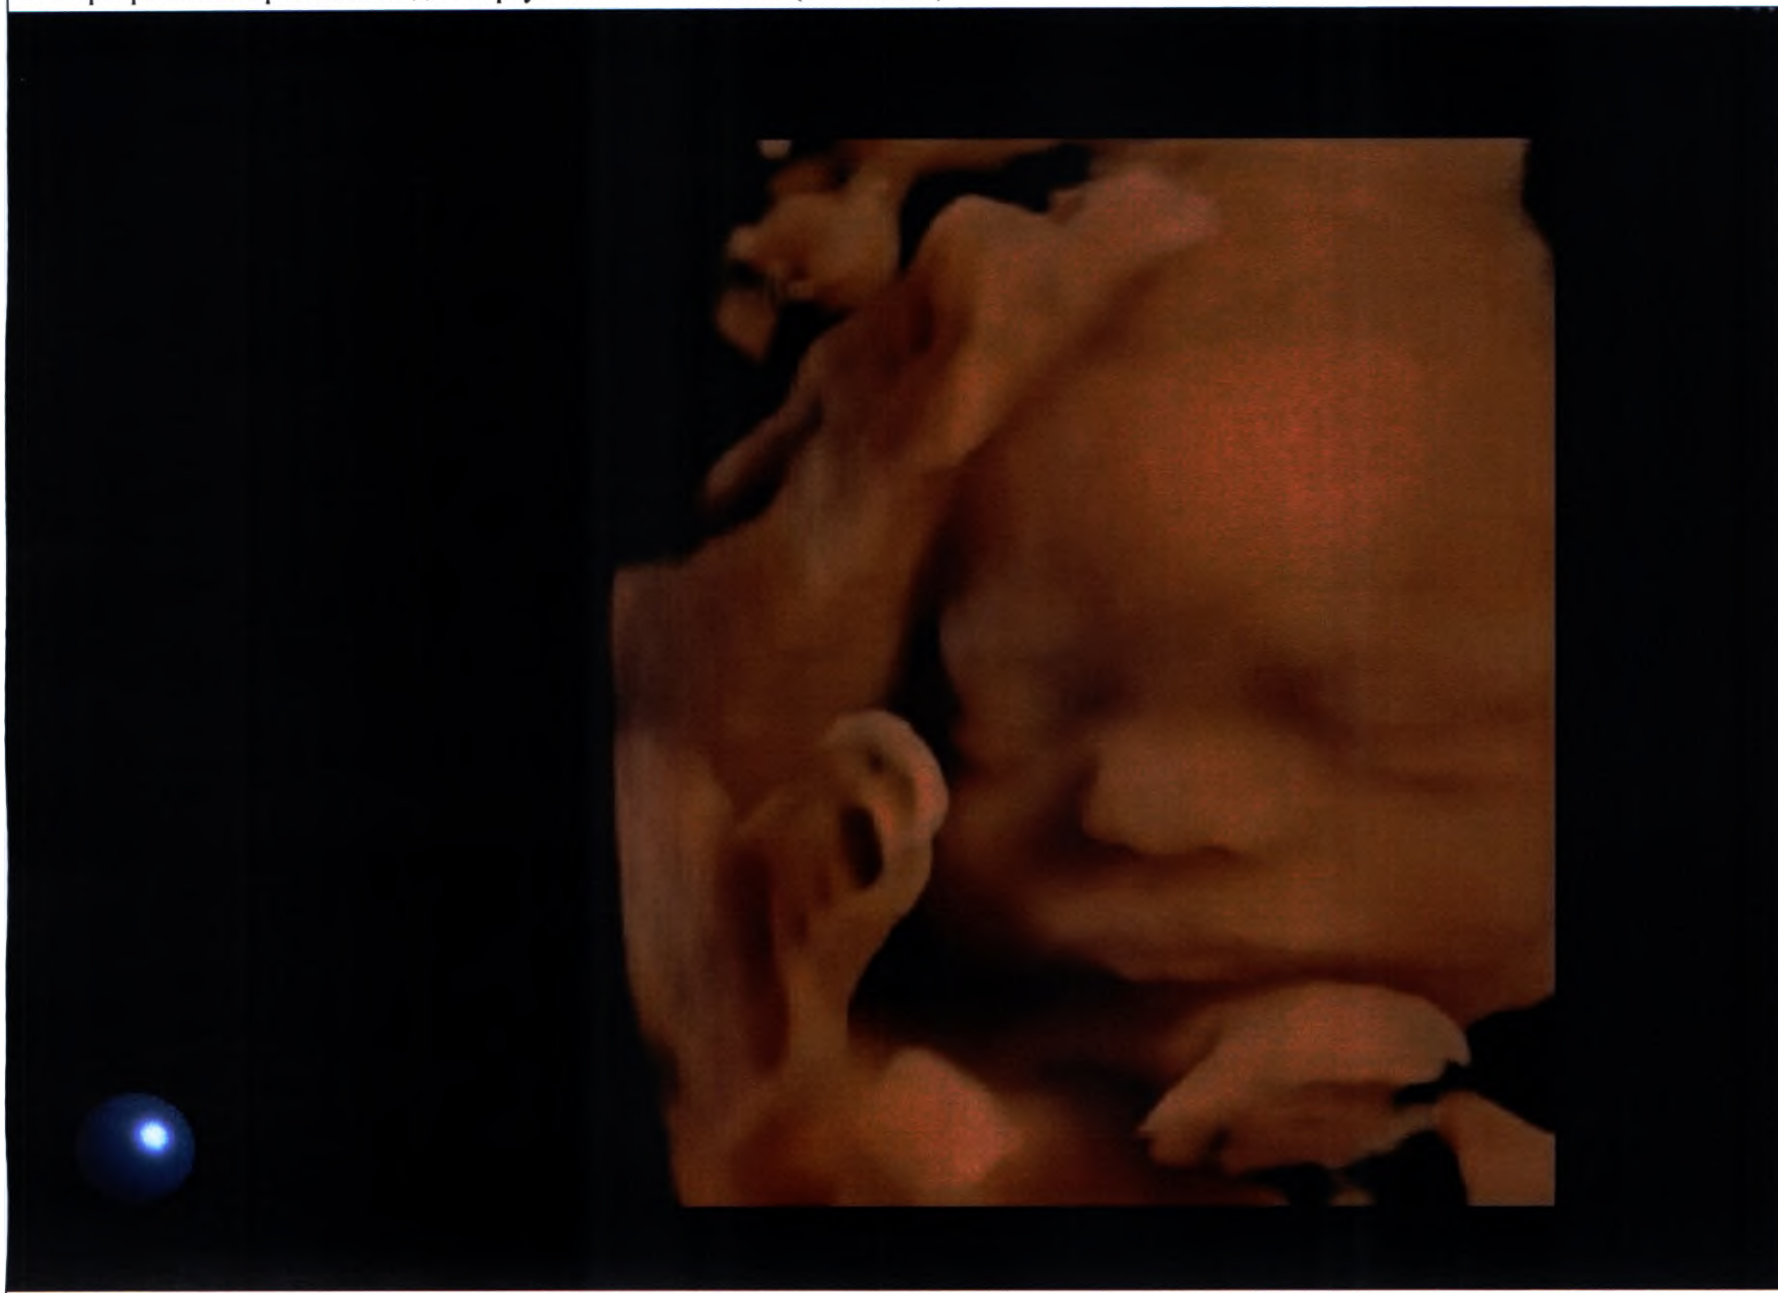

20. Программное приложение для прецизионной визуализации (Precision Plus).

Home
Config.
Utils
Diag.
Logs

Site Description
System Management
Network Settings
DICOM Management
Security Management
Option Management
System ID
Option Settings
Backup
Backup Restore
Preset Link

License Code	Status	Expiration	Expiry Date	Description	Installation Date
110ZZOU0KU6HURZ422QQ08330	Not Expired	01/01/2019	Service	03/04/2018	
1WVTTI5I3E2CFCZKIIIIIGYYS	Not Expired	17/07/2018	USDF-X200A	19/04/2018	
1WVTT2SZP99M1YK5333331JJG	Not Expired	17/07/2018	USEL-X200A	19/04/2018	
1LKII2354ZWK41OVTITTTTR994	Not Expired	17/07/2018	USDT-X200A	19/04/2018	
1SRPPCRIFUZ5KH0IGGGGG6220	Not Expired	14/05/2019	USHI-X200A	16/05/2018	
1KJHHMDAOIN4DALQ00000EAA4	Not Expired	14/05/2019	USPV-X200A	16/05/2018	
1UTRRGYNY4KK1Y9ZXXXXXNJG	Not Expired	14/05/2019	USPA-X200A	16/05/2018	
1SRPPQ8YB9XAHM866666WSSO	Not Expired	14/05/2019	USSE-X200A	16/05/2018	
121ZZQ2H436LLI5NLLLLLB774	Not Expired	14/05/2019	USDI-X200A	16/05/2018	
1VUSS4ANELPPKH4B99999ZVVS	Not Expired	14/05/2019	USDT-X200A	16/05/2018	
1GFDD7J20Q6A41097777XTTS	Not Expired	14/05/2019	USDF-X200A	16/05/2018	
10ZXXH5JM92LEBWA88888YUUO	Not Expired	14/05/2019	USXM-X200A	16/05/2018	
1ONLLVM47XZ685V866666WSSO	Not Expired	14/05/2019	USAN-X200A	16/05/2018	
19866C8C170A96R0YYYYYOKKK	Not Expired	14/05/2019	USFR-X200A	16/05/2018	
10ZXXGWE0K12HET755555VRRO	Not Expired	14/05/2019	USLM-X200A	16/05/2018	
14311HCNG1C2MLI6KIIIIIR440	Not Expired	14/05/2019	USMI-X200A	16/05/2018	

Details >>>
Select All
Add...
Edit
Remove...

Add Favorite
Previous
Next
QUIT

Home
Config
Utils
Diag.
Logs

Site Description

- System Management
- Network Settings
- DICOM Management
- Security Management
- Option Management
- System ID
- Option Settings
- Backup
- Backup Restore
- Preset Link

License Code	Status	Expiration	Expiry Date	Description	Installation Date
110ZZOU0KU6HURZ422QQ08330	Not Expired	01/01/2019	Service	03/04/2018	
1WVTT5I3E2CFCZKIIIIIGYYS	Not Expired	17/07/2018	USDF-X200A	19/04/2018	
1WVTT2SZP99M1YK5333331JJG	Not Expired	17/07/2018	USEL-X200A	19/04/2018	
1LKII2354ZWK41OVTITTTTR994	Not Expired	17/07/2018	USDT-X200A	19/04/2018	
1SRPPCRIFUZ5KH0IGGGGGG6220	Not Expired	14/05/2019	USHI-X200A	16/05/2018	
1KJHHMDAOIN4DALQ00000EEAA4	Not Expired	14/05/2019	USPV-X200A	16/05/2018	
1UTRRGYNY4KK1Y9ZXXXXXNJG	Not Expired	14/05/2019	USPA-X200A	16/05/2018	
1SRPPQ8YB9XAHM866666WSSO	Not Expired	14/05/2019	USSE-X200A	16/05/2018	
121ZZQ2H436LLI5NLLLLLB774	Not Expired	14/05/2019	USDI-X200A	16/05/2018	
1VUSS4ANELPPKH4B99999ZVVS	Not Expired	14/05/2019	USDT-X200A	16/05/2018	
1GFDD7J20Q6A41097777XTTS	Not Expired	14/05/2019	USDF-X200A	16/05/2018	
10ZXKH5JM92LEBWA88888YUU0	Not Expired	14/05/2019	USXM-X200A	16/05/2018	
1ONLLVM47XZ685V866666WSSO	Not Expired	14/05/2019	USAN-X200A	16/05/2018	
19866C8C170A96R0YYYYYOKKK	Not Expired	14/05/2019	USFR-X200A	16/05/2018	
10ZXGWE0K12HET755555VRRO	Not Expired	14/05/2019	USLM-X200A	16/05/2018	
14311HCNG1C2MLI6KIIIIIR440	Not Expired	14/05/2019	USMI-X200A	16/05/2018	

Details >>>
Select All
Add...
Edit
Remove...

Add Favorite
Previous
Next
QUIT

22. Программное приложение для специальной оптимизации тканевого отображения (TSO).

Home
Config.
Utils
Diag.
Logs

Site Description


- System Management
- Network Settings
- DICOM Management
- Security Management
- Option Management
 - System ID
 - Option Settings
- Backup
- Backup Restore
- Preset Link

License Code	Status	Expiration	Expiry Date	Description	Installation Date
110ZZ0U0KU6HURZ422QQ08330	Not Expired	01/01/2019	Service	03/04/2018	
1WVTTI5I3E2CFCZKIIIIIGYYS	Not Expired	17/07/2018	USDF-X200A	19/04/2018	
1WVTT2SZP99M1YK5333331JJG	Not Expired	17/07/2018	USEL-X200A	19/04/2018	
1LKII2354ZWK41OVTTTTTR994	Not Expired	17/07/2018	USDT-X200A	19/04/2018	
1SRPPCRIFUZ5KH0IGGGGG6220	Not Expired	14/05/2019	USHI-X200A	16/05/2018	
1KJHHMDA0IN4DALQ00000EAA4	Not Expired	14/05/2019	USPV-X200A	16/05/2018	
1UTRRGYNY4KK1Y9ZXXXXXNJG	Not Expired	14/05/2019	USPA-X200A	16/05/2018	
1SRPPQ8YB9XAHM866666WSS0	Not Expired	14/05/2019	USSE-X200A	16/05/2018	
121ZZQ2H436LLI5NLLLLLB774	Not Expired	14/05/2019	USDI-X200A	16/05/2018	
1VUSS4ANELPPKH4B99999ZVVS	Not Expired	14/05/2019	USDT-X200A	16/05/2018	
1GFDD7J20Q6A41097777XTTS	Not Expired	14/05/2019	USDF-X200A	16/05/2018	
10ZXXH5JM92LEBWA88888YUUD	Not Expired	14/05/2019	USXM-X200A	16/05/2018	
1ONLLVM47XZ685V866666WSS0	Not Expired	14/05/2019	USAN-X200A	16/05/2018	
19866C8C170A96R0YYYYYOKKK	Not Expired	14/05/2019	USFR-X200A	16/05/2018	
10ZXXGWE0K12HET755555VRR0	Not Expired	14/05/2019	USLM-X200A	16/05/2018	
14311HCNG1C2M16KIIIIIR440	Not Expired	14/05/2019	USMI-X200A	16/05/2018	

Details >>>
Select All
Add...
Edit
Remove...

Add Favorite
Previous
Next
QUIT

23. Программное приложение для отслеживания движения стенок миокарда в 2D режиме (2D Wall Motion Tracking).

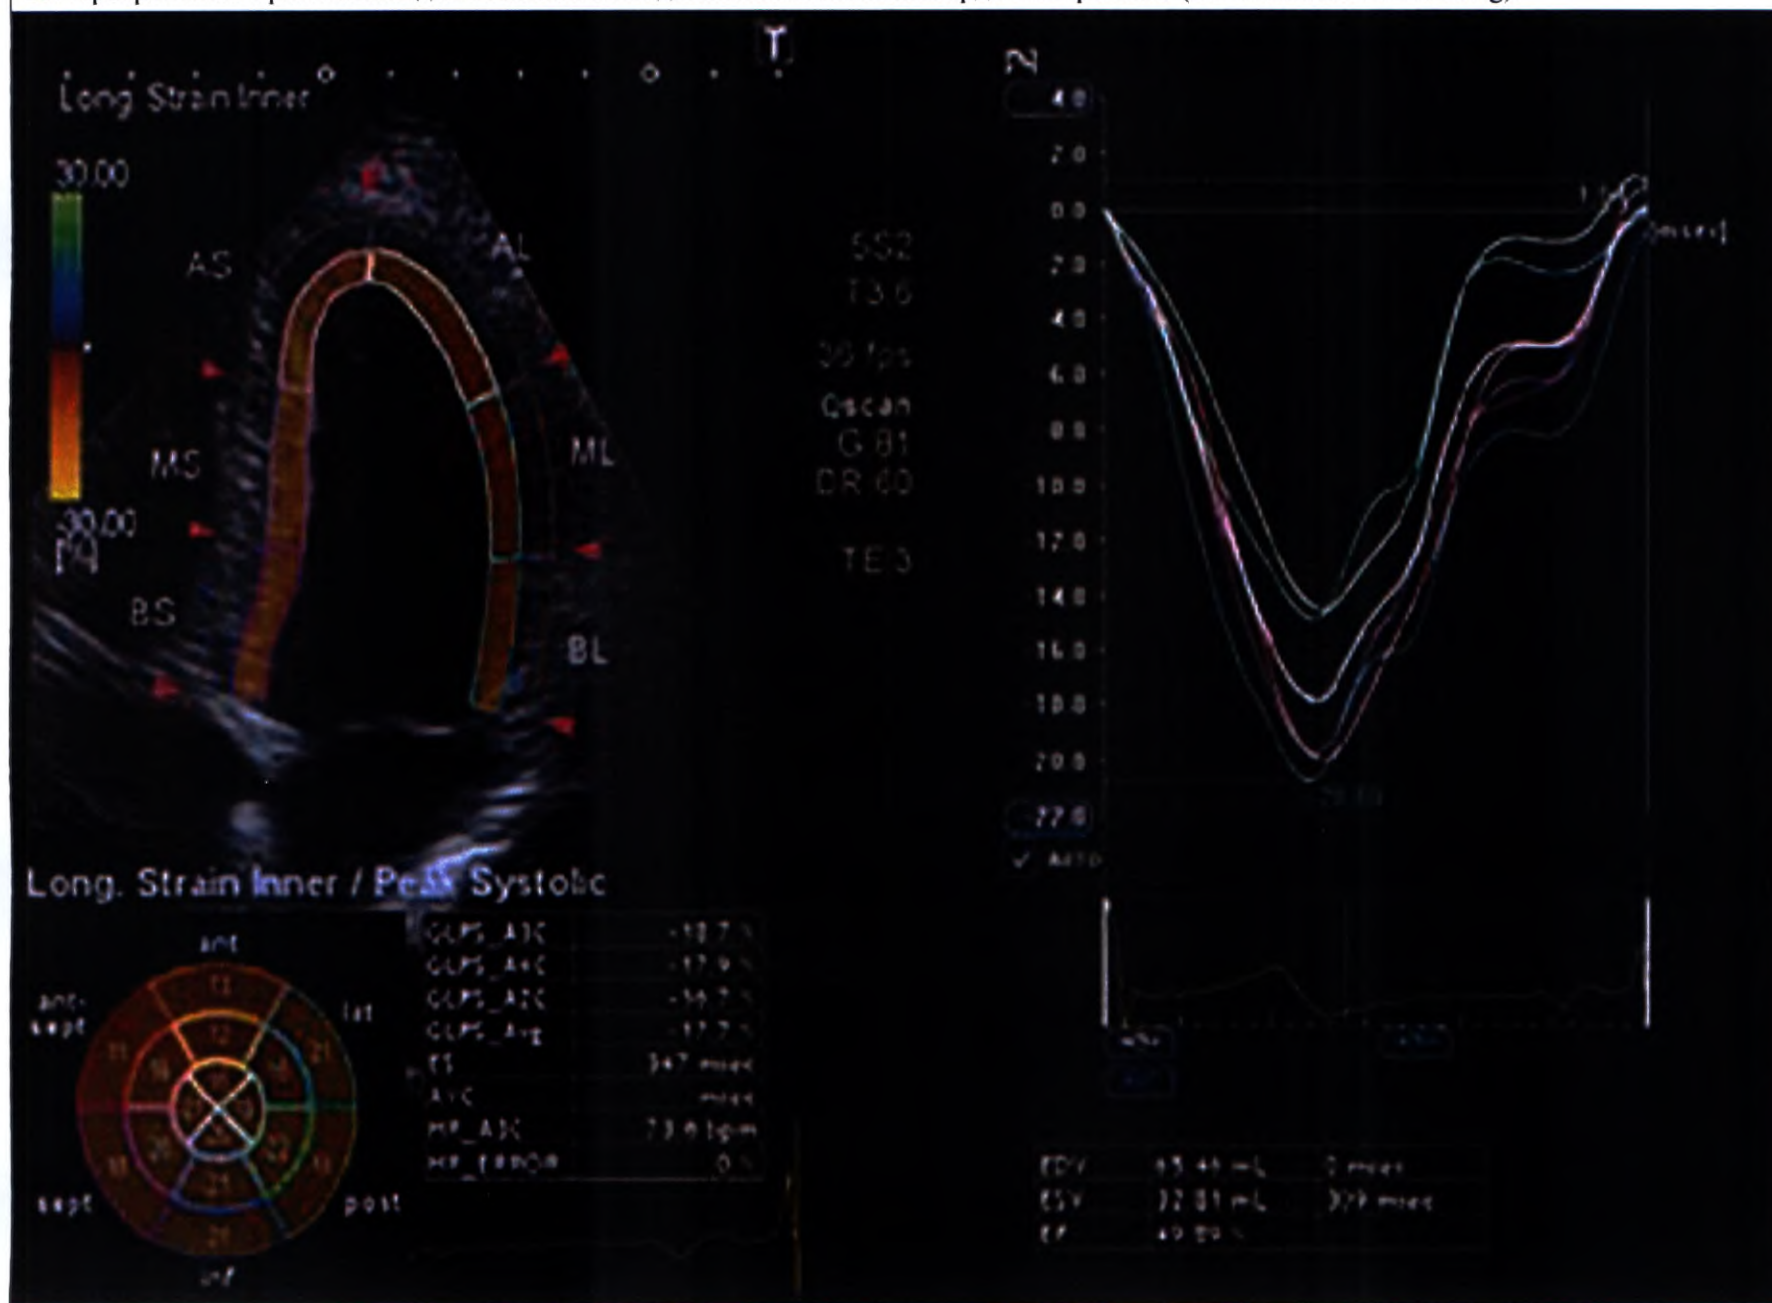





25.Подогреватель геля.




26. Ножная педаль управления.

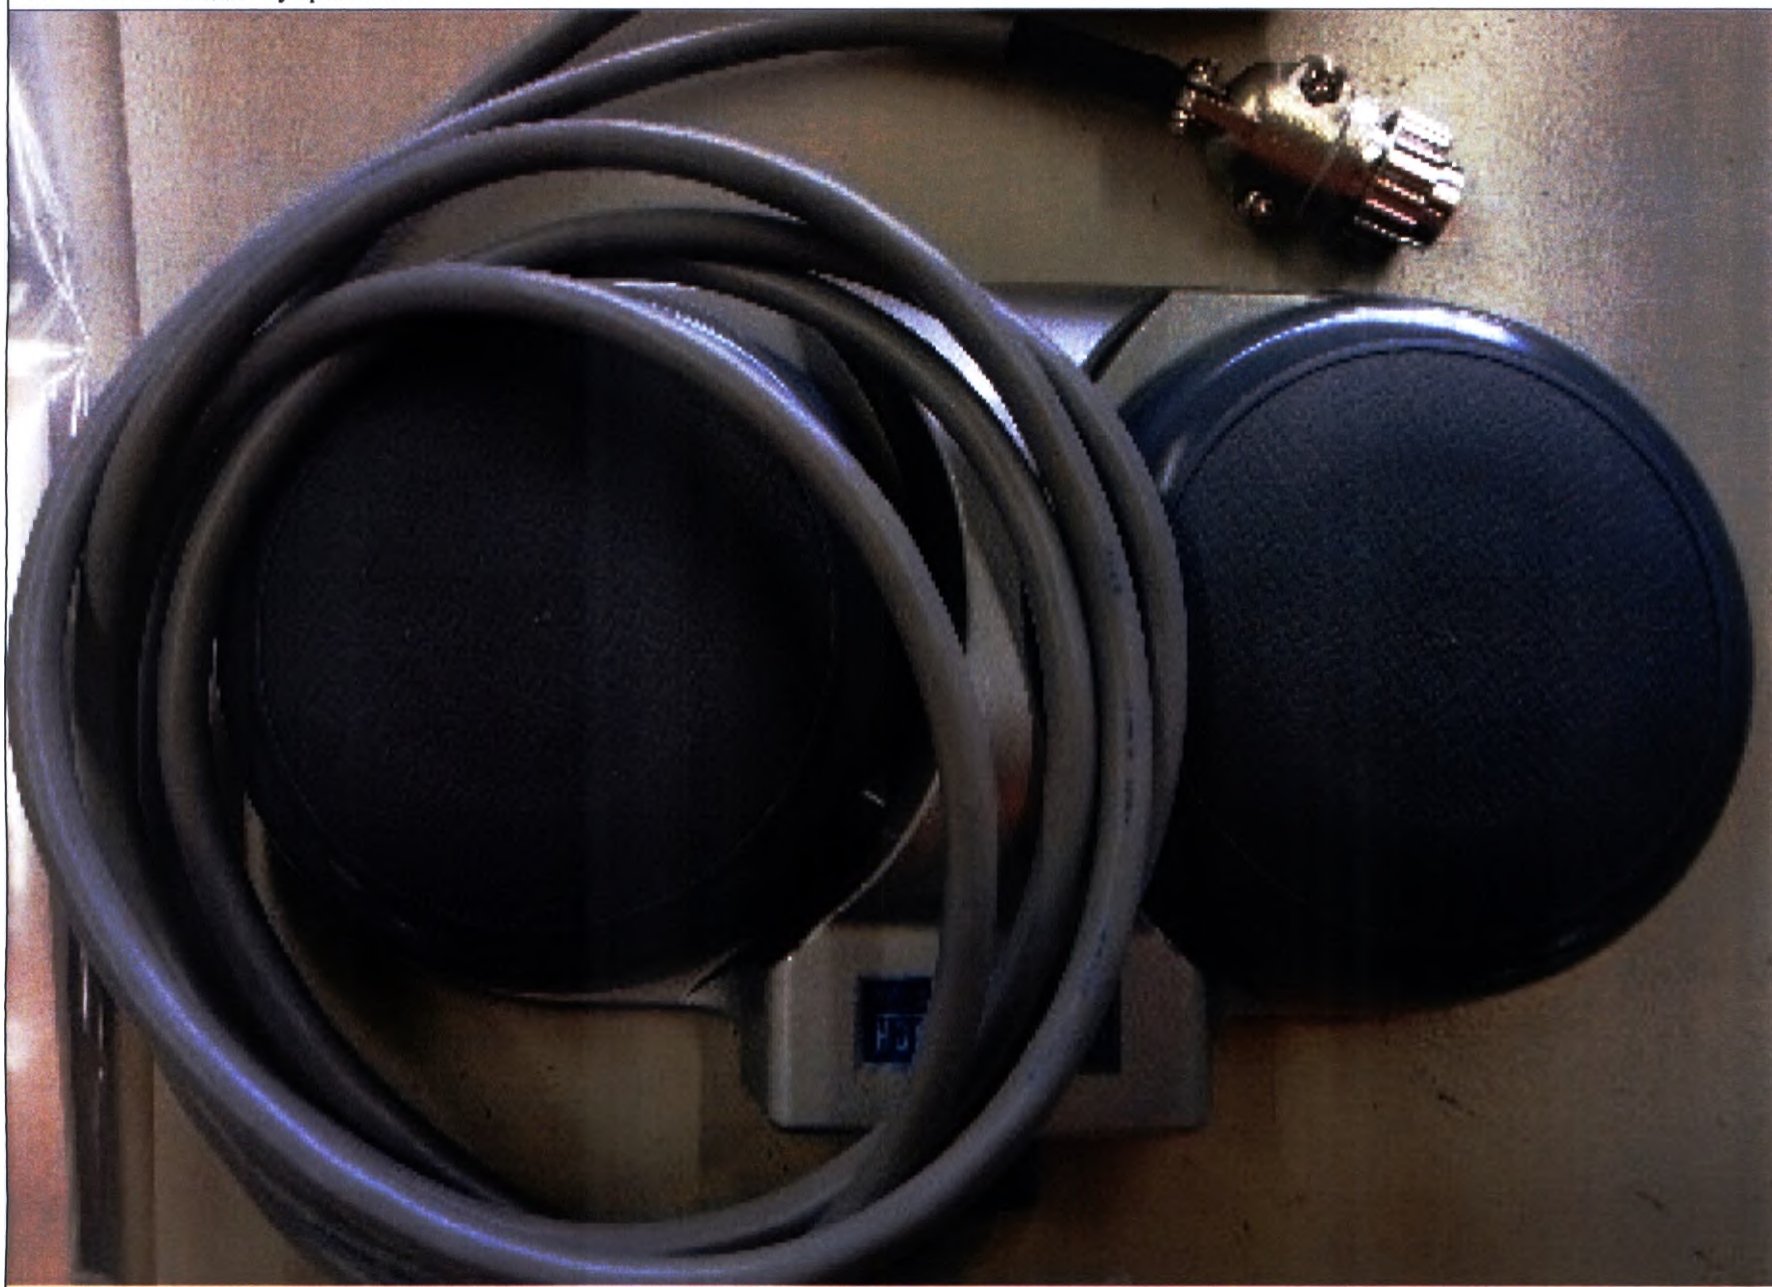


27. Адаптер для подключения транснашеводного, лапароскопического датчиков.

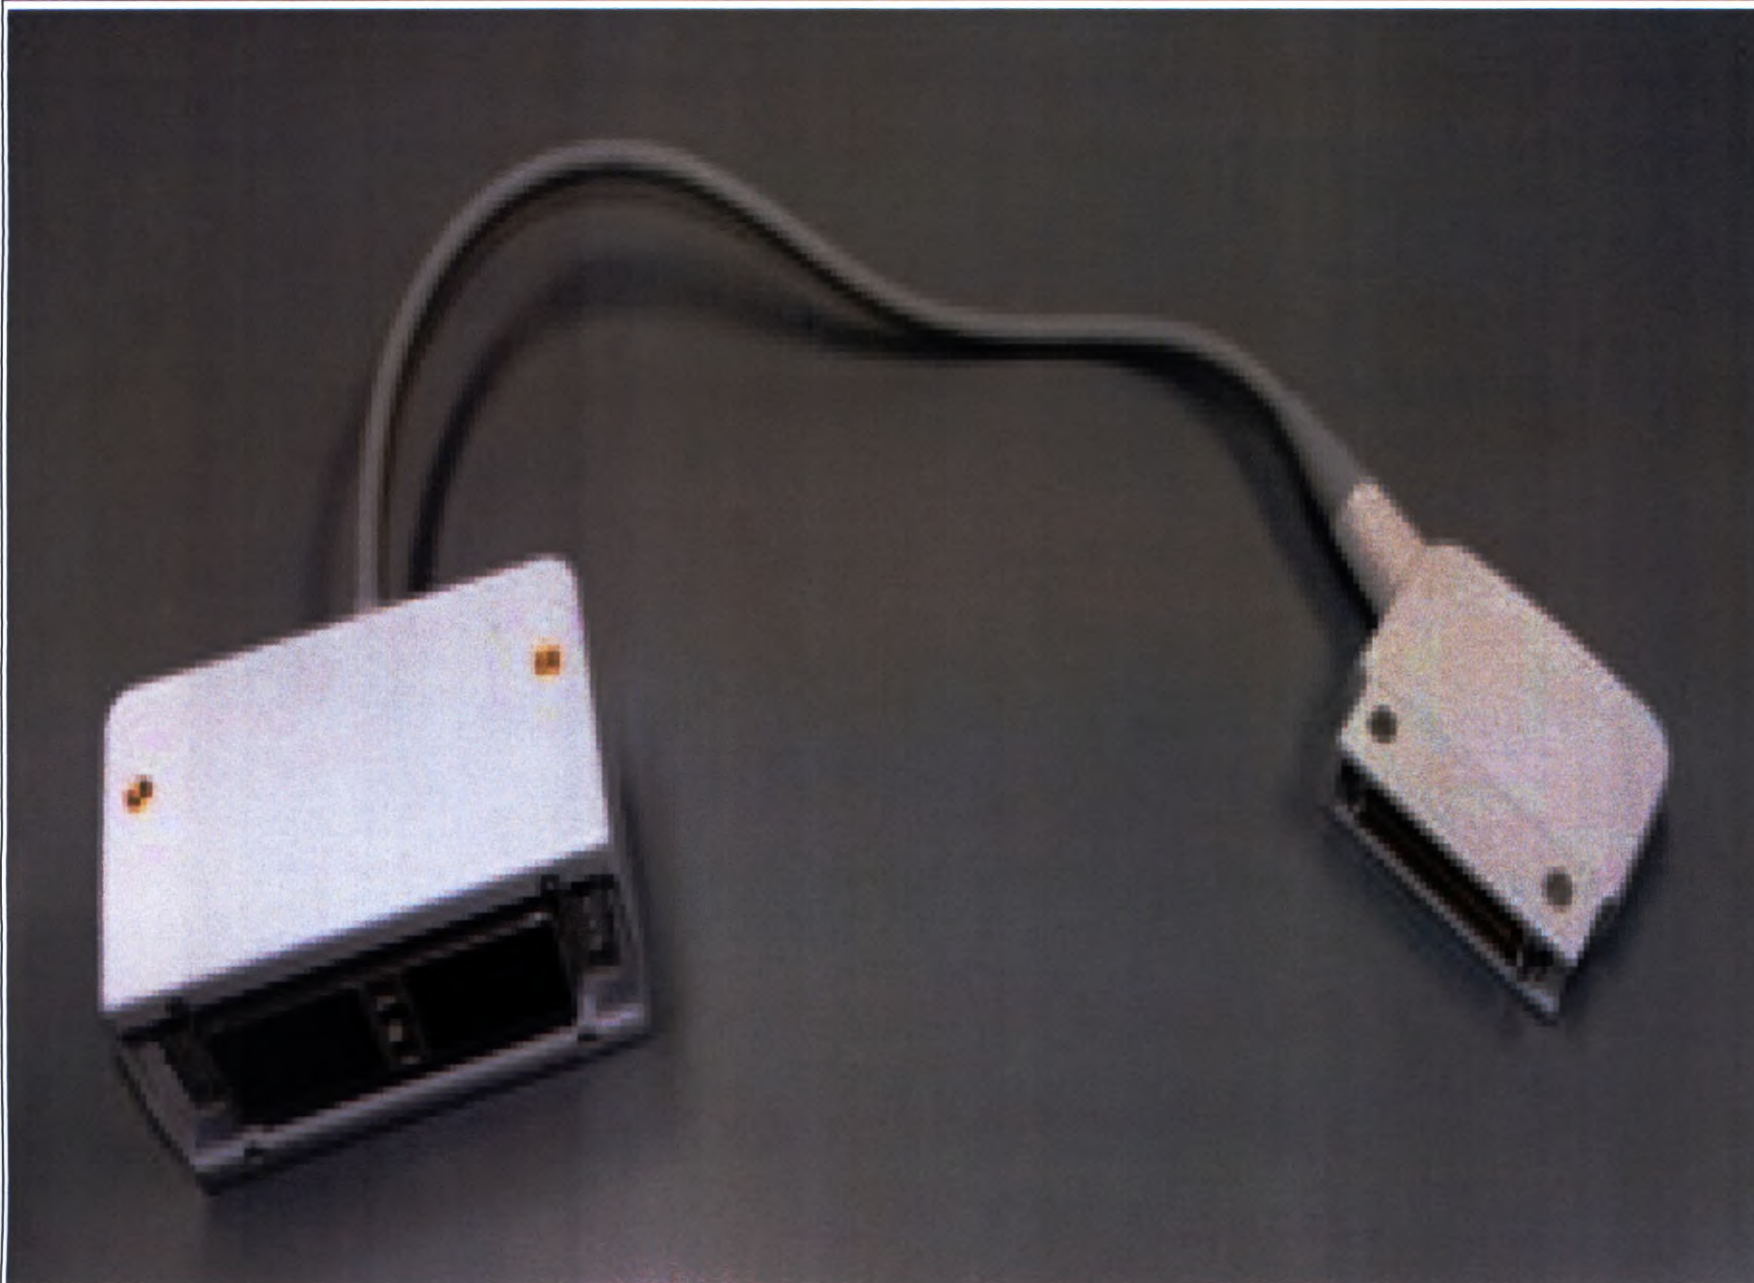


28. Держатель для транспищеводного датчика.

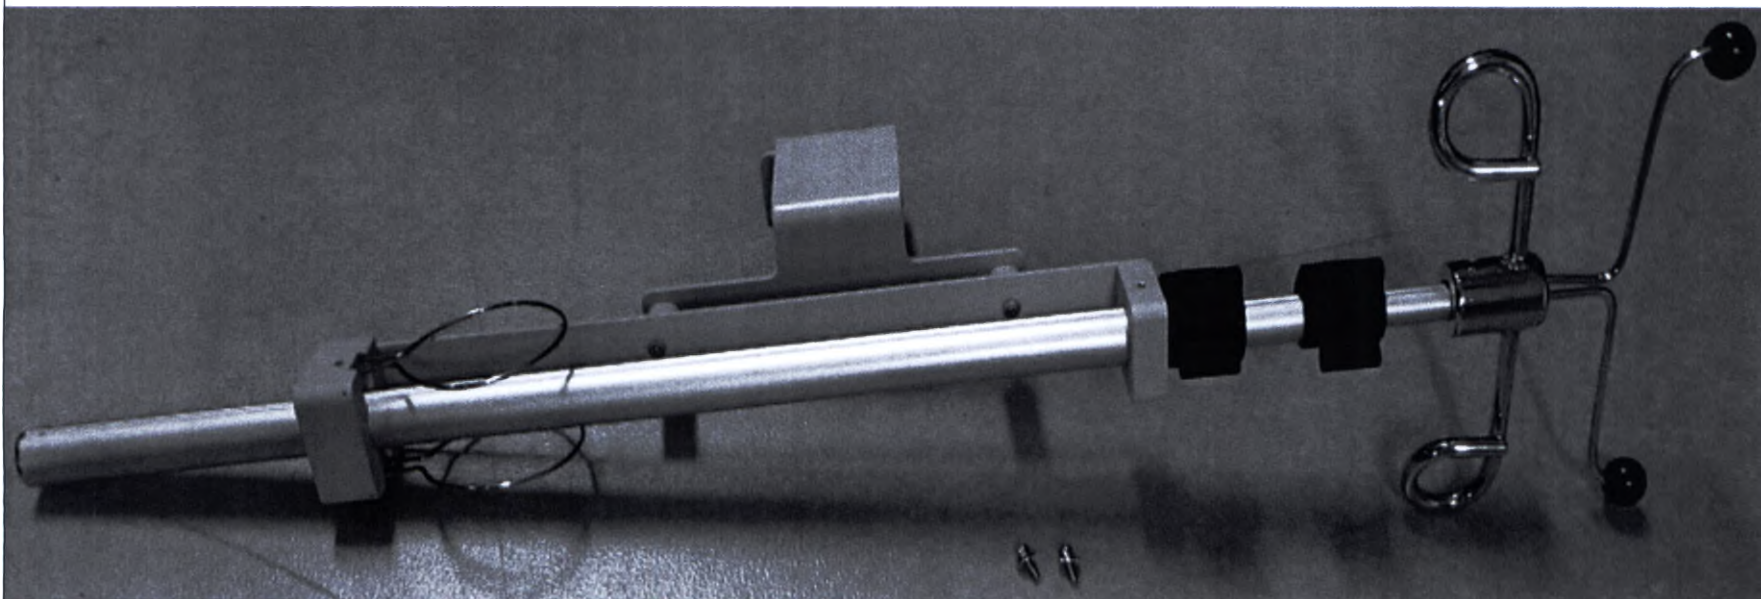


29. Держатель для кабелей датчиков.

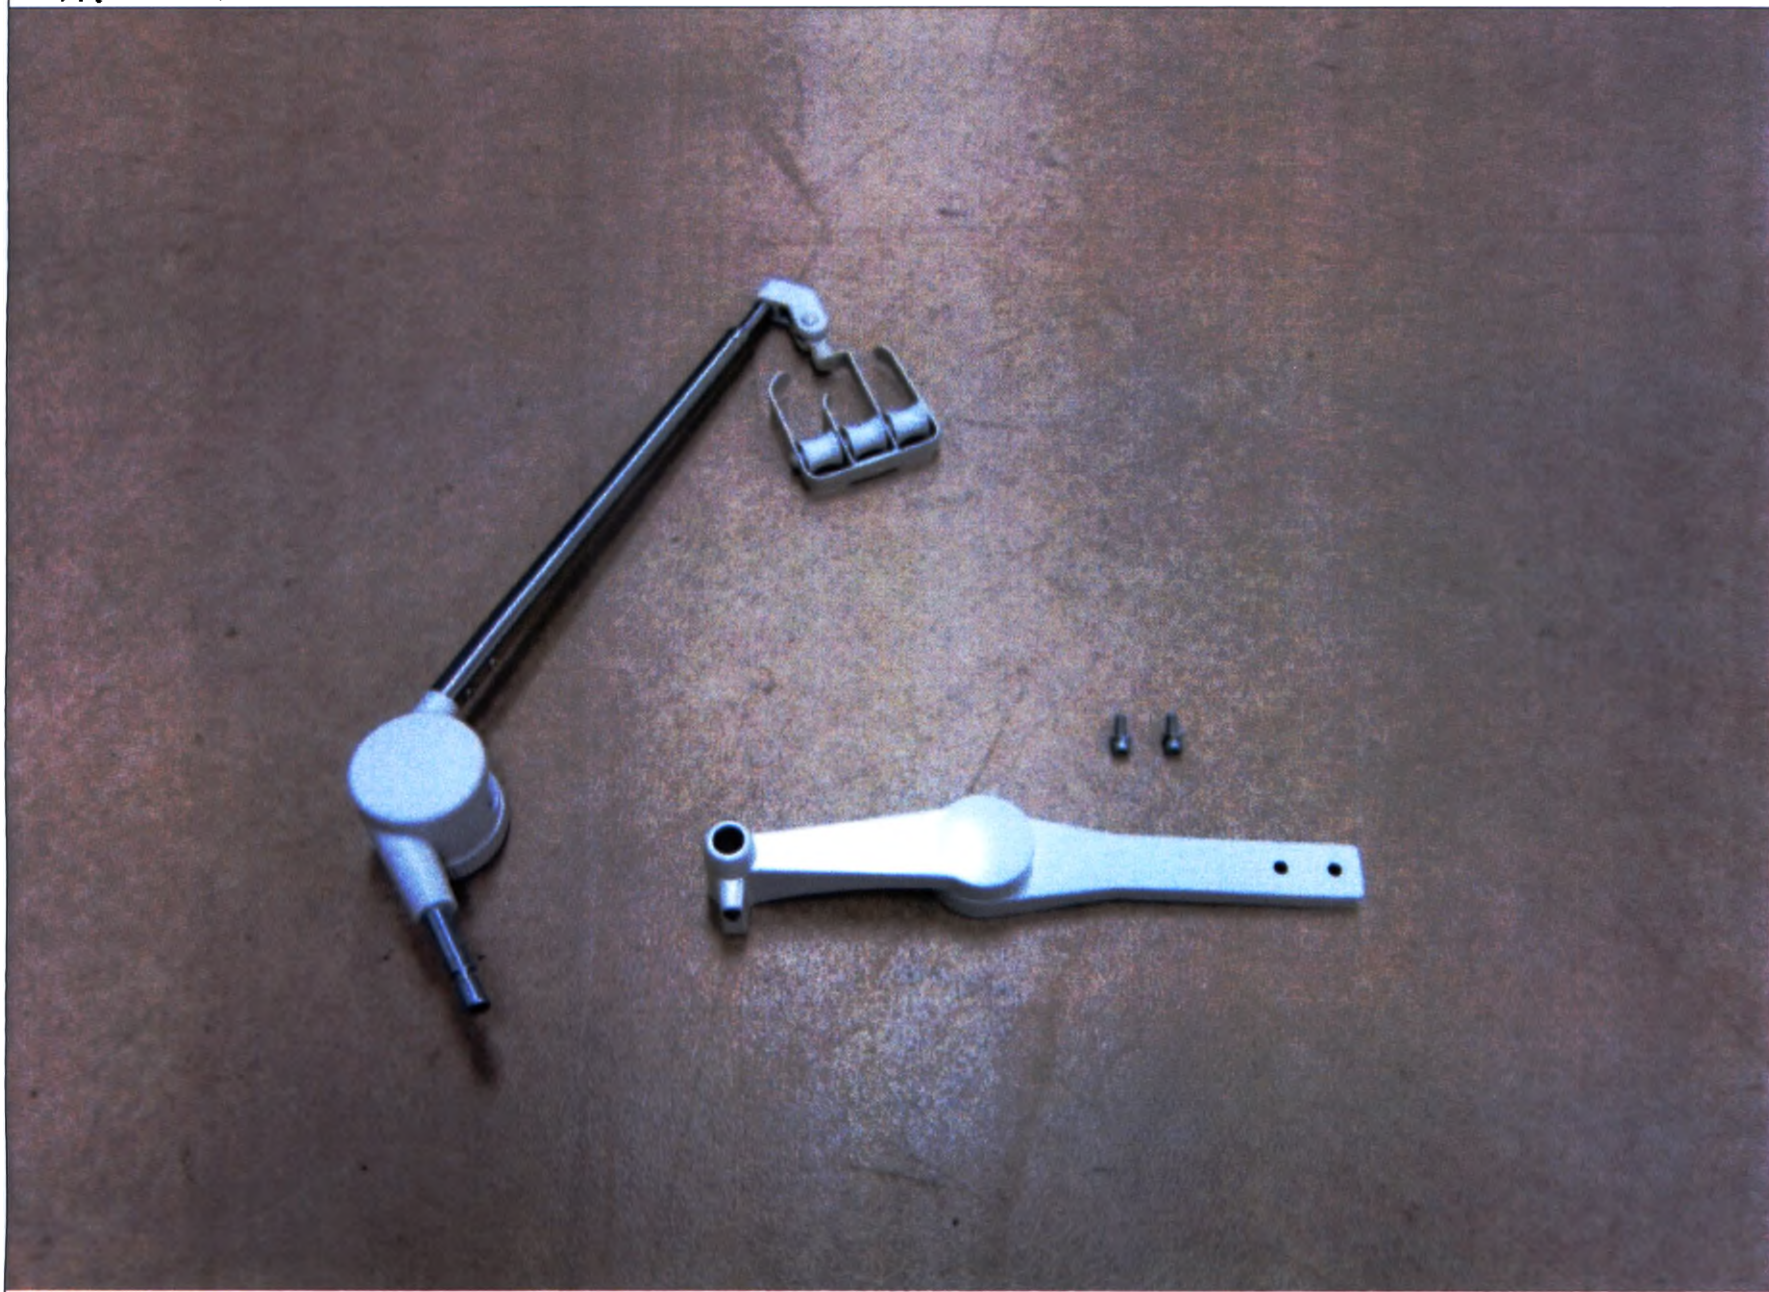


30. Держатель для датчиков с левой стороны.

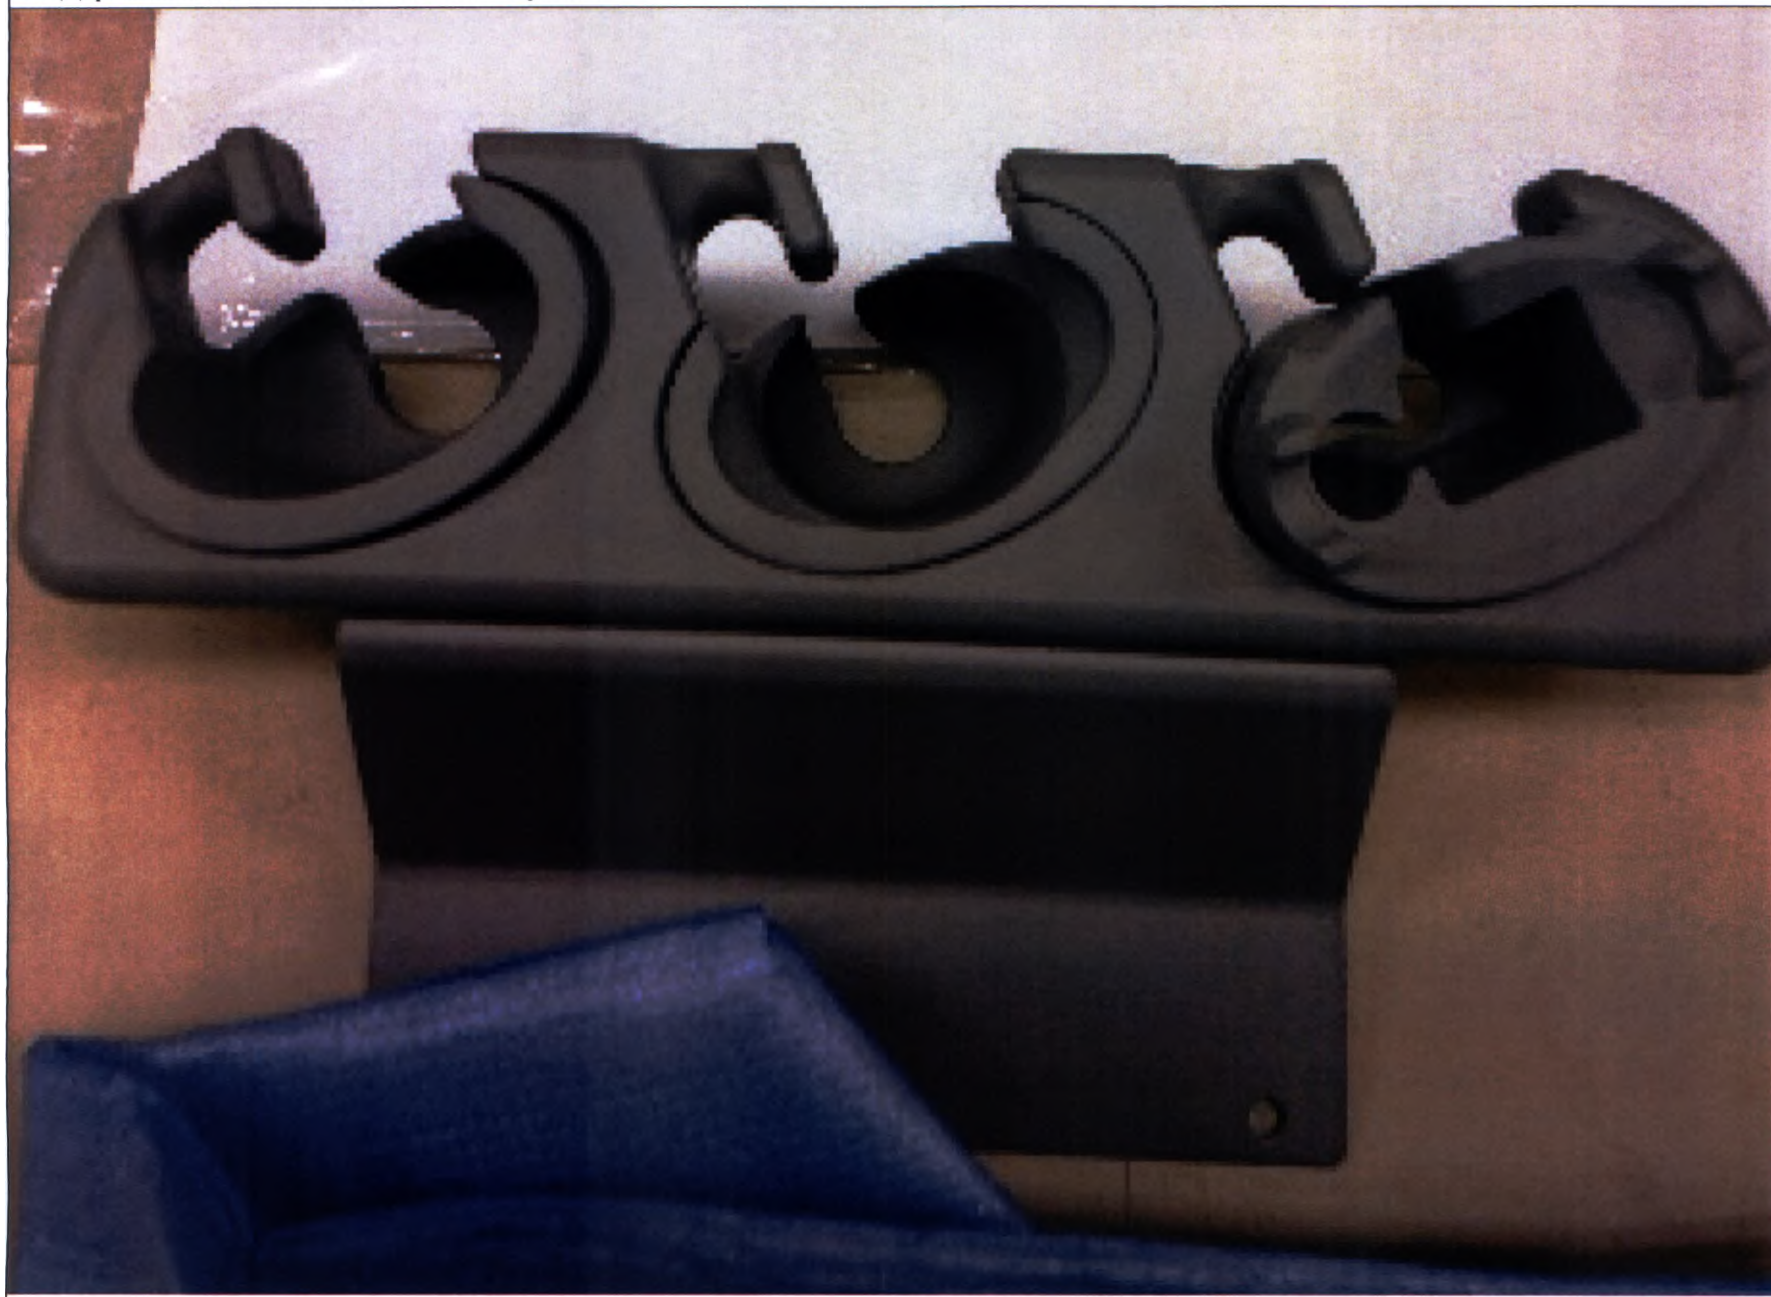


30. Держатель для датчиков с левой стороны.

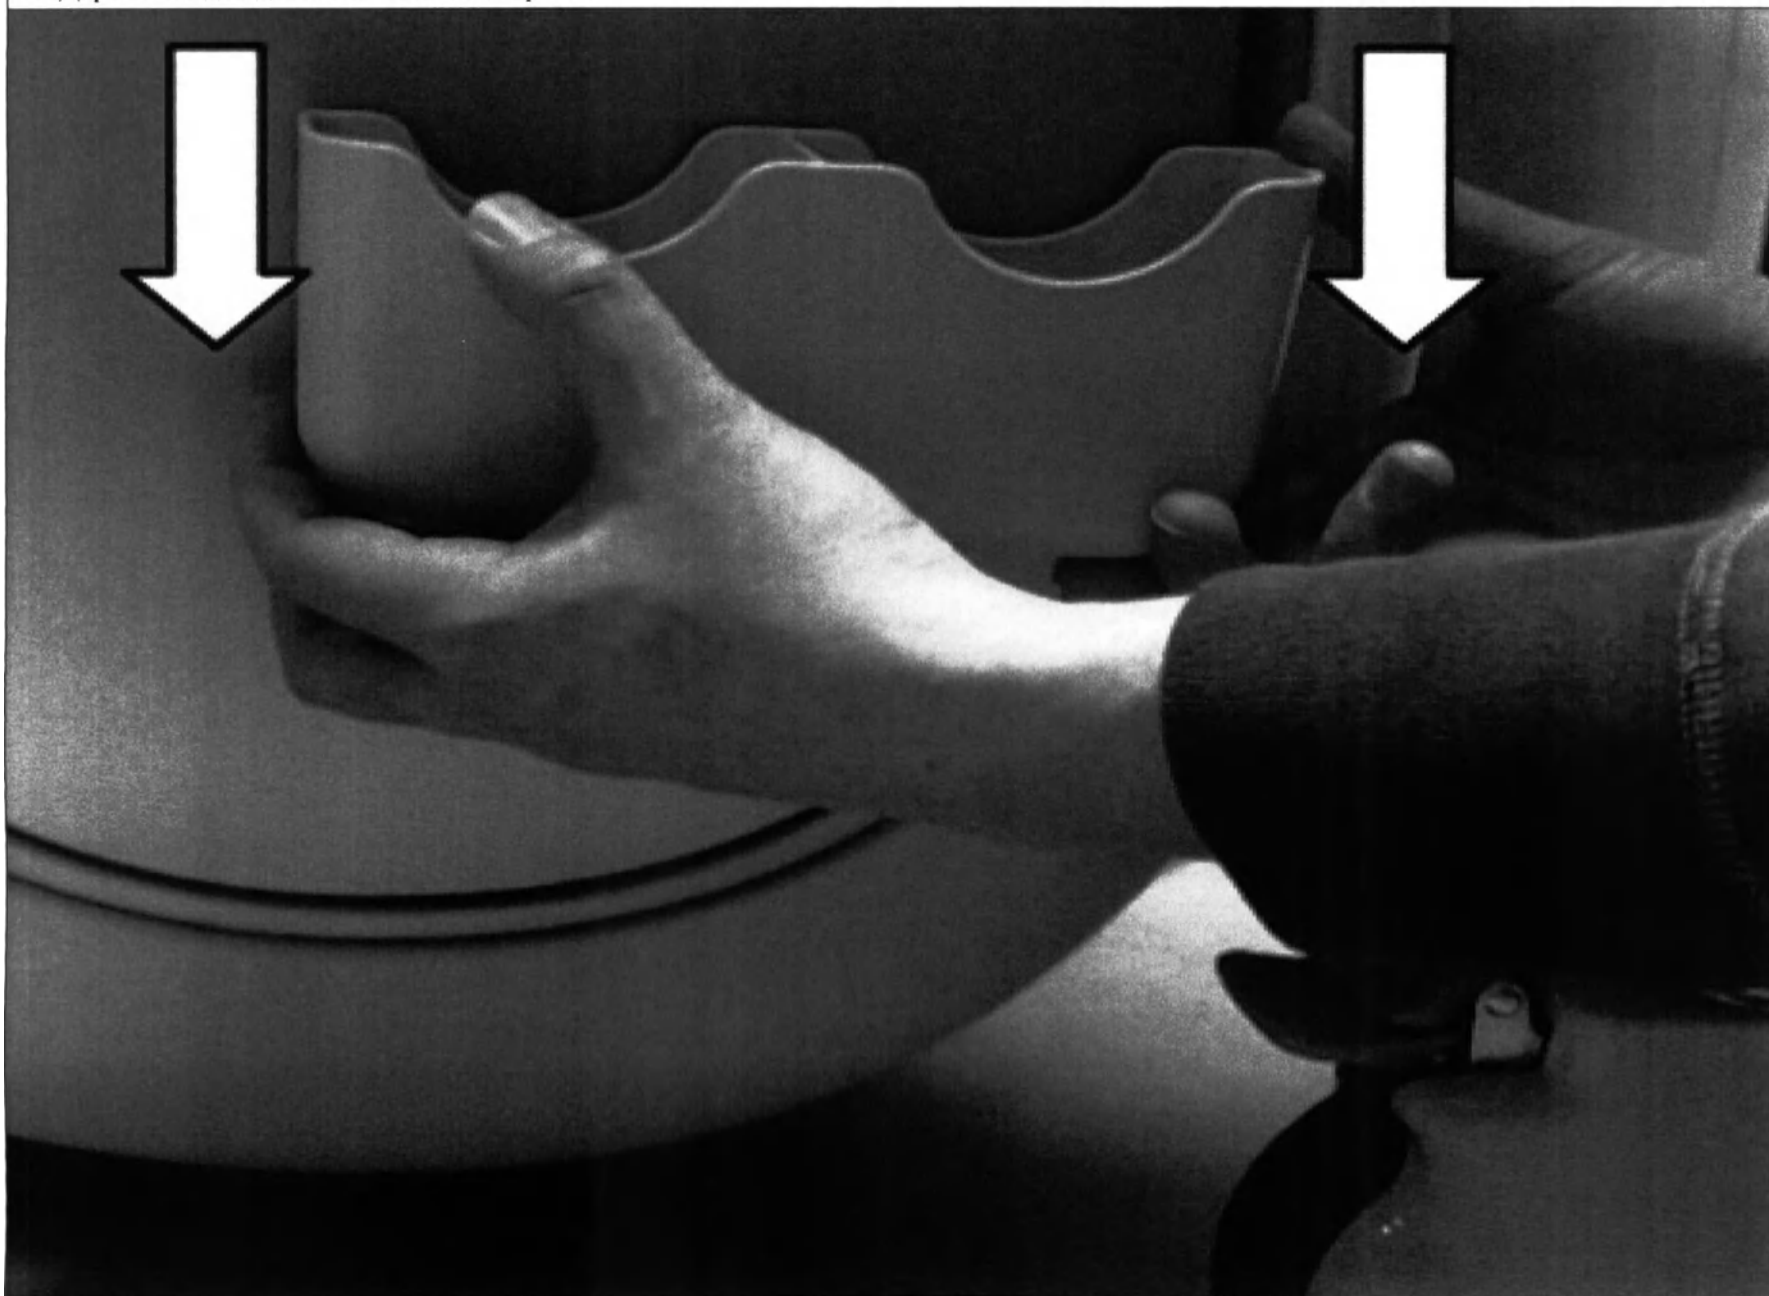


31. Держатель корзиночный.

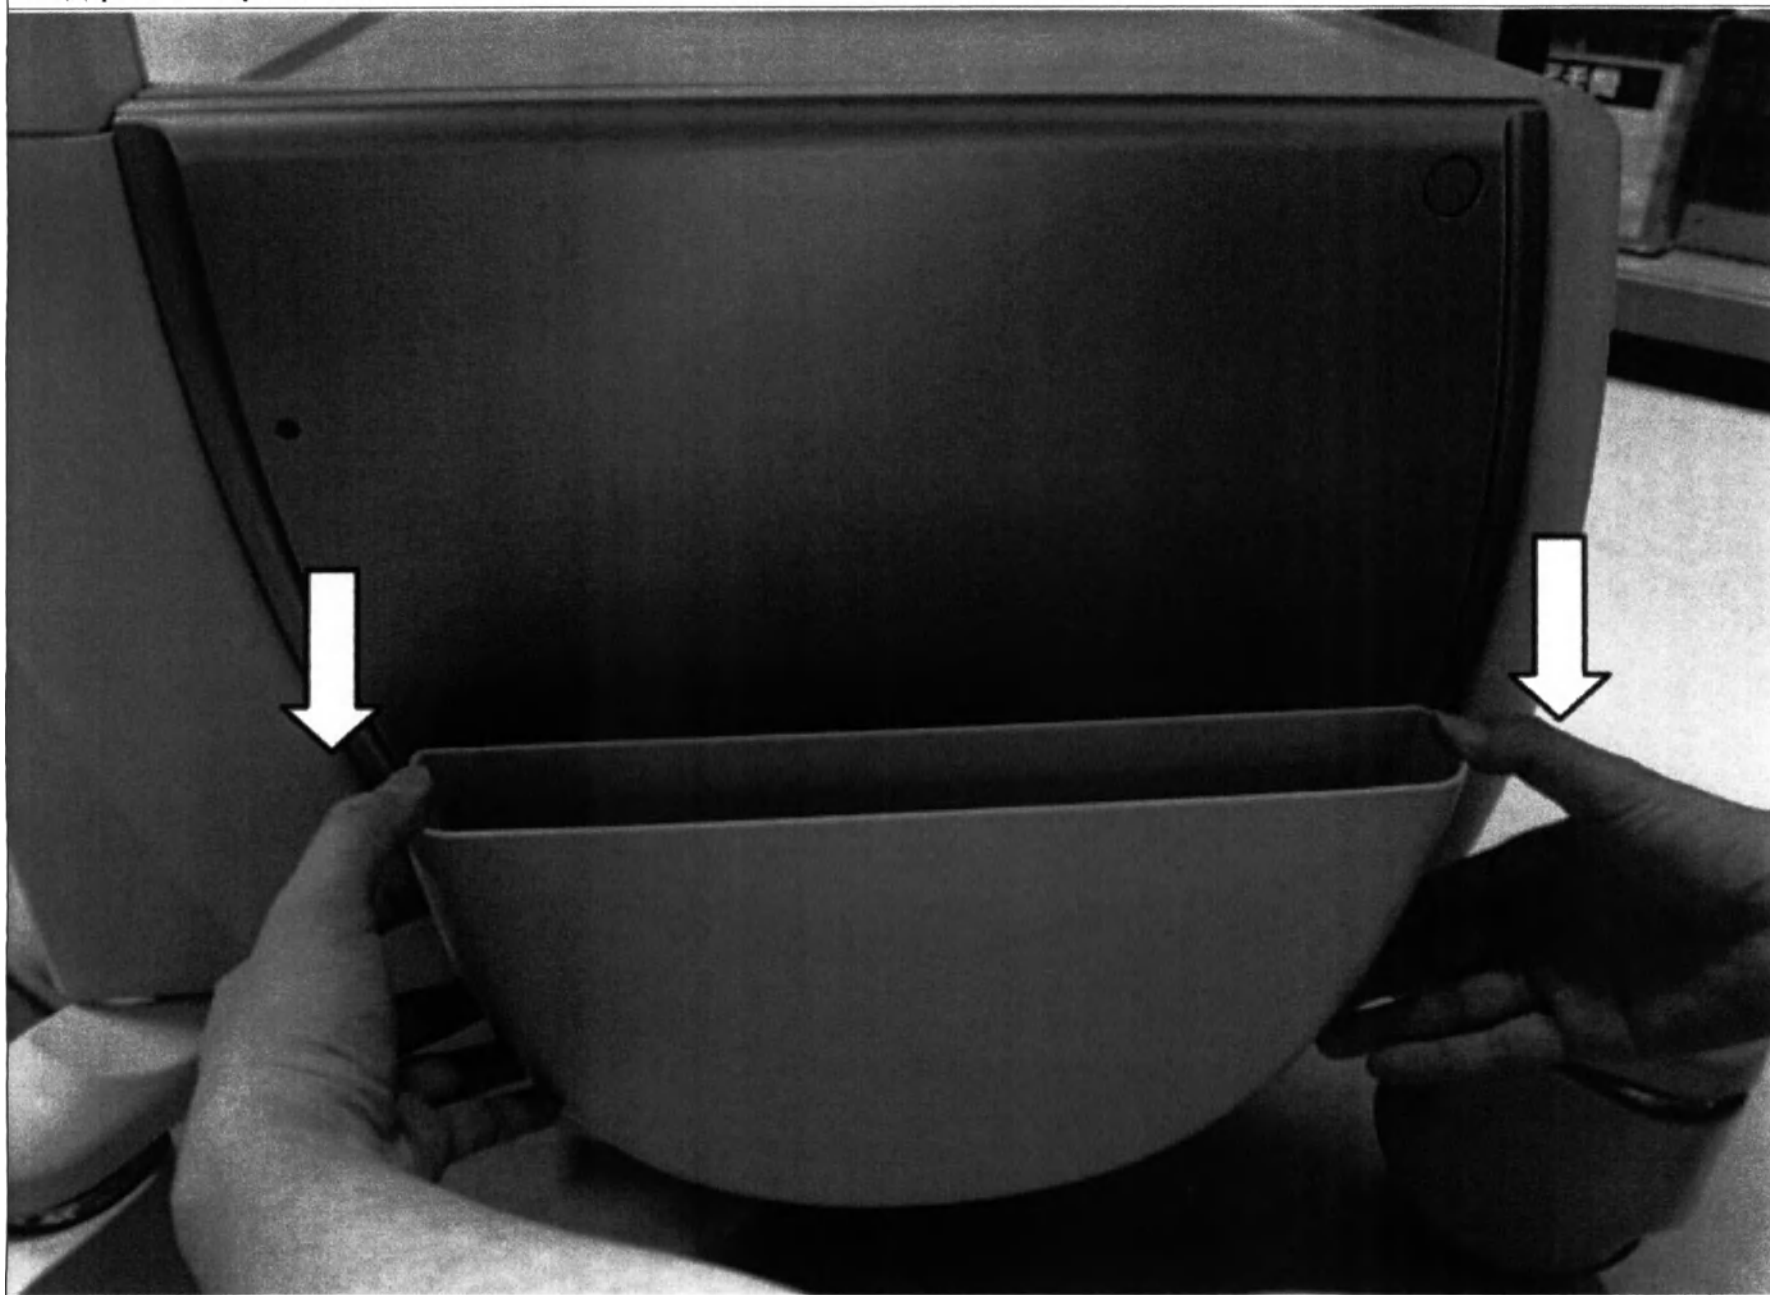


32. Комплект деталей для крепления черно-белого принтера слева.

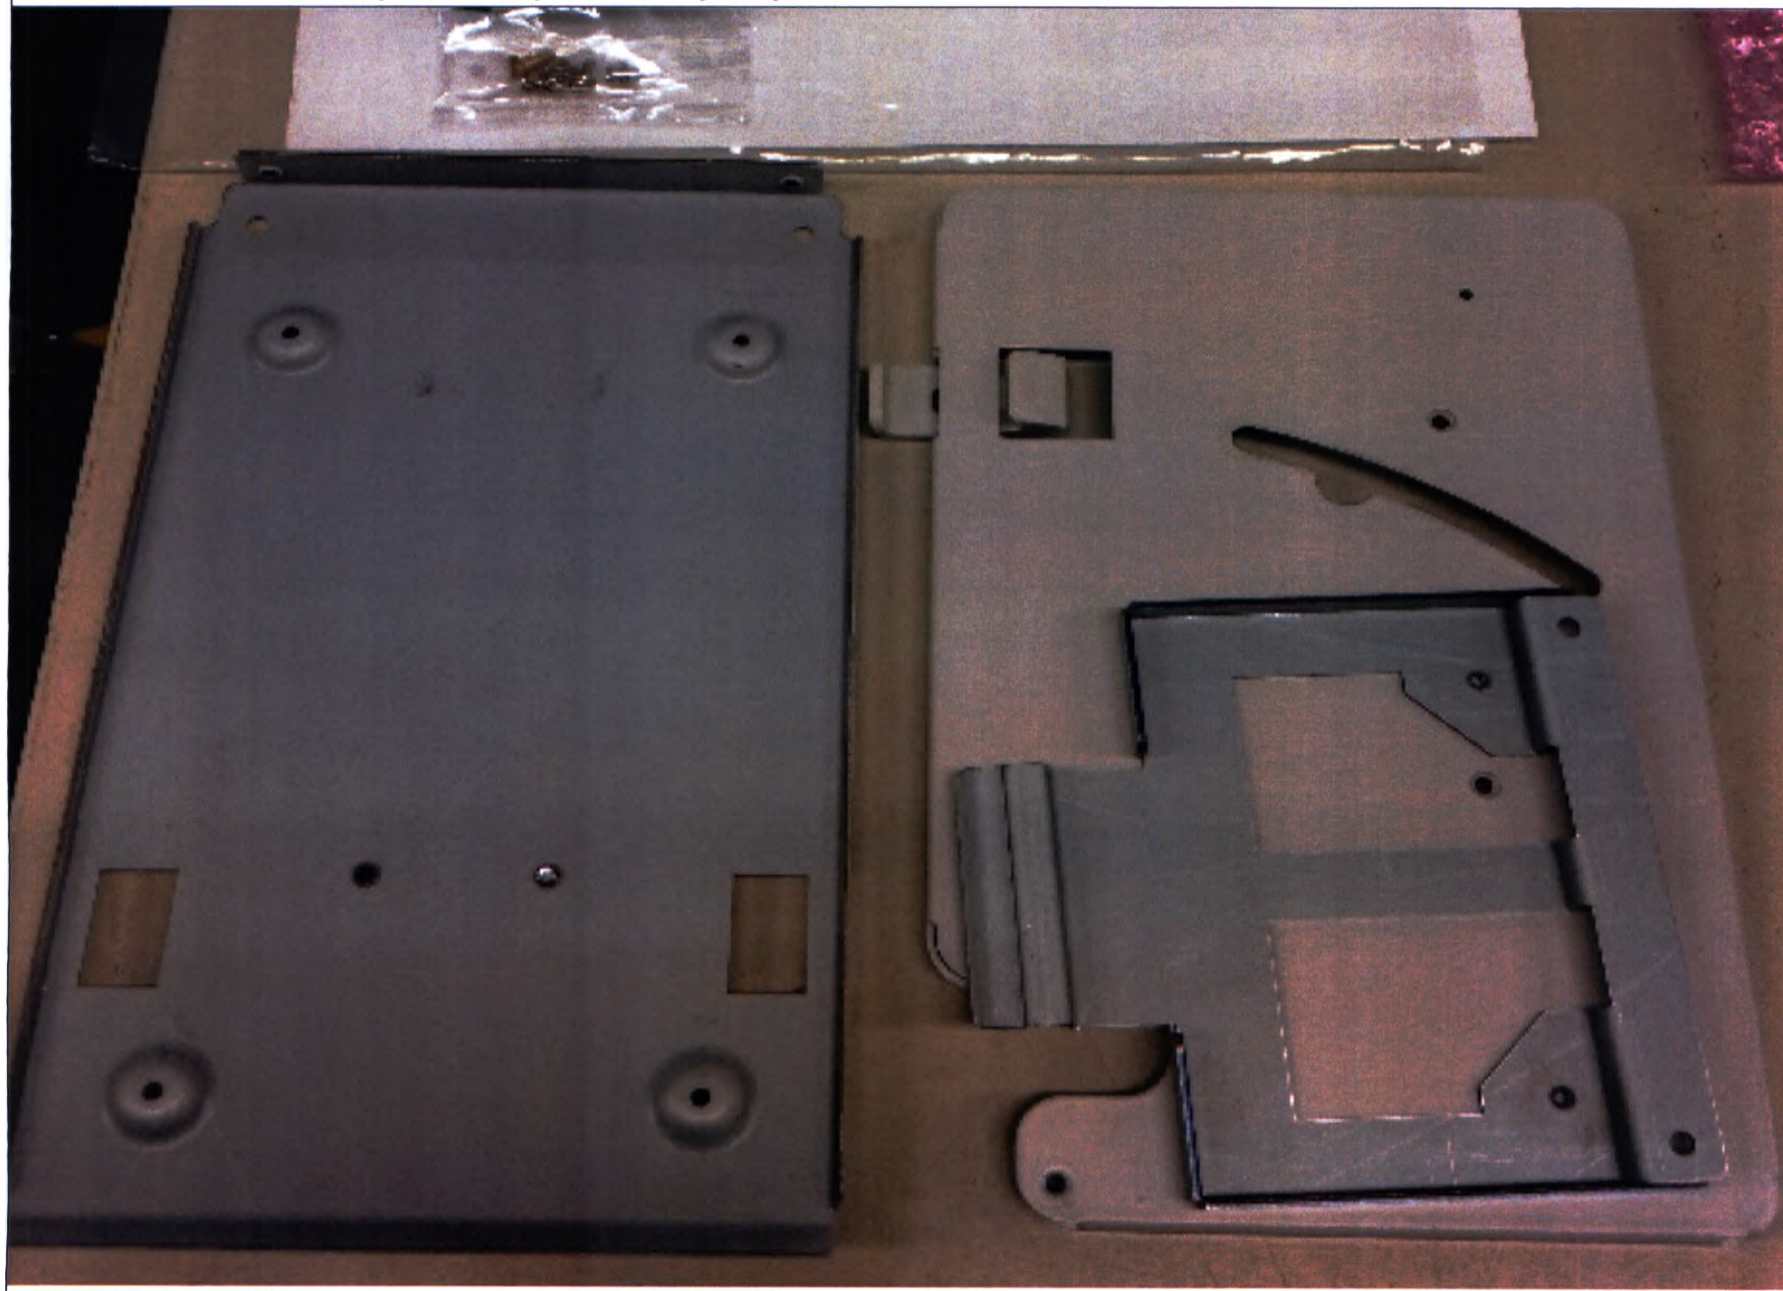


33. Комплект деталей для крепления черно-белого принтера справа.

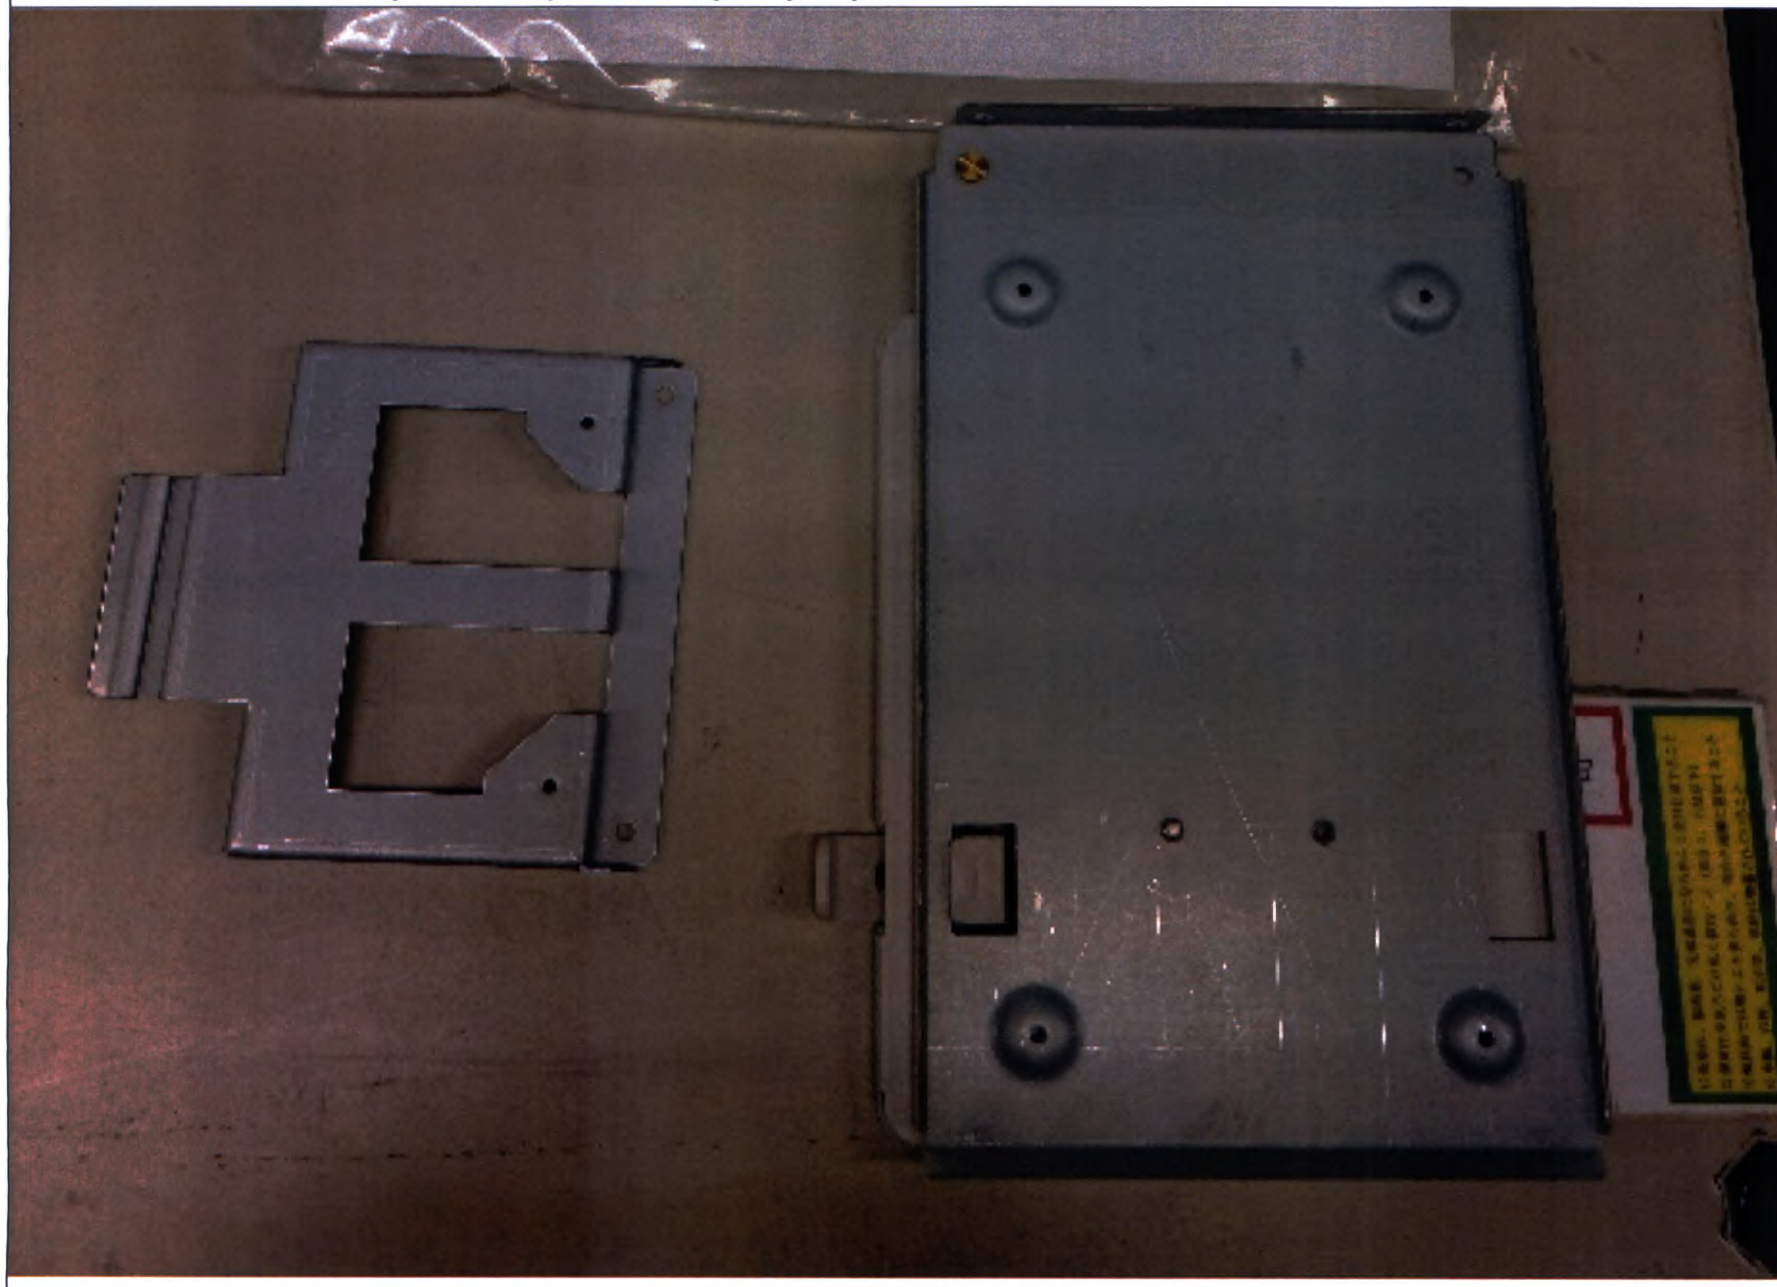


34. Комплект деталей для крепления цветного принтера

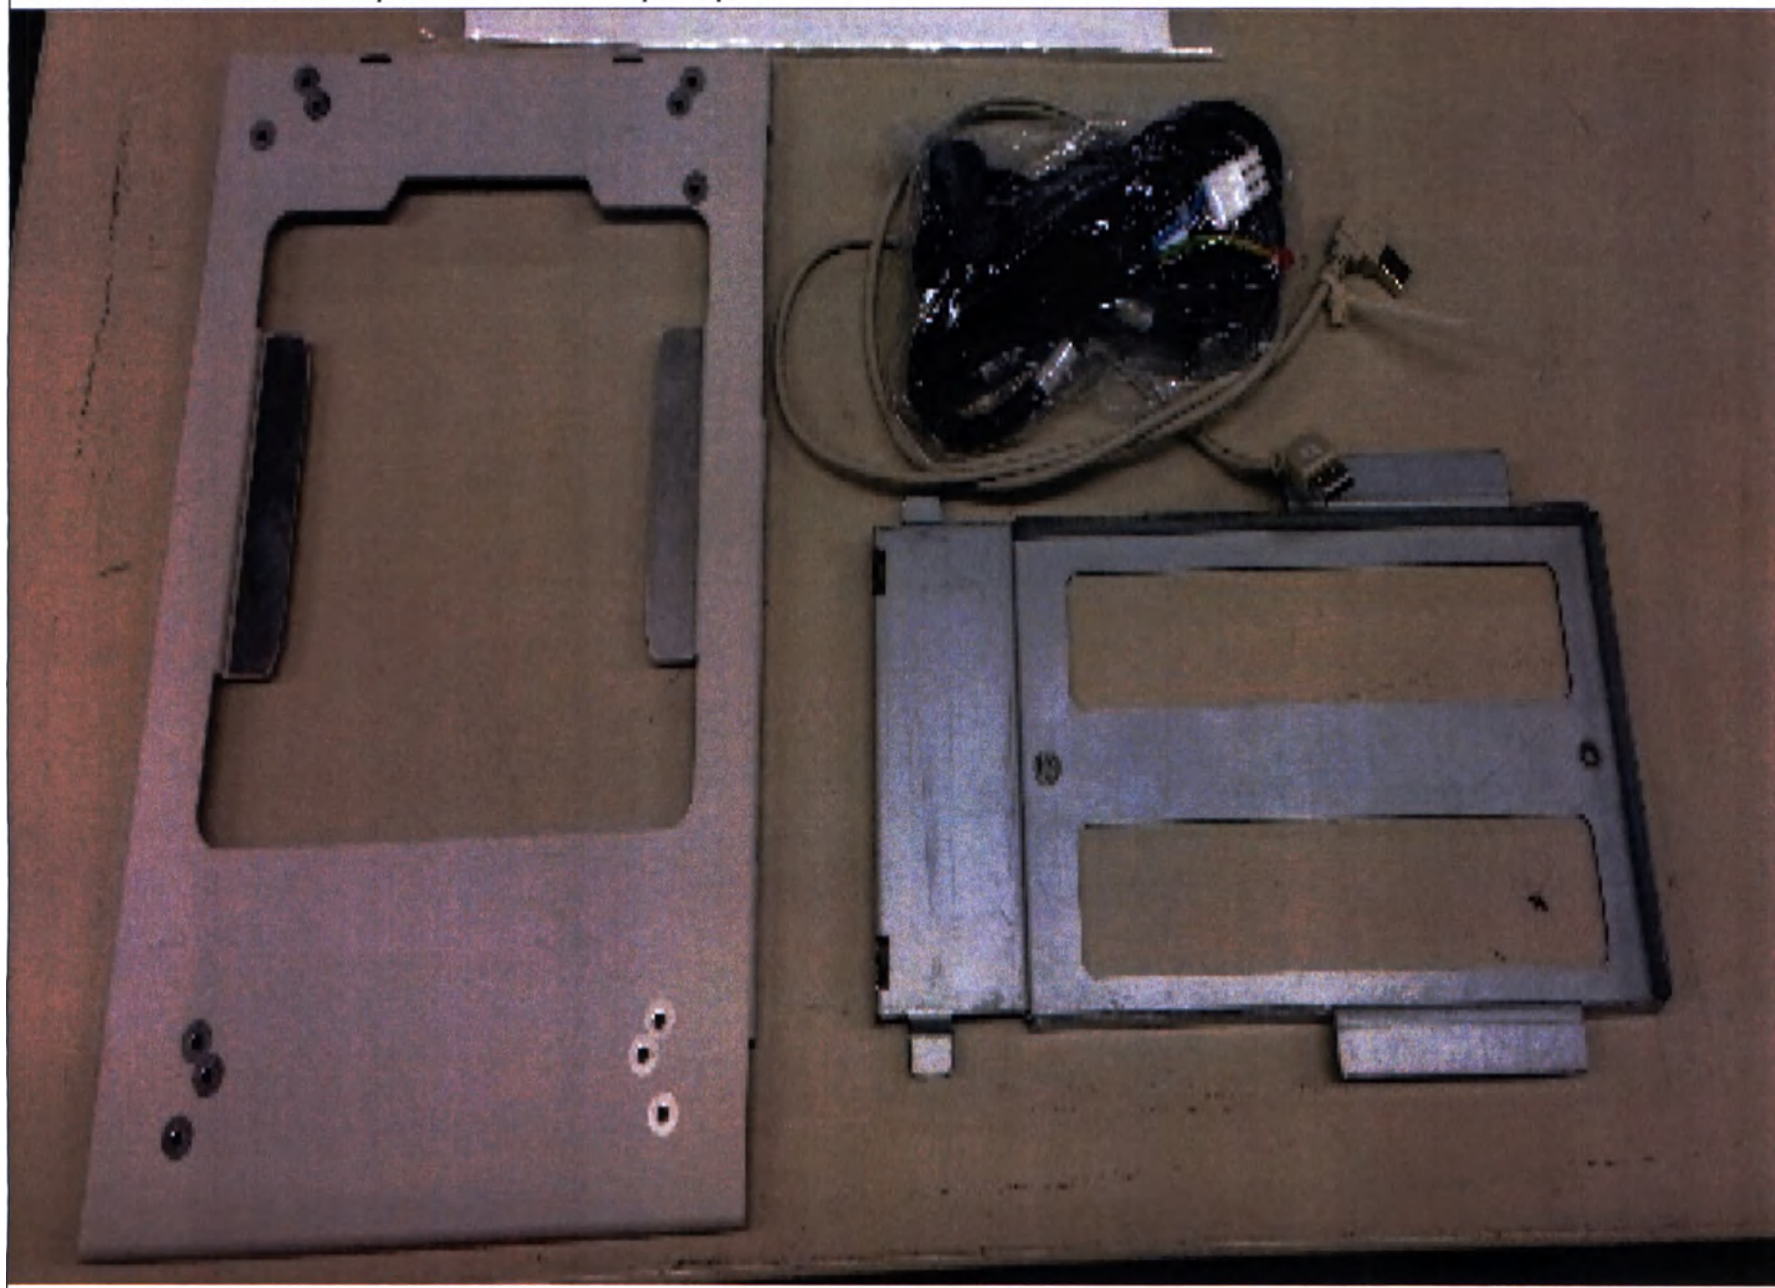

35. Комплект деталей для крепления DVD-рекодера.

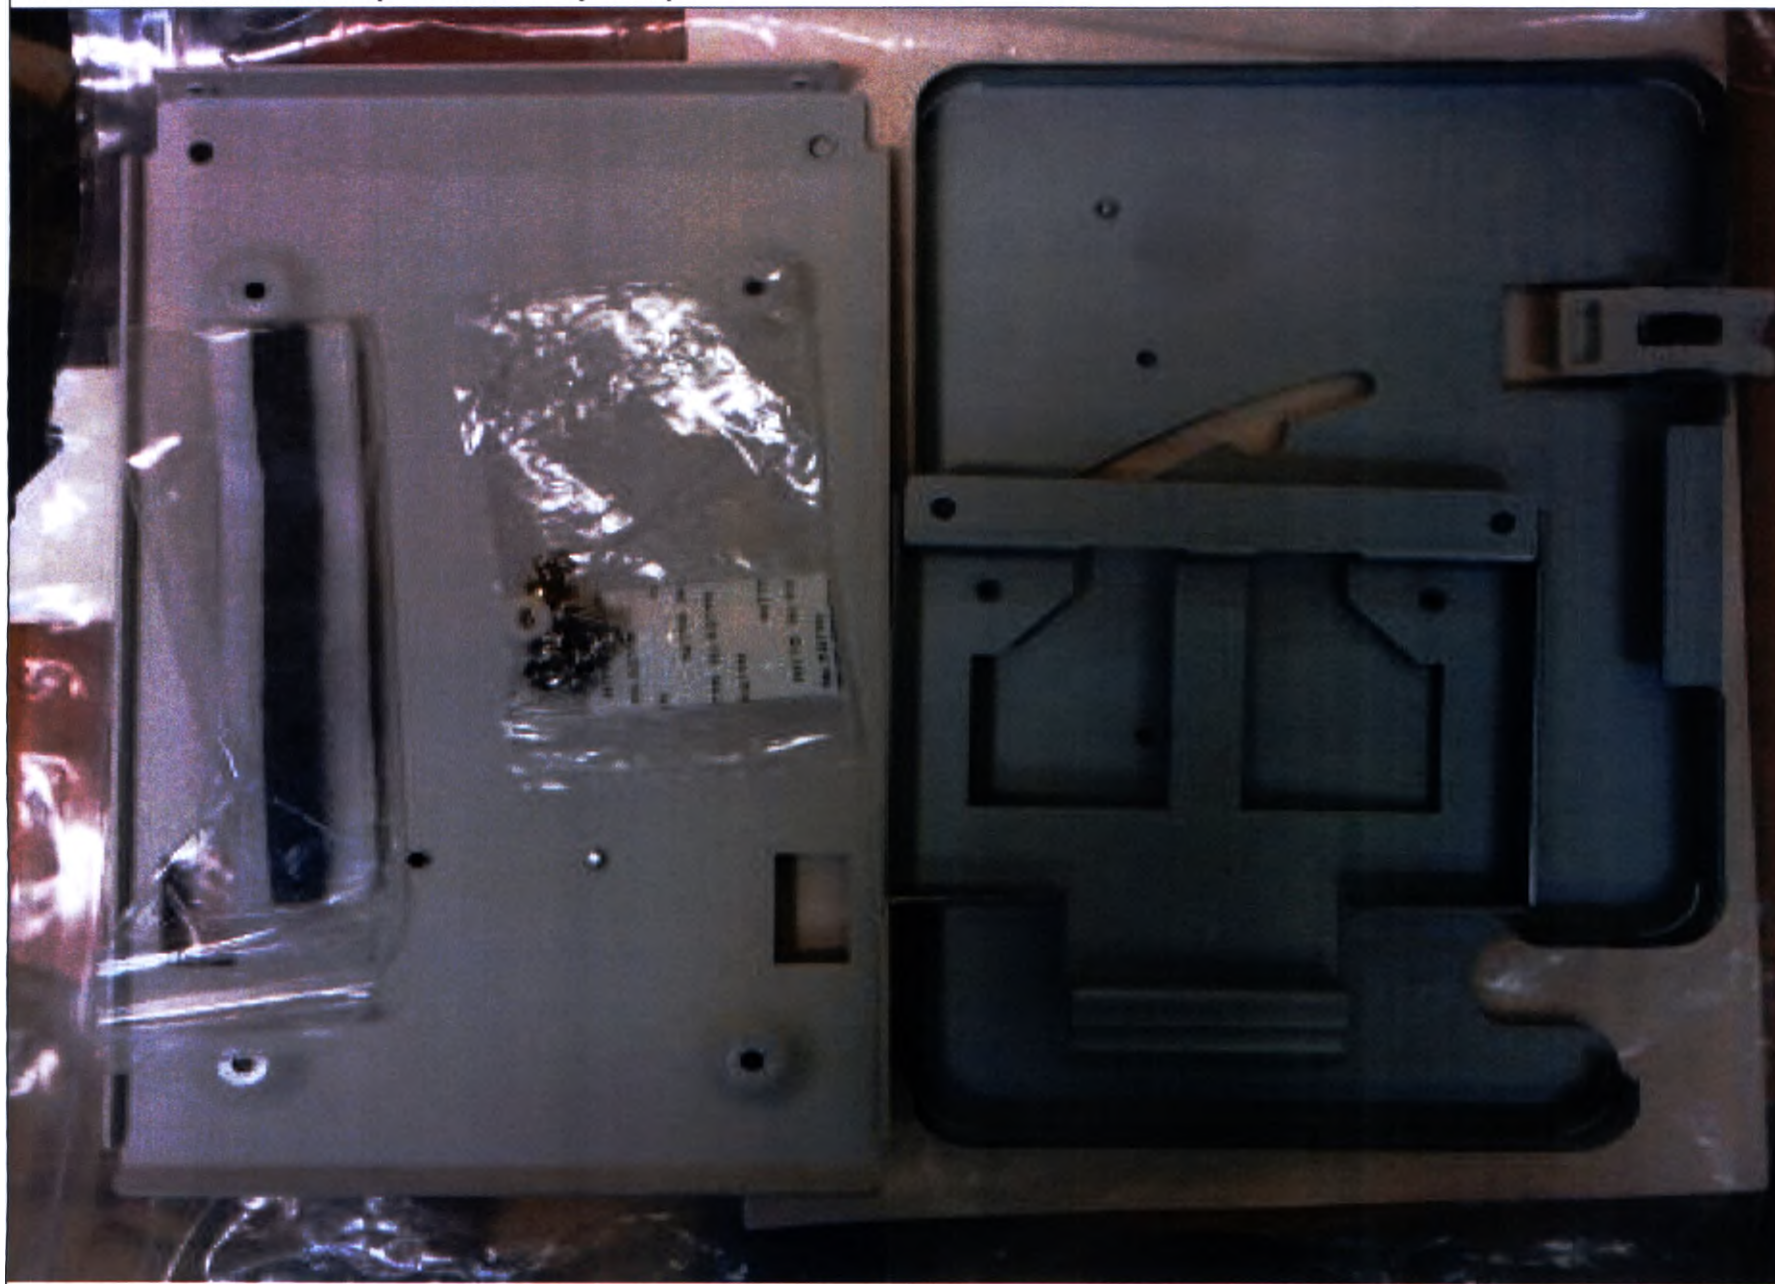

36. Комплект деталей для крепления цветного принтера и DVD-рекодера.

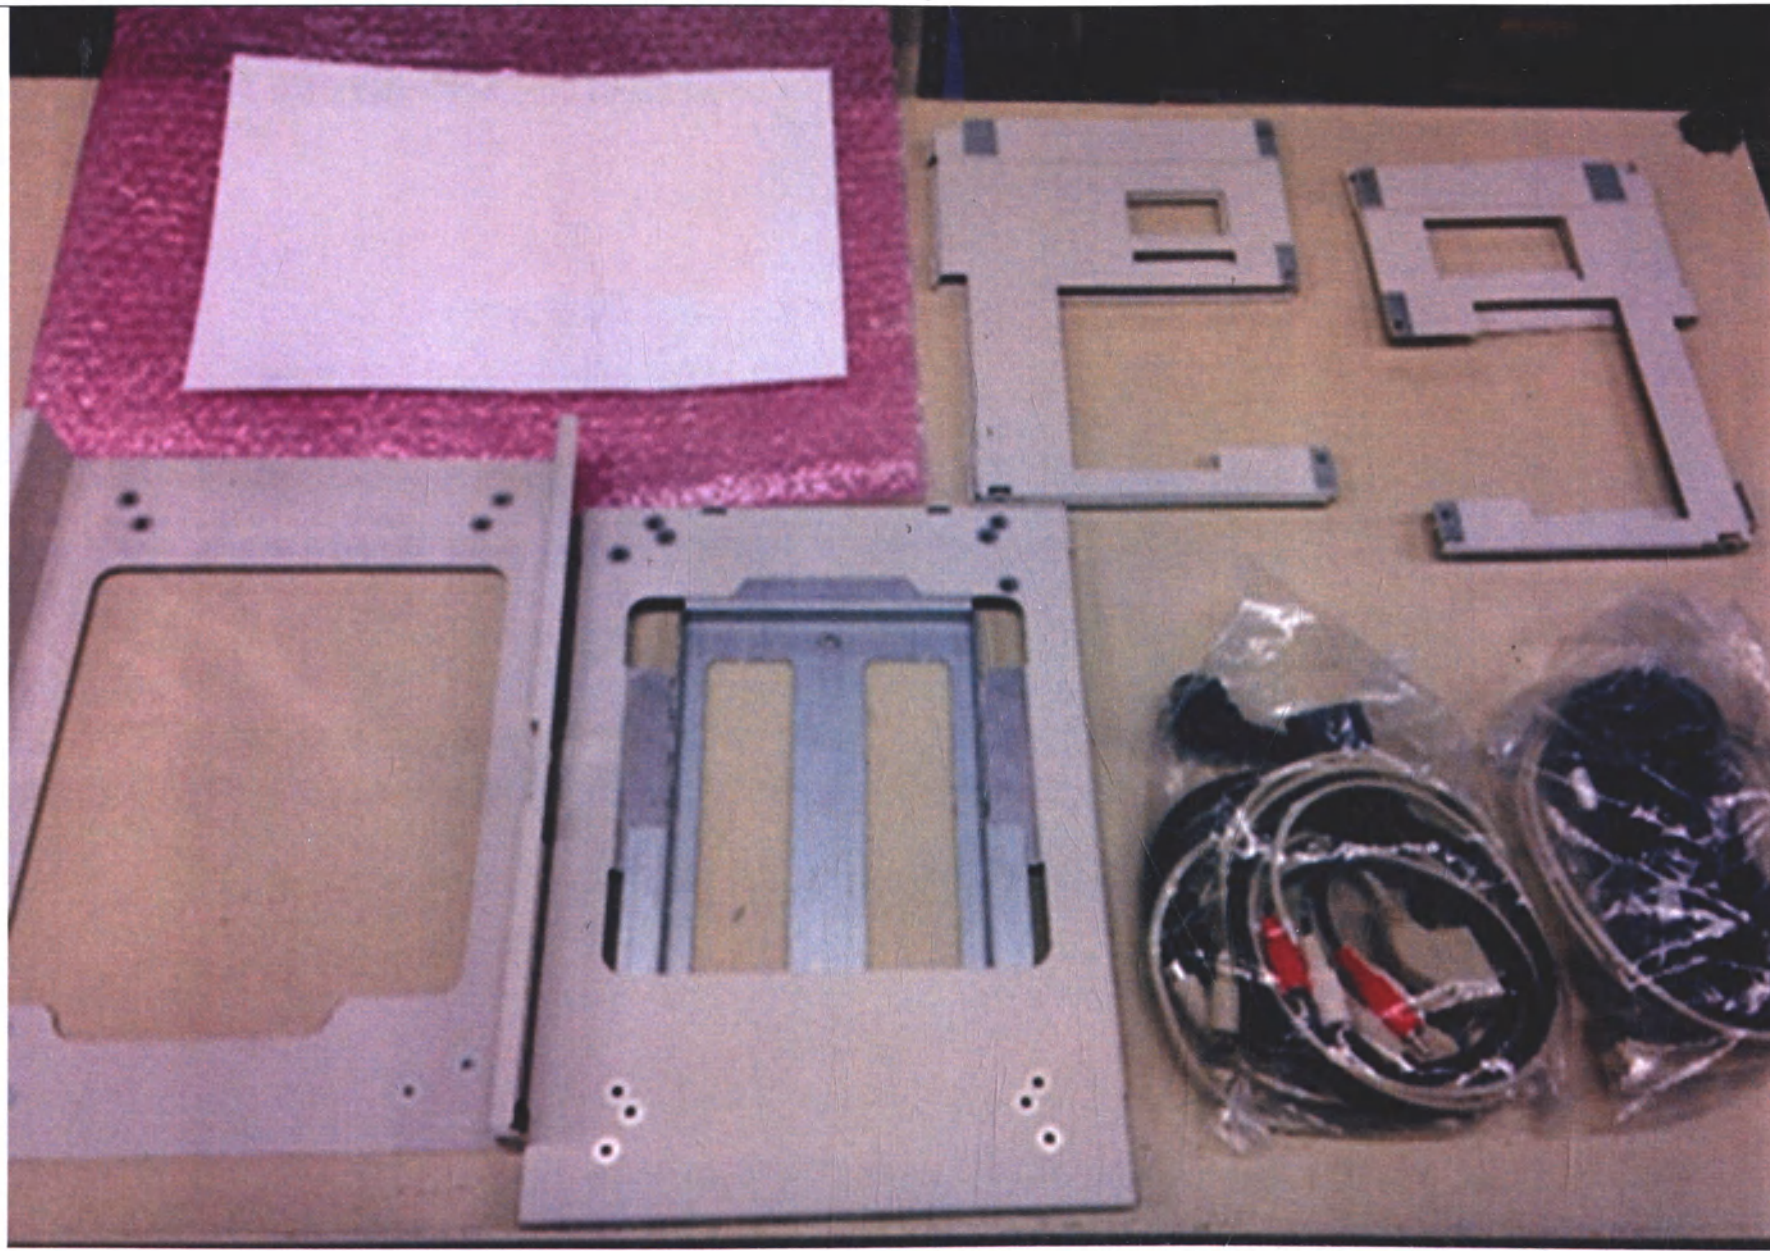



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 116 листов

Подпись _____