

Фотографические изображения
медицинского изделия

Система цифровая диагностическая ультразвуковая APLIO 500 (модель TUS-A500) с принадлежностями

Производства

Canon Medical Systems Corporation, Япония

(Канон Медикал Системз Корпорейшн), Япония

**1385 Shimoishigami, Otawara-shi, Tochigi, 324-8550,
Japan**

Система диагностическая ультразвуковая Aplio 500 (модель TUS-A500) с принадлежностями



Система диагностическая ультразвуковая Aplio 500 (модель TUS-A500) с принадлежностями (макет маркировки на русском языке)



CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION
1385 SHIMOISHIGAMI, OTAWARA-SHI, TOCHIGI,
324-8550, JAPAN

Система диагностическая ультразвуковая Aplio 500
(модель TUS-A500) с принадлежностями

Регистрационное Удостоверение


№ _____ от _____

Сделано в _____

Основной блок системы TUS-A500:

4

1. Монитор цветной жидкокристаллический.

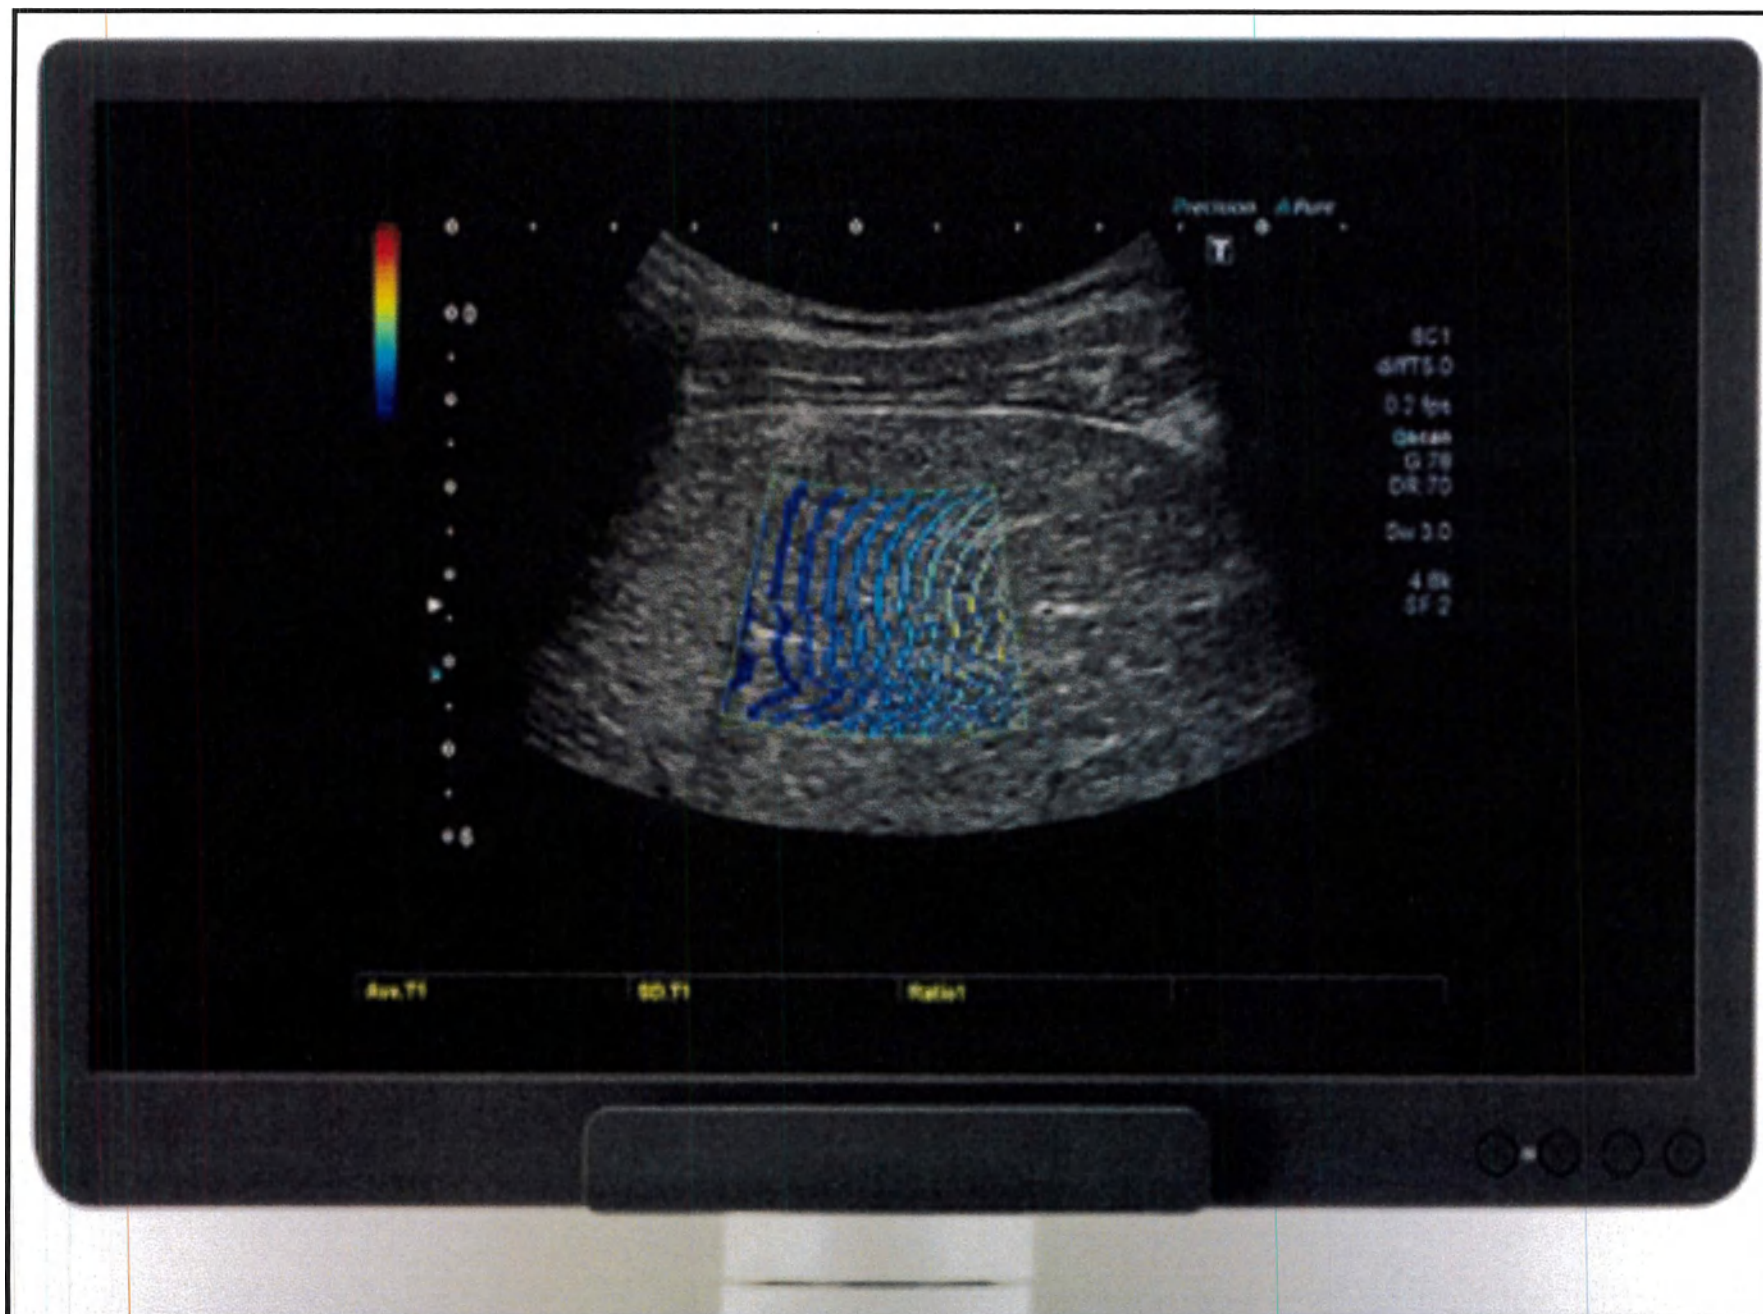

Основной блок системы TUS-A500:

1. Монитор цветной жидкокристаллический.

5



2. Порт для датчиков.



3. Порт паркингový.




4. Порт для карандашного датчика.




5. Базовое системное программное обеспечение встроенное.



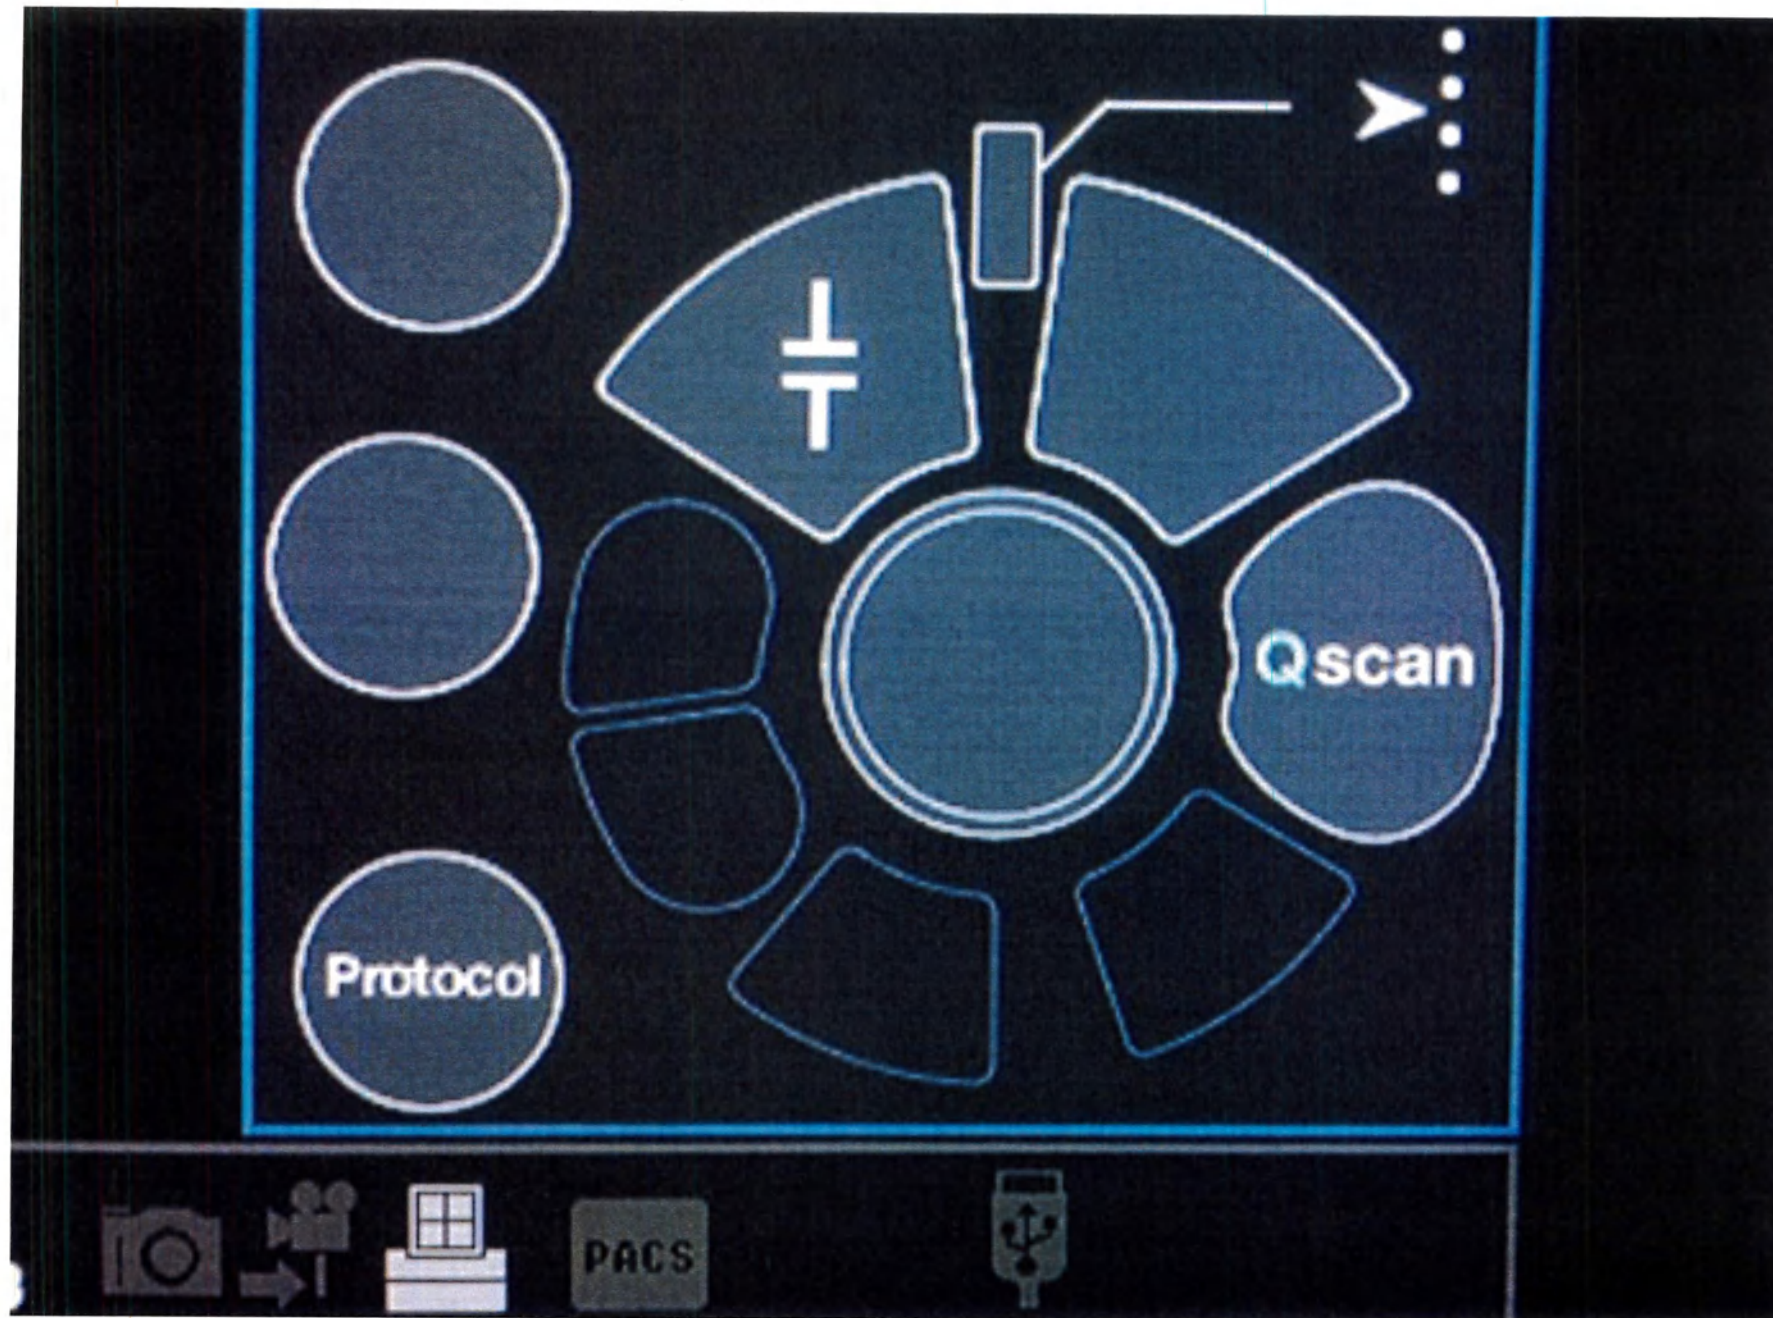

6. Интегрированная рабочая станция для архивации данных пациентов и эхографических изображений в формате DICOM.

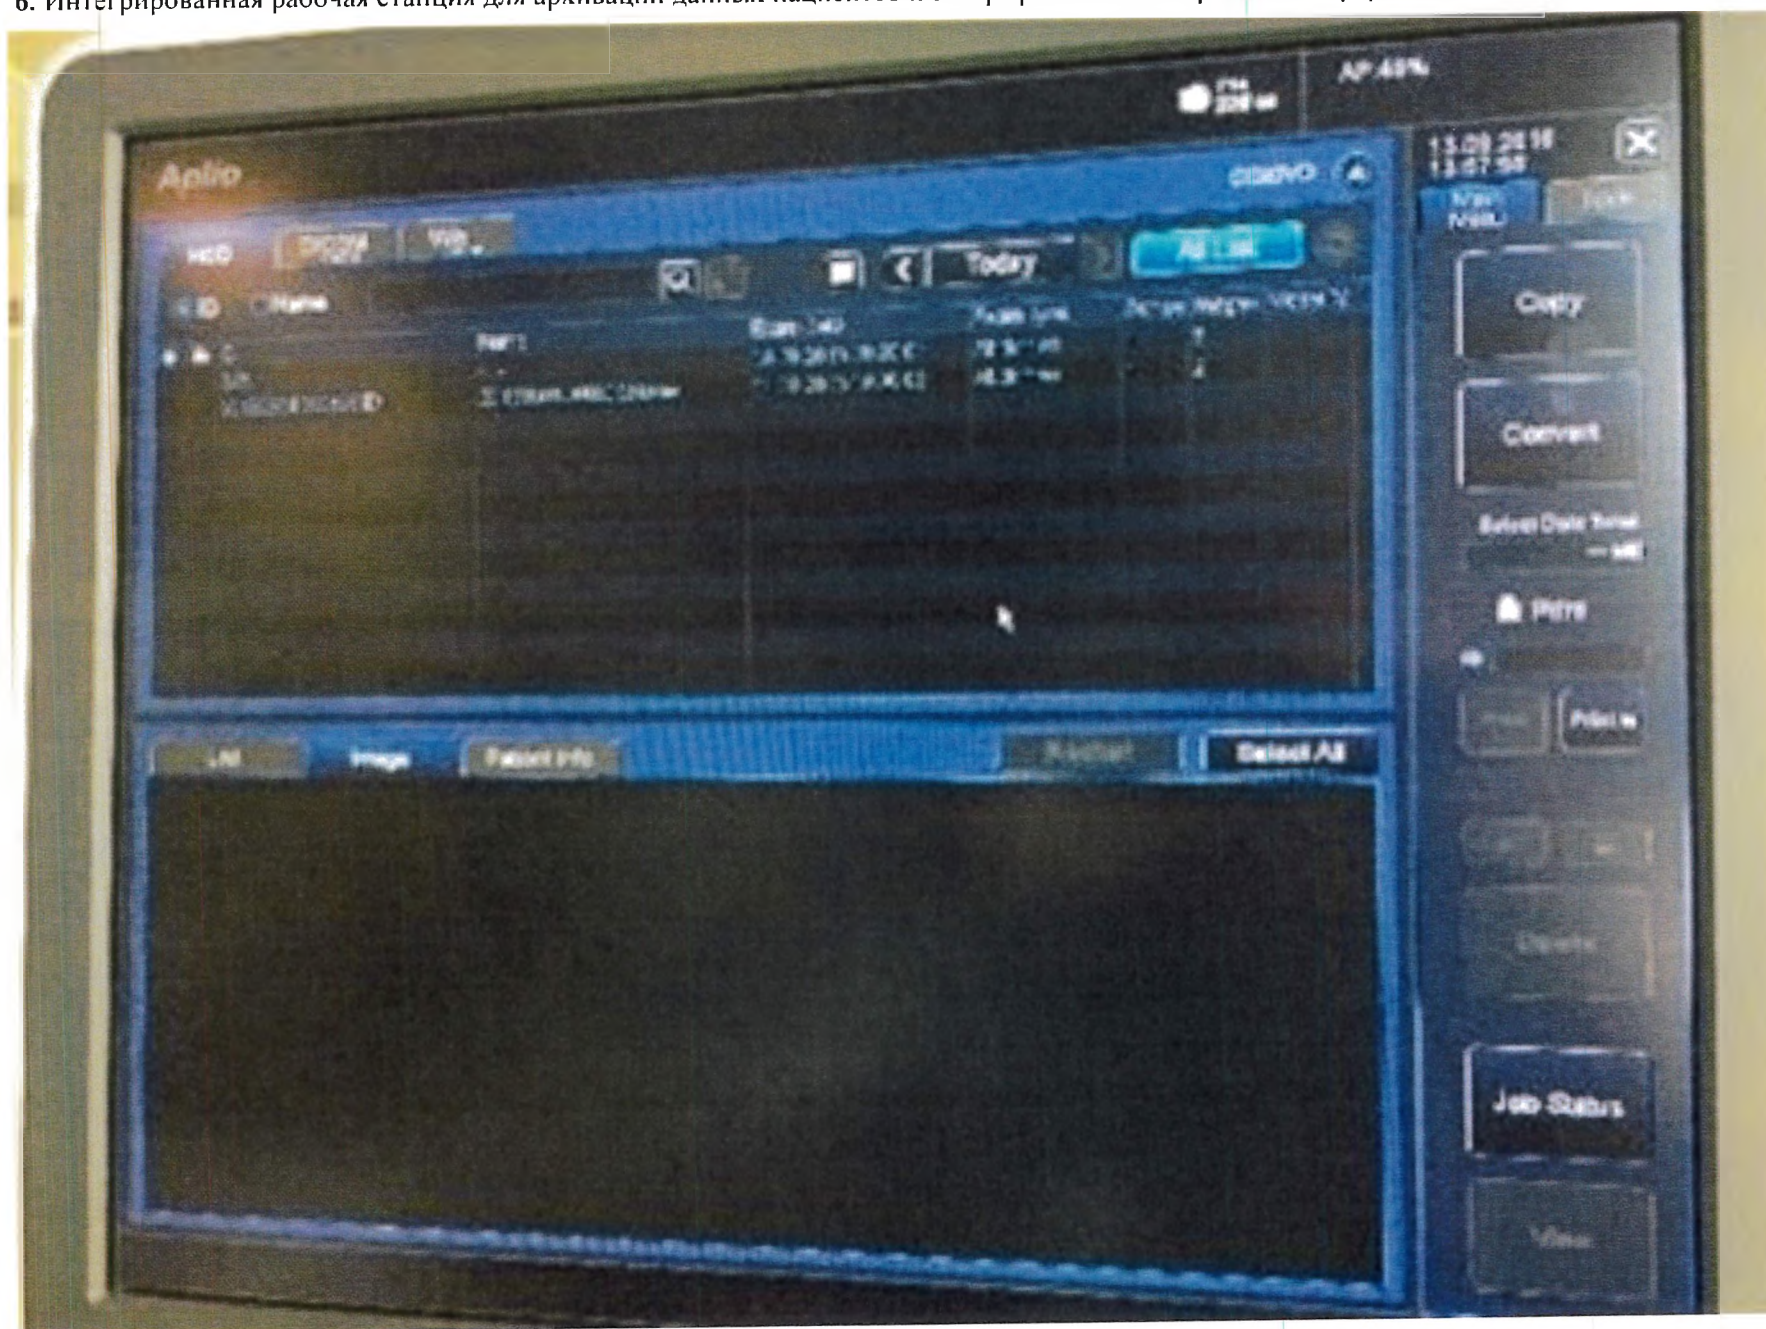

7. Дискковод записывающий DVD/CD.



8. Датчик конвексный, модель PVT-375BT.




8. Датчик конвексный, модель PVT-375BT.



8. Датчик конвексный, модель PVT-375BT.



9. Датчик конвексный, модель PVT-375SC.

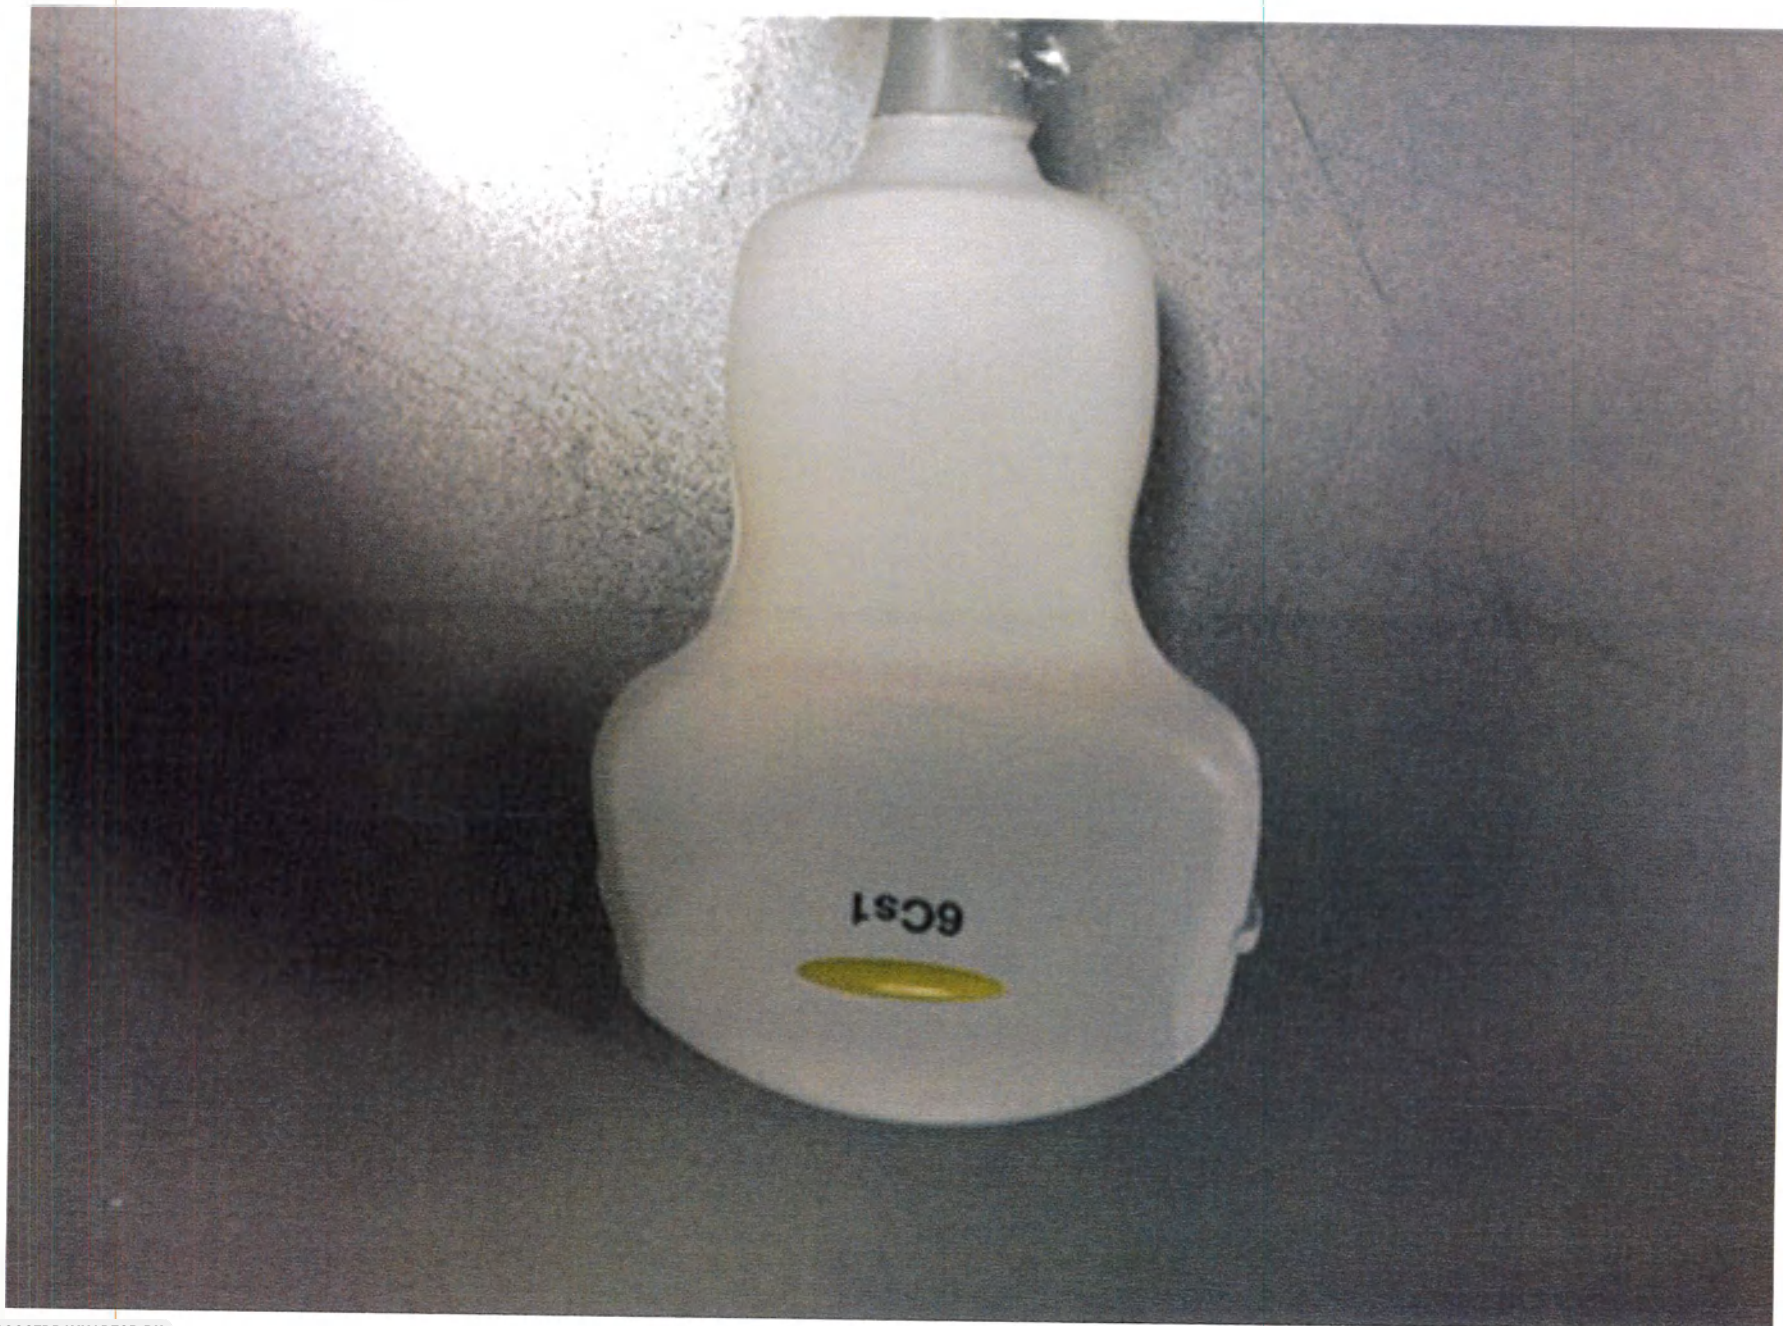


9. Датчик конвексный, модель PVT-375SC.




9. Датчик конвексный, модель PVT-375SC.




10. Датчик конвексный, модель PVT-382BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544

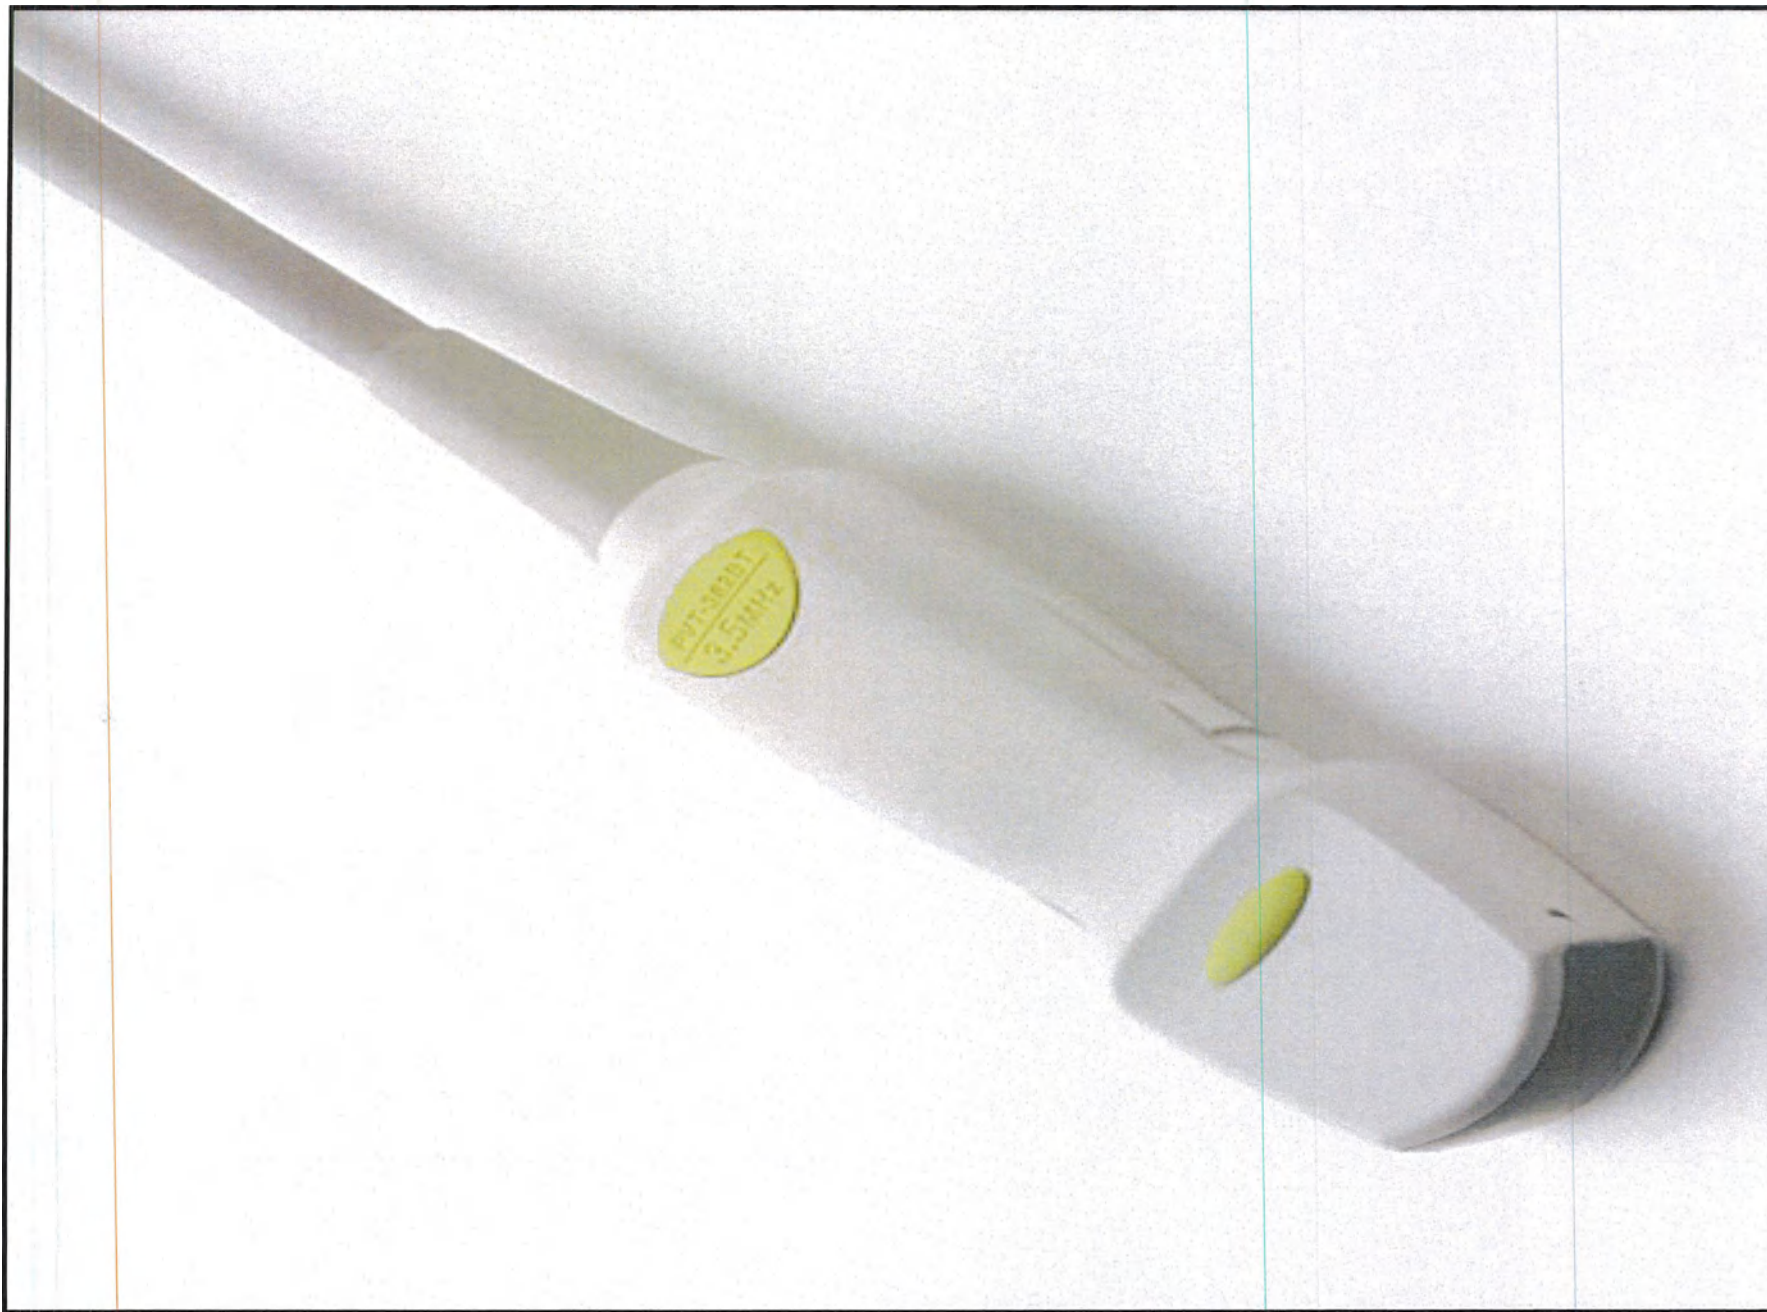

10. Датчик конвексный, модель PVT-382BT.

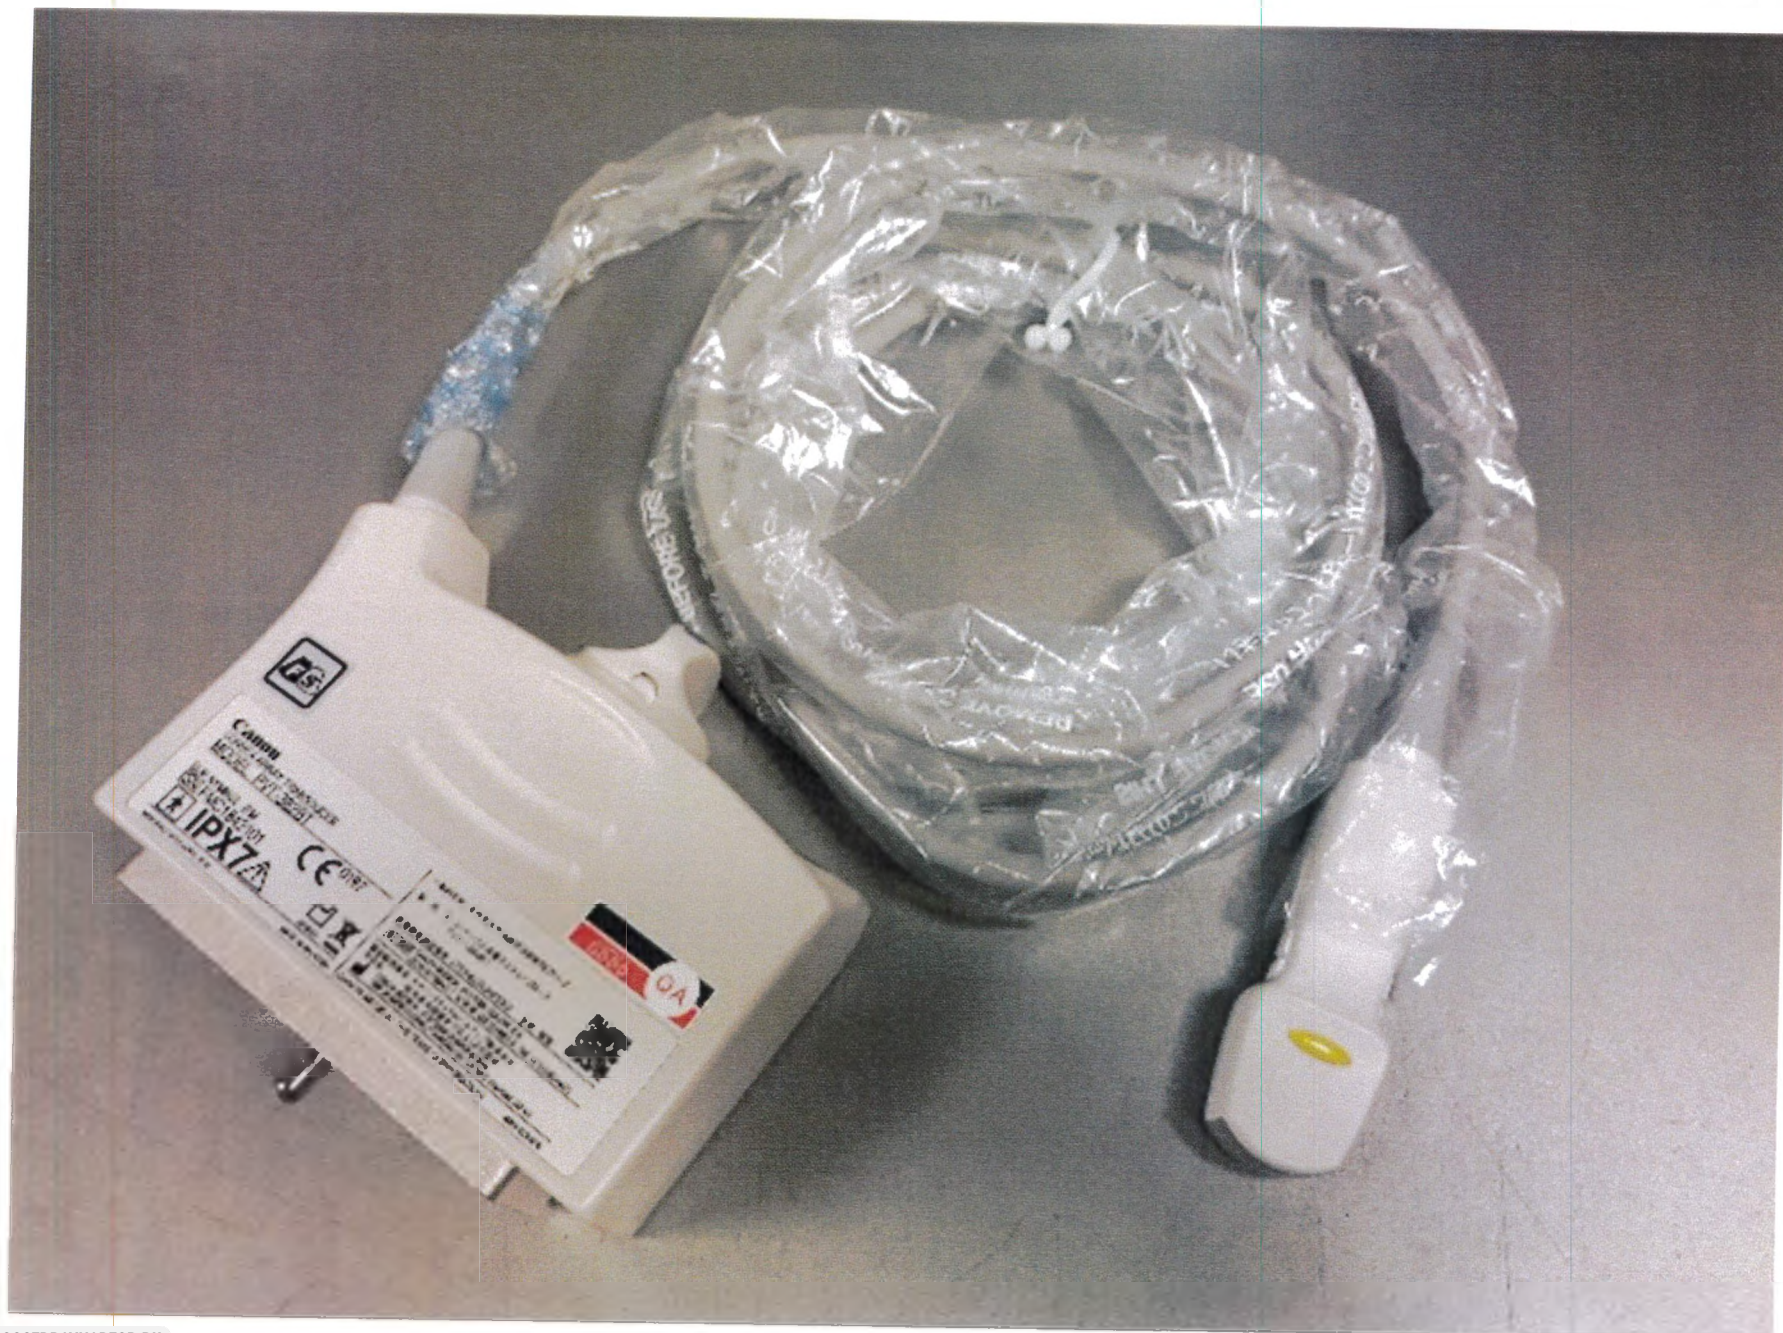

10. Датчик конвексный, модель PVT-382BT.

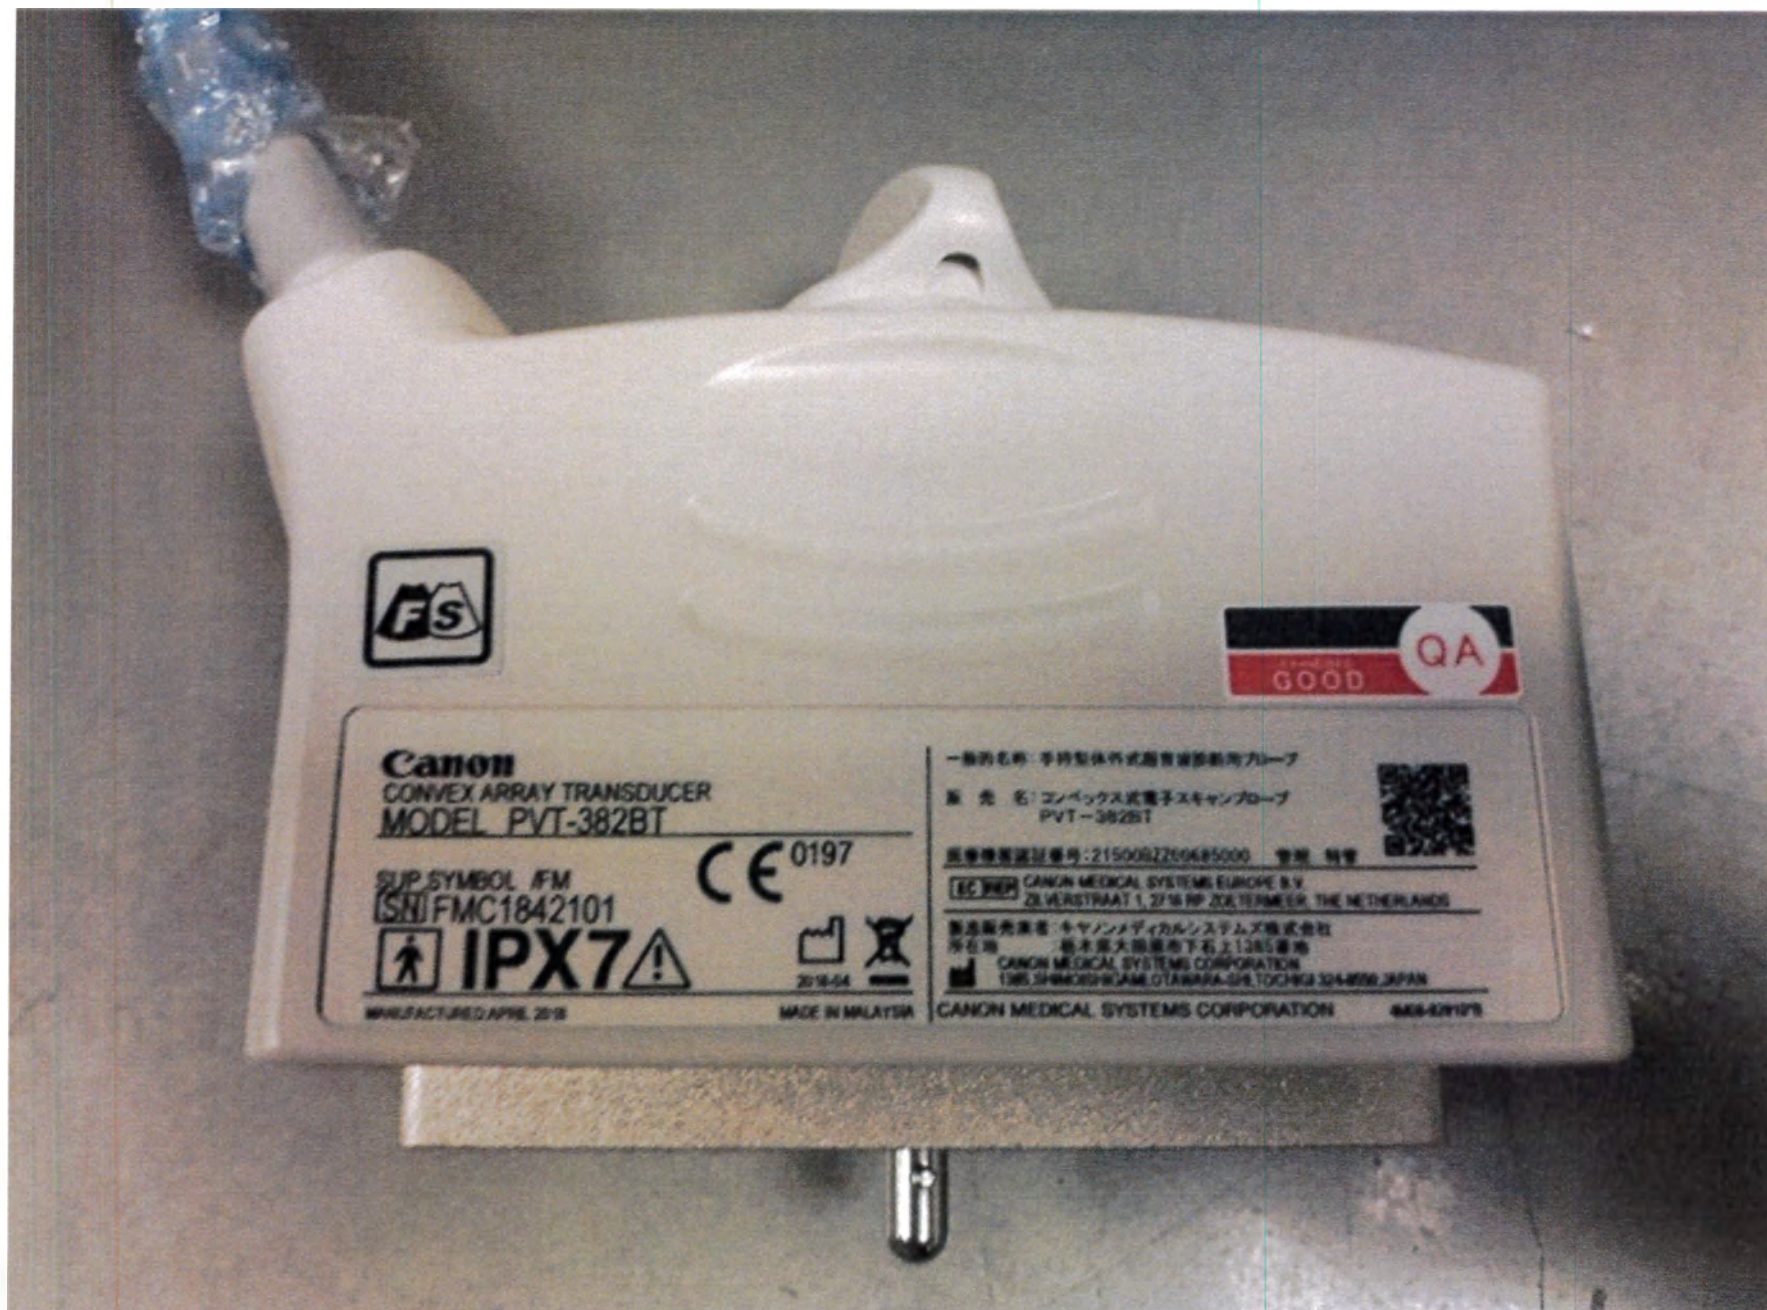

11. Датчик конвексный, модель PVT-674BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544



11. Датчик конвексный, модель PVT-674BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544



11. Датчик конвексный, модель PVT-674BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544



12. Датчик конвексный, модель PVT-712BT.



12. Датчик конвексный, модель PVT-712BT.



12. Датчик конвексный, модель PVT-712BT.




13. Датчик линейный, модель PLT-705BT.



13. Датчик линейный, модель PLT-705BT.



13. Датчик линейный, модель PLT-705BT.

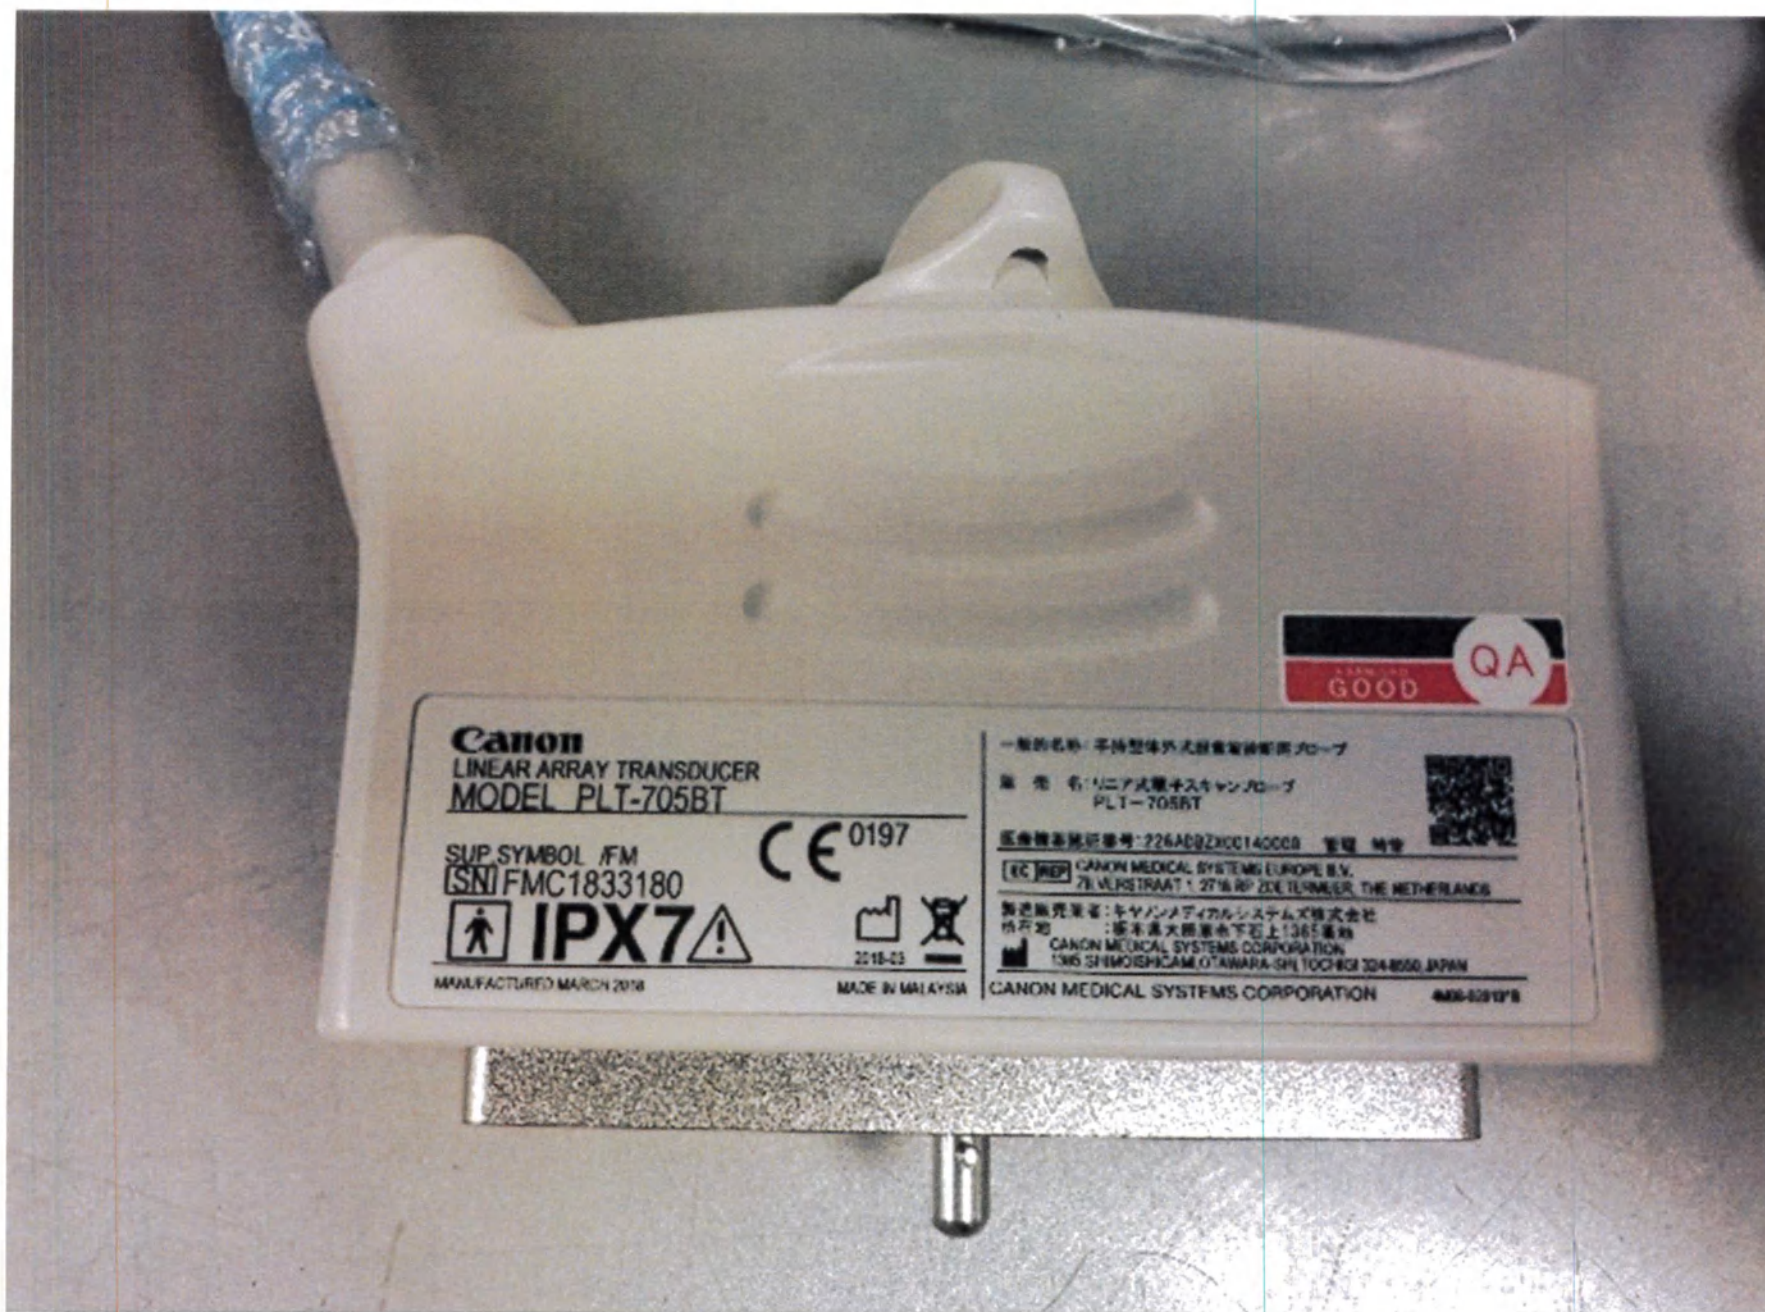


14. Датчик линейный, модель PLT-704SBT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544



14. Датчик линейный, модель PLT-704SBT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544




14. Датчик линейный, модель PLT-704SBT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544

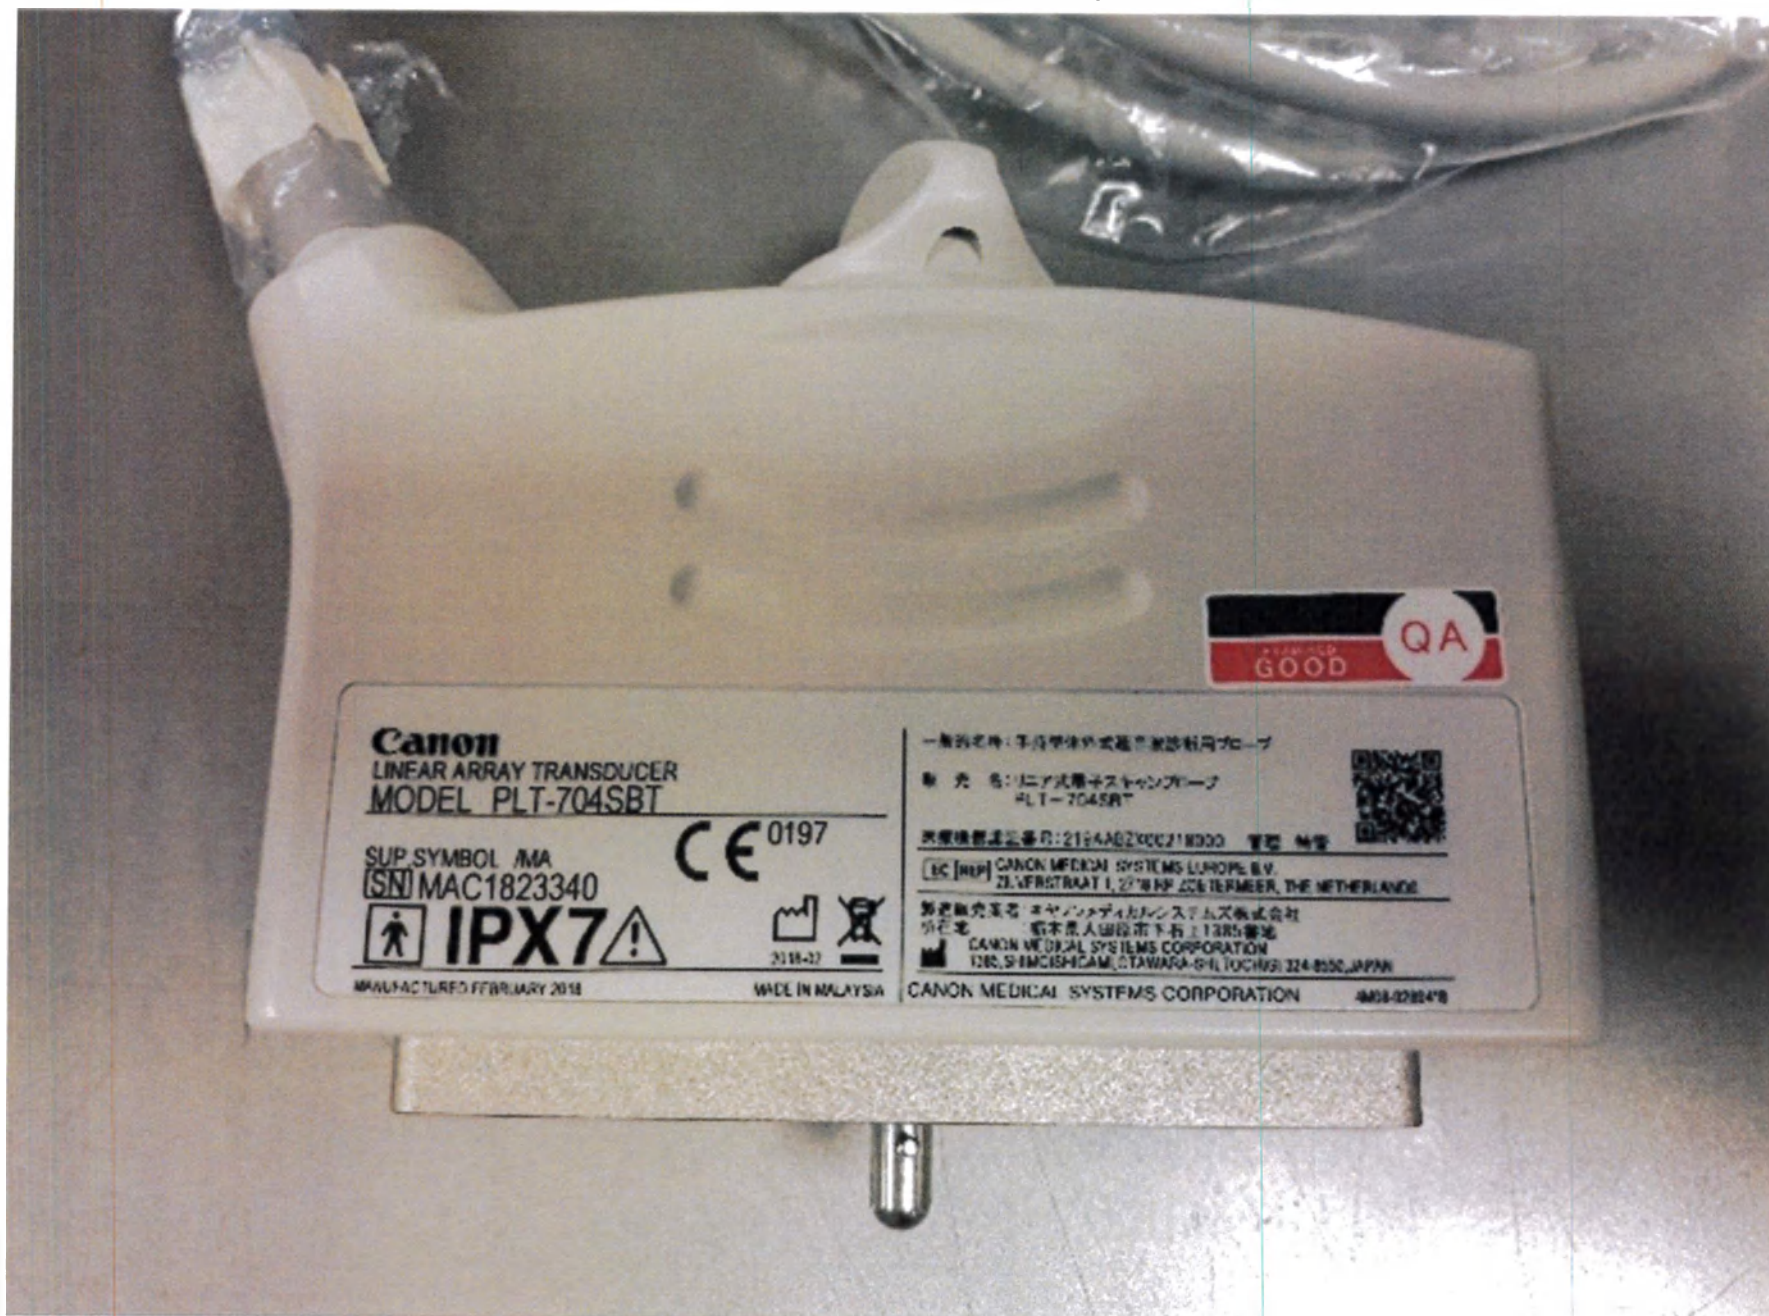

15. Датчик линейный, модель PLT-1005BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544




15. Датчик линейный, модель PLT-1005BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544

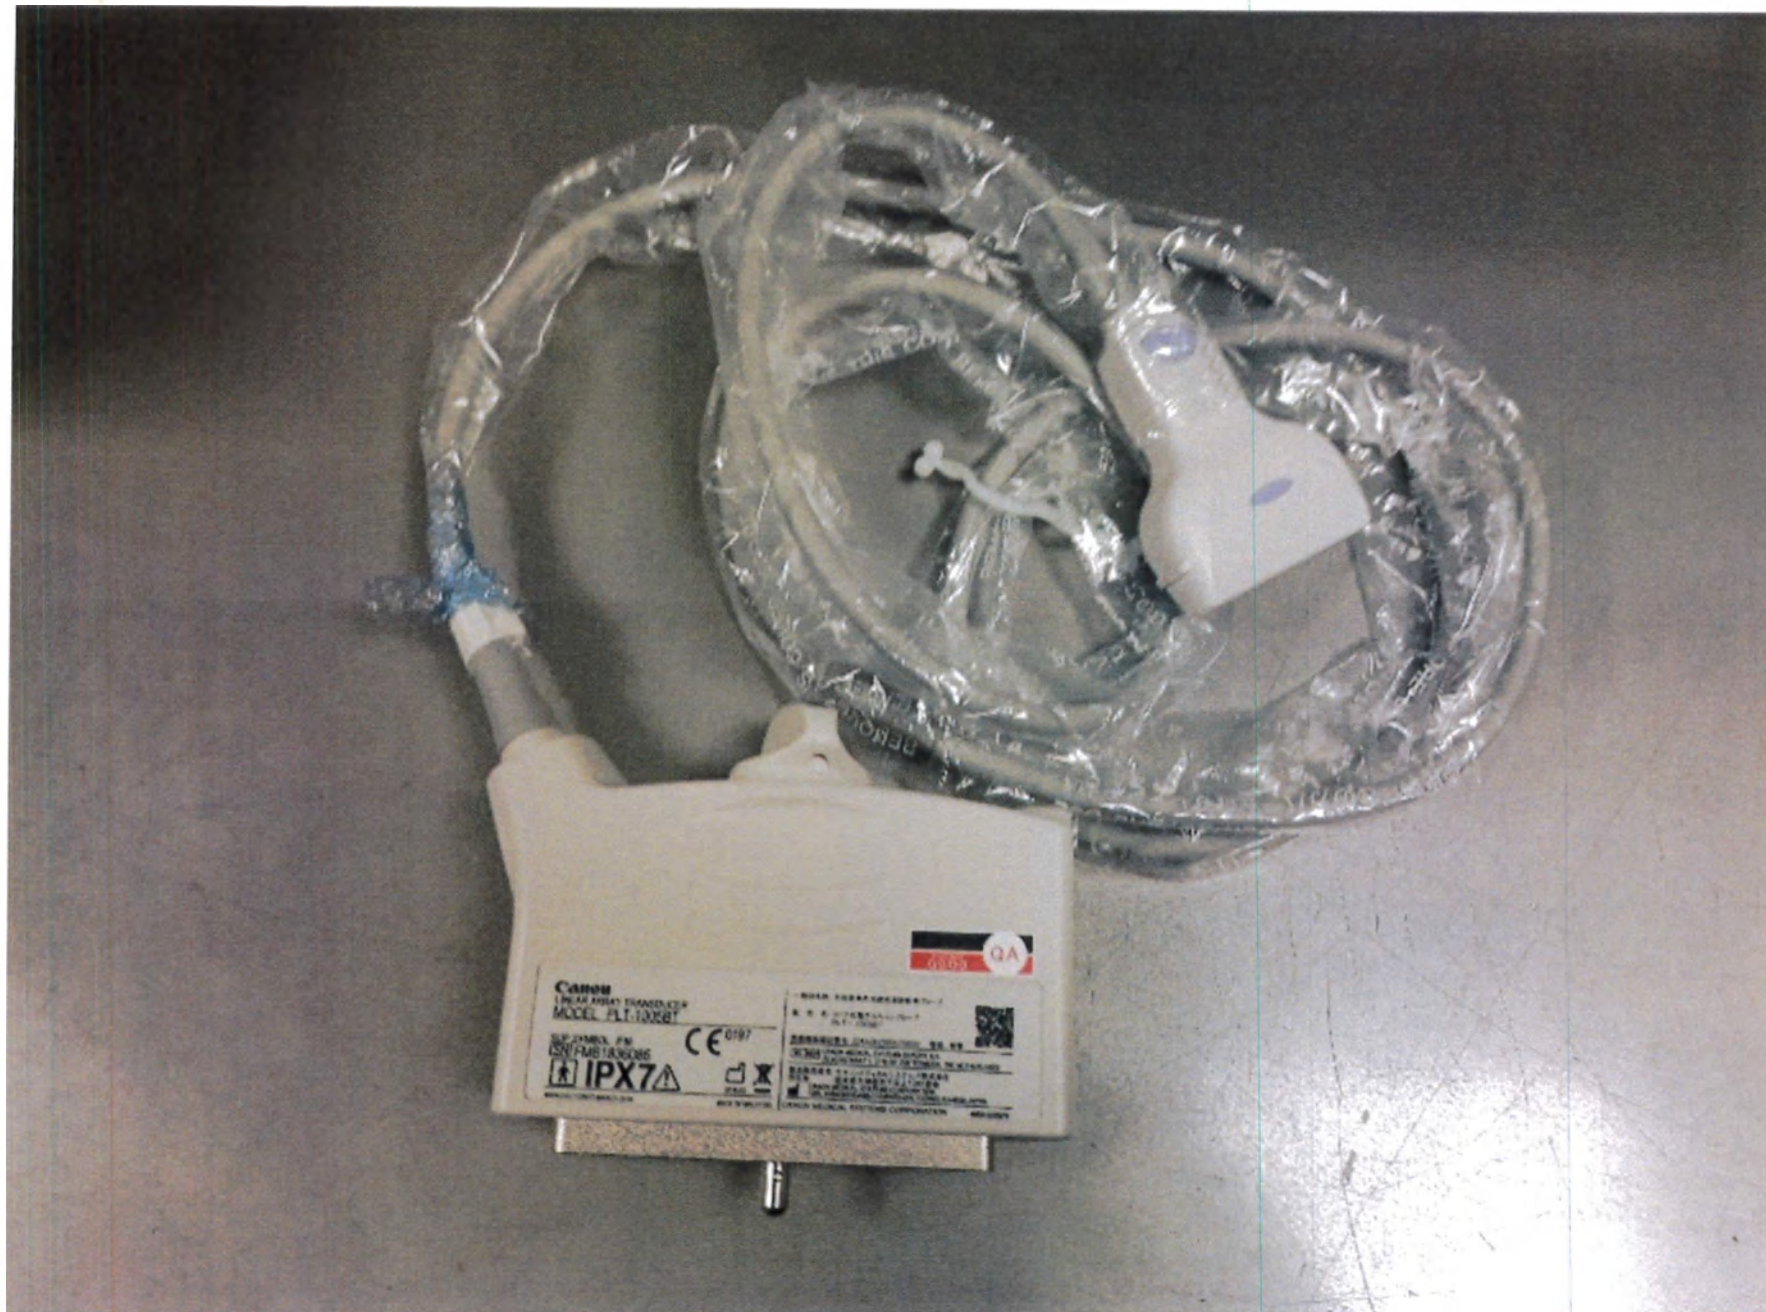

15. Датчик линейный, модель PLT-1005BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544



16. Датчик линейный, модель PLT-1204BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544

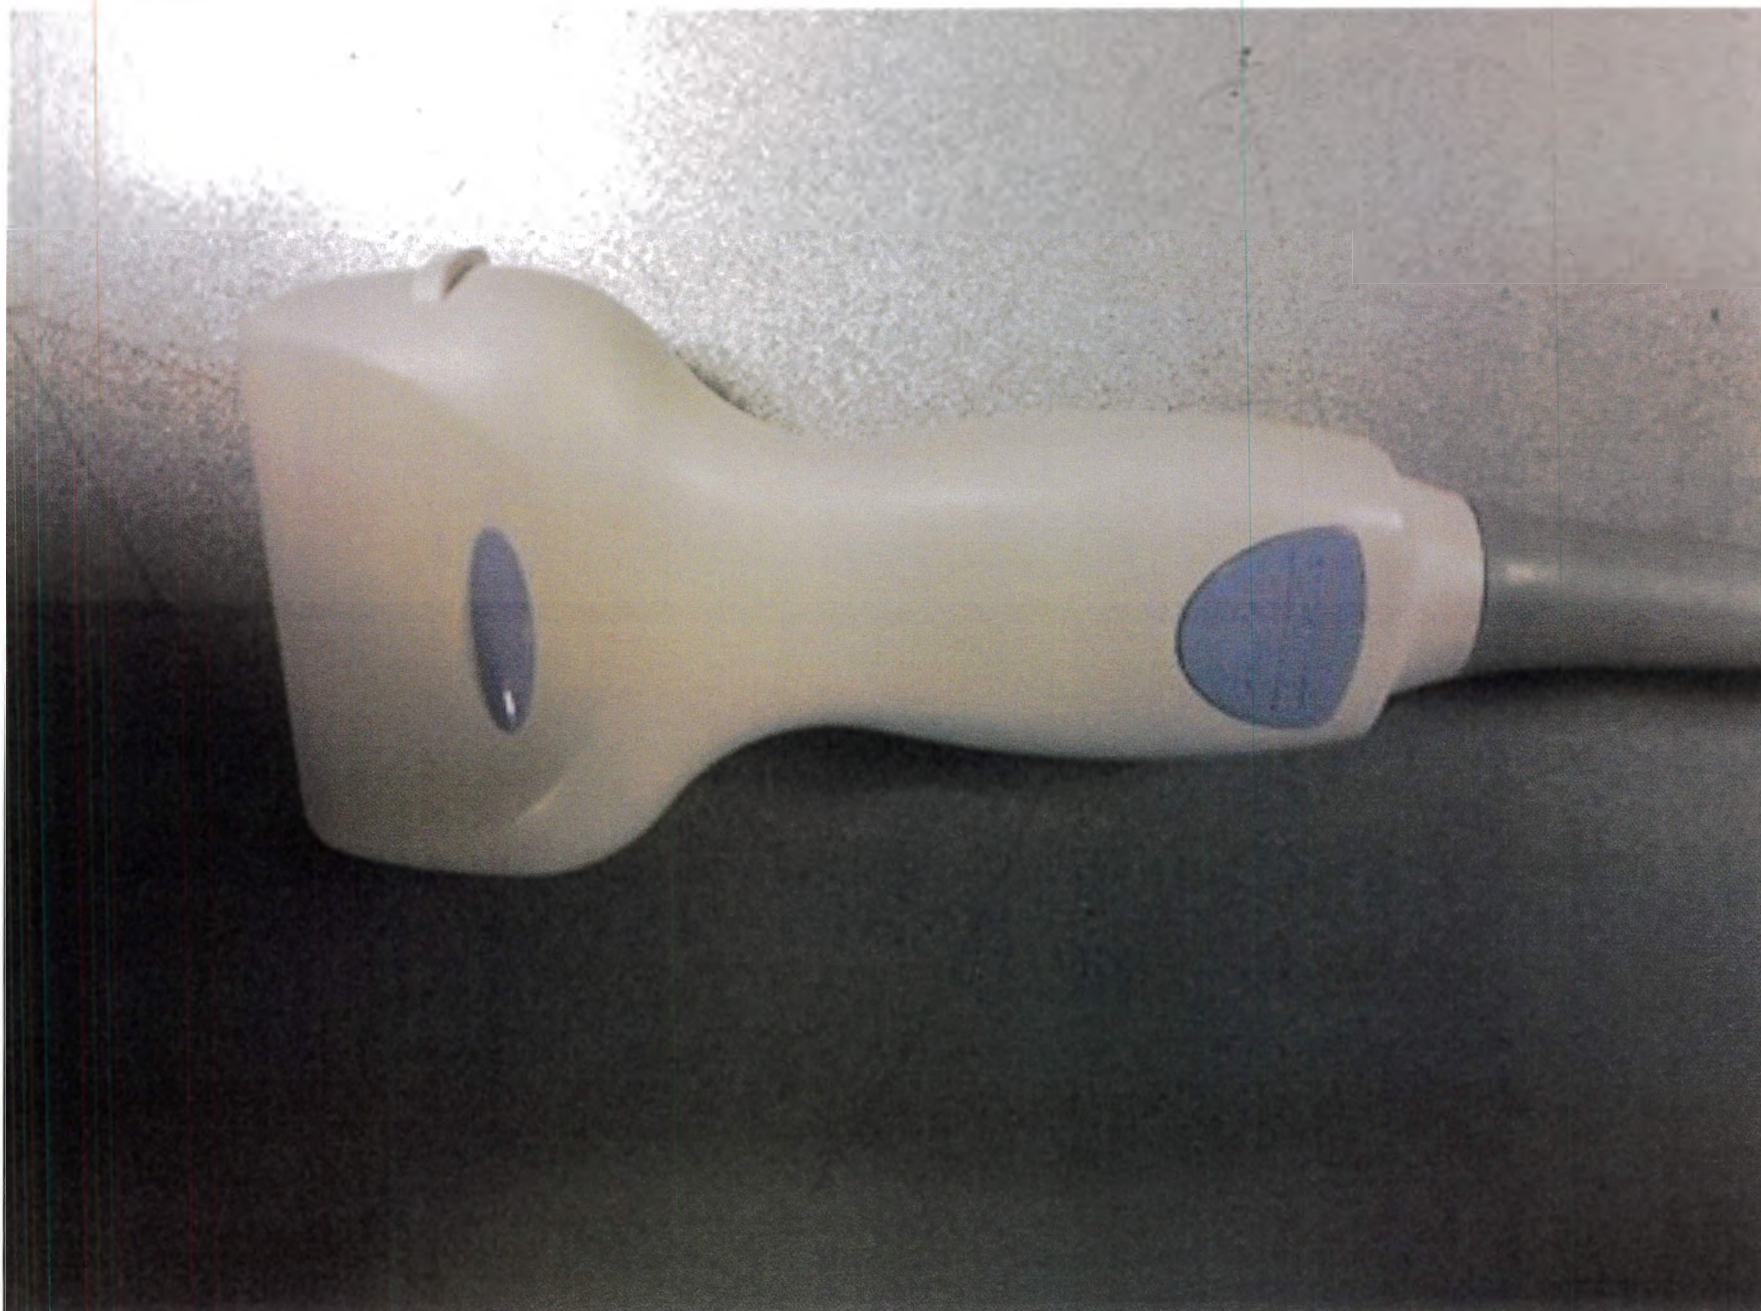


16. Датчик линейный, модель PLT-1204BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544



16. Датчик линейный, модель PLT-1204BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544



17. Датчик линейный, модель PLT-1202BT.

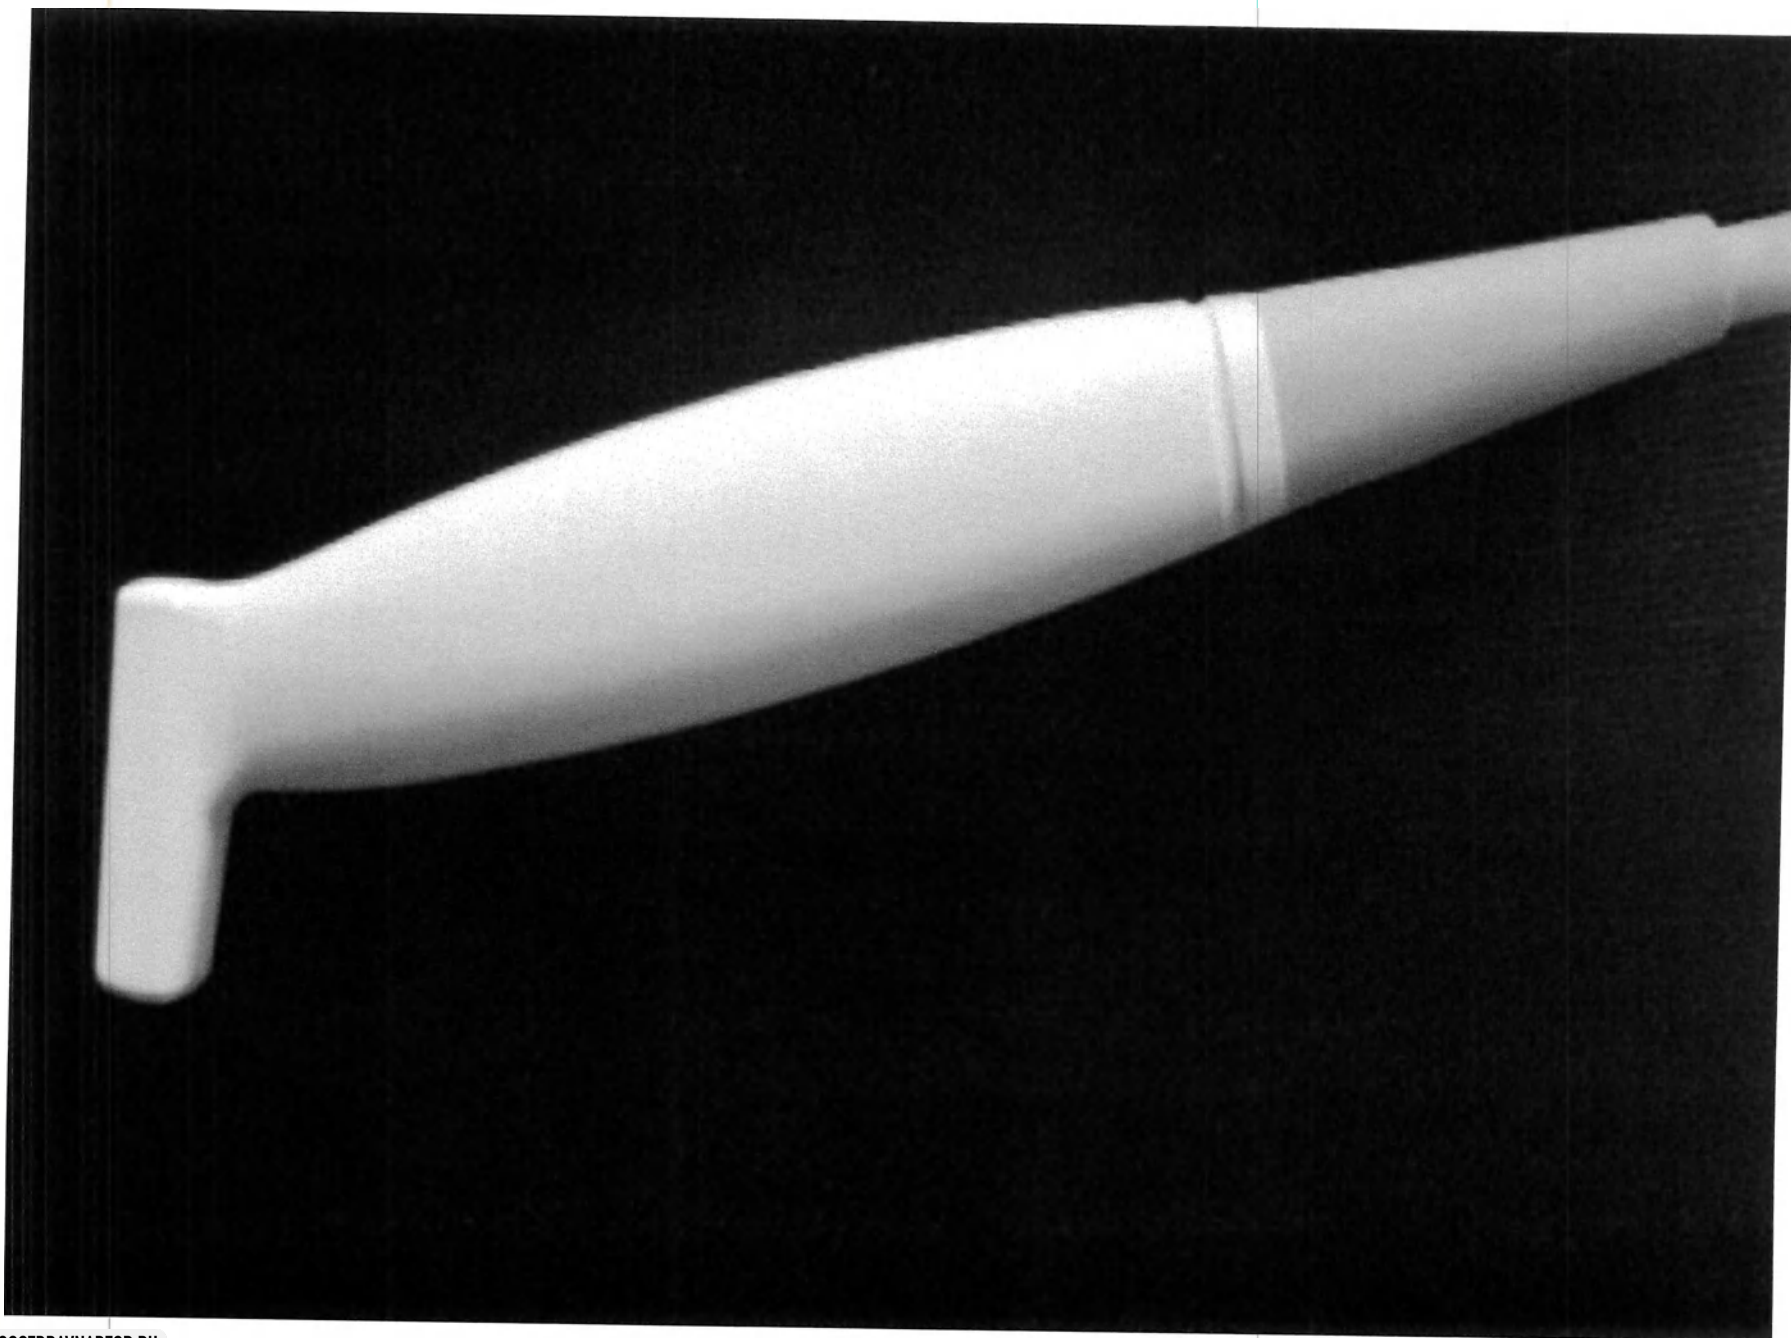

17. Датчик линейный, модель PLT-1202BT.




17. Датчик линейный, модель PLT-1202BT.



18. Датчик секторный, модель PST-25BT.



18. Датчик секторный, модель PST-25BT.

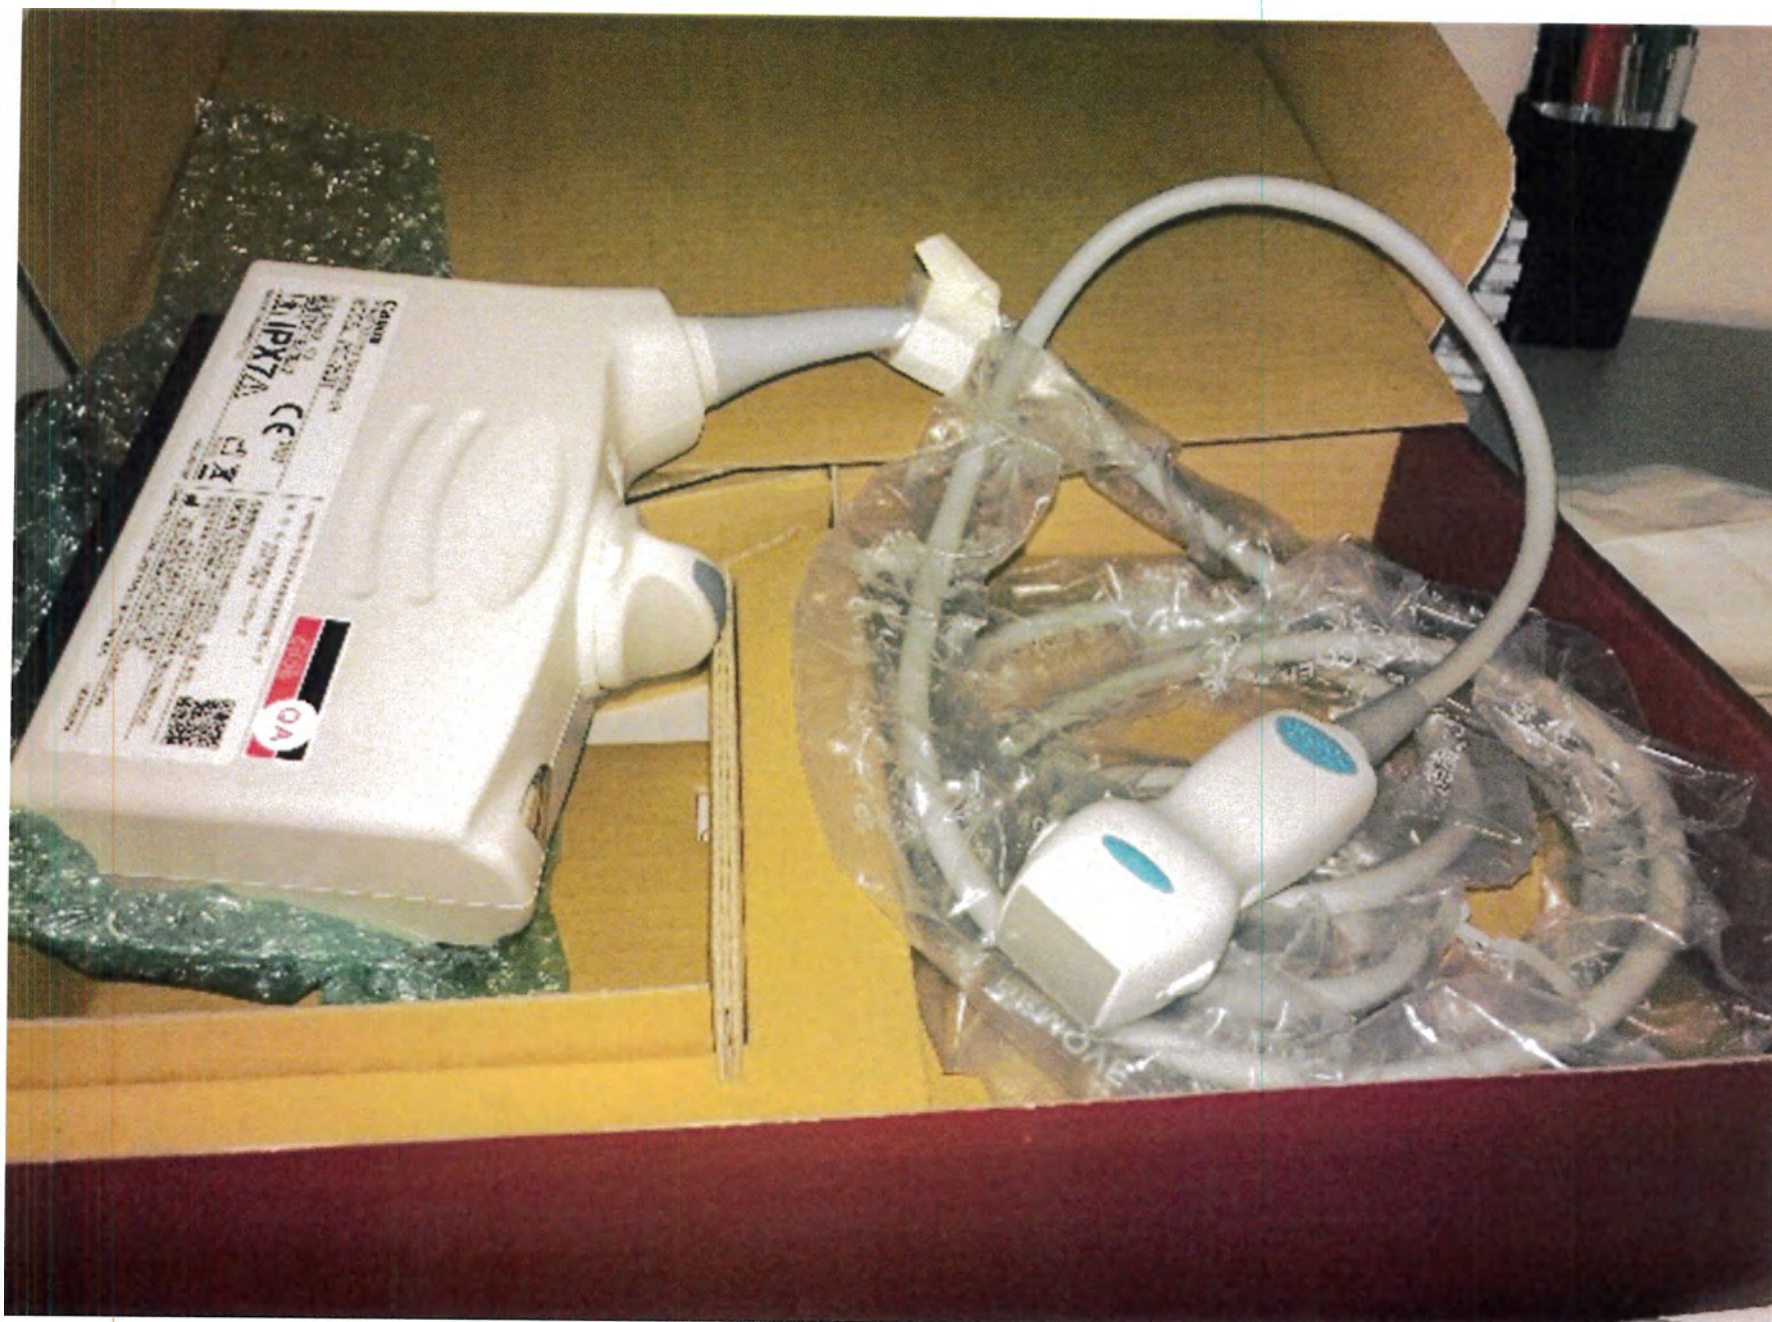

18. Датчик секторный, модель PST-25BT.



19. Датчик секторный, модель PST-30BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544



19. Датчик секторный, модель PST-30BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544



19. Датчик секторный, модель PST-30BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544



20. Датчик секторный, модель PST-50BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544



20. Датчик секторный, модель PST-50BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544




20. Датчик секторный, модель PST-50BT, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544



21. Датчик транспищеводный мультиплановый, модель РЕТ-512МД



21. Датчик транспищеводный мультиплановый, модель РЕТ-512MD

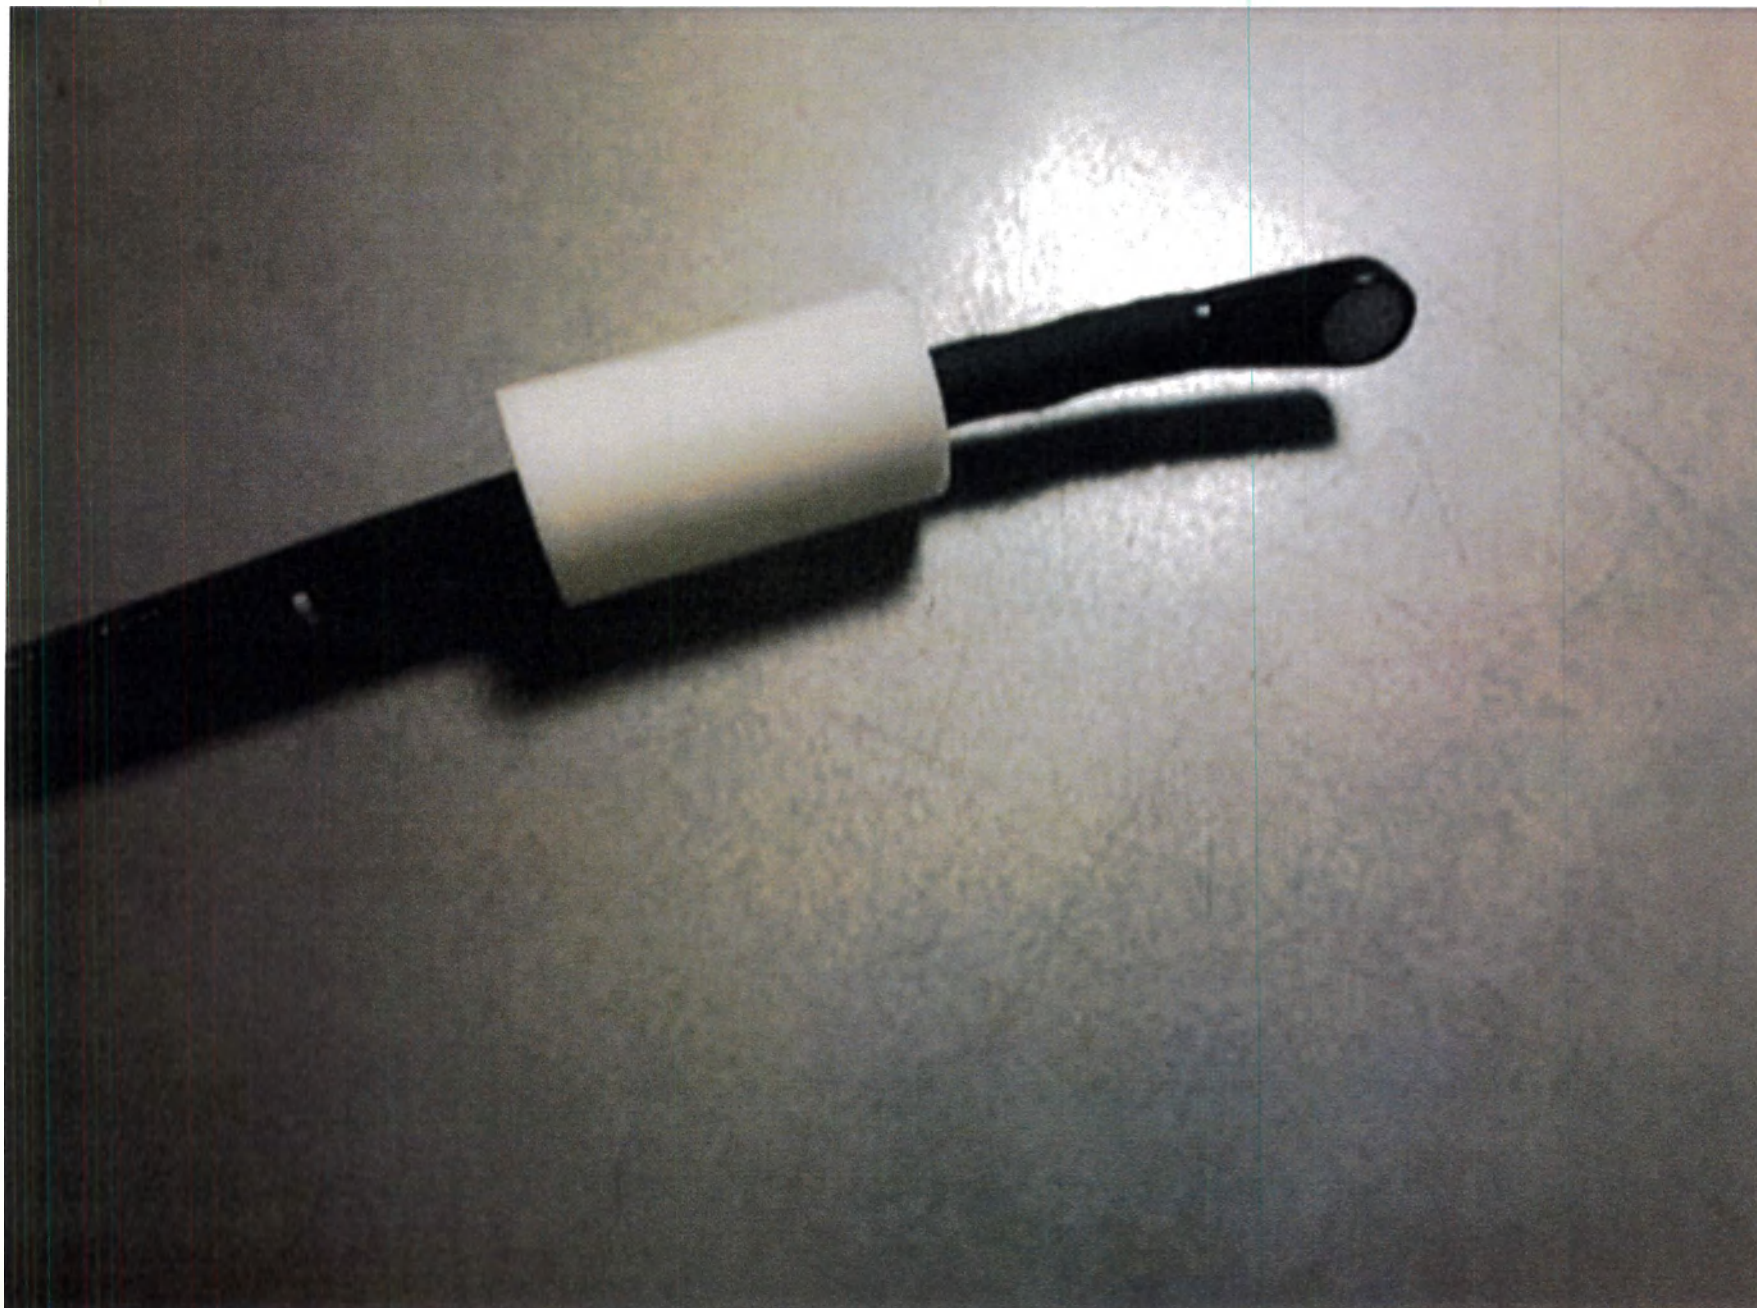

21. Датчик транспищеводный мультиплановый, модель PET-512MD



22. Датчик внутривидеоскопический, модель PVT-781VT.



22. Датчик внутривидеоскопический, модель PVT-781VT.




22. Датчик внутрисполостной, модель PVT-781VT.



23. Датчик внутривидеоскопический, модель PVT-781VTE, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544



23. Датчик внутриматочной, модель PVT-781VTE.

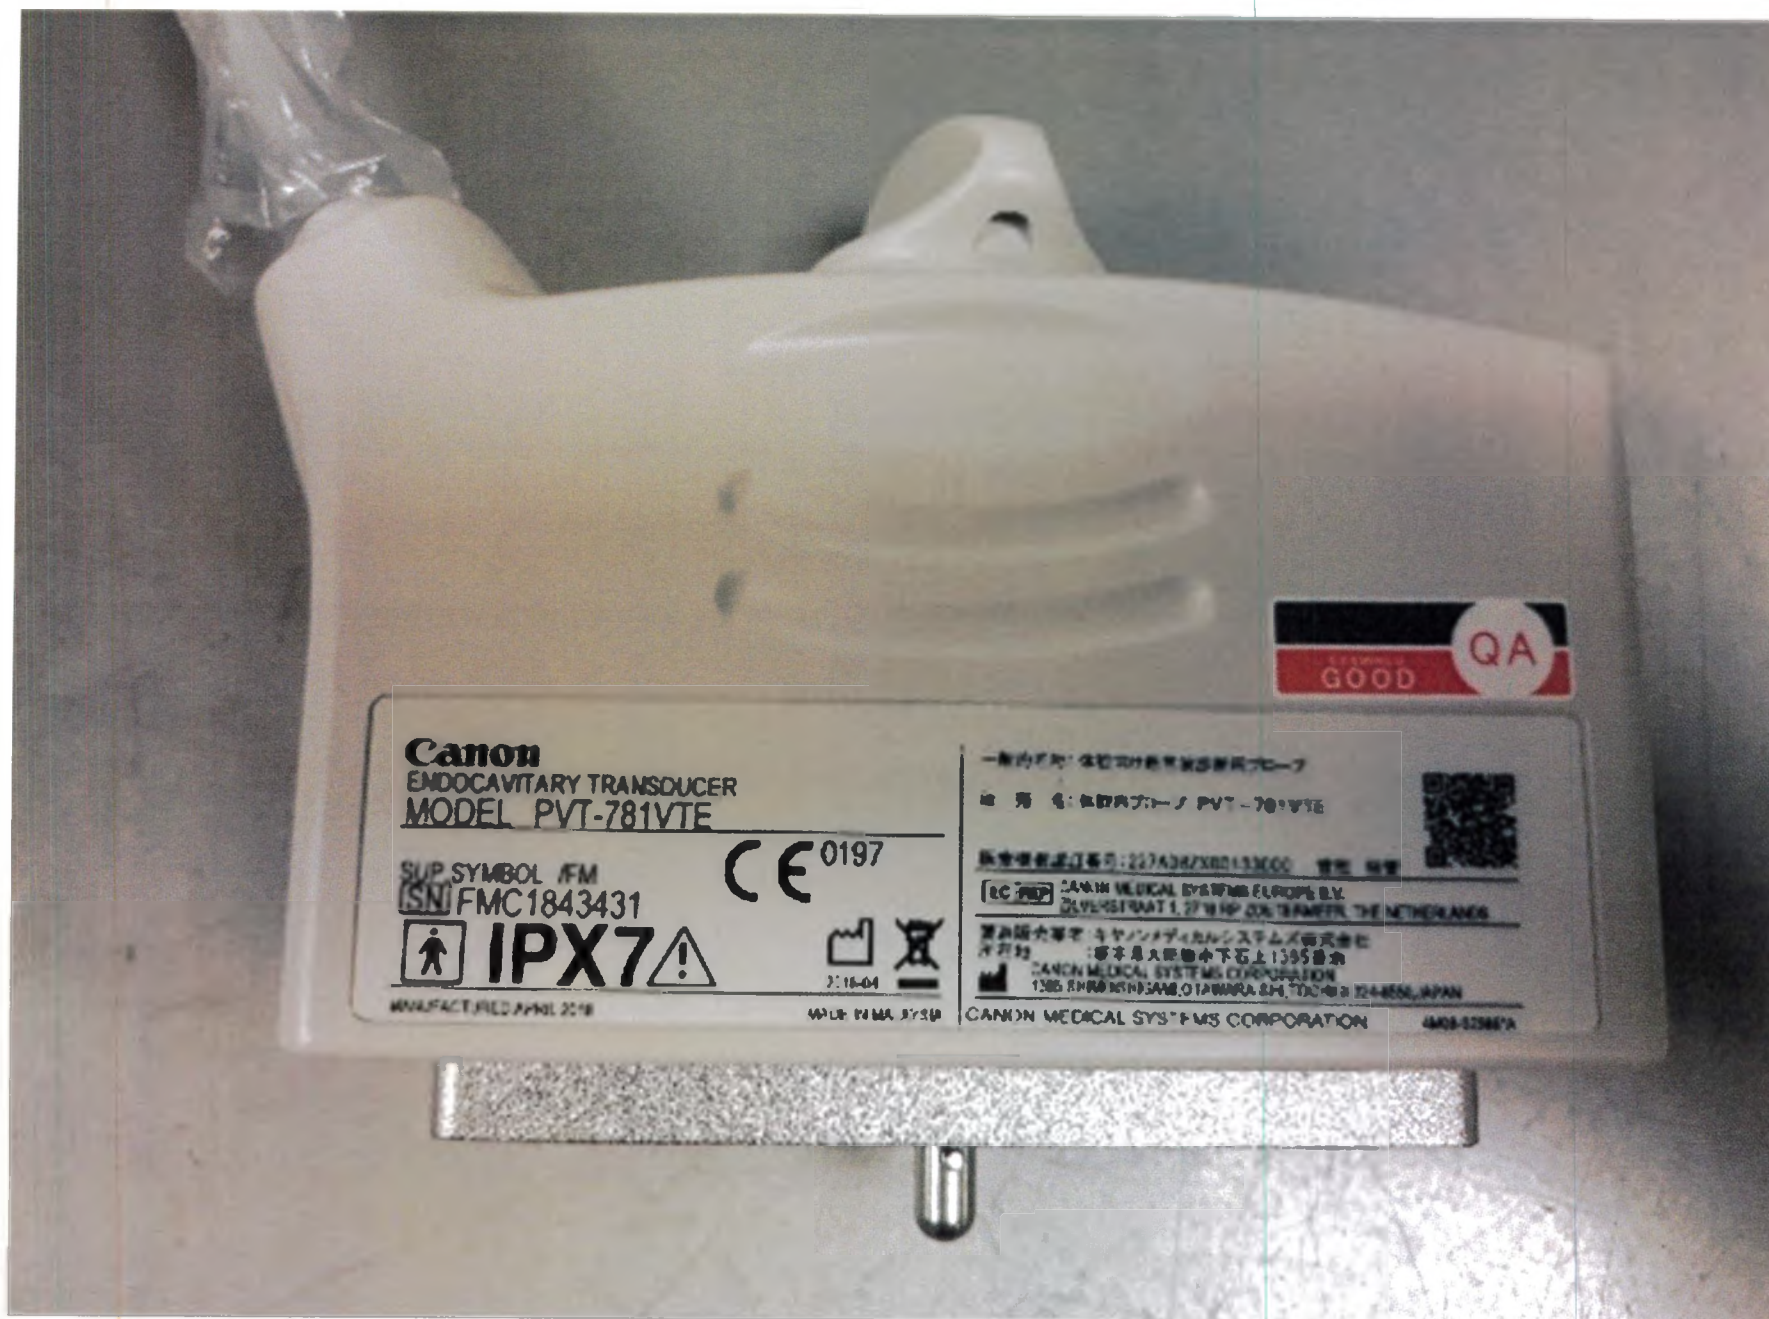

24. Датчик внутриполостной, модель PVL-715RST.



24. Датчик внутриматочной, модель PVL-715RST.



24. Датчик внутриматочный, модель PVL-715RST.



25. Датчик конвексный биопсийный, модель PVT-350BTP, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544

63




25. Датчик конвексный биопсийный, модель PVT-350BTP, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544



25. Датчик конвексный биопсийный, модель PVT-350BTP, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544



25. Датчик конвексный биопсийный, модель PVT-350ВТР, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544

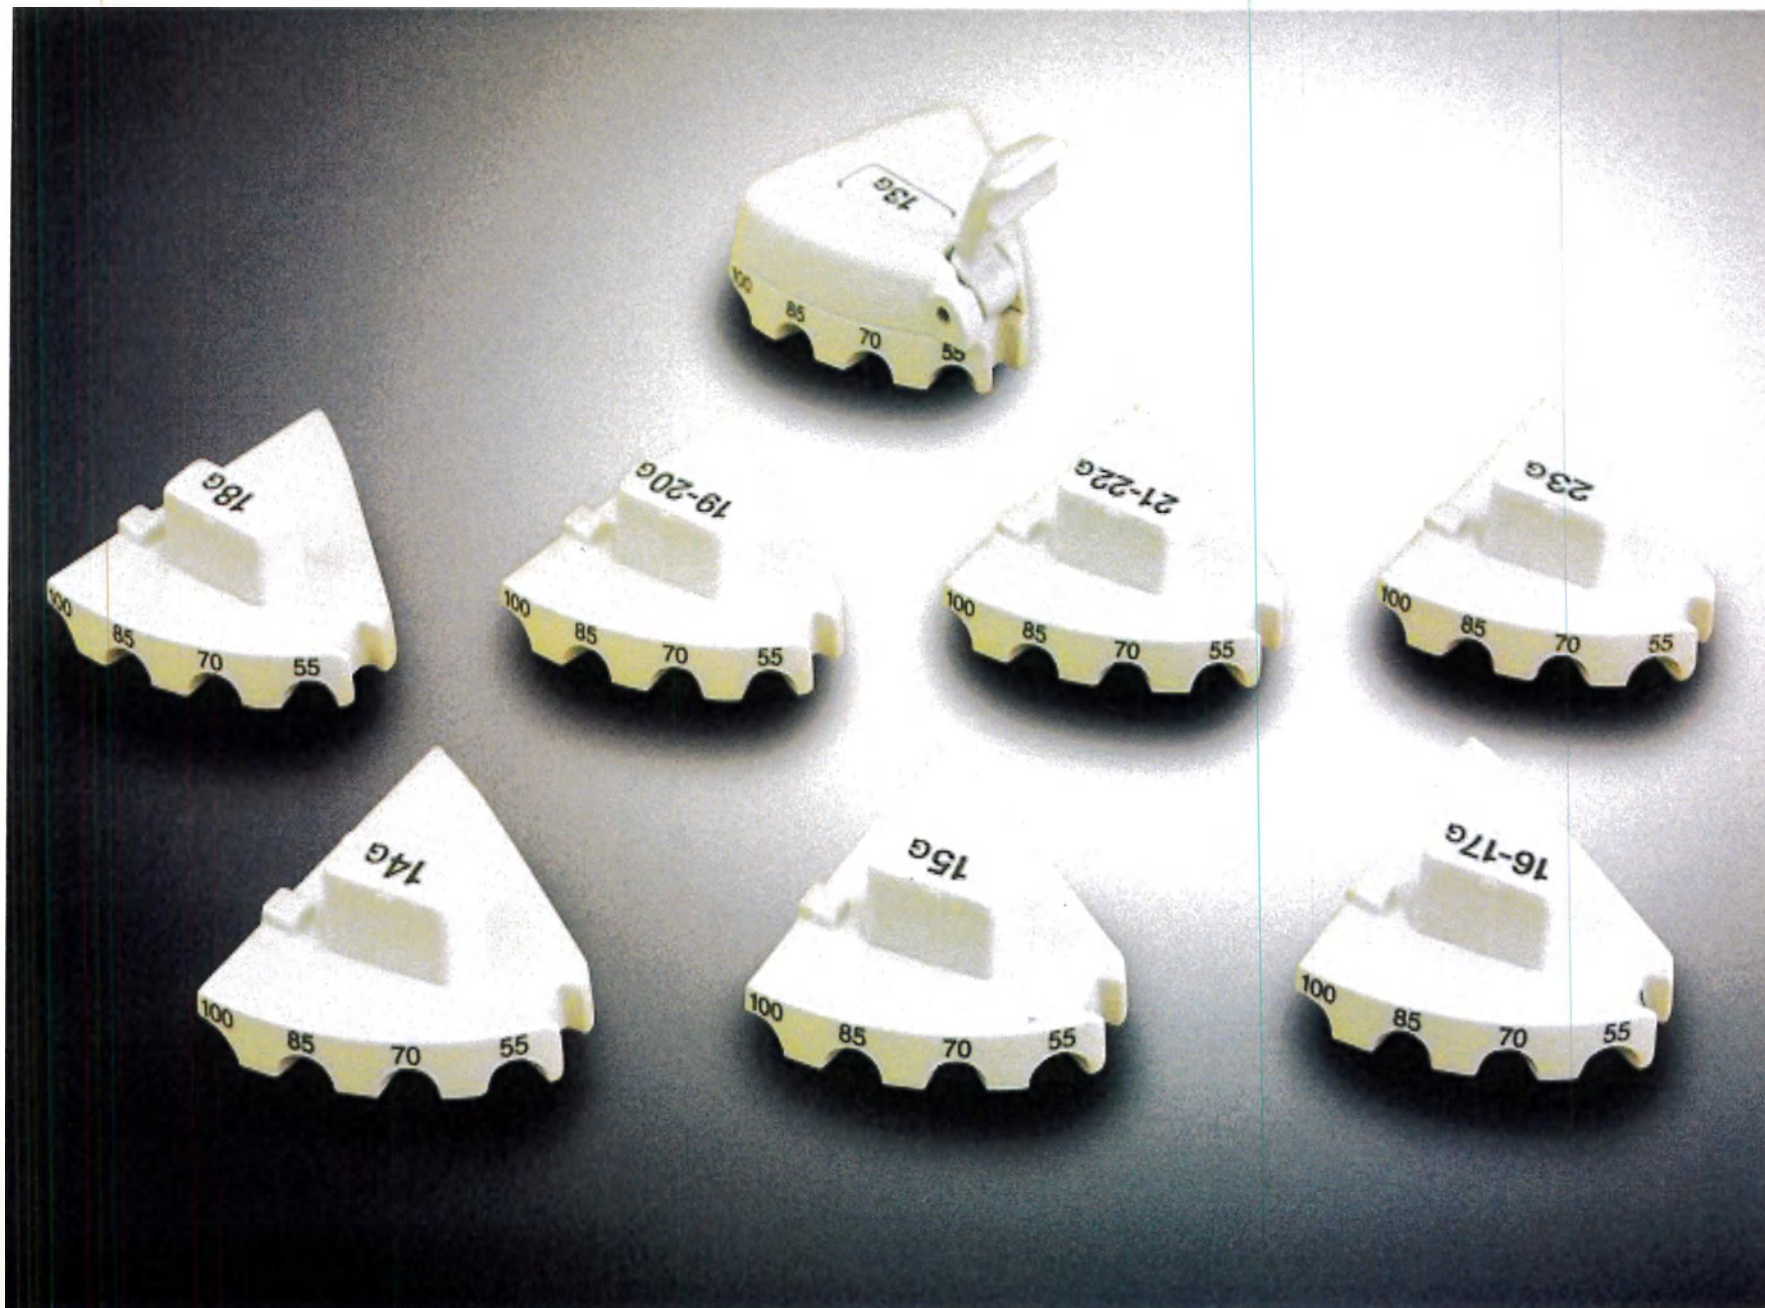

26. Датчик конвексный, модель PVT-745BTH, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544



26. Датчик конвексный, модель PVT-745BTH, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544



26. Датчик конвексный, модель PVT-745BTH, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544



26. Датчик конвексный, модель PVT-745BTH, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544



27. Датчик конвексный, модель PVT-745BTV, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544



27. Датчик конвексный, модель PVT-745BTV, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544




27. Датчик конвексный, модель PVT-745BTV, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544




27. Датчик конвексный, модель PVT-745BTV, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544



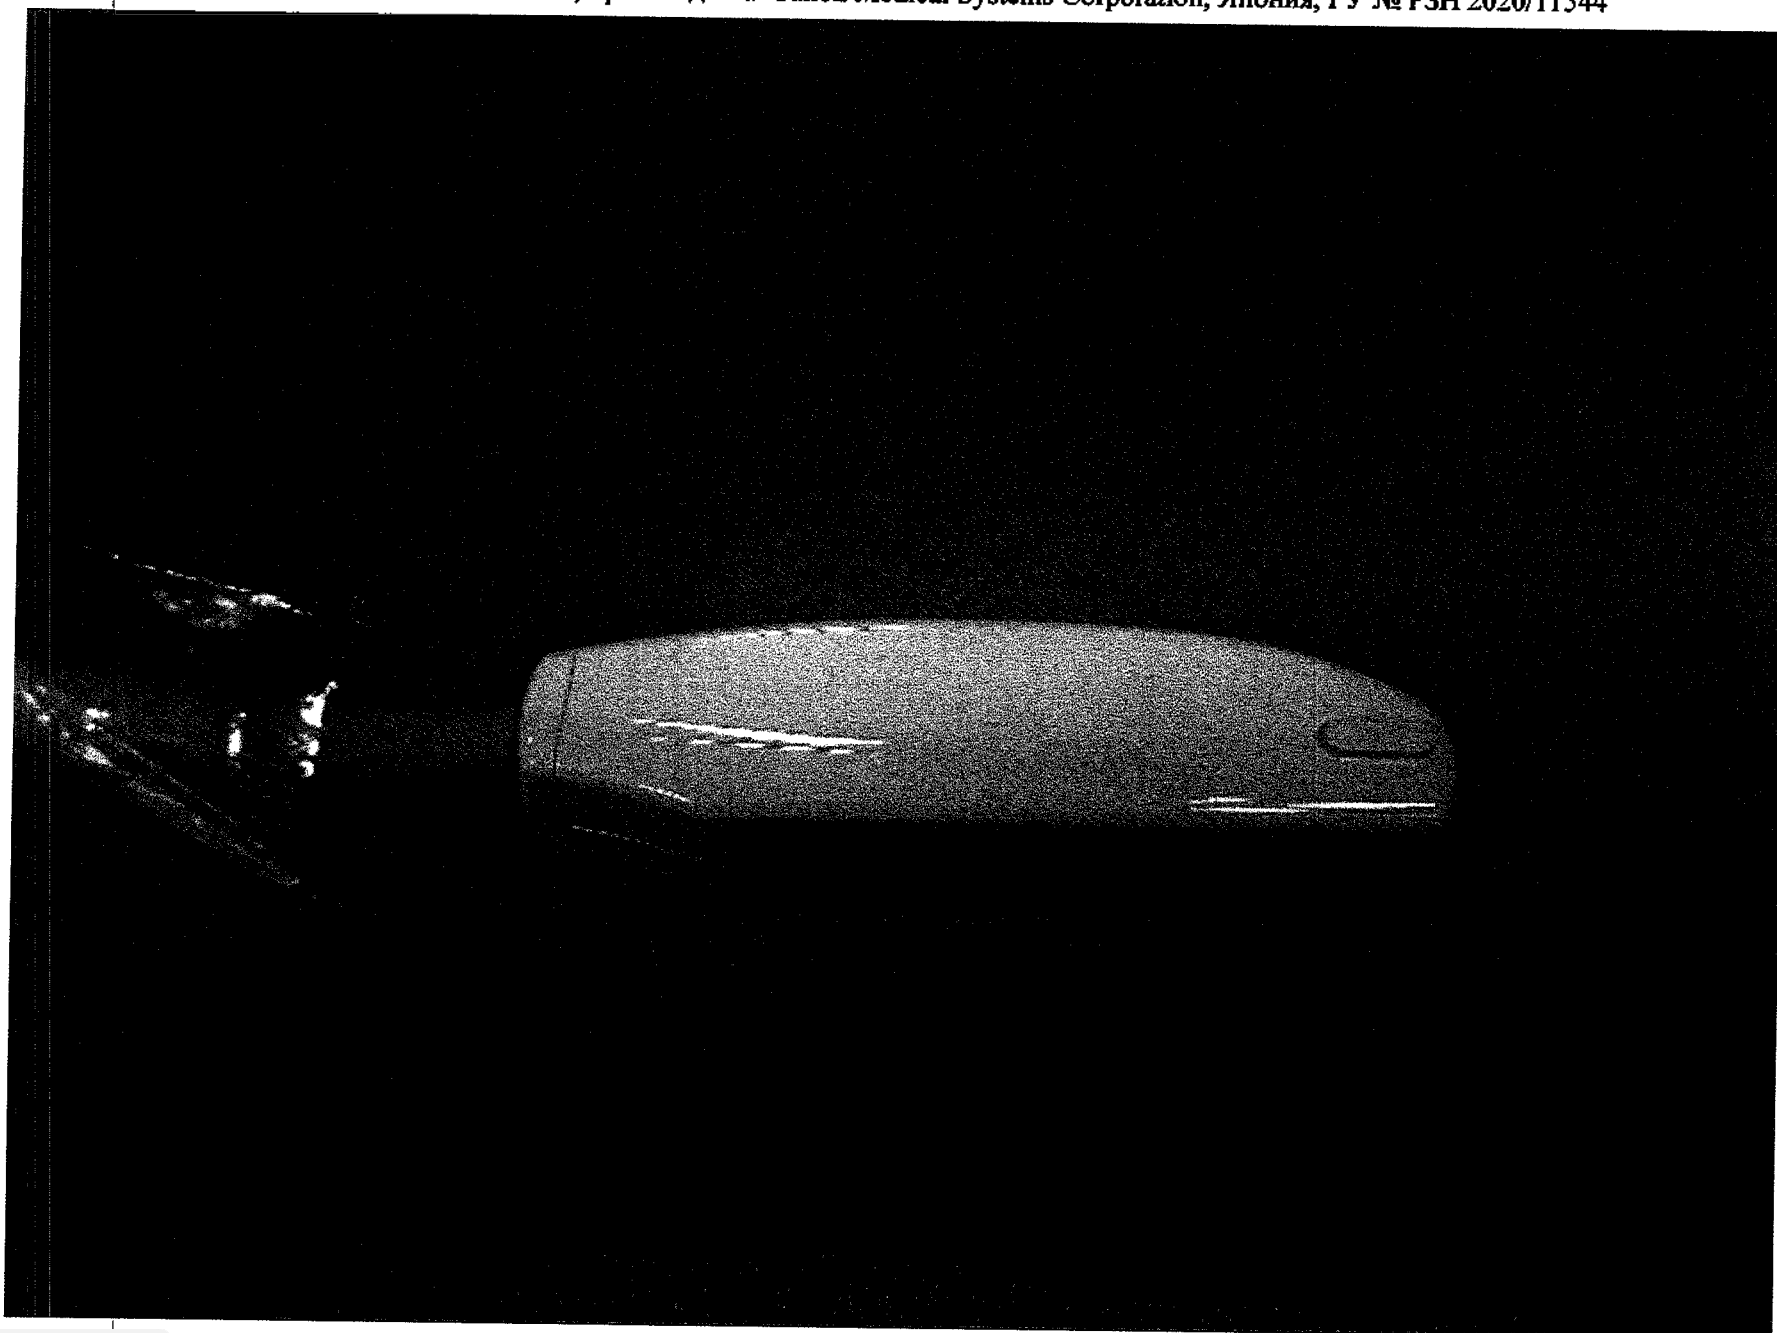




28. Датчик линейный, модель PLT-705BTF, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544

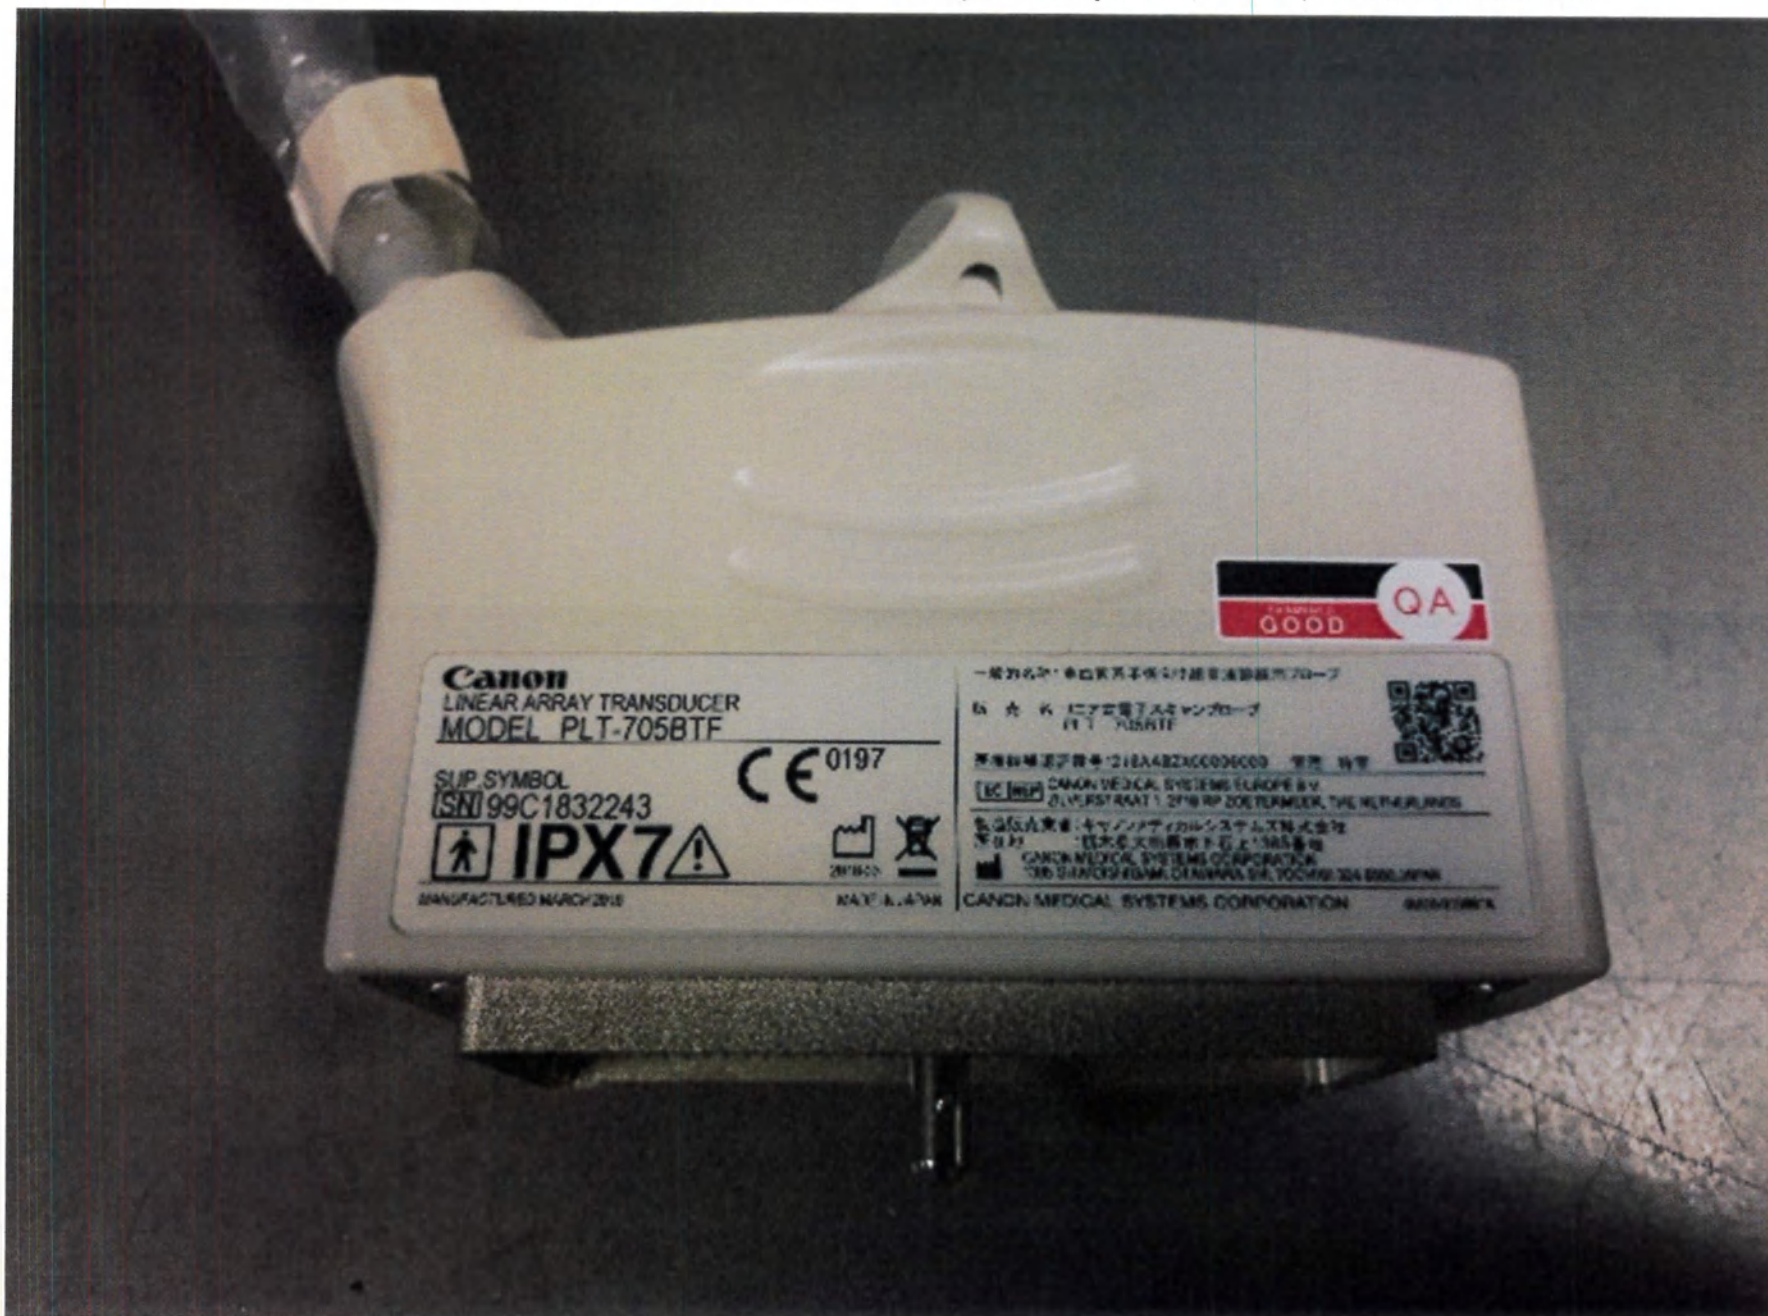

29. Датчик линейный, модель PLT-705BTH, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544

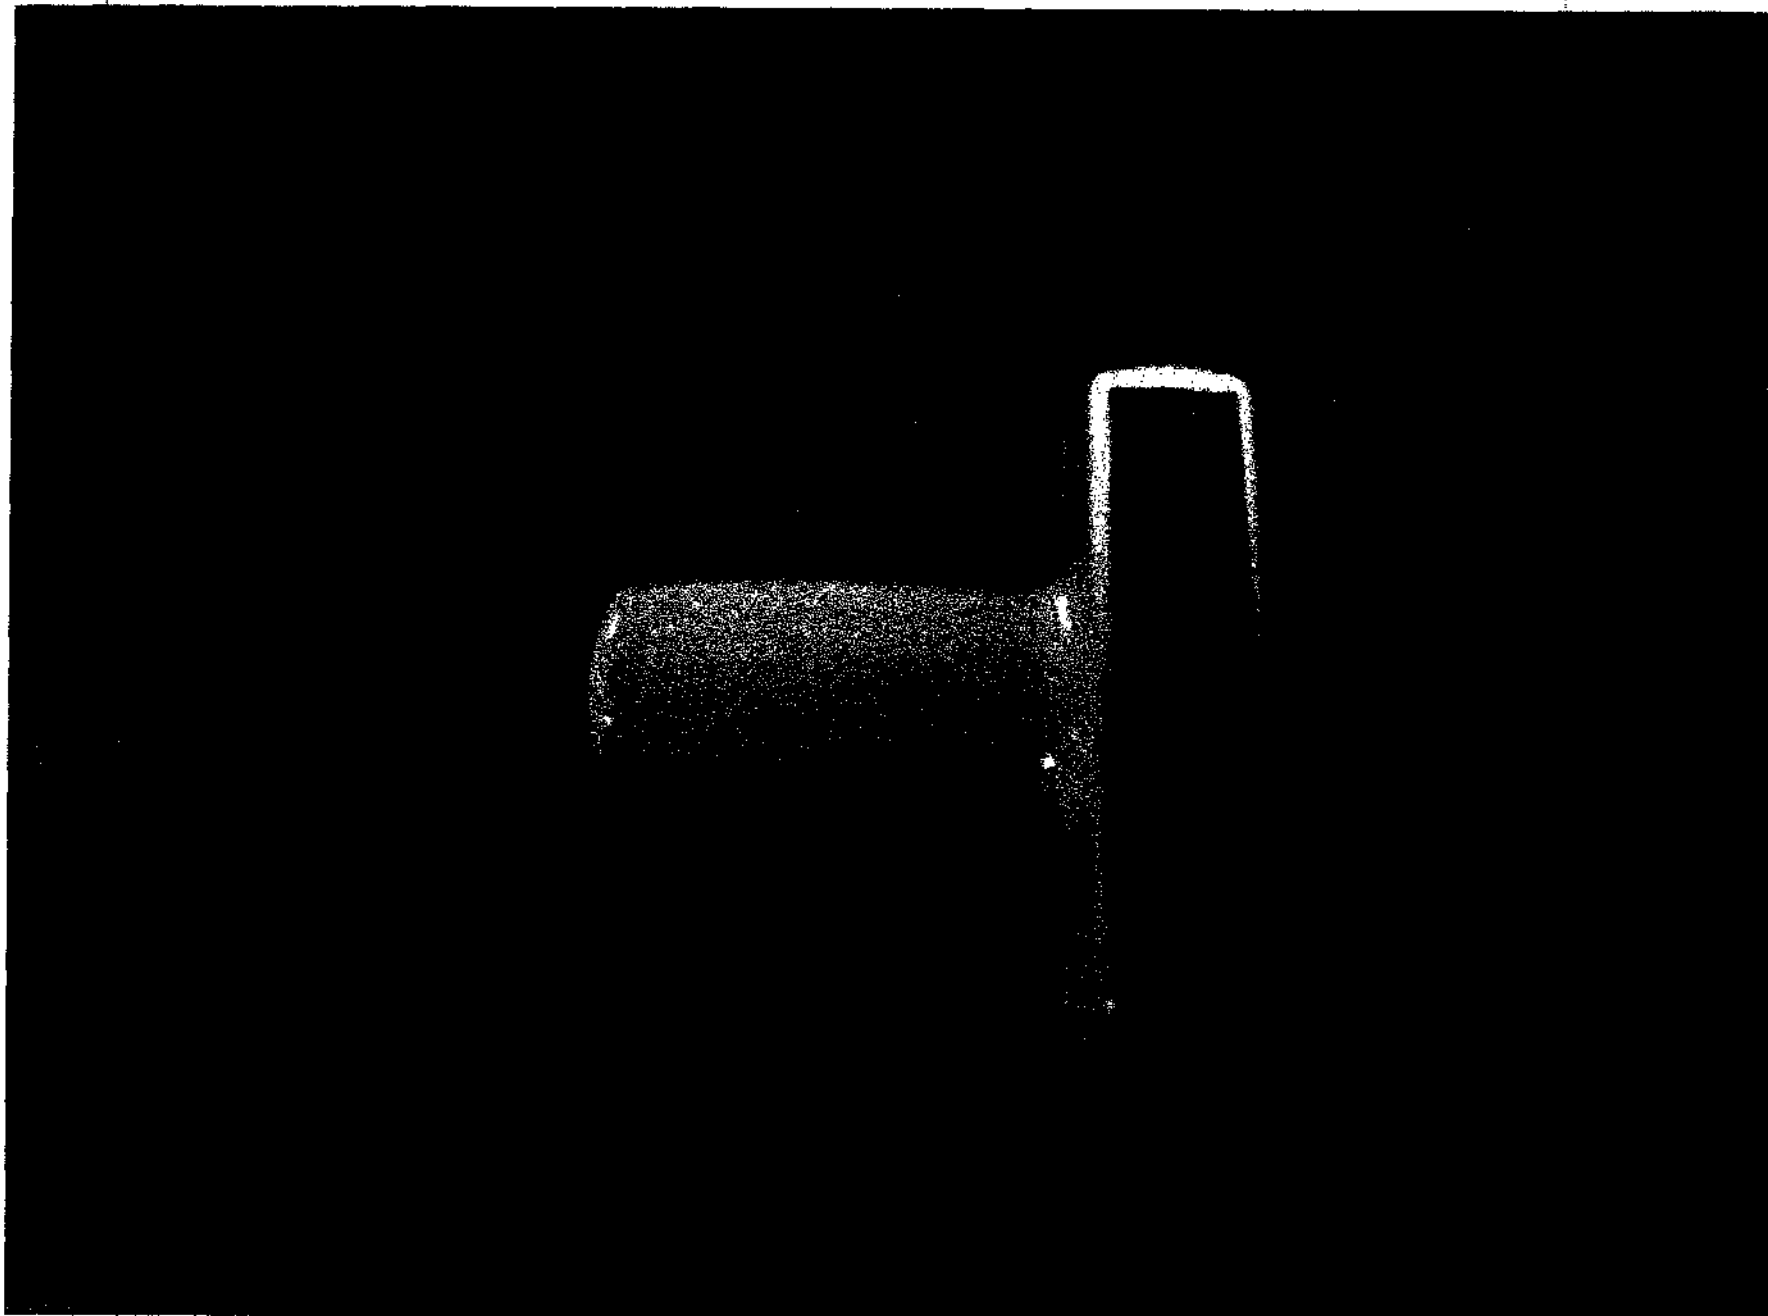


29. Датчик линейный, модель PLT-705BTH, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544



29. Датчик линейный, модель PLT-705BTH, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544



30. Датчик линейный, модель PET-805LA, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544

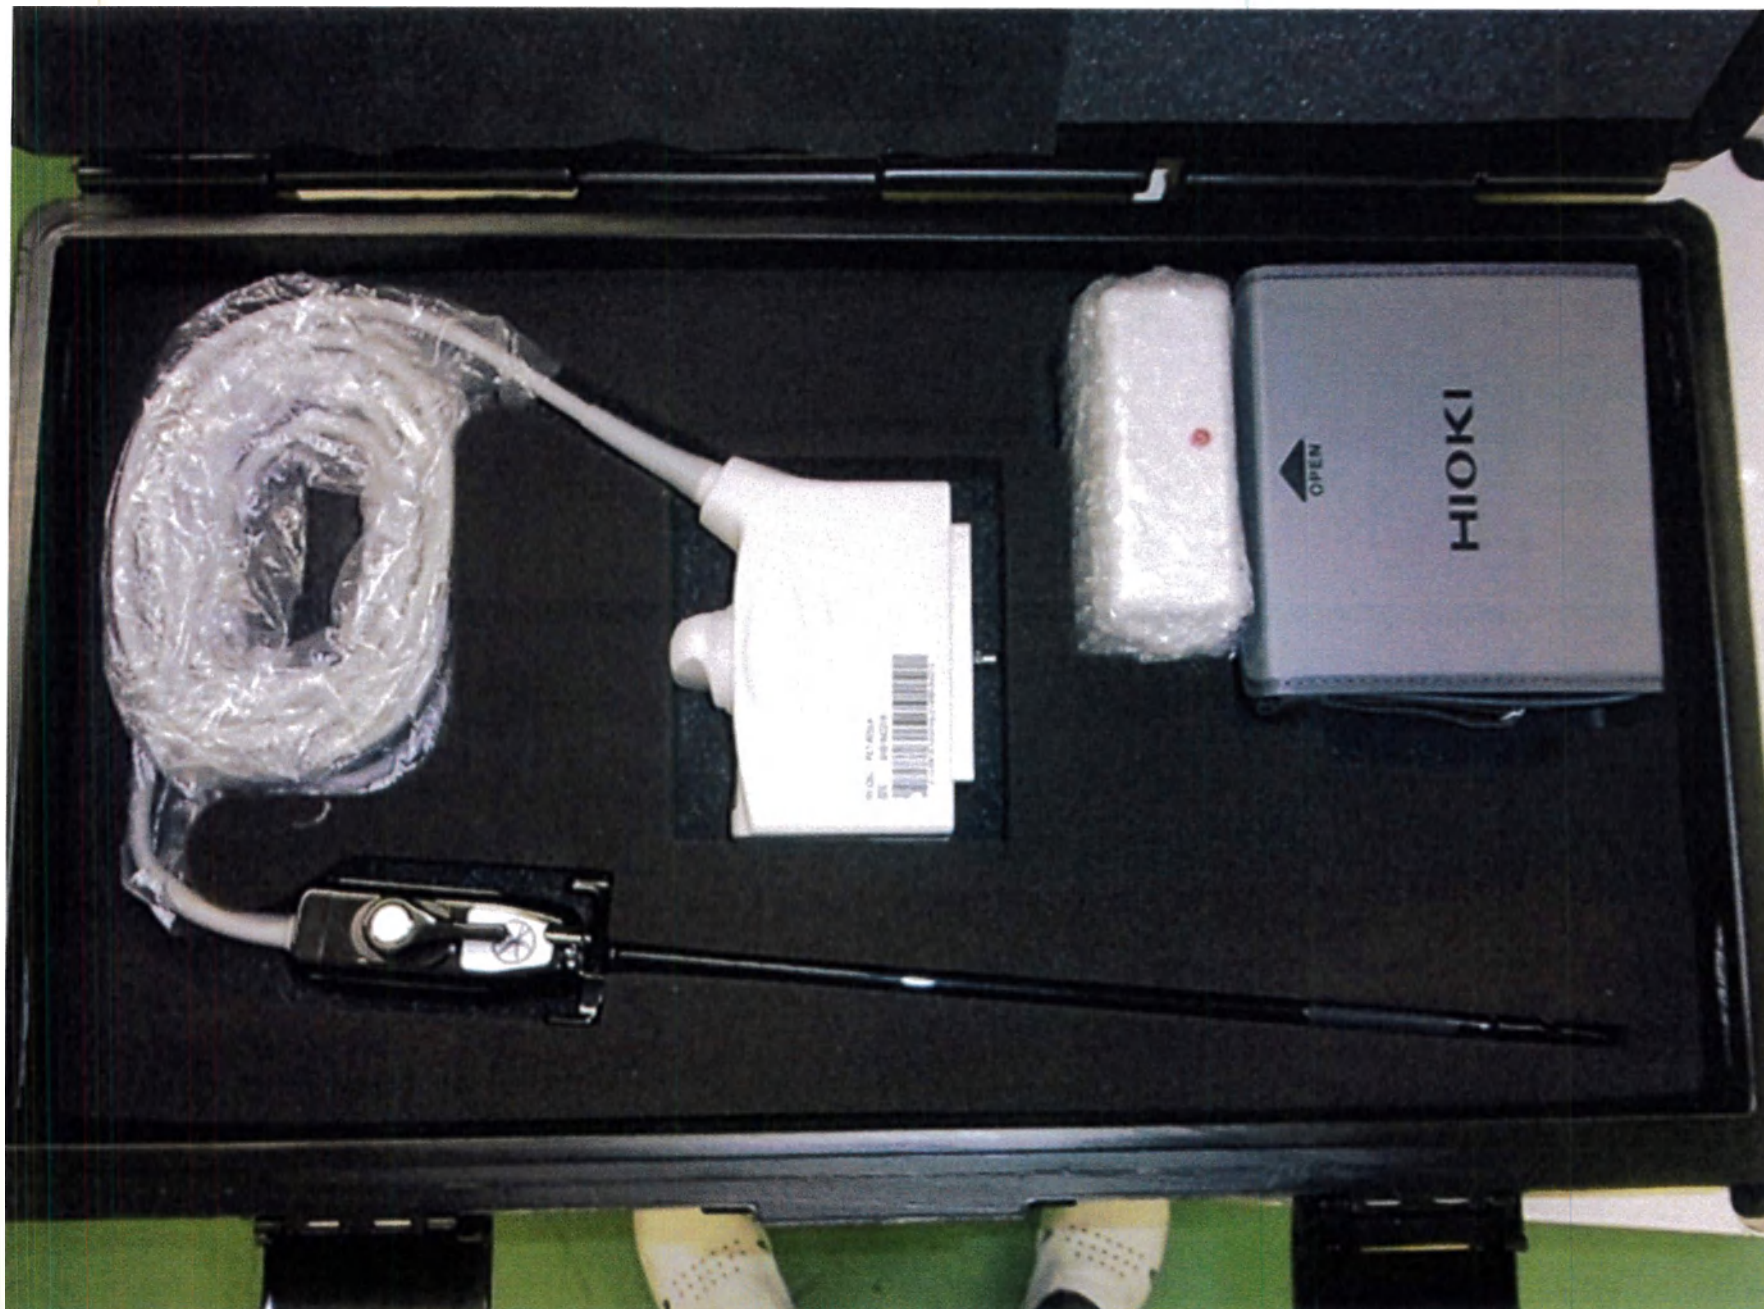


30. Датчик линейный, модель PET-805LA, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544



30. Датчик линейный, модель PET-805LA, производства Canon Medical Systems Corporation, Япония, РУ № РЗН 2020/11544



31. Датчик карандашный, модель РС-20М.

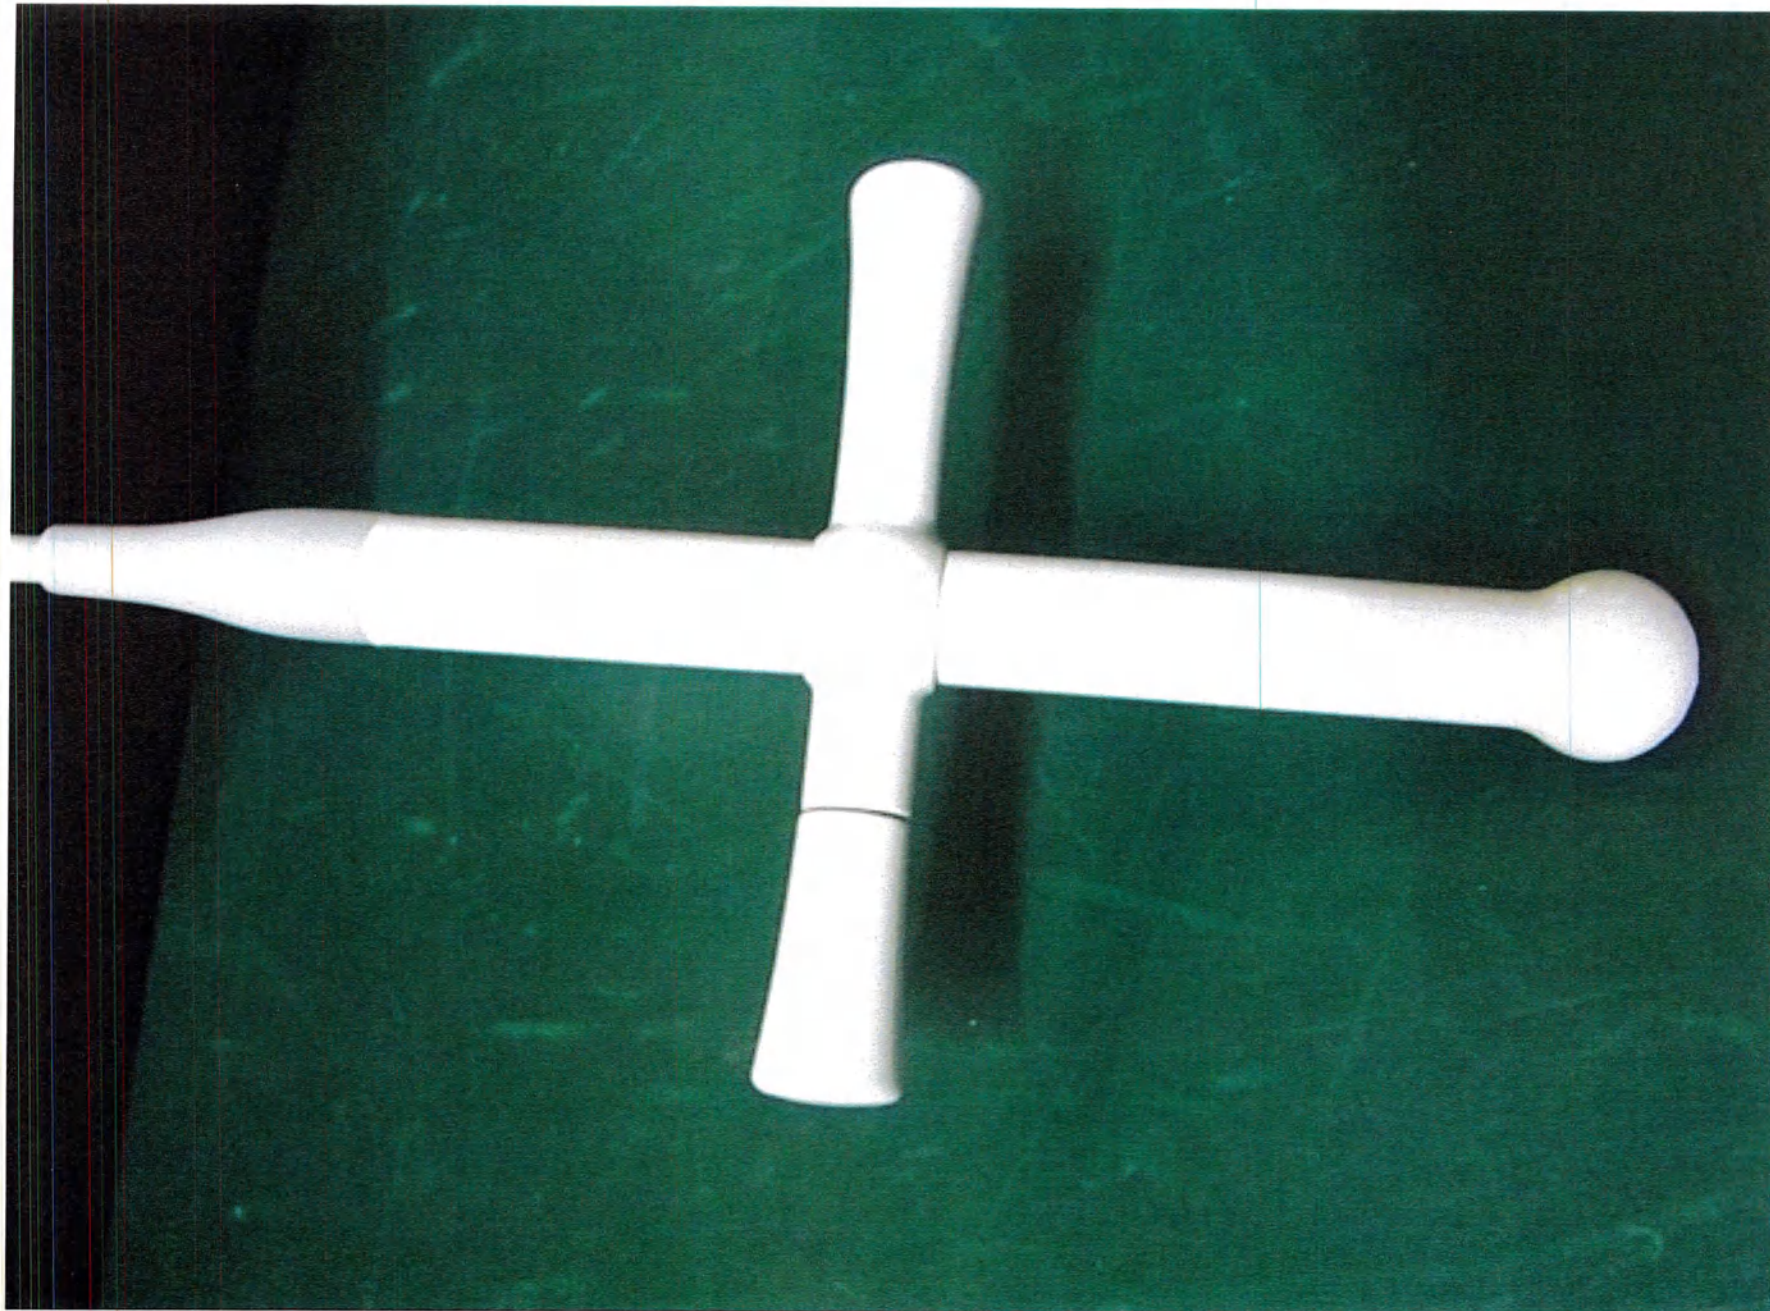

31. Датчик карандашный, модель PC-20M.




31. Датчик карандашный, модель PC-20M.



31. Датчик карандашный, модель PC-20M.



32. Датчик карандашный, модель РС-50М.

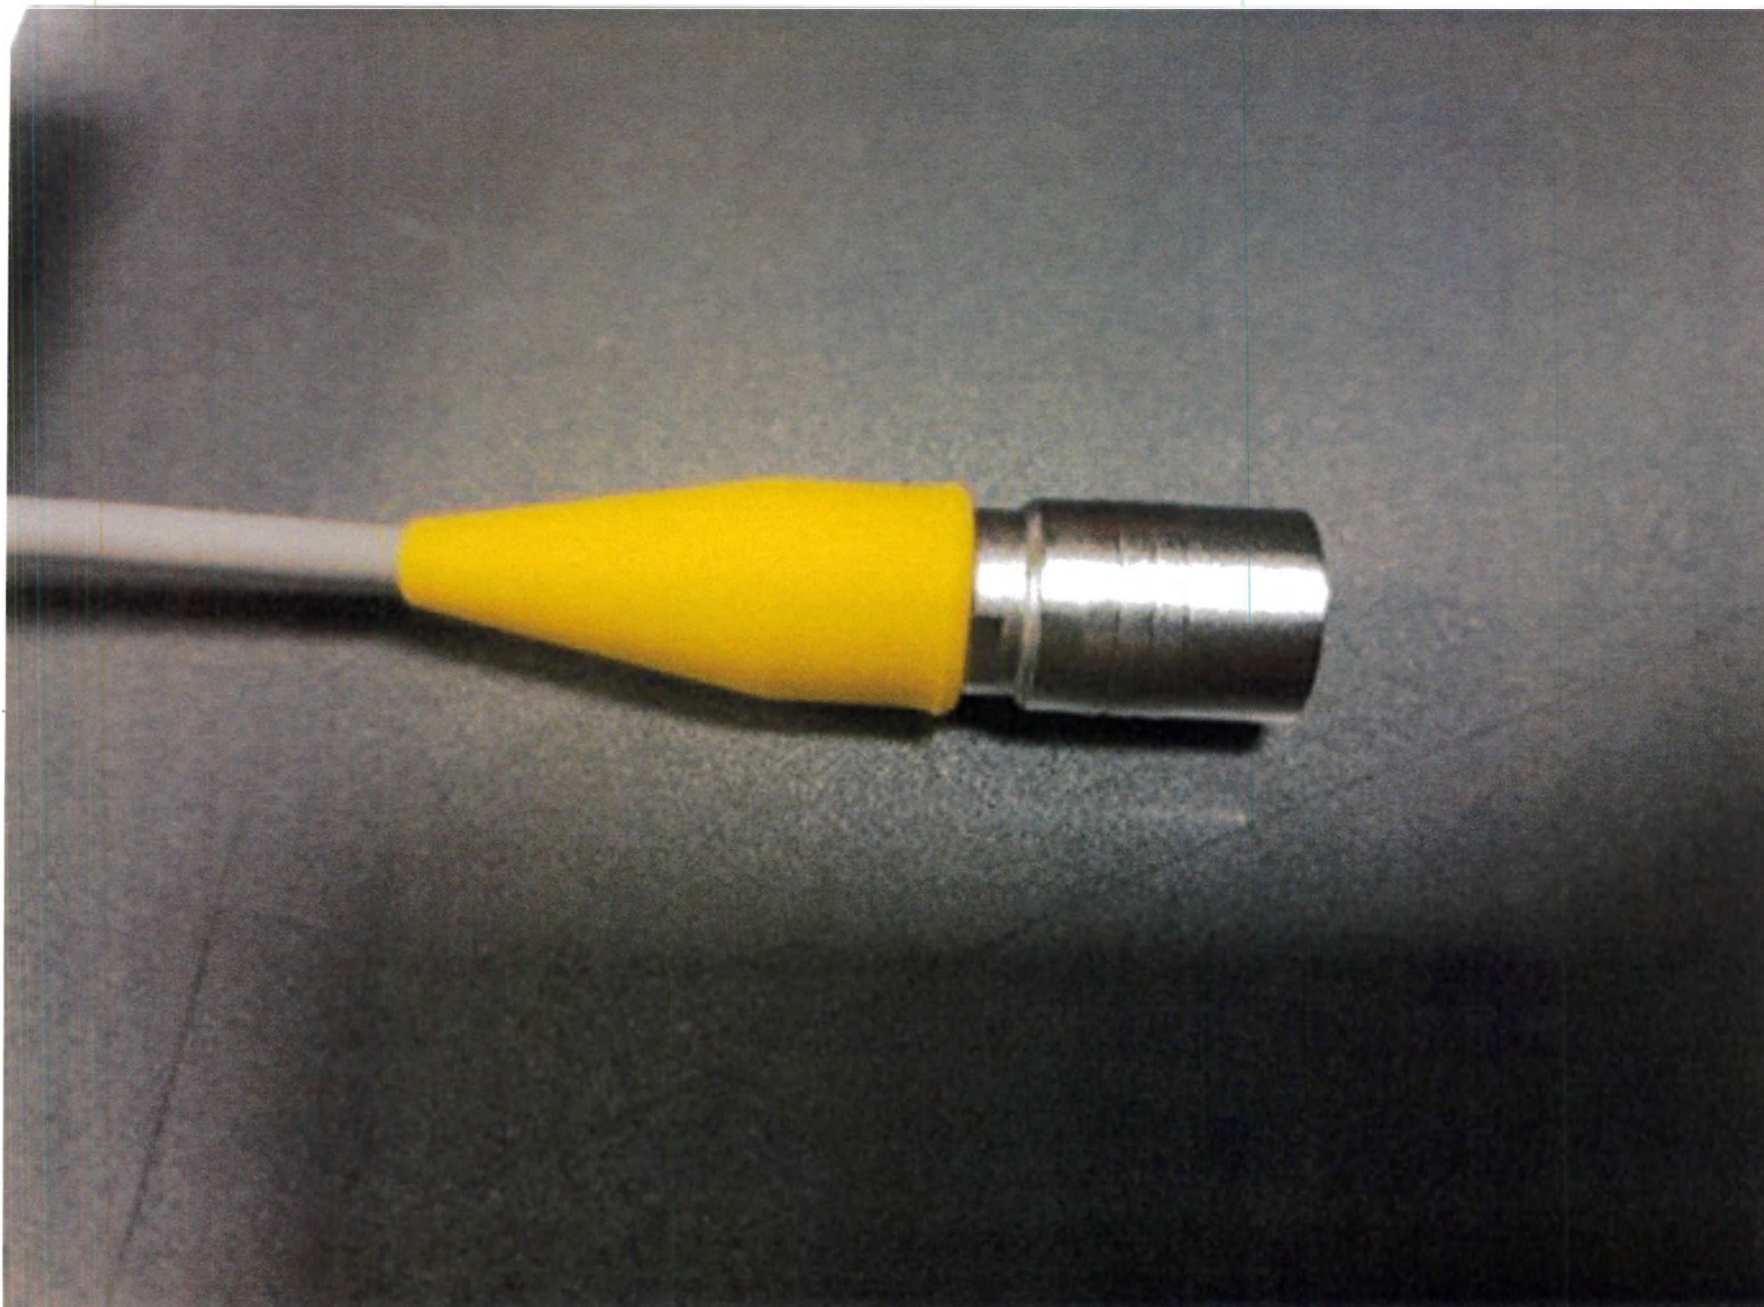

32. Датчик карандашный, модель РС-50М.




32. Датчик карандашный, модель PC-50M.



32. Датчик карандашный, модель PC-50M.



33. Датчик конвексный, модель PVT-675MVL.

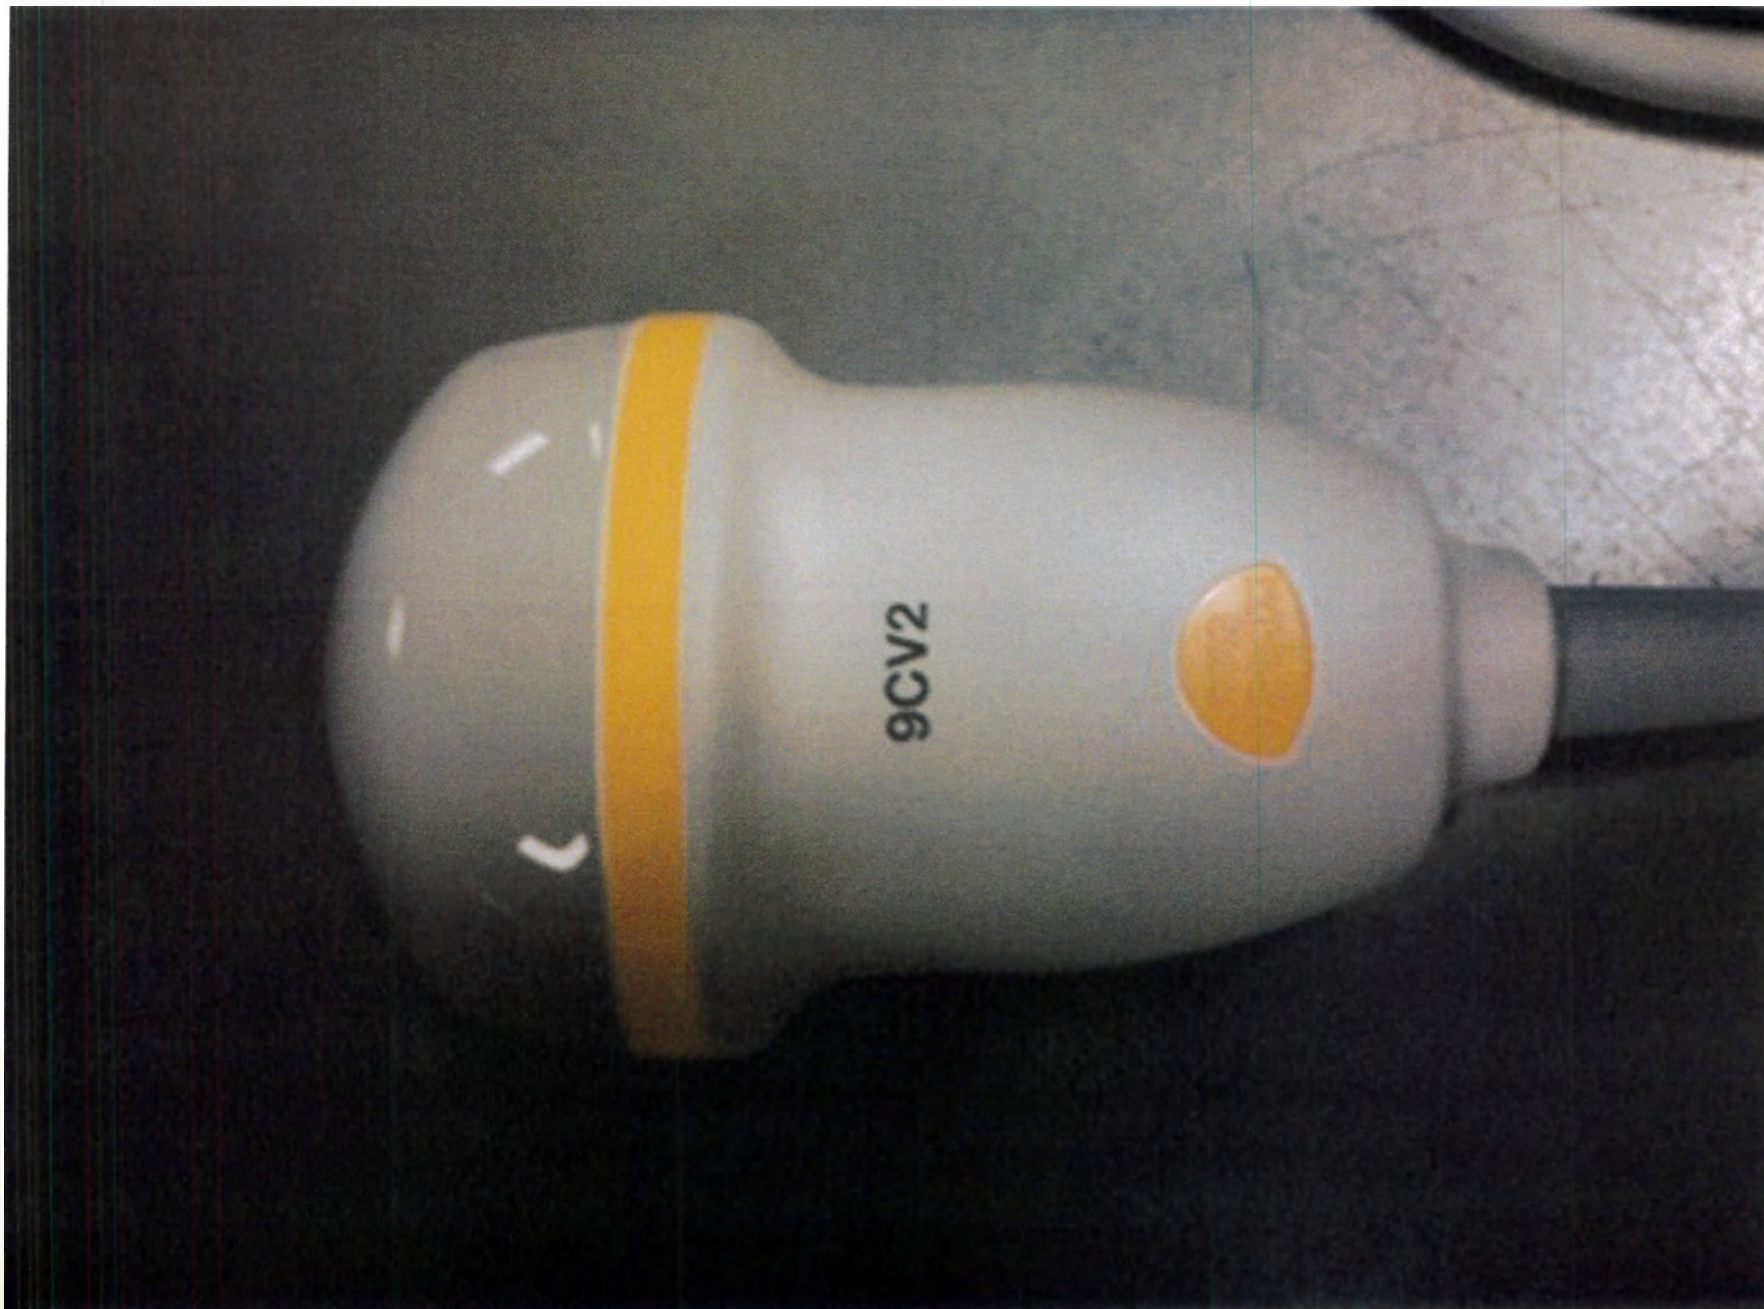

33. Датчик конвексный, модель PVT-675MVL.




33. Датчик конвексный, модель PVT-675MVL.



34. Датчик внутриматочный, модель PVT-681MVL.



34. Датчик внутривидеолостной, модель PVT-681MVL.

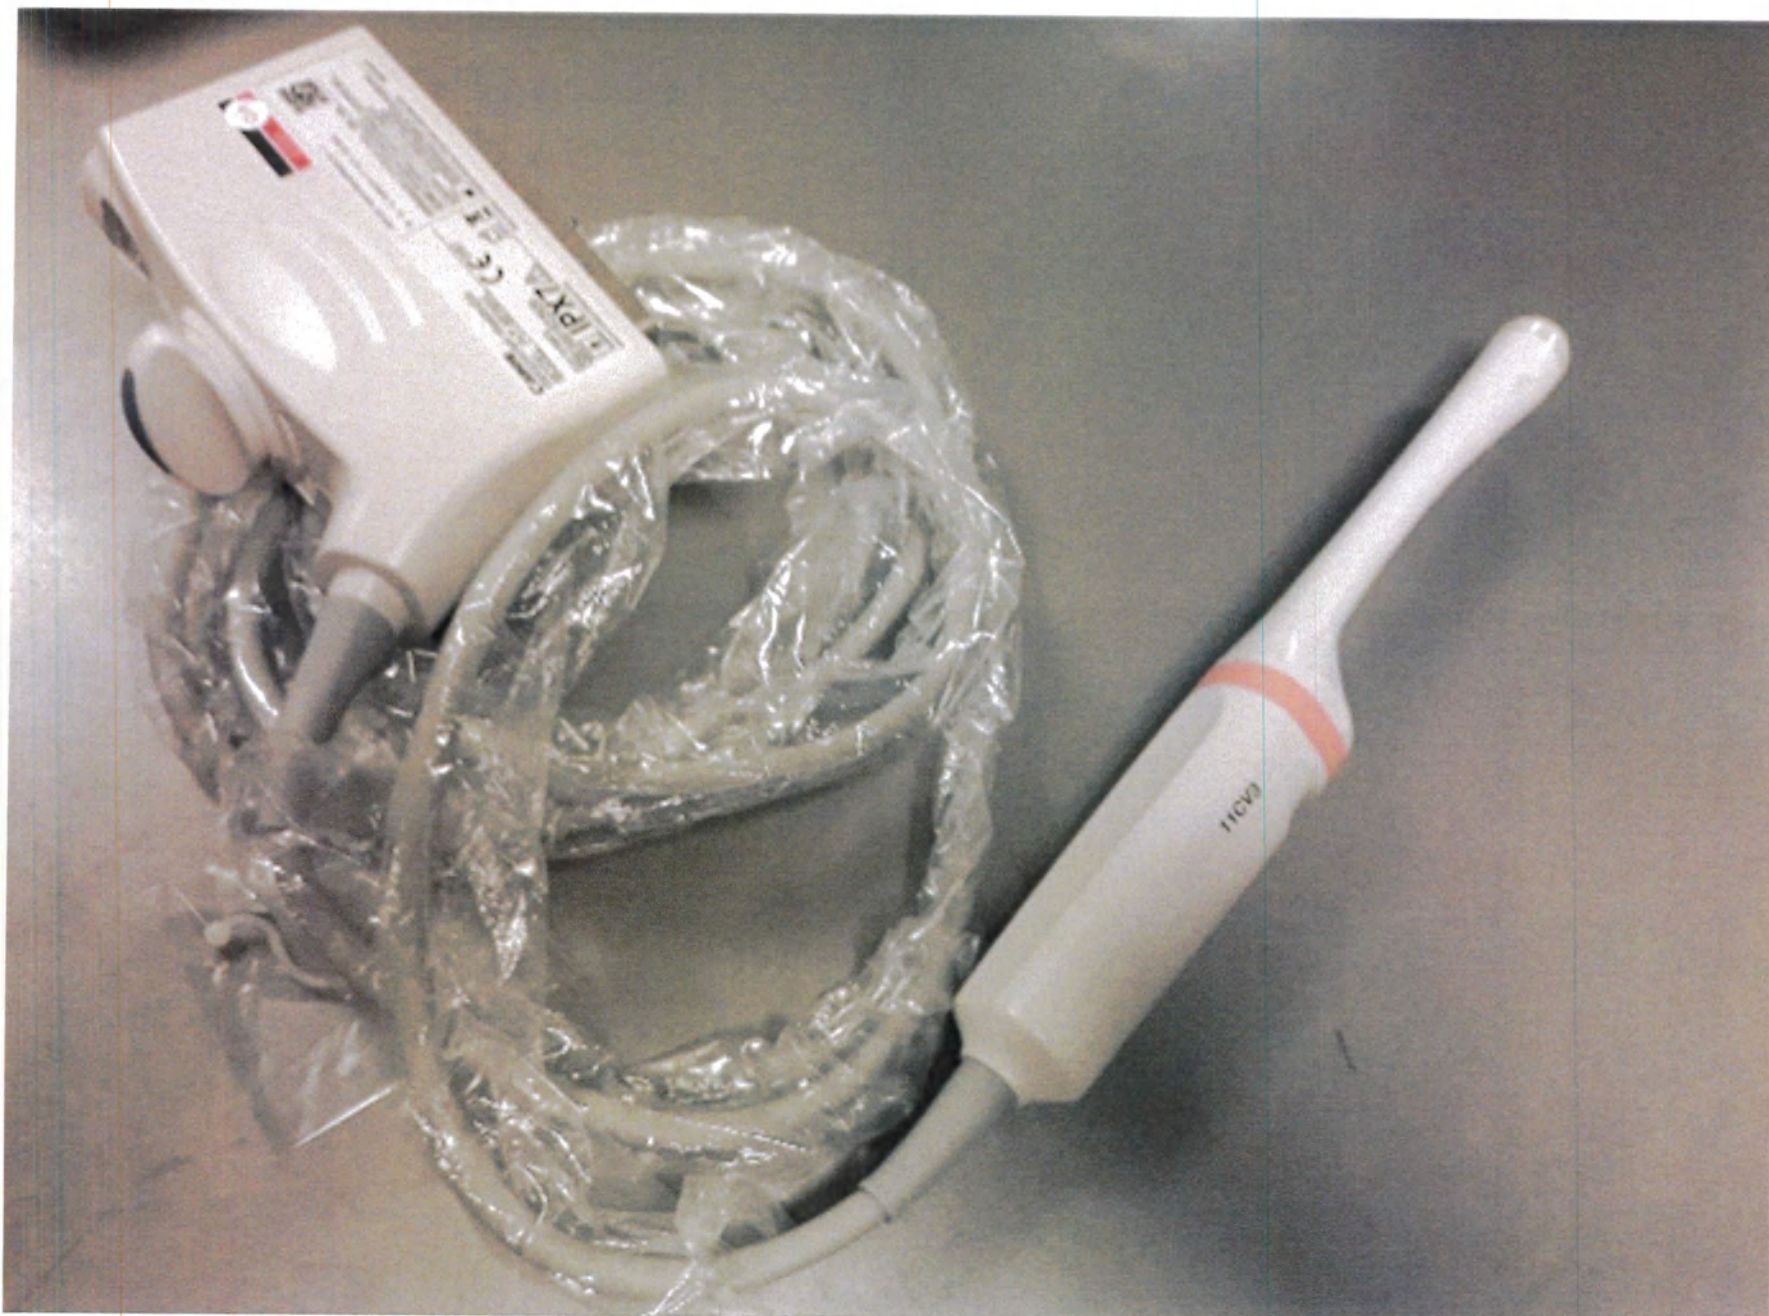

34. Датчик внутриматочной, модель PVT-681MVL.



35. Кабель питания.



36. Эксплуатационная документация на бумажном и/или электронном носителе, не более 50 шт.

99



№ 2B771-256RU*E

РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДЛЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
СИСТЕМЫ

Aplio 500
МОДЕЛЬ TUS-A500
[ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ]
(2B771-256RU*E)

ВНИМАНИЕ:
Федеральный закон США разрешает приобретение и
использование этого устройства только врачом или
по предписанию врача.

ВАЖНО!
Перед работой с оборудованием изучите и используйте настоящее
руководство. После прочтения держите руководство в
легкодоступном месте.

CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION


©CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION 2017 2018
ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ

Выпущено: 2018-08


ООО ЦРПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

принадлежности.

1. Модуль компрессионной эластографии.

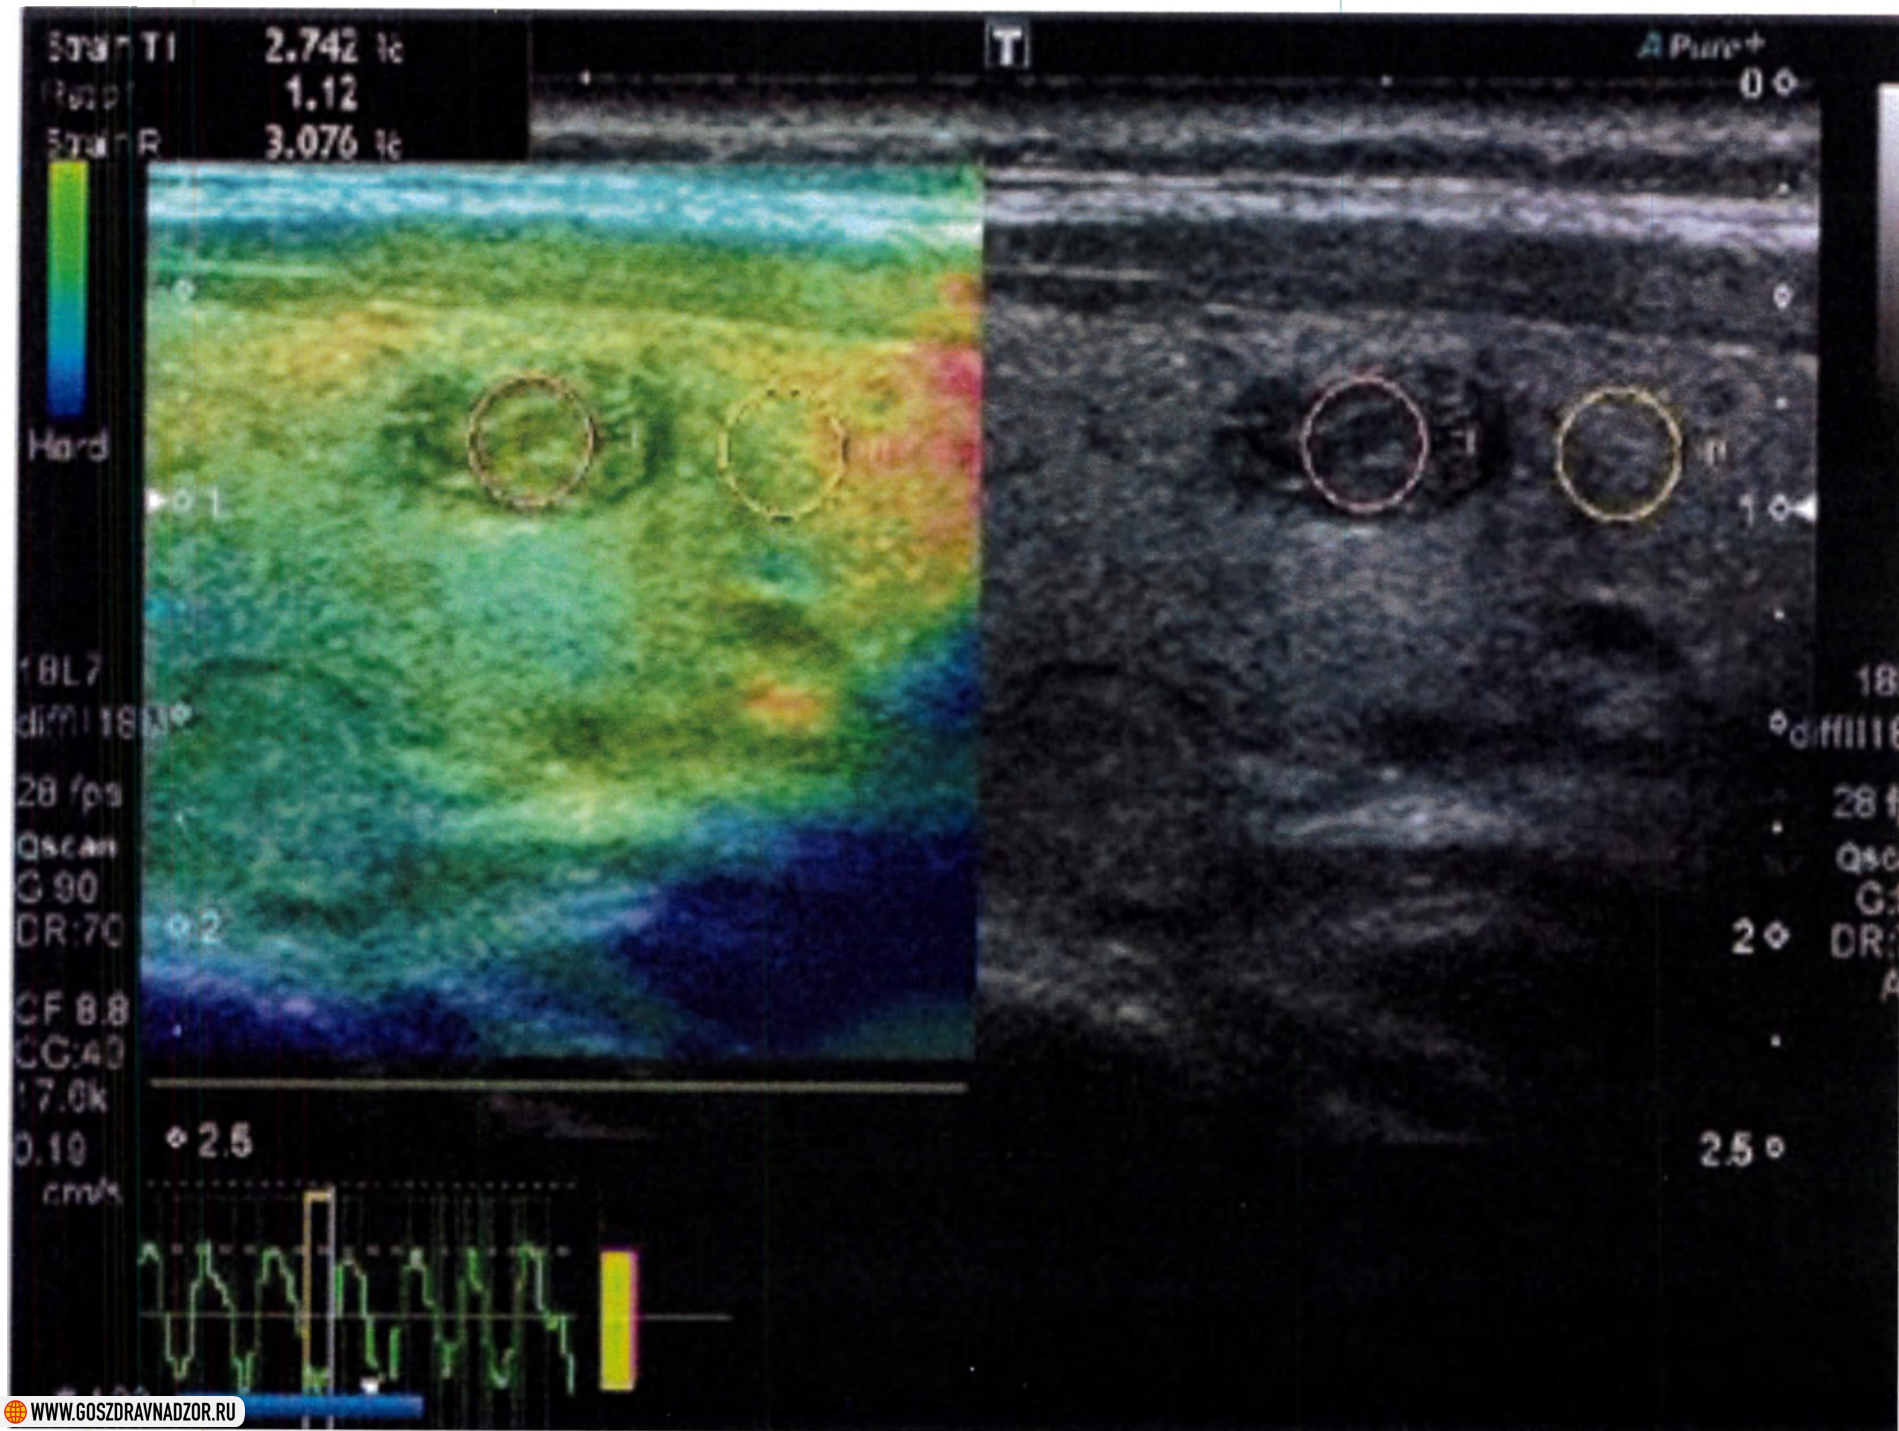


2. Модуль эластографии сдвиговой волной.

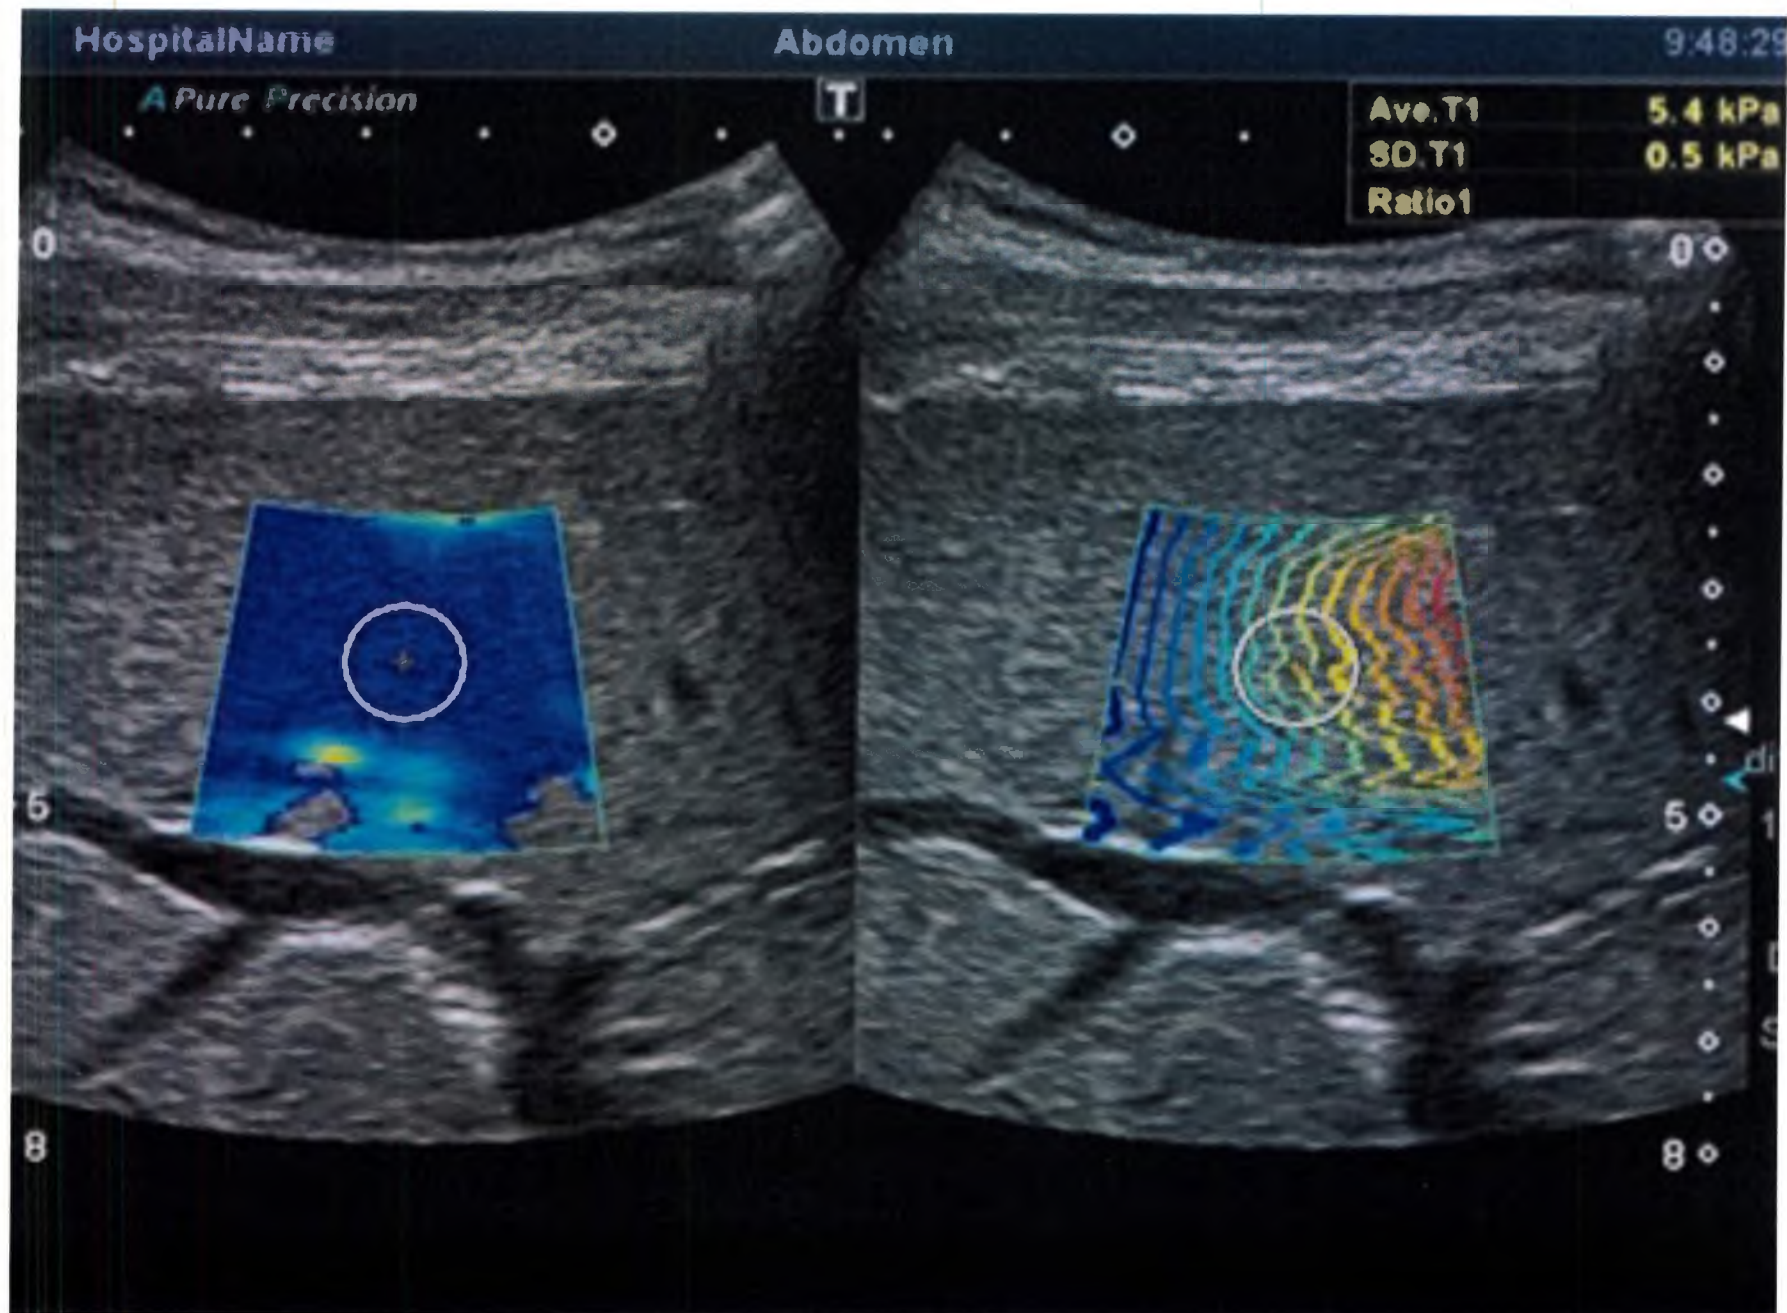

3. Модуль визуализации микрососудистого кровотока (SMI).




4. Модуль выявления микрокальцинатов (MicroPure).

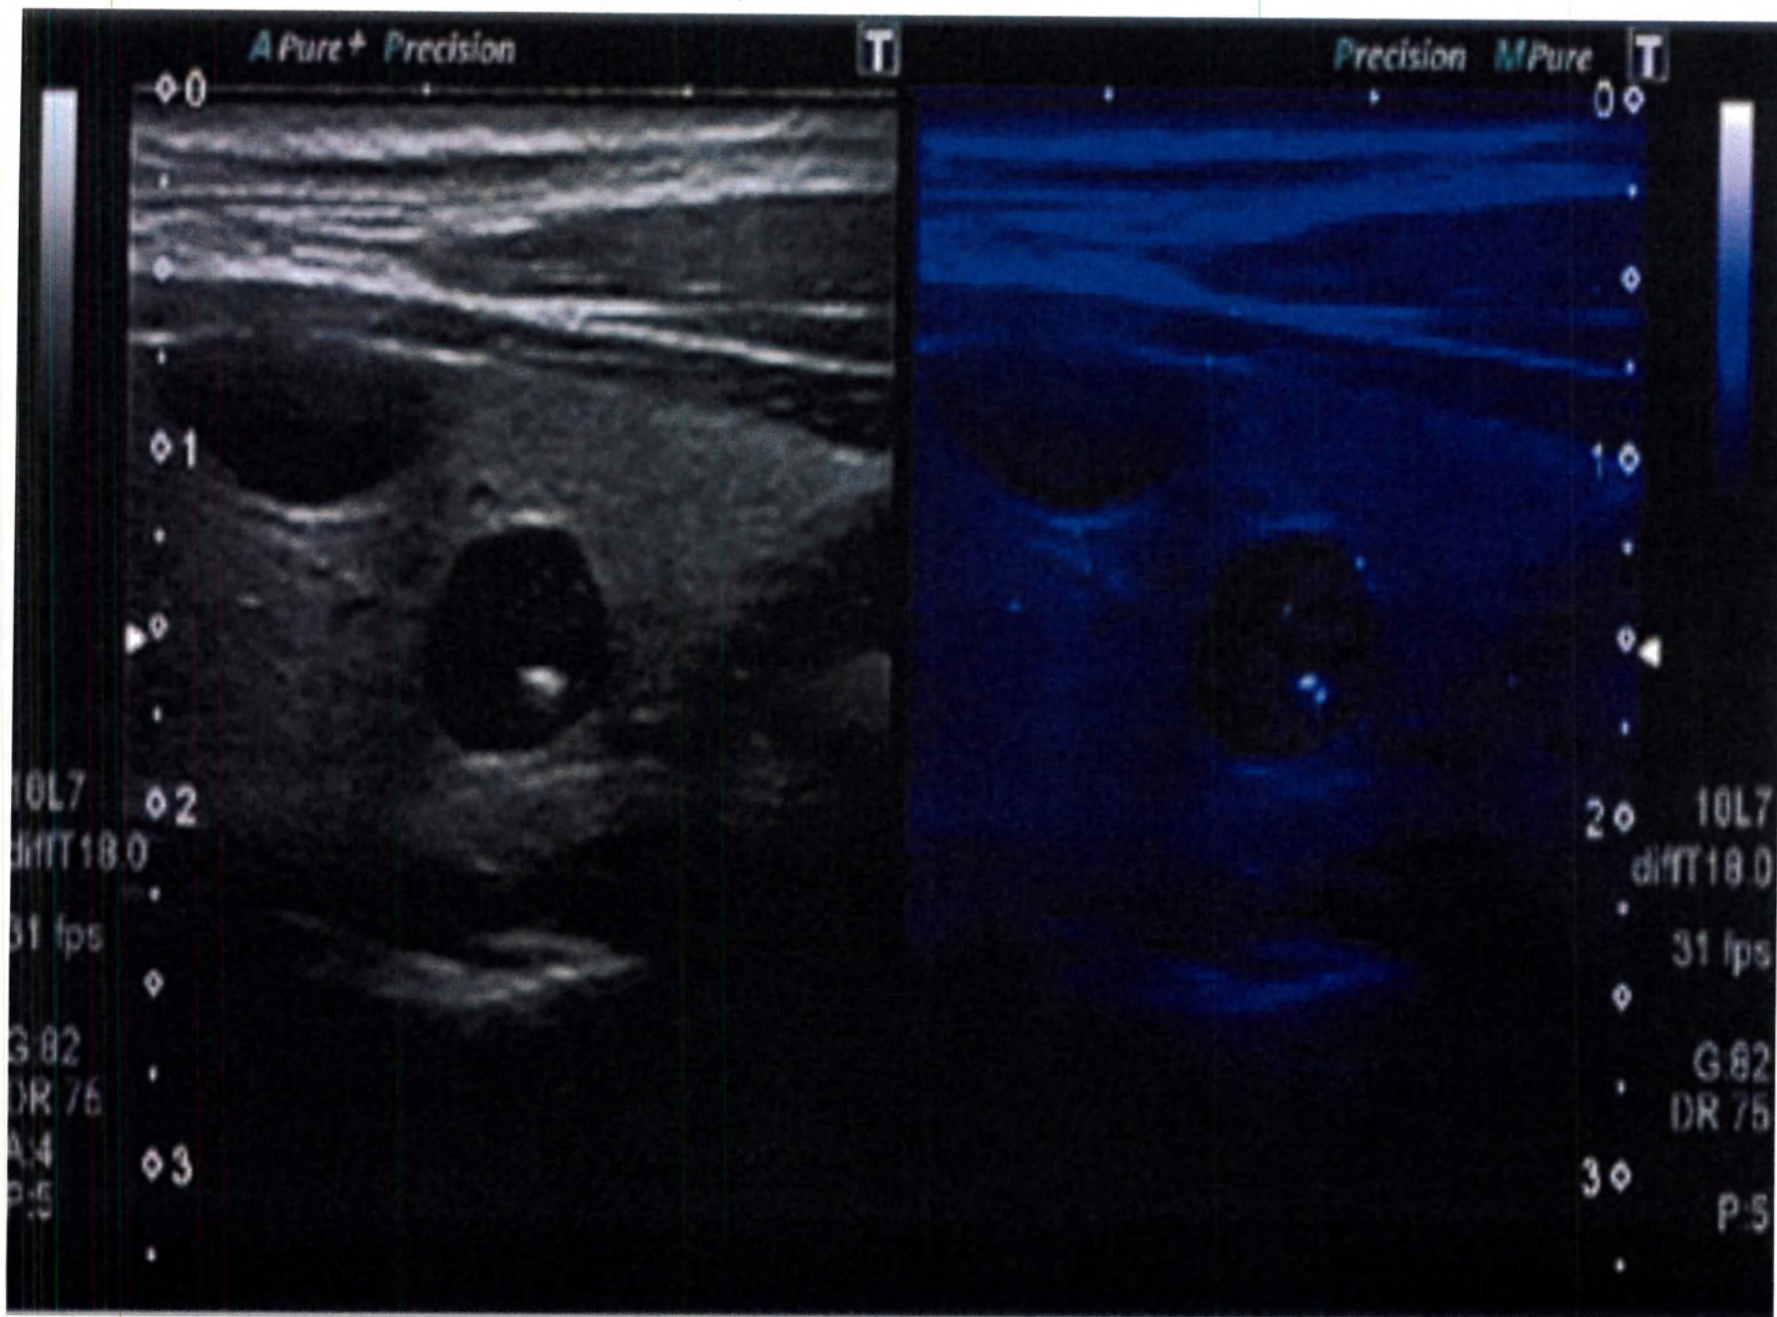


5. Модуль панорамной реконструкции изображения (Panoramic View).




6. Модуль формирования протокола исследования (Protocol Assistant).

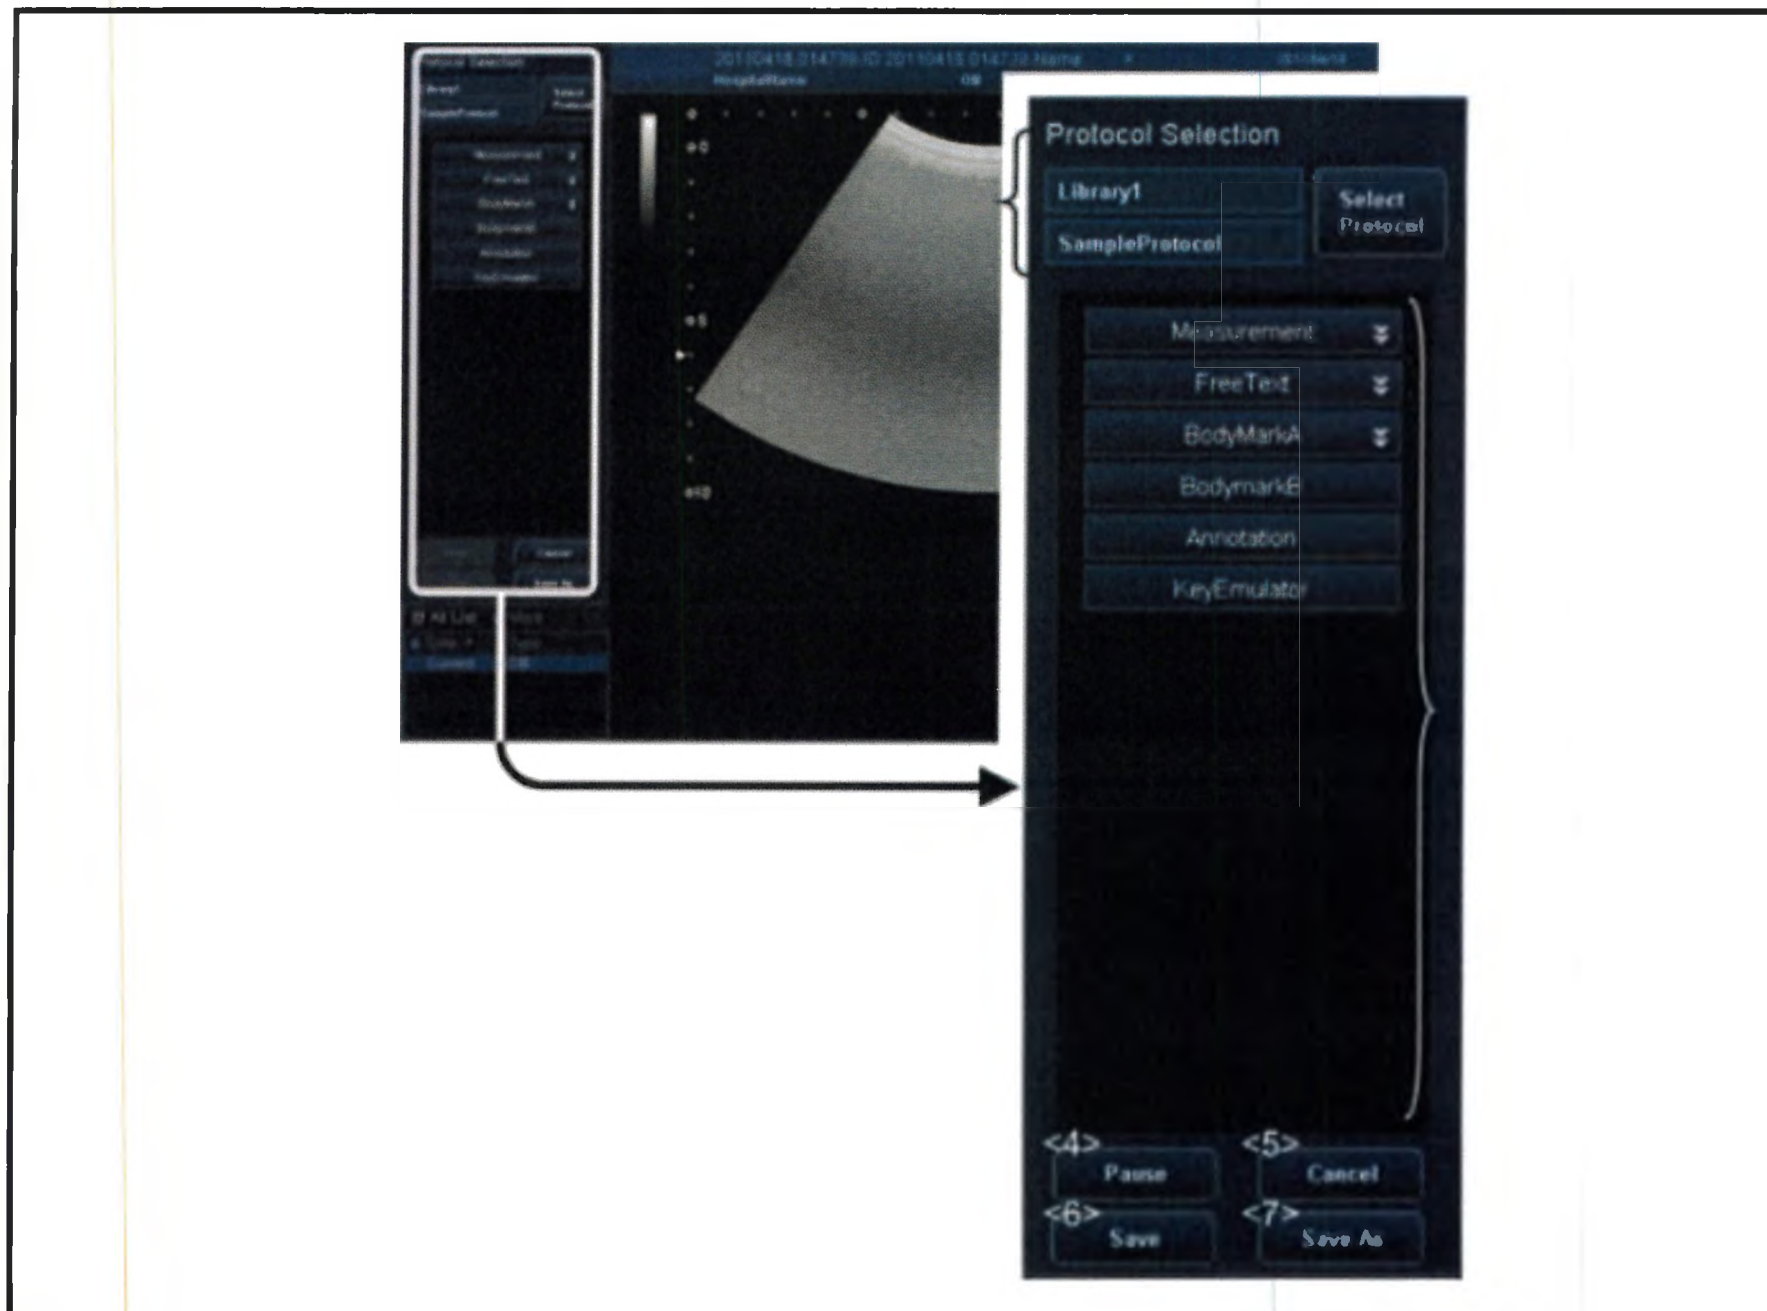

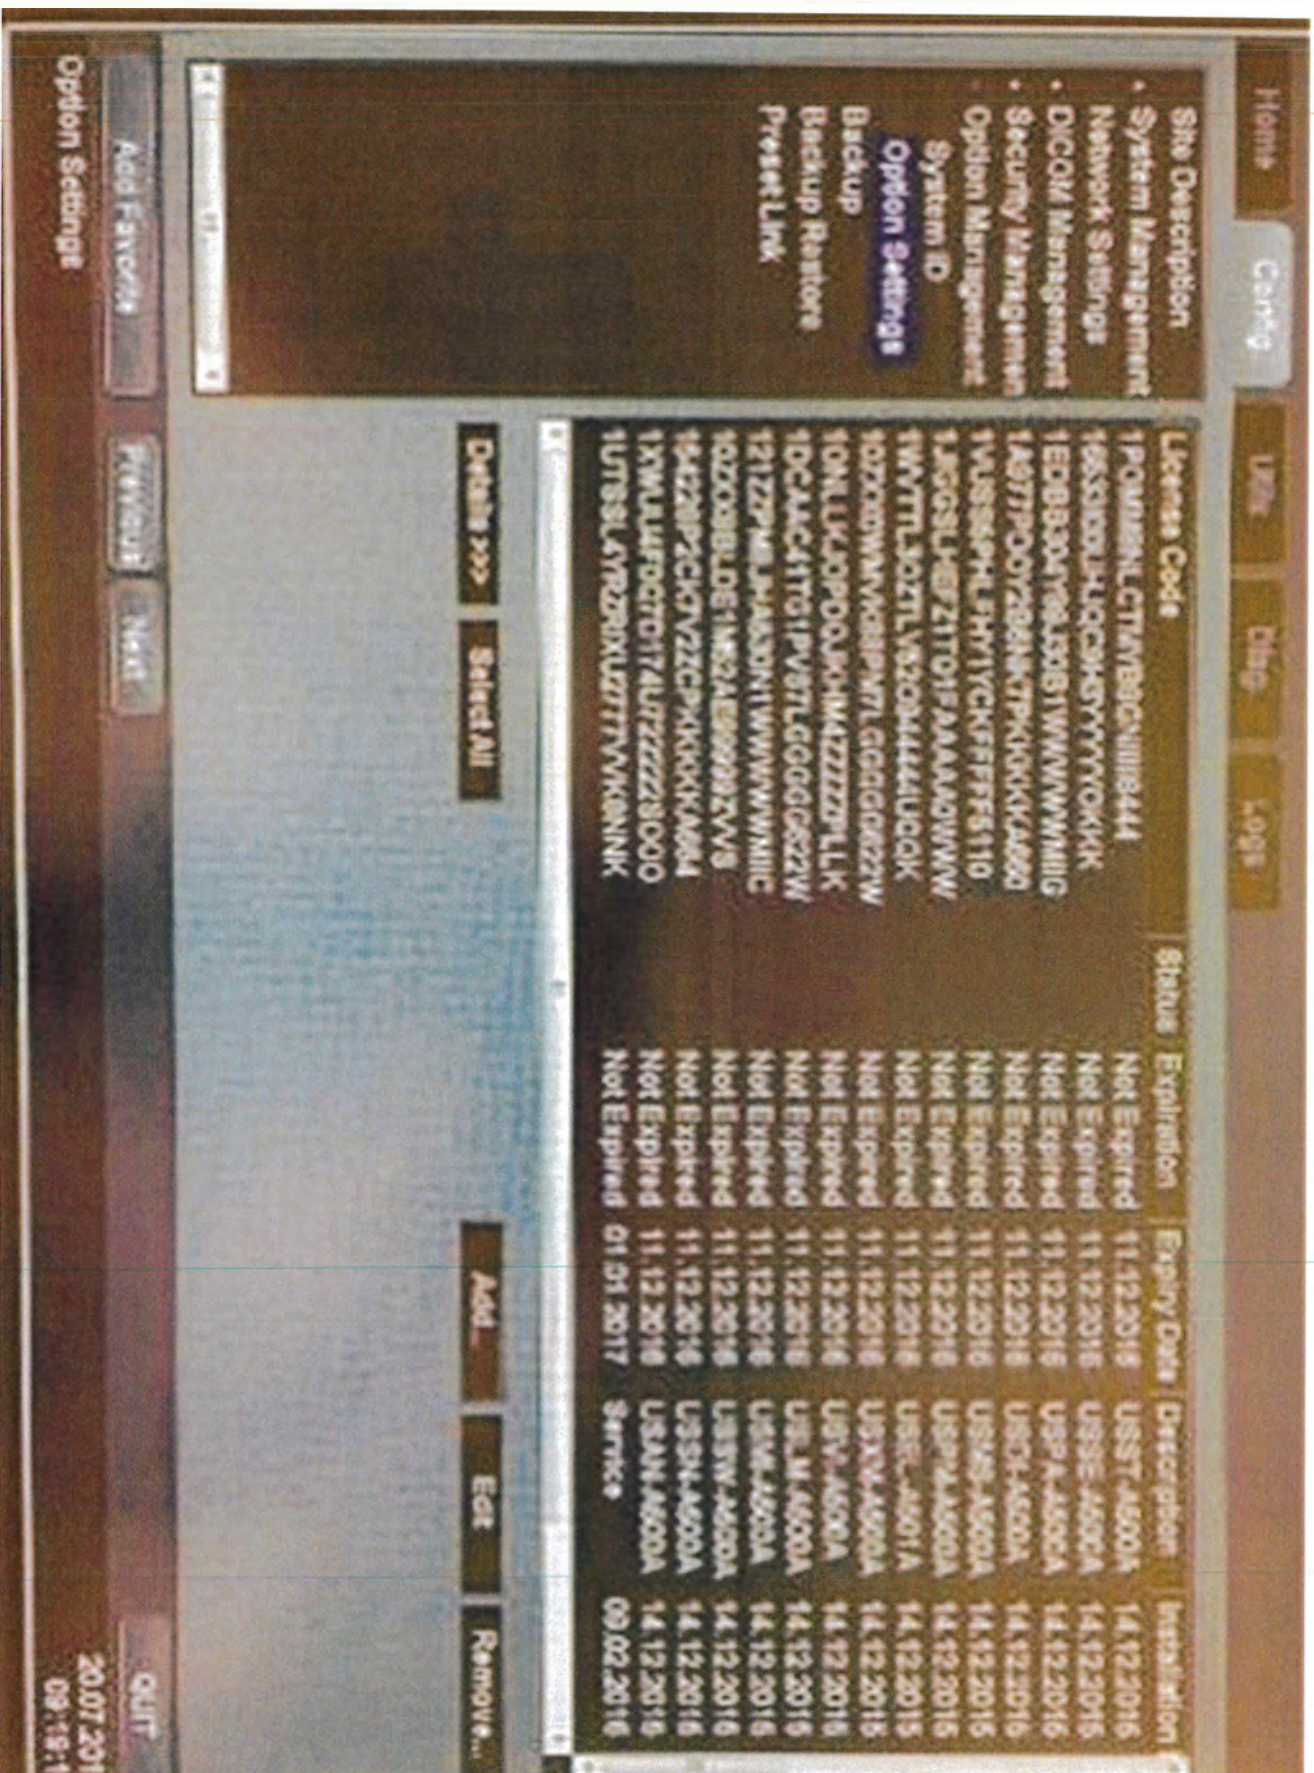

8. Модуль акустической количественной оценки структур (ASQ).

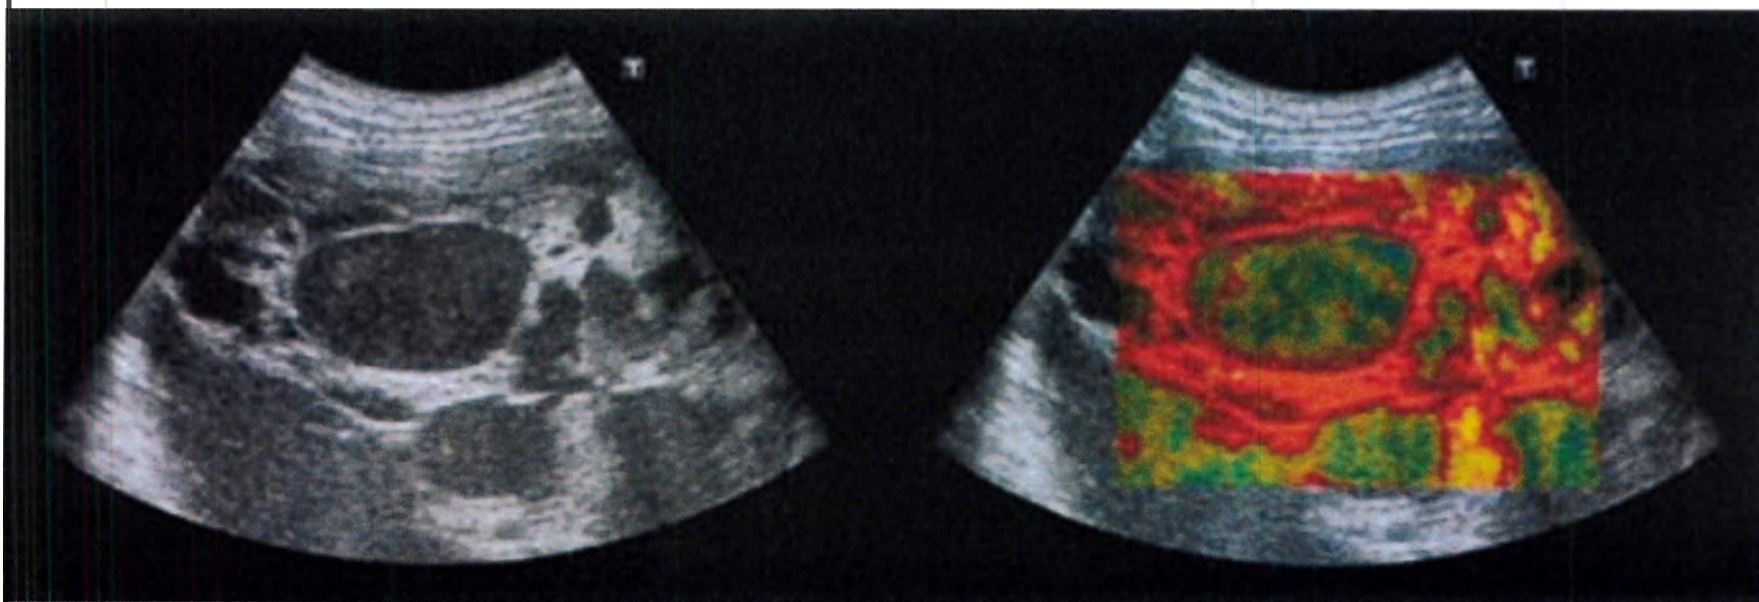

9. Модуль обеспечения безопасности при управлении системой (Security Management).

The screenshot displays the 'Security Management' module interface. On the left, a sidebar menu lists various system management options, with 'Option Settings' currently selected. The main area shows a table of licenses with columns for License Code, Status, Expiration, Expiry Date, Description, and Installation. Below the table are buttons for 'Details >>>', 'Select All', 'Add...', 'Edit', and 'Remove...'. At the bottom, there are buttons for 'Add Favorite', 'Previous', 'Next', and 'QUIT', along with a timestamp '20.07.201 09:19:1'.

License Code	Status	Expiration	Expiry Date	Description	Installation
1POMJ5NLCTMYB8GNIII8444	Not Expired	11.12.2016	11.12.2016	USST-A500A	14.12.2016
1653300UHQCSH3YYYYYOKKK	Not Expired	11.12.2016	11.12.2016	USSE-A500A	14.12.2016
1EDB8304Y89J3081WWW/WWMIG	Not Expired	11.12.2016	11.12.2016	USPA-A500A	14.12.2016
1A977POOY2B6NKTPIKIKKA660	Not Expired	11.12.2016	11.12.2016	USOI-A500A	14.12.2016
1VUSS6PHLFHY1YCKFFFFF5110	Not Expired	11.12.2016	11.12.2016	USMS-A500A	14.12.2016
1JGGSLHEFZ1T01FAAAAAQWWW	Not Expired	11.12.2016	11.12.2016	USPM-A500A	14.12.2016
1WVTTL3OZTLV52O34444UQQK	Not Expired	11.12.2016	11.12.2016	USBL-A501A	14.12.2016
10ZOXDWVVK88PM7LGGGGG622W	Not Expired	11.12.2016	11.12.2016	USXM-A500A	14.12.2016
10NLUKJOPDOJKIM4ZZZZZPLK	Not Expired	11.12.2016	11.12.2016	USVI-A500A	14.12.2016
1DCAAC41TG1PV87LGGGGG622W	Not Expired	11.12.2016	11.12.2016	USLM-A500A	14.12.2016
121ZZPMSJHA530N1WWW/WMIIC	Not Expired	11.12.2016	11.12.2016	USMI-A500A	14.12.2016
10ZOXBLDS1M52AE99999ZVVS	Not Expired	11.12.2016	11.12.2016	USSW-A500A	14.12.2016
164228P2CK7V2ZCPKIKIKKA664	Not Expired	11.12.2016	11.12.2016	USSN-A500A	14.12.2016
1XWJU4FDQ7D174U7222228000	Not Expired	11.12.2016	11.12.2016	USAN-A500A	14.12.2016
1UTSSL4YRZRXU2777VVK8NNK	Not Expired	01.01.2017	01.01.2017	Service	09.02.2016

10. Держатель для кабелей датчиков.




11. Ножная педаль управления.

110



11. Ножная педаль управления.

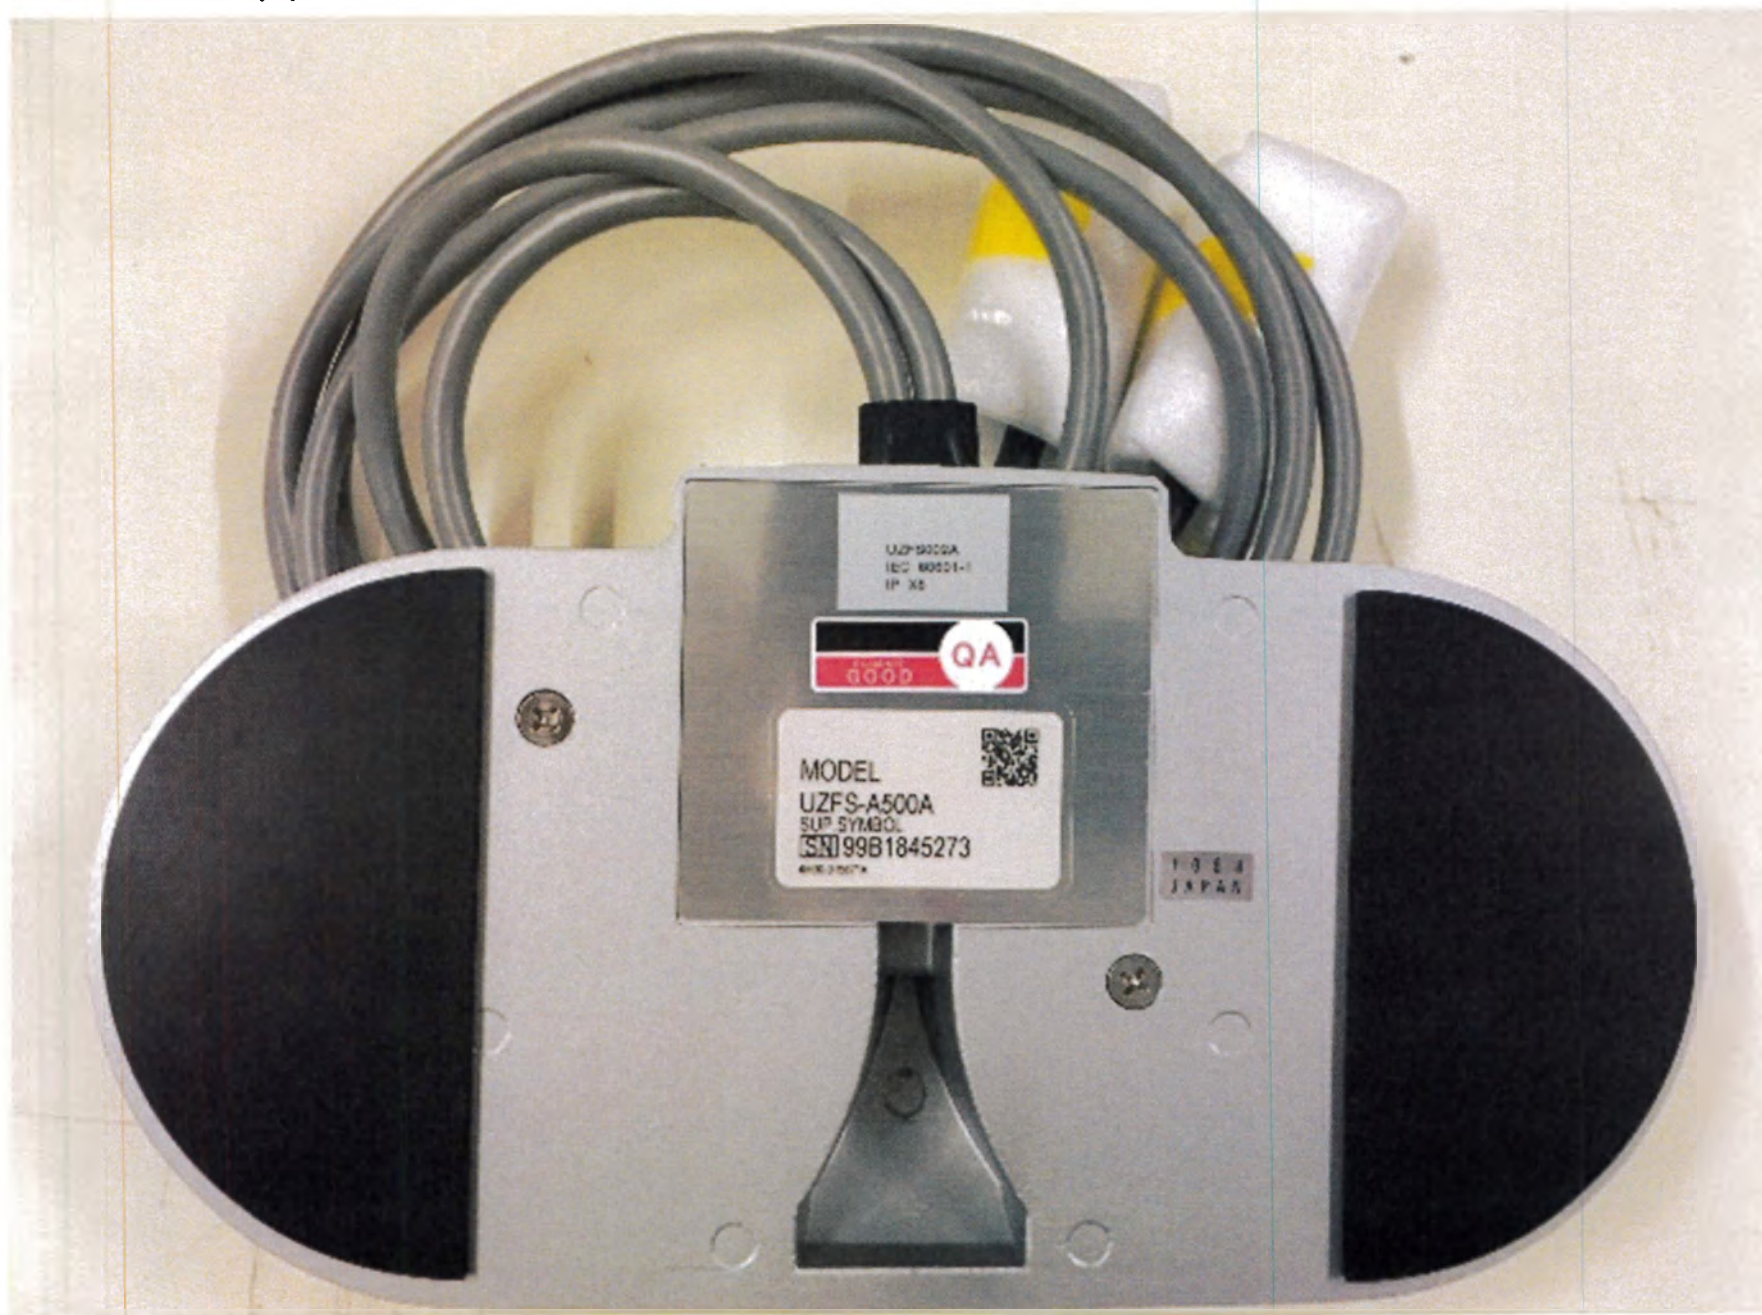


12. Нагреватель геля.

112




13. Модуль поддержки русского языка.

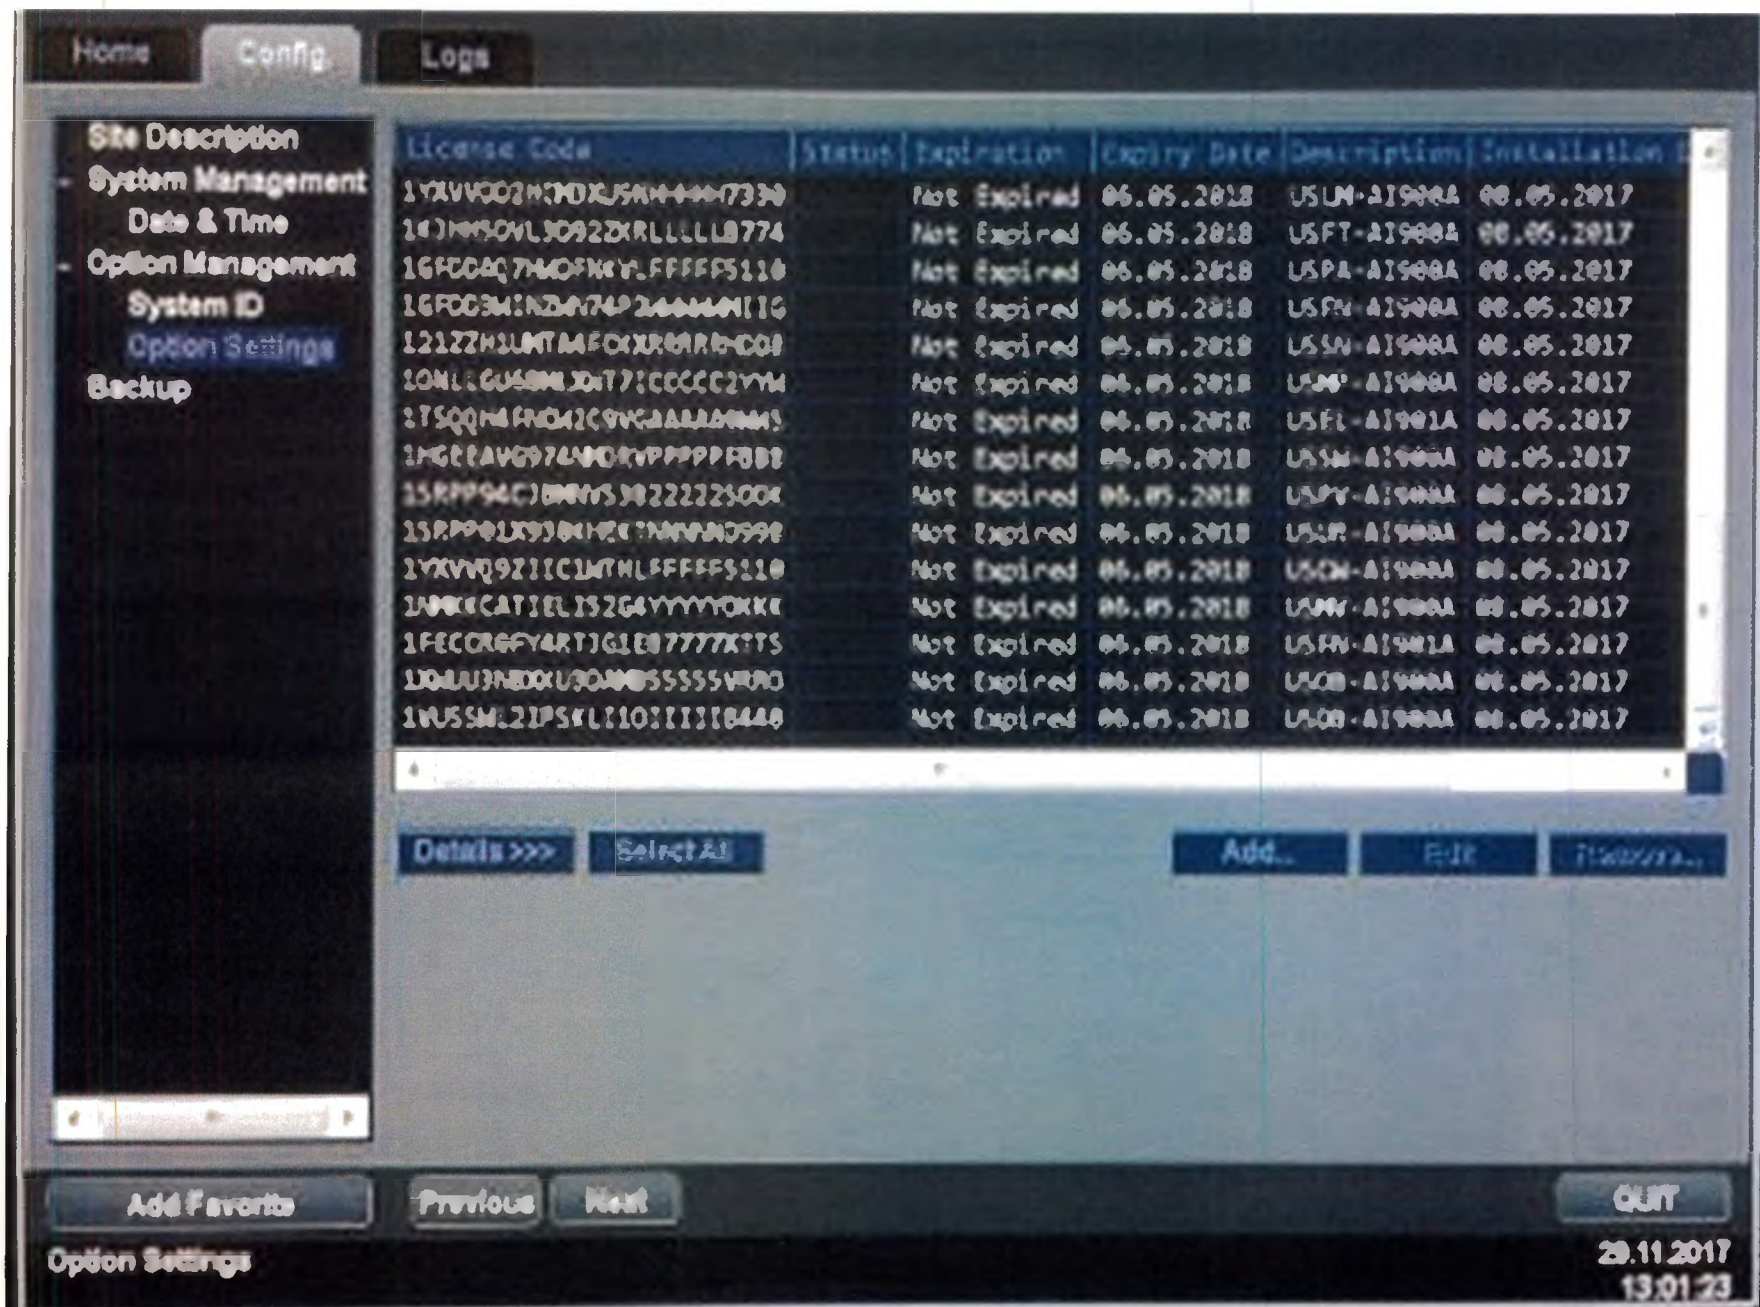





14. Модуль постоянно-волнового доплера (CW).

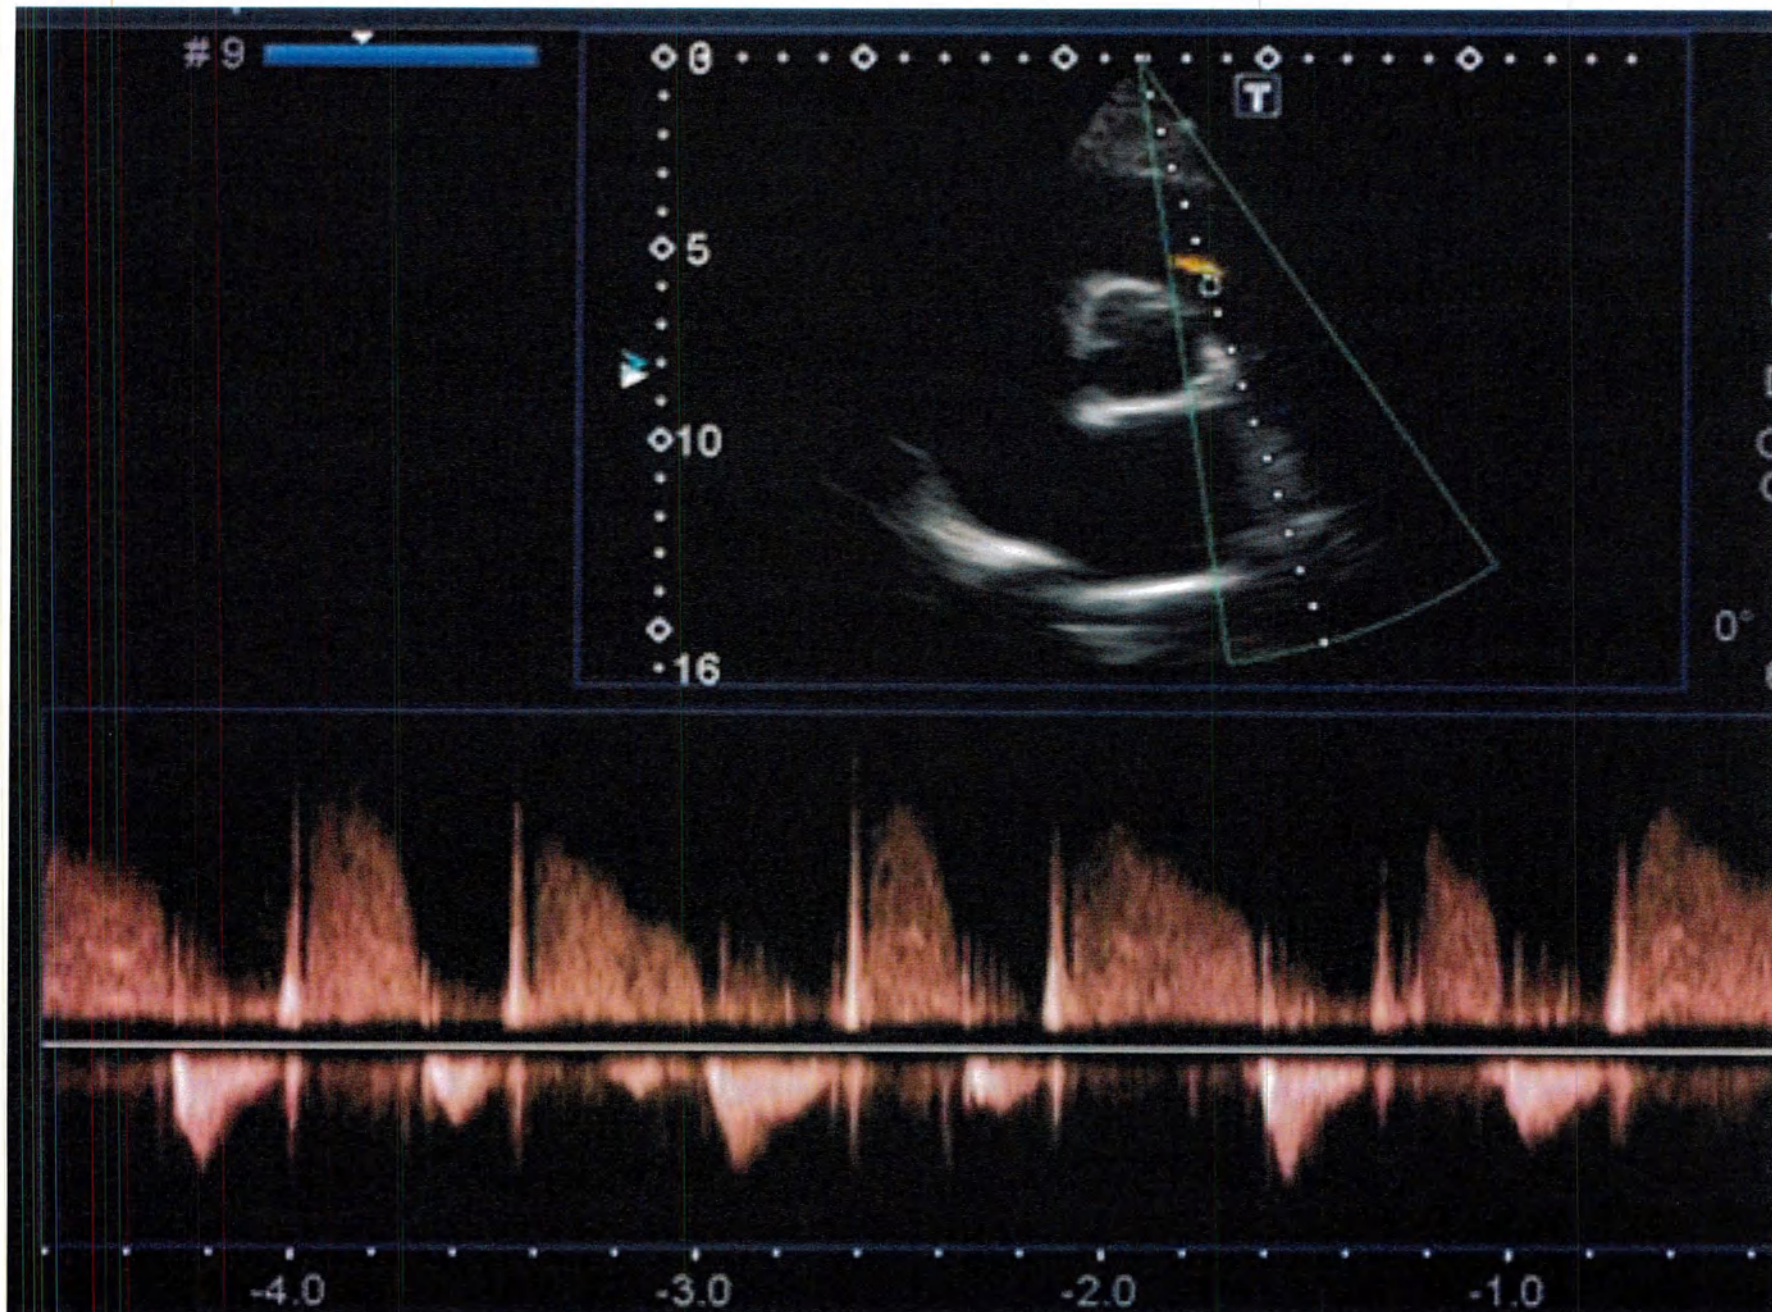


15. Модуль отображения референсных сигналов (ЭКГ).

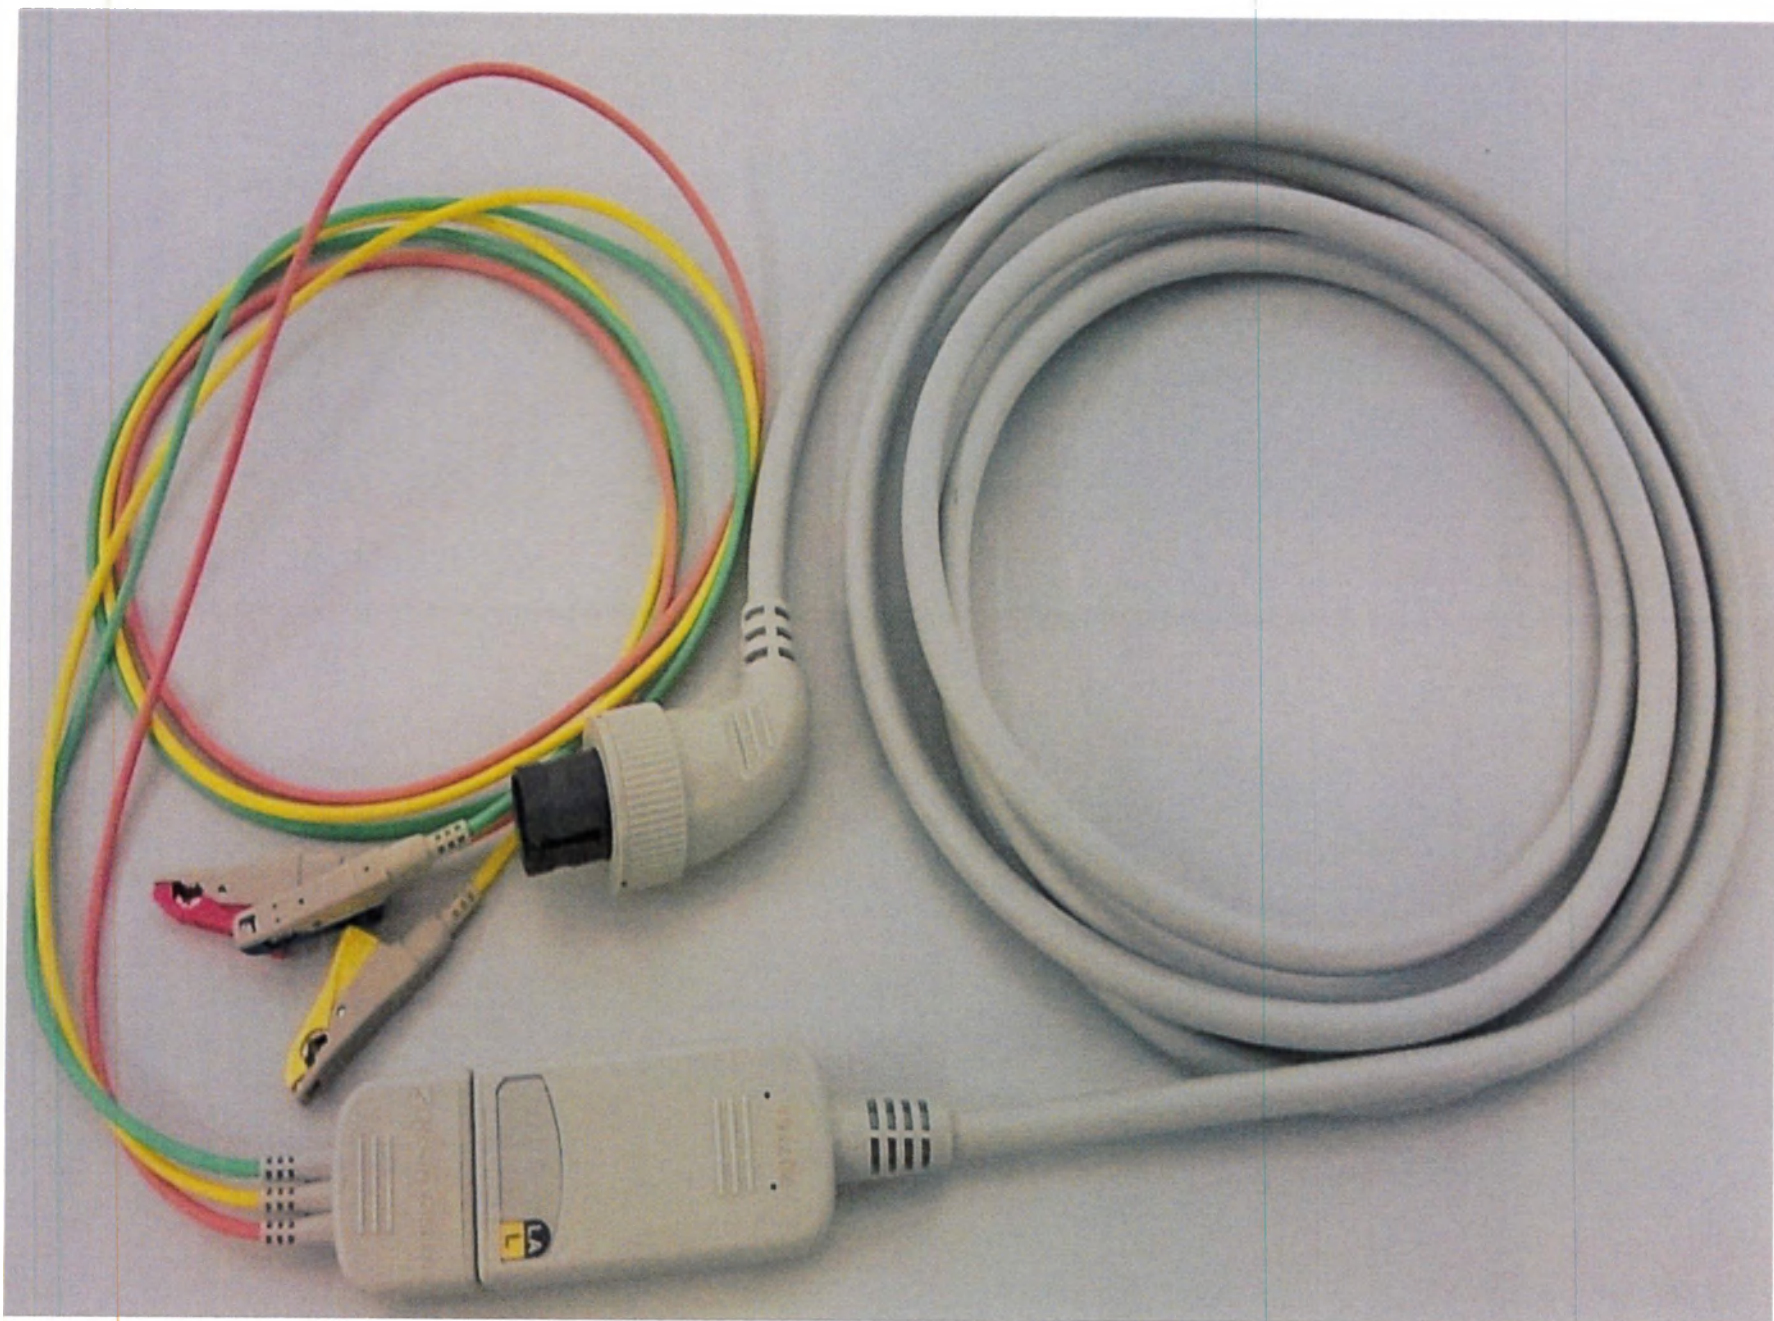


16. Модуль трекинга и анализ смещения стенки миокарда.

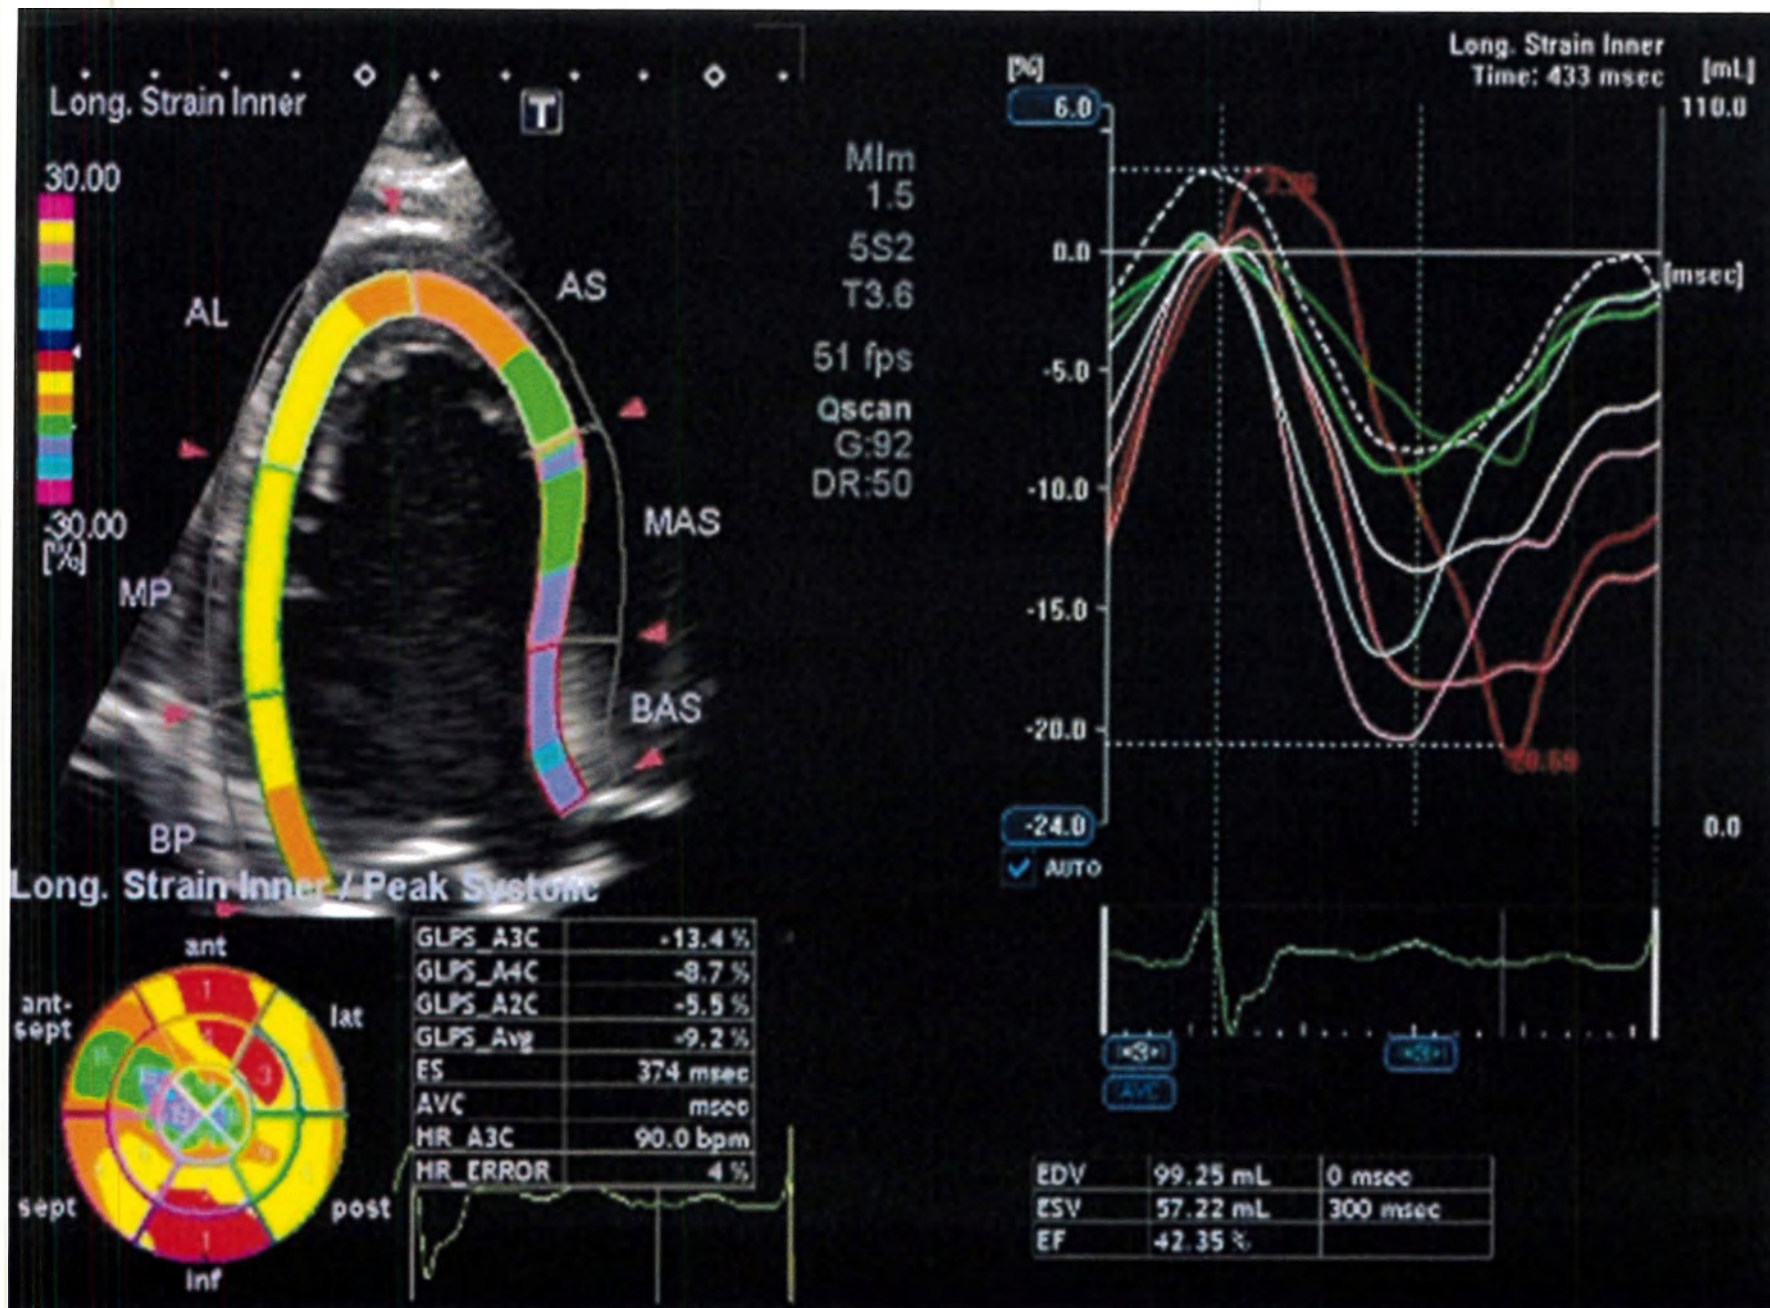


17. Модуль стресс-эхокардиографии (Stress Echo).

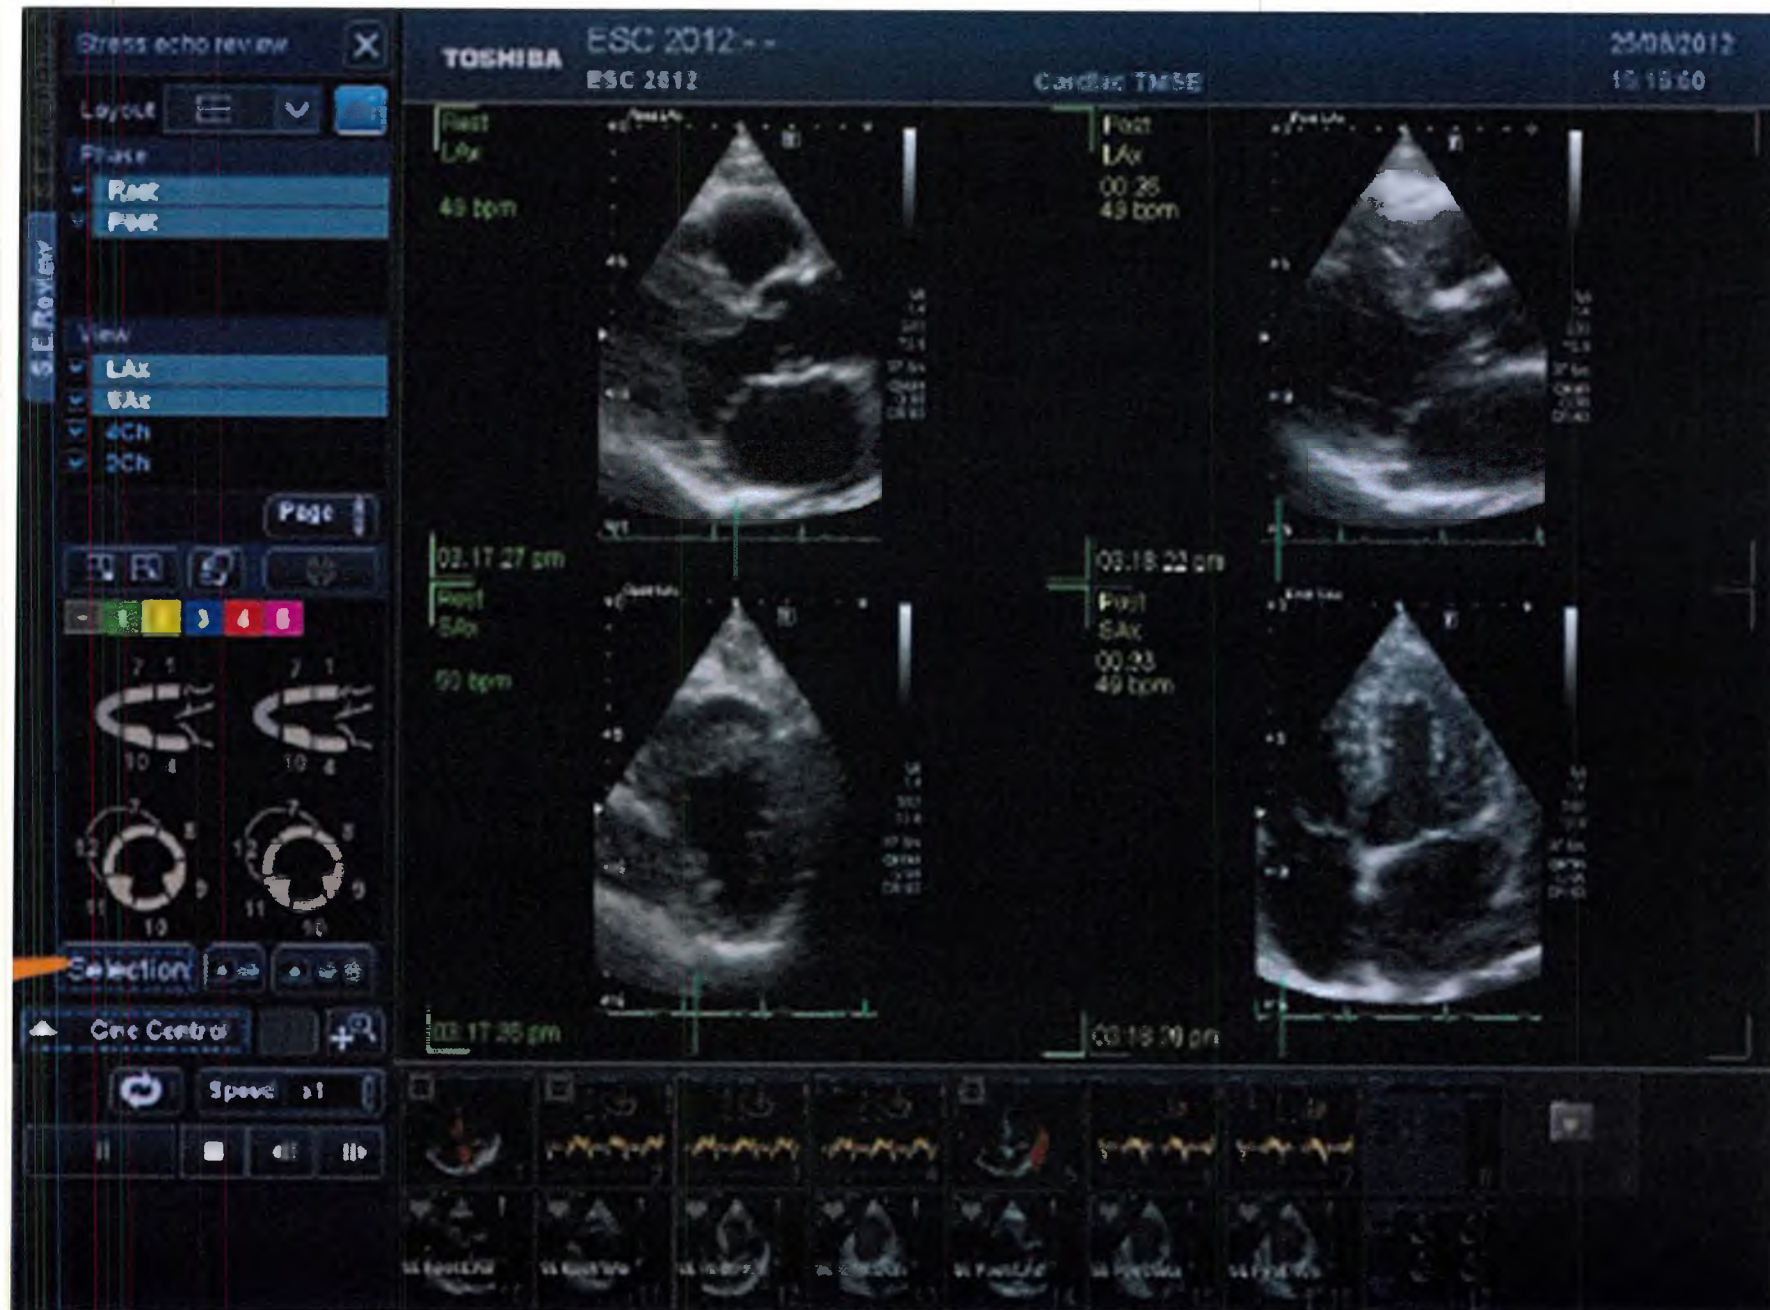


18. Модуль специализированный кардио-сосудистый (CV).

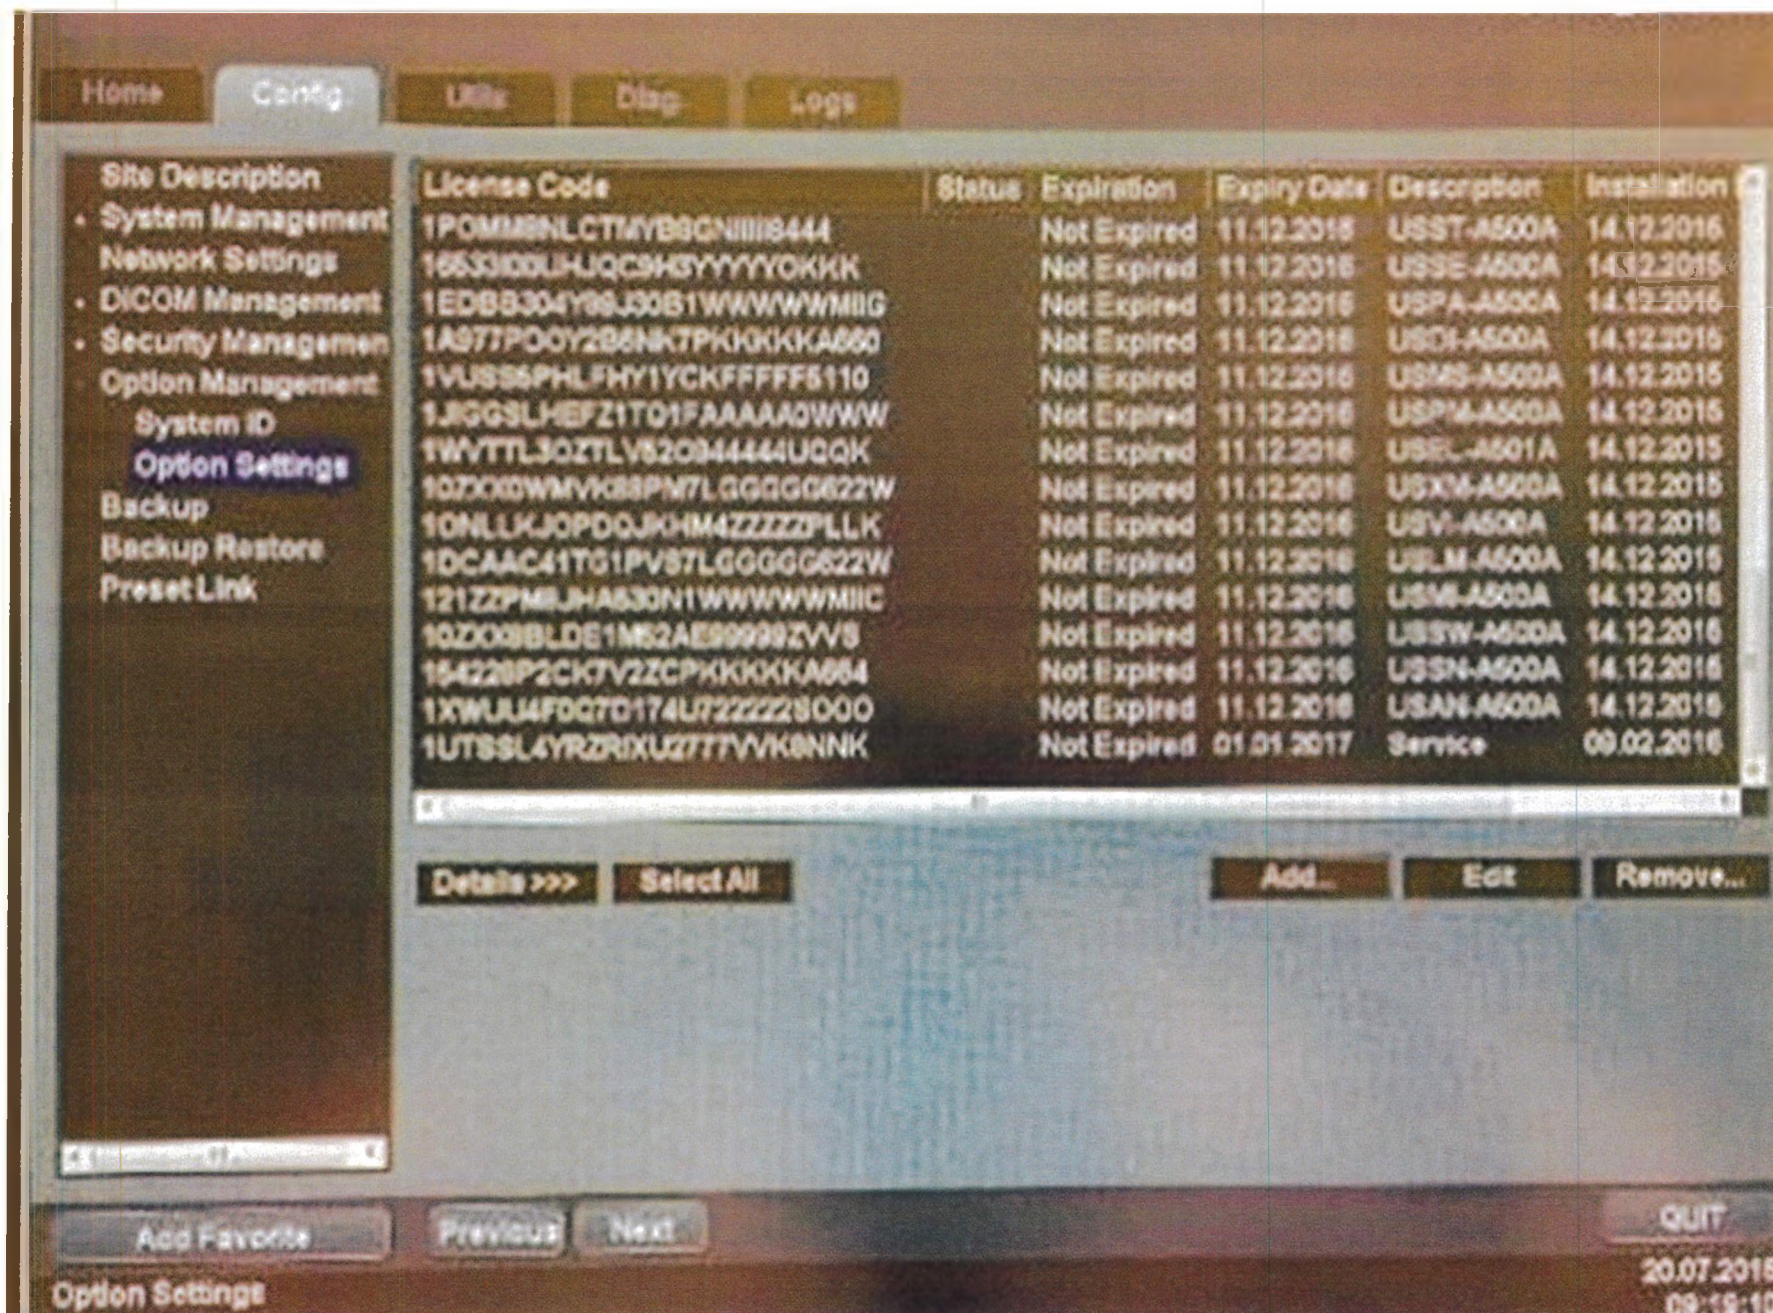


19. Модуль визуализации в режиме 4D (STIC).

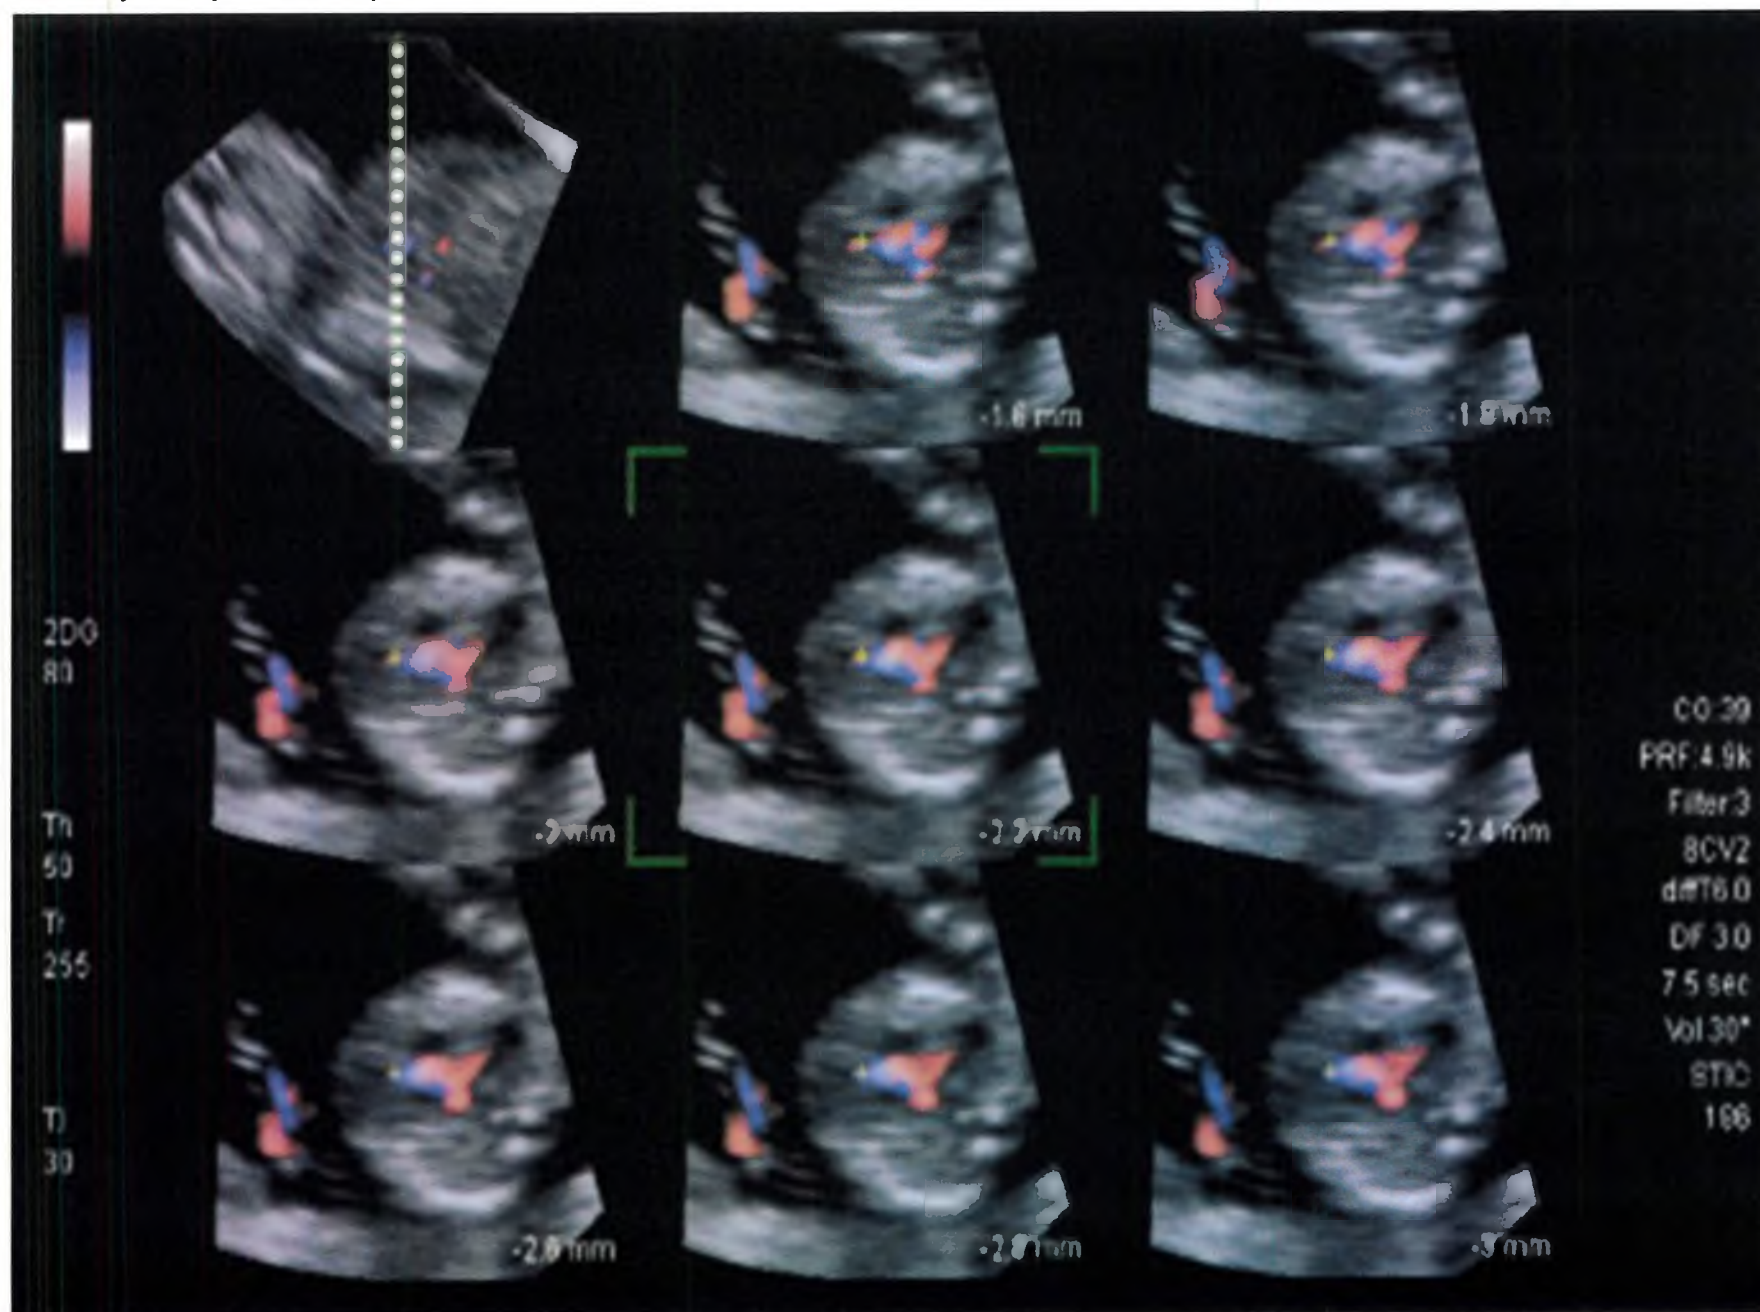


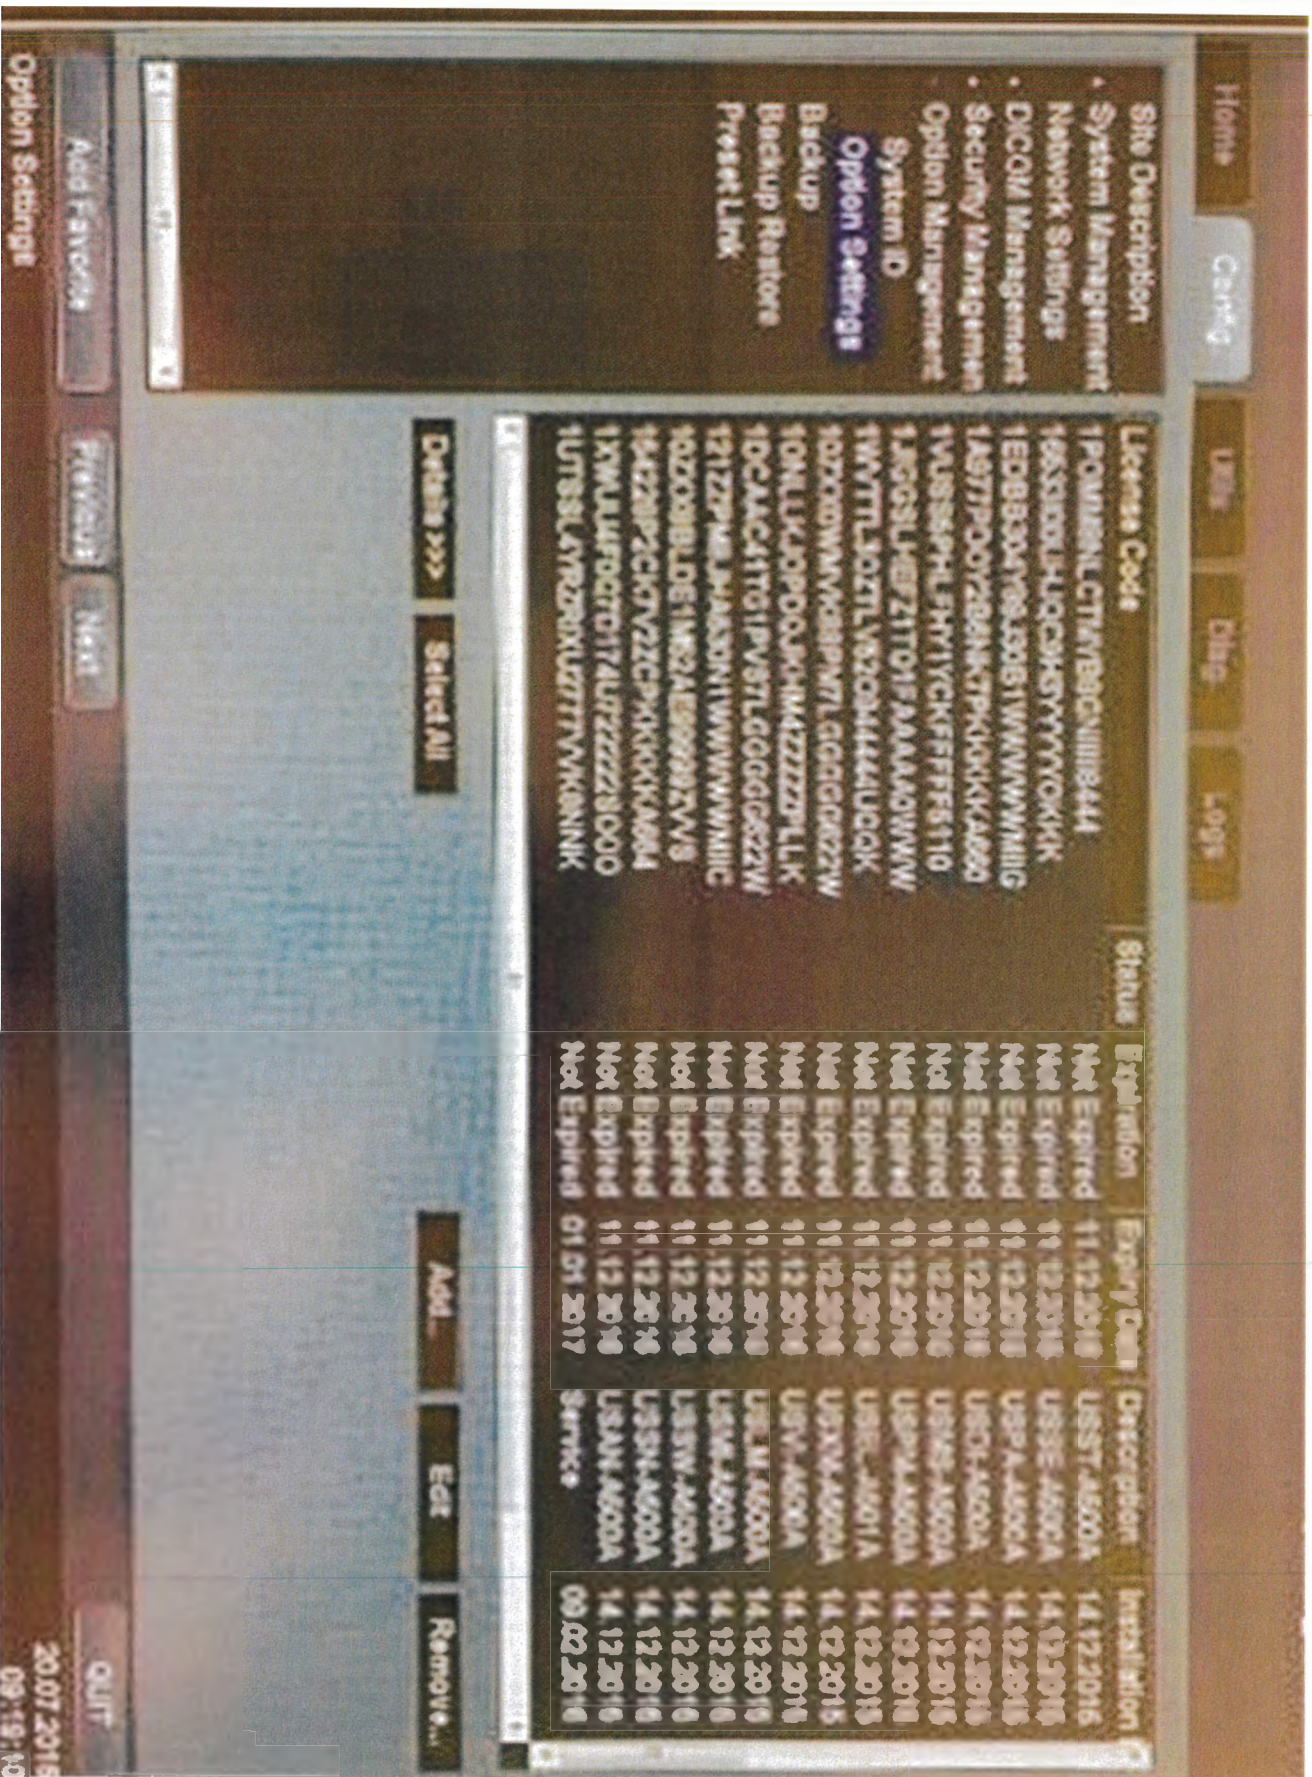


21. Модуль виртуального объемного освещения высокой плотности (Luminance).

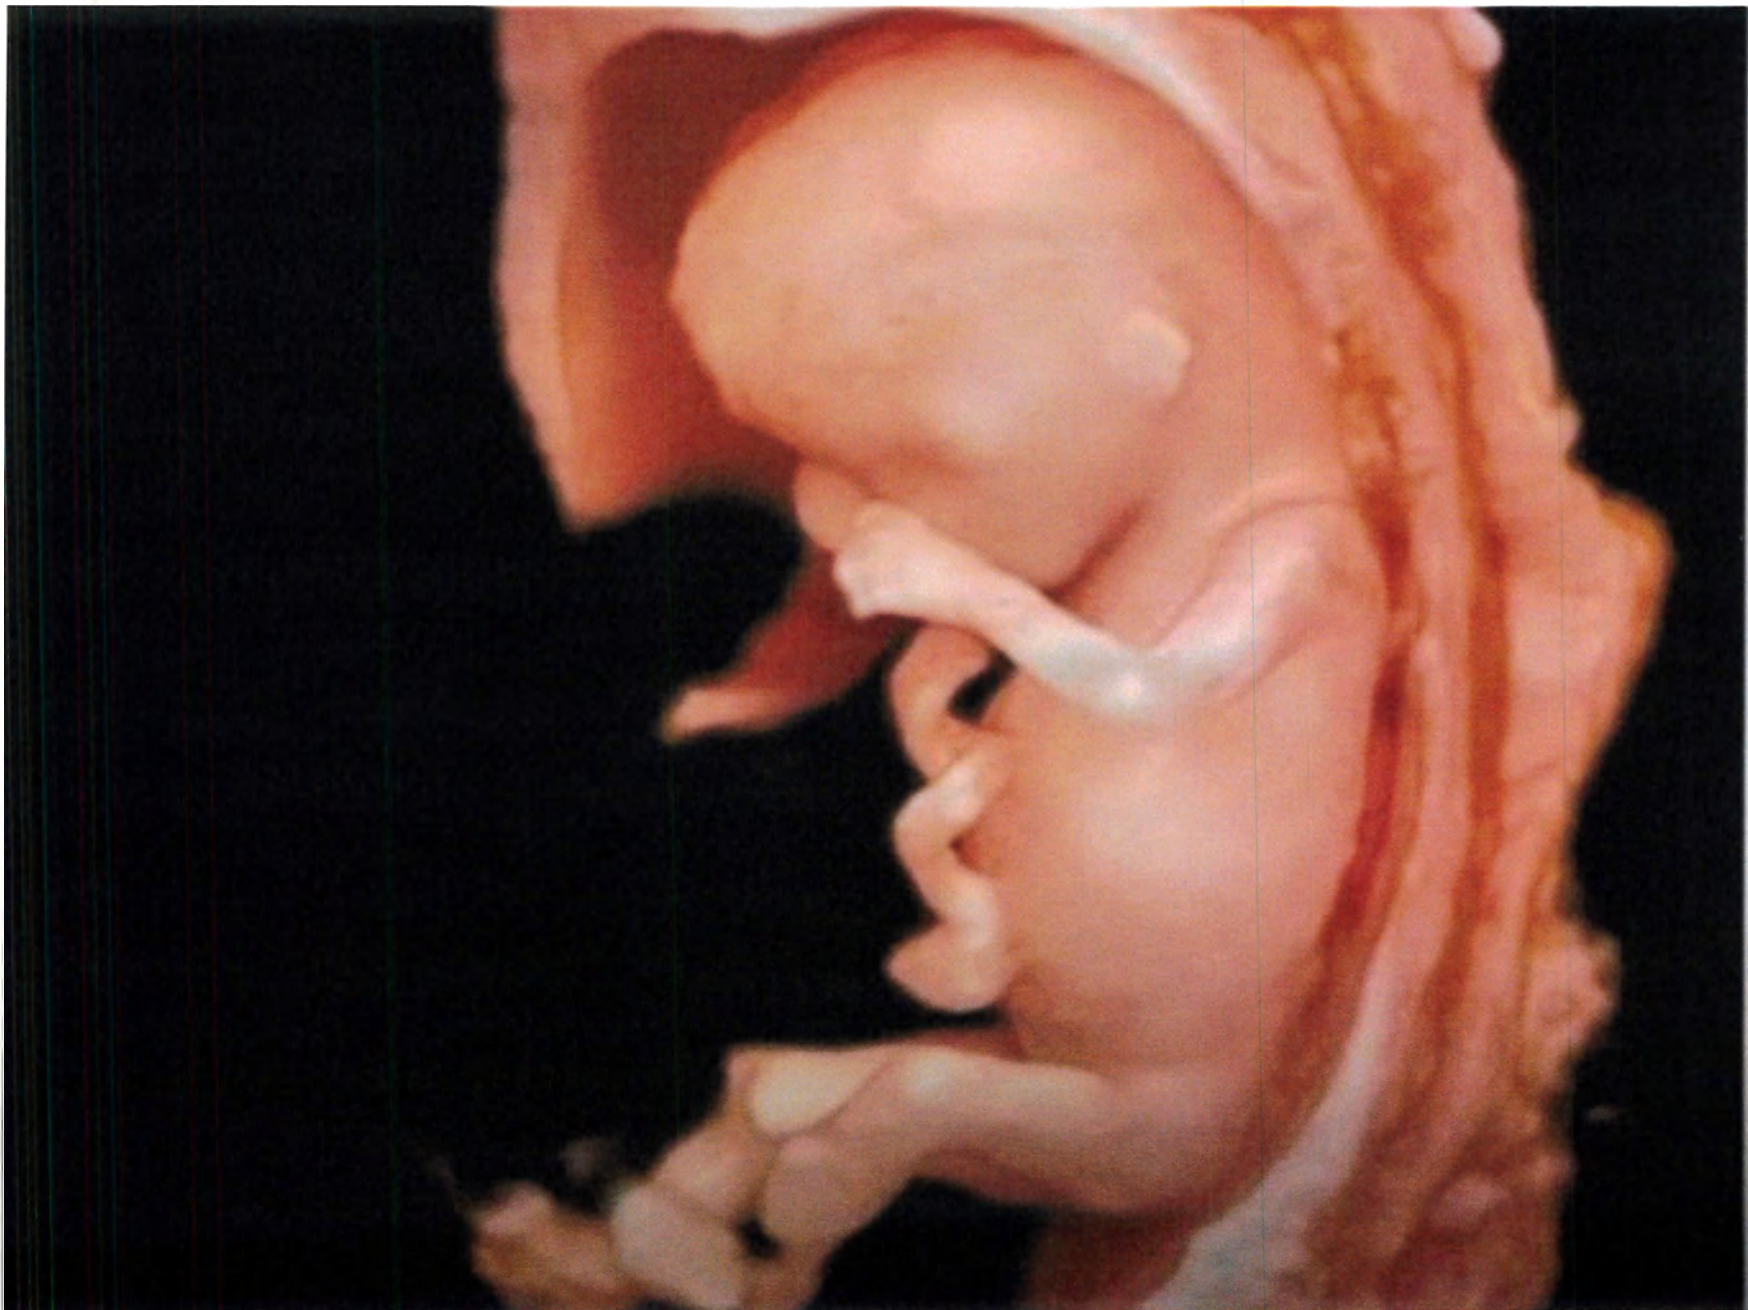


22. Модуль виртуальной 4D эндозографии (Fly Thru).

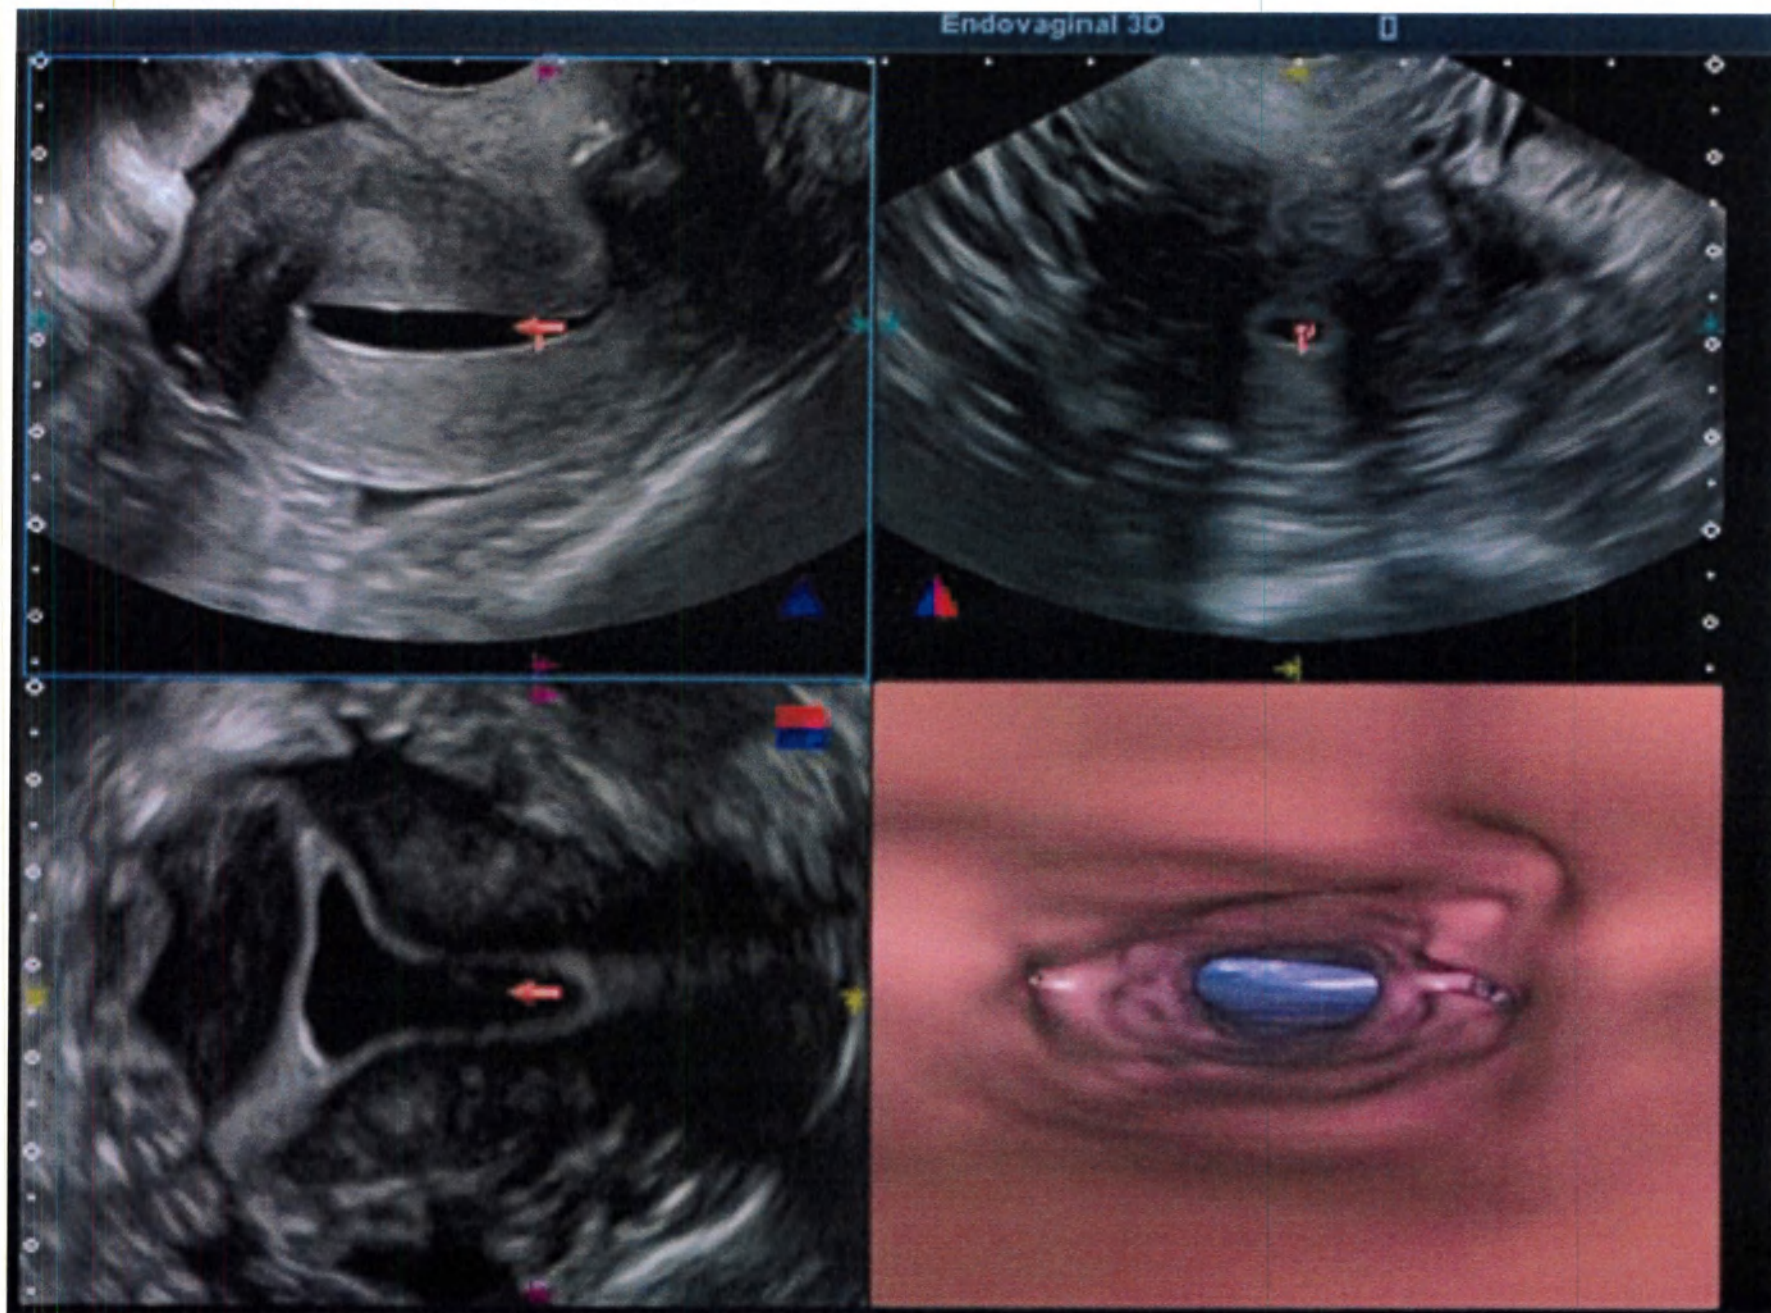


23. Модуль для исследования с контрастами (СНІ).

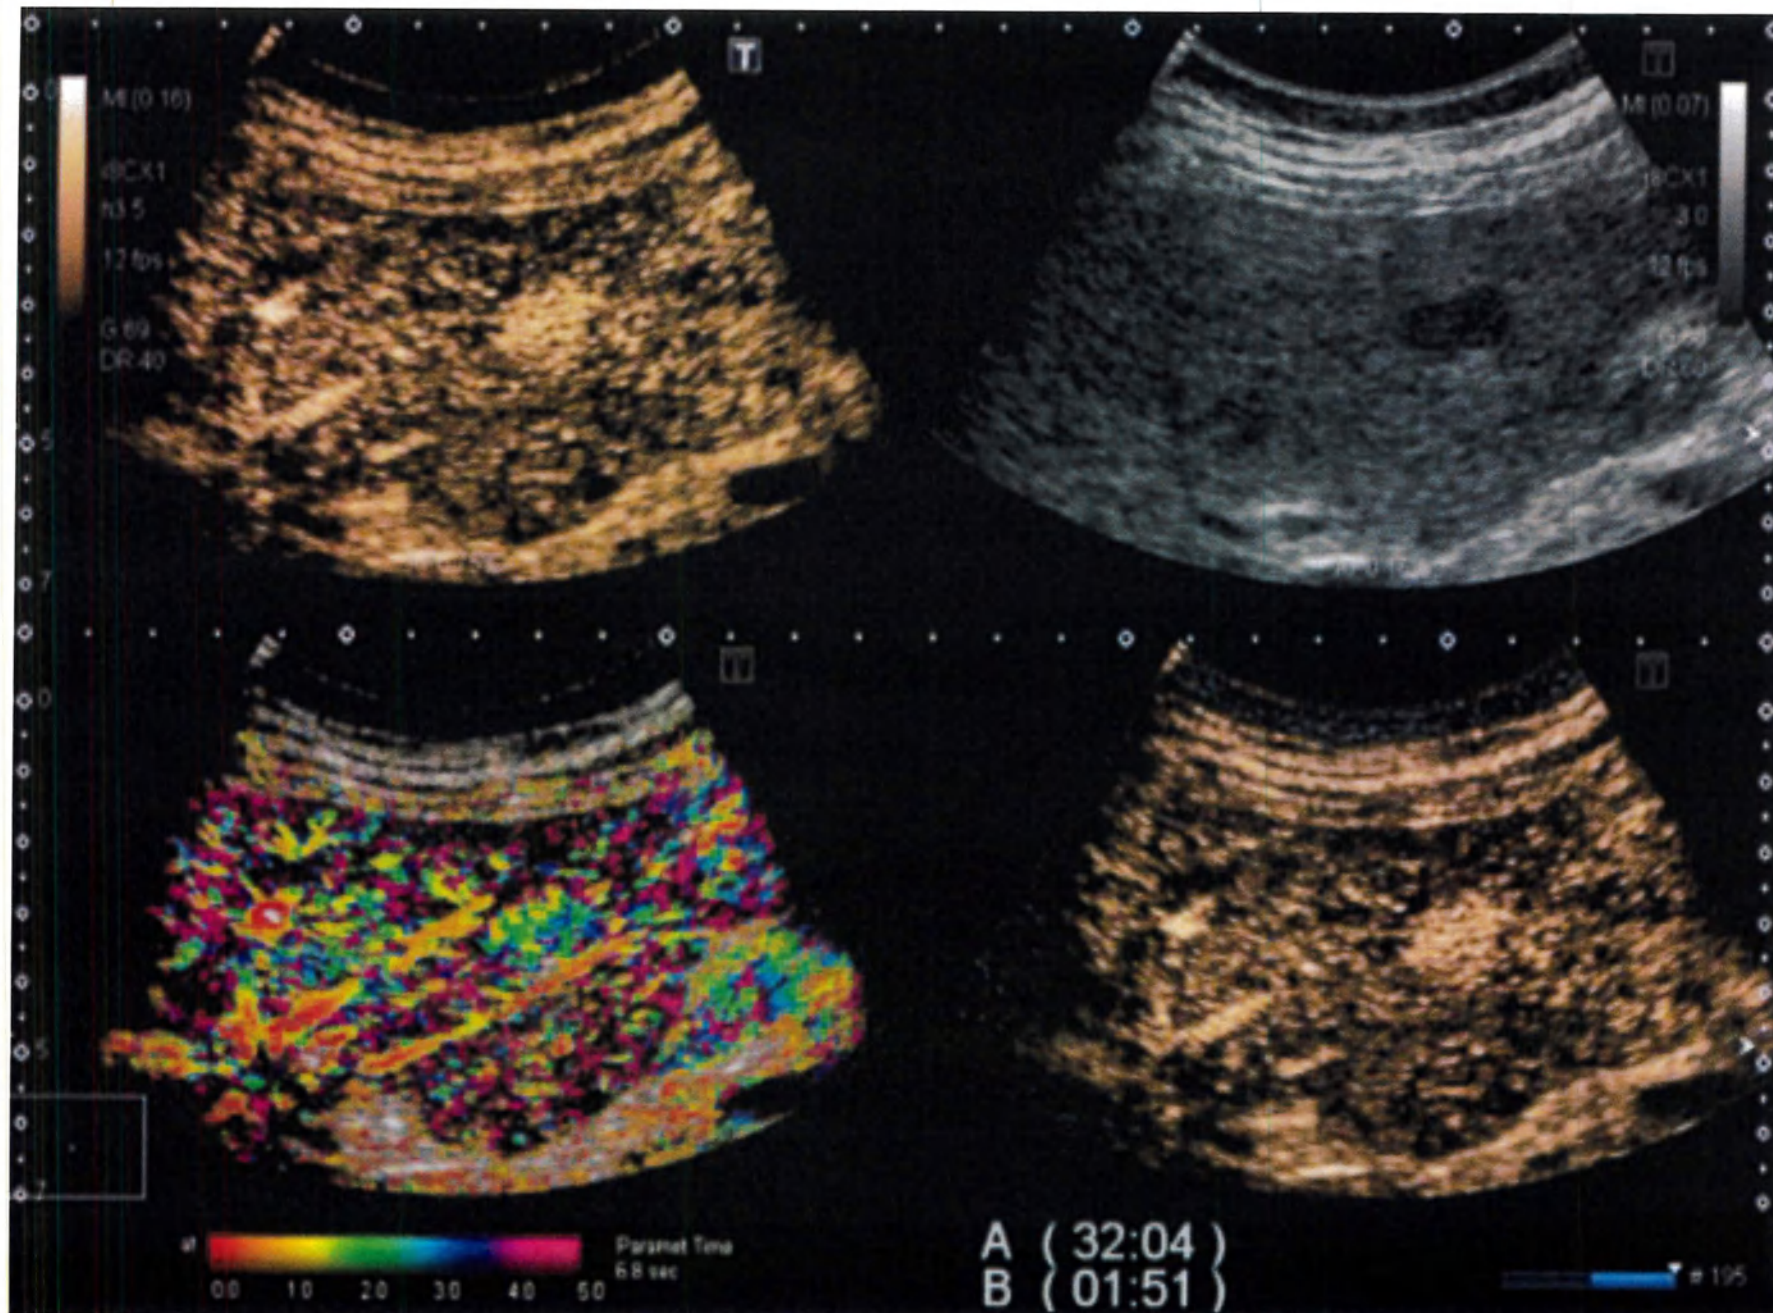


24. Модуль количественного анализа в режиме контрастной эхографии (CHI-Q).

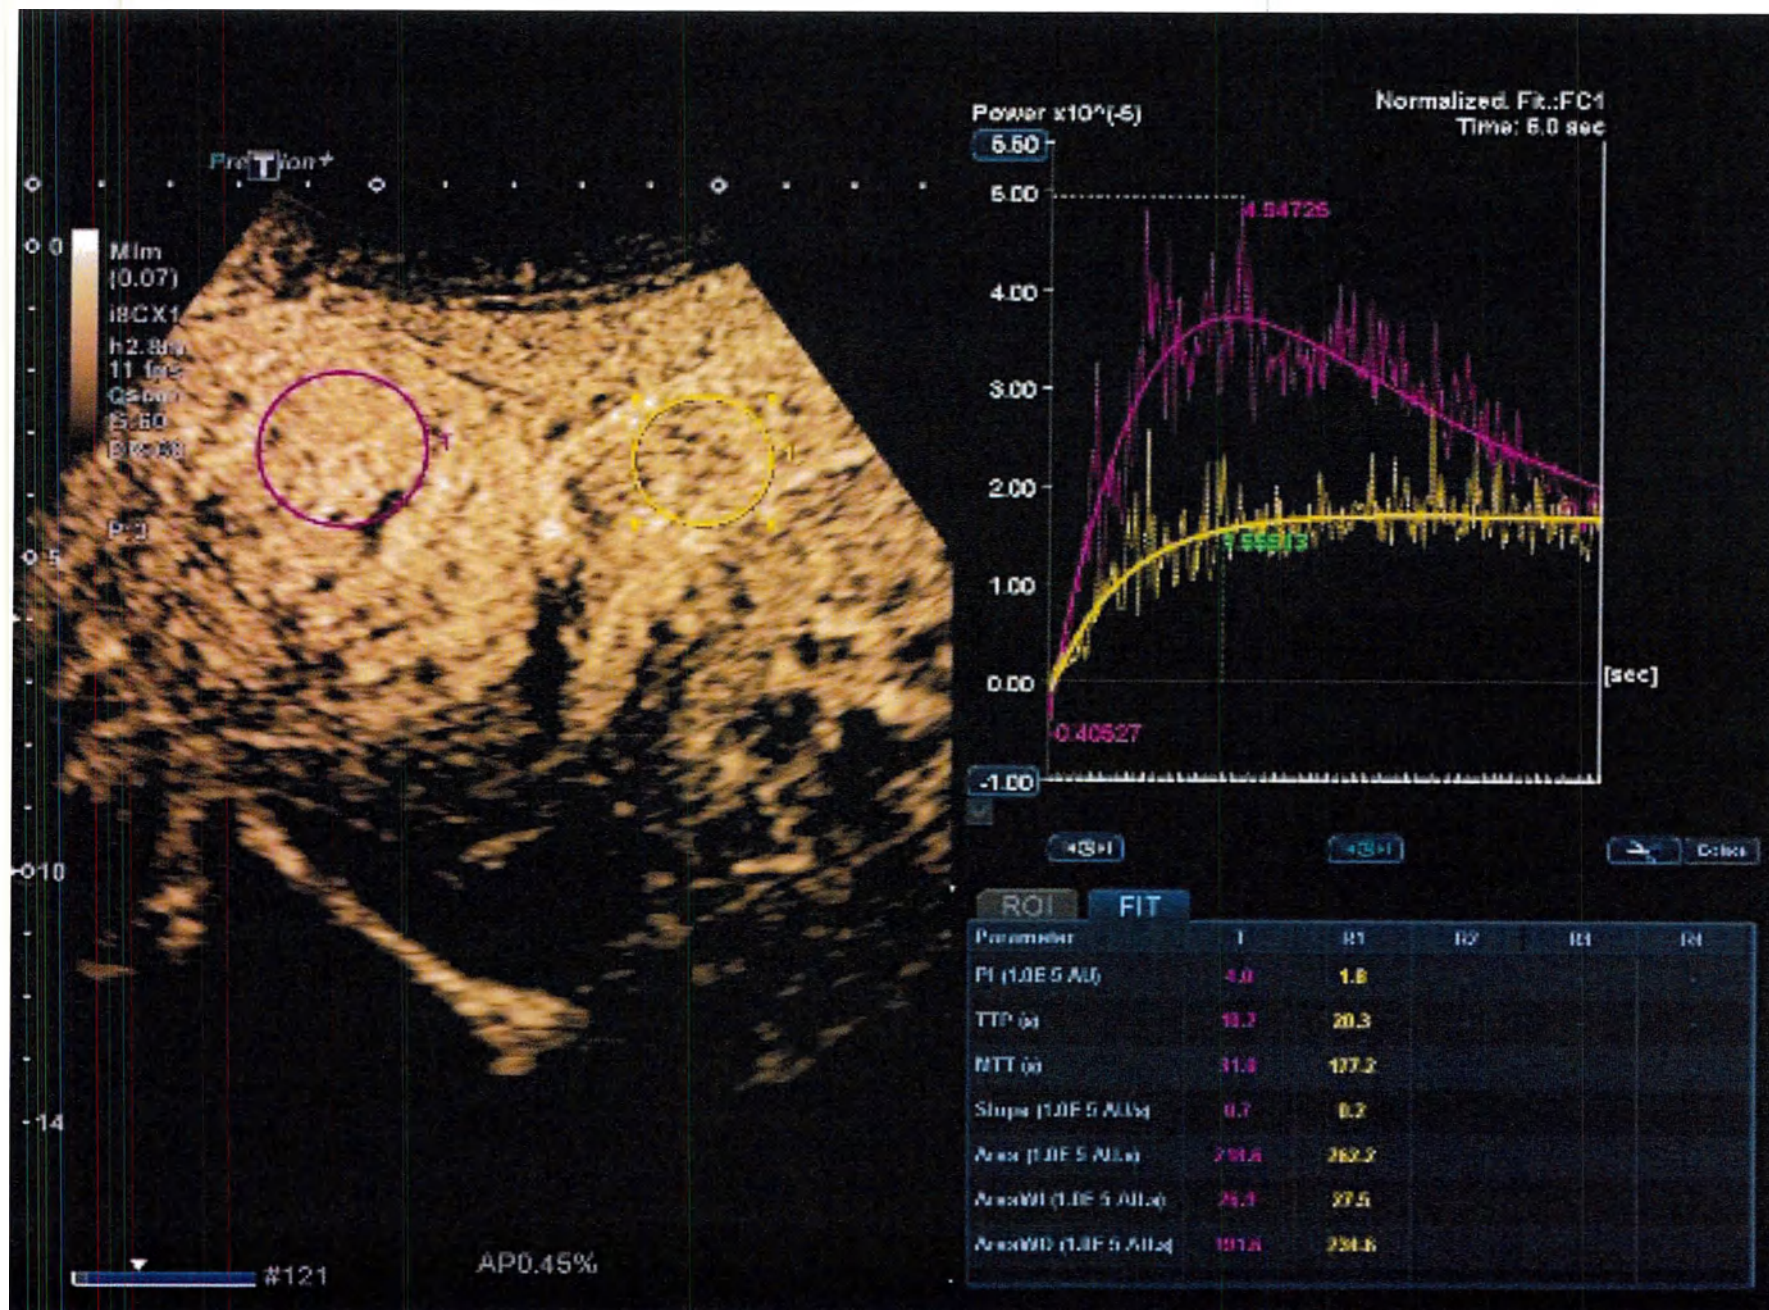


25. Модуль построения графика временного распределения контраста (FCF-Q).

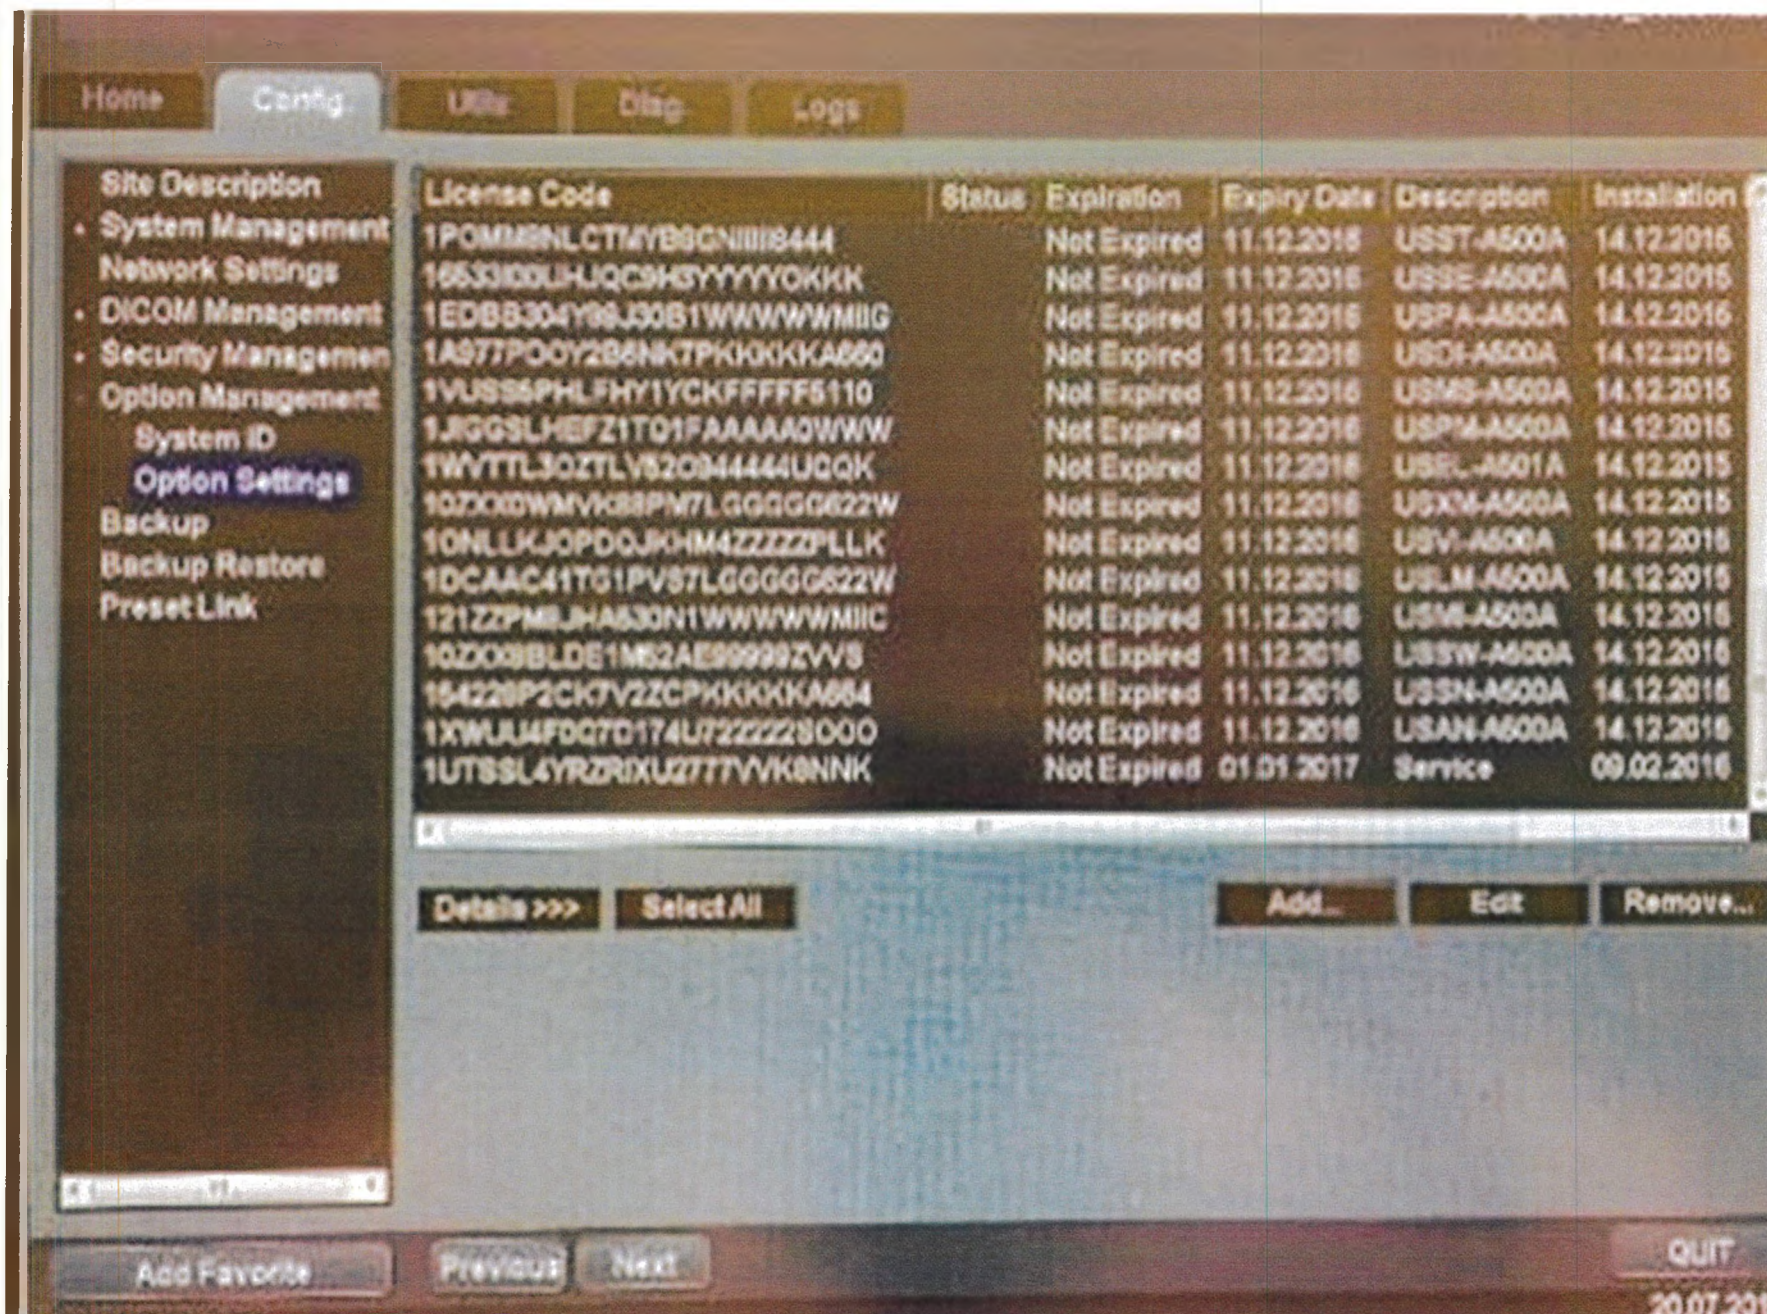

26. Модуль цветового контроля поступления и распределения контраста (Parametric MFI).

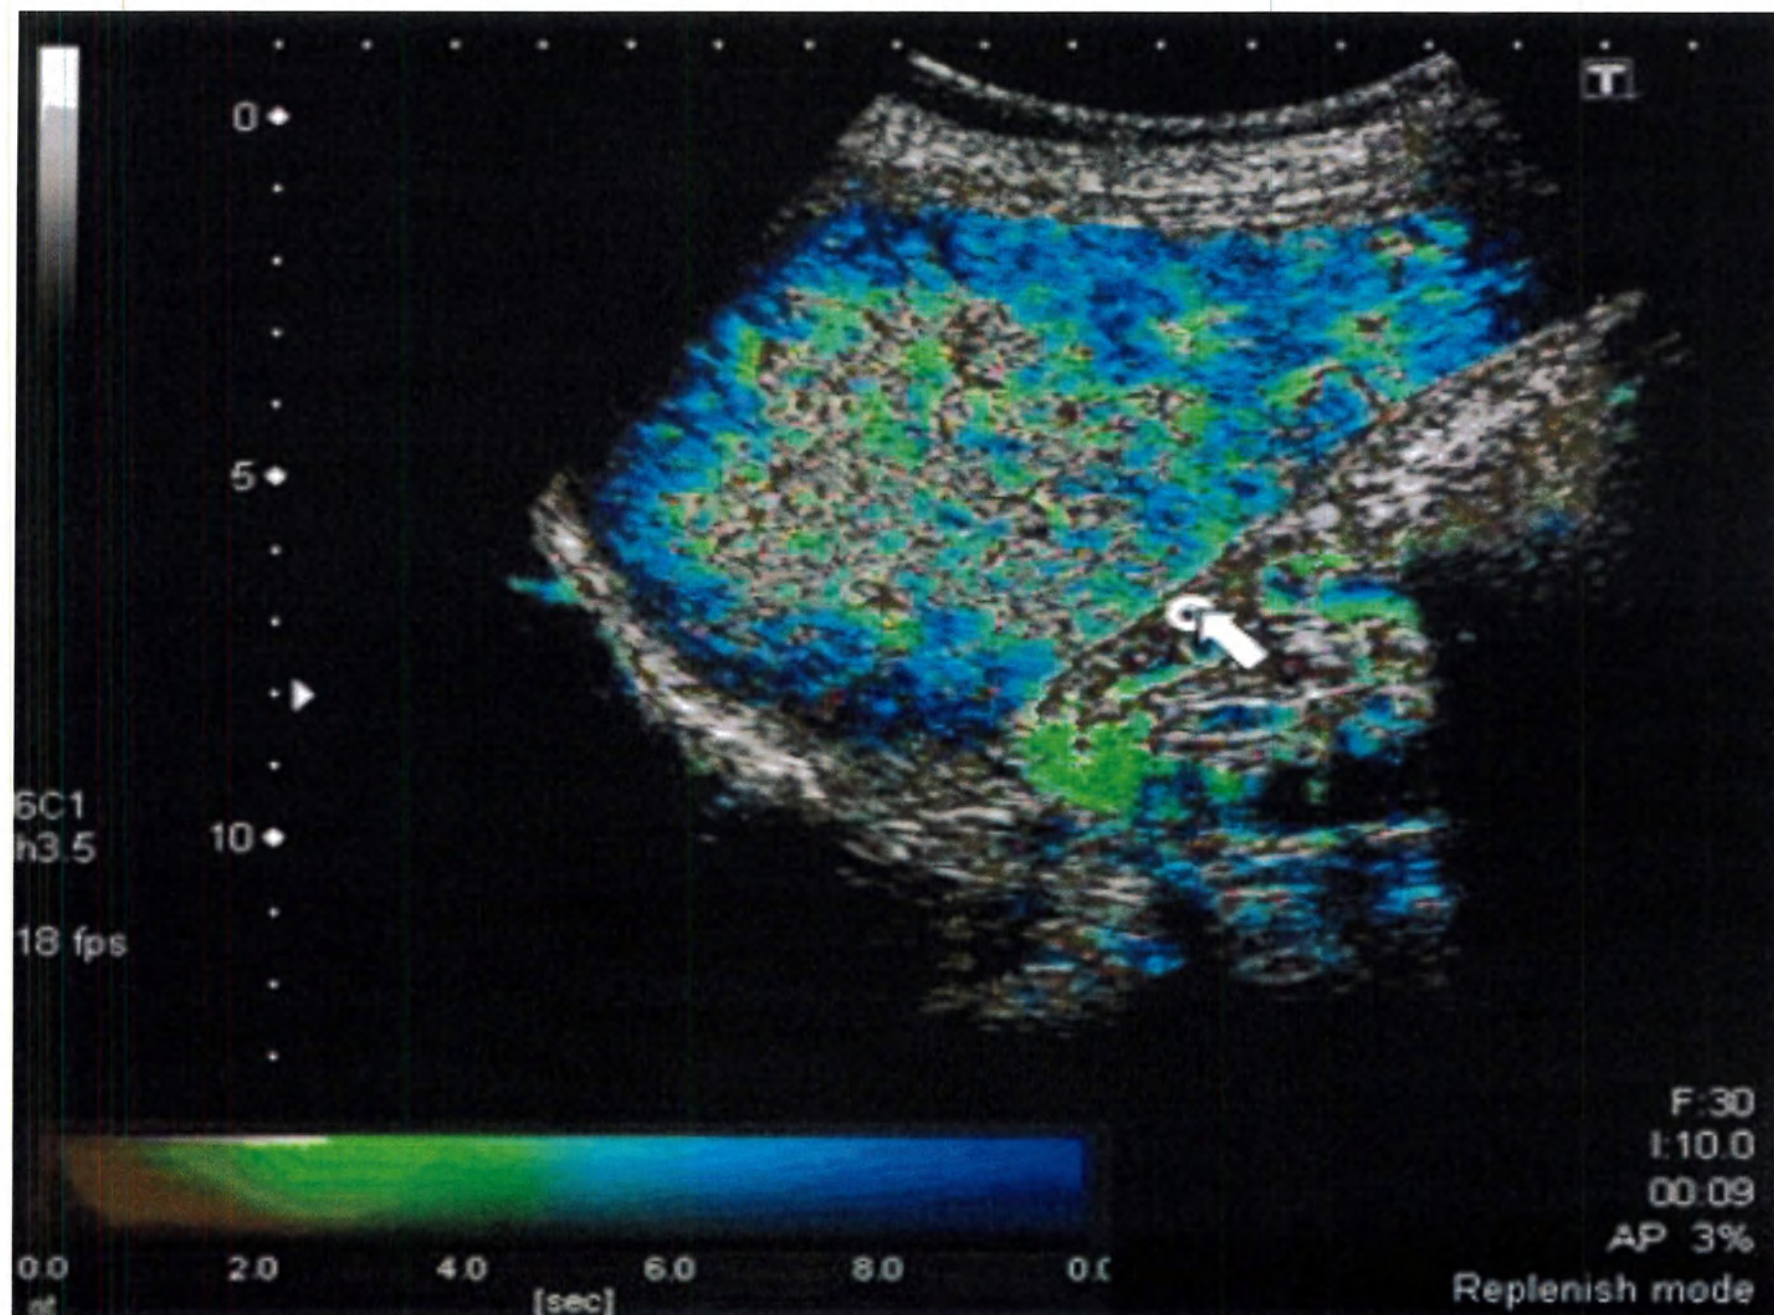

27. Модуль функции Smart Fusion.

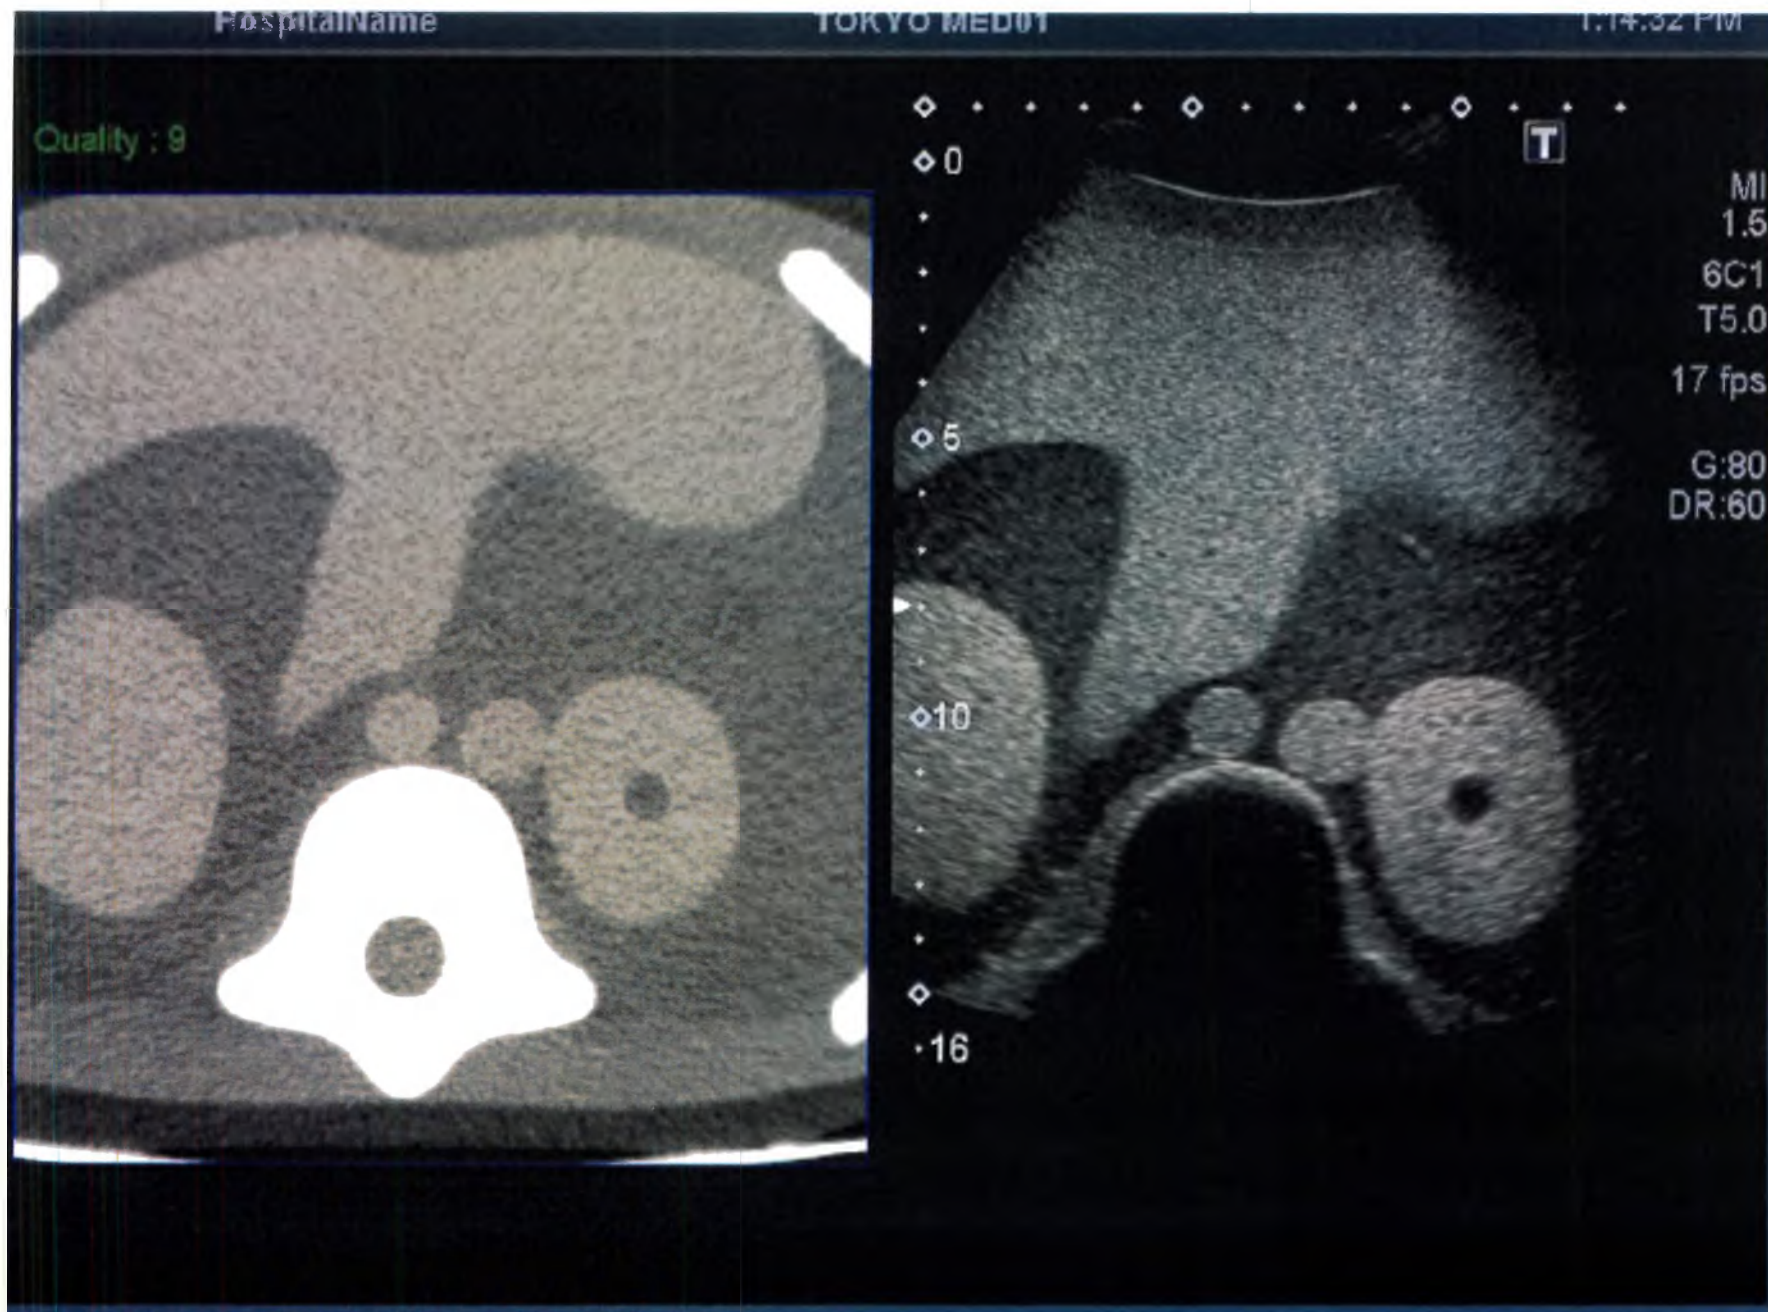


28. Набор для формирования поля в режиме мультимодальной визуализации.

129



28. Набор для формирования поля в режиме мультимодальной визуализации.

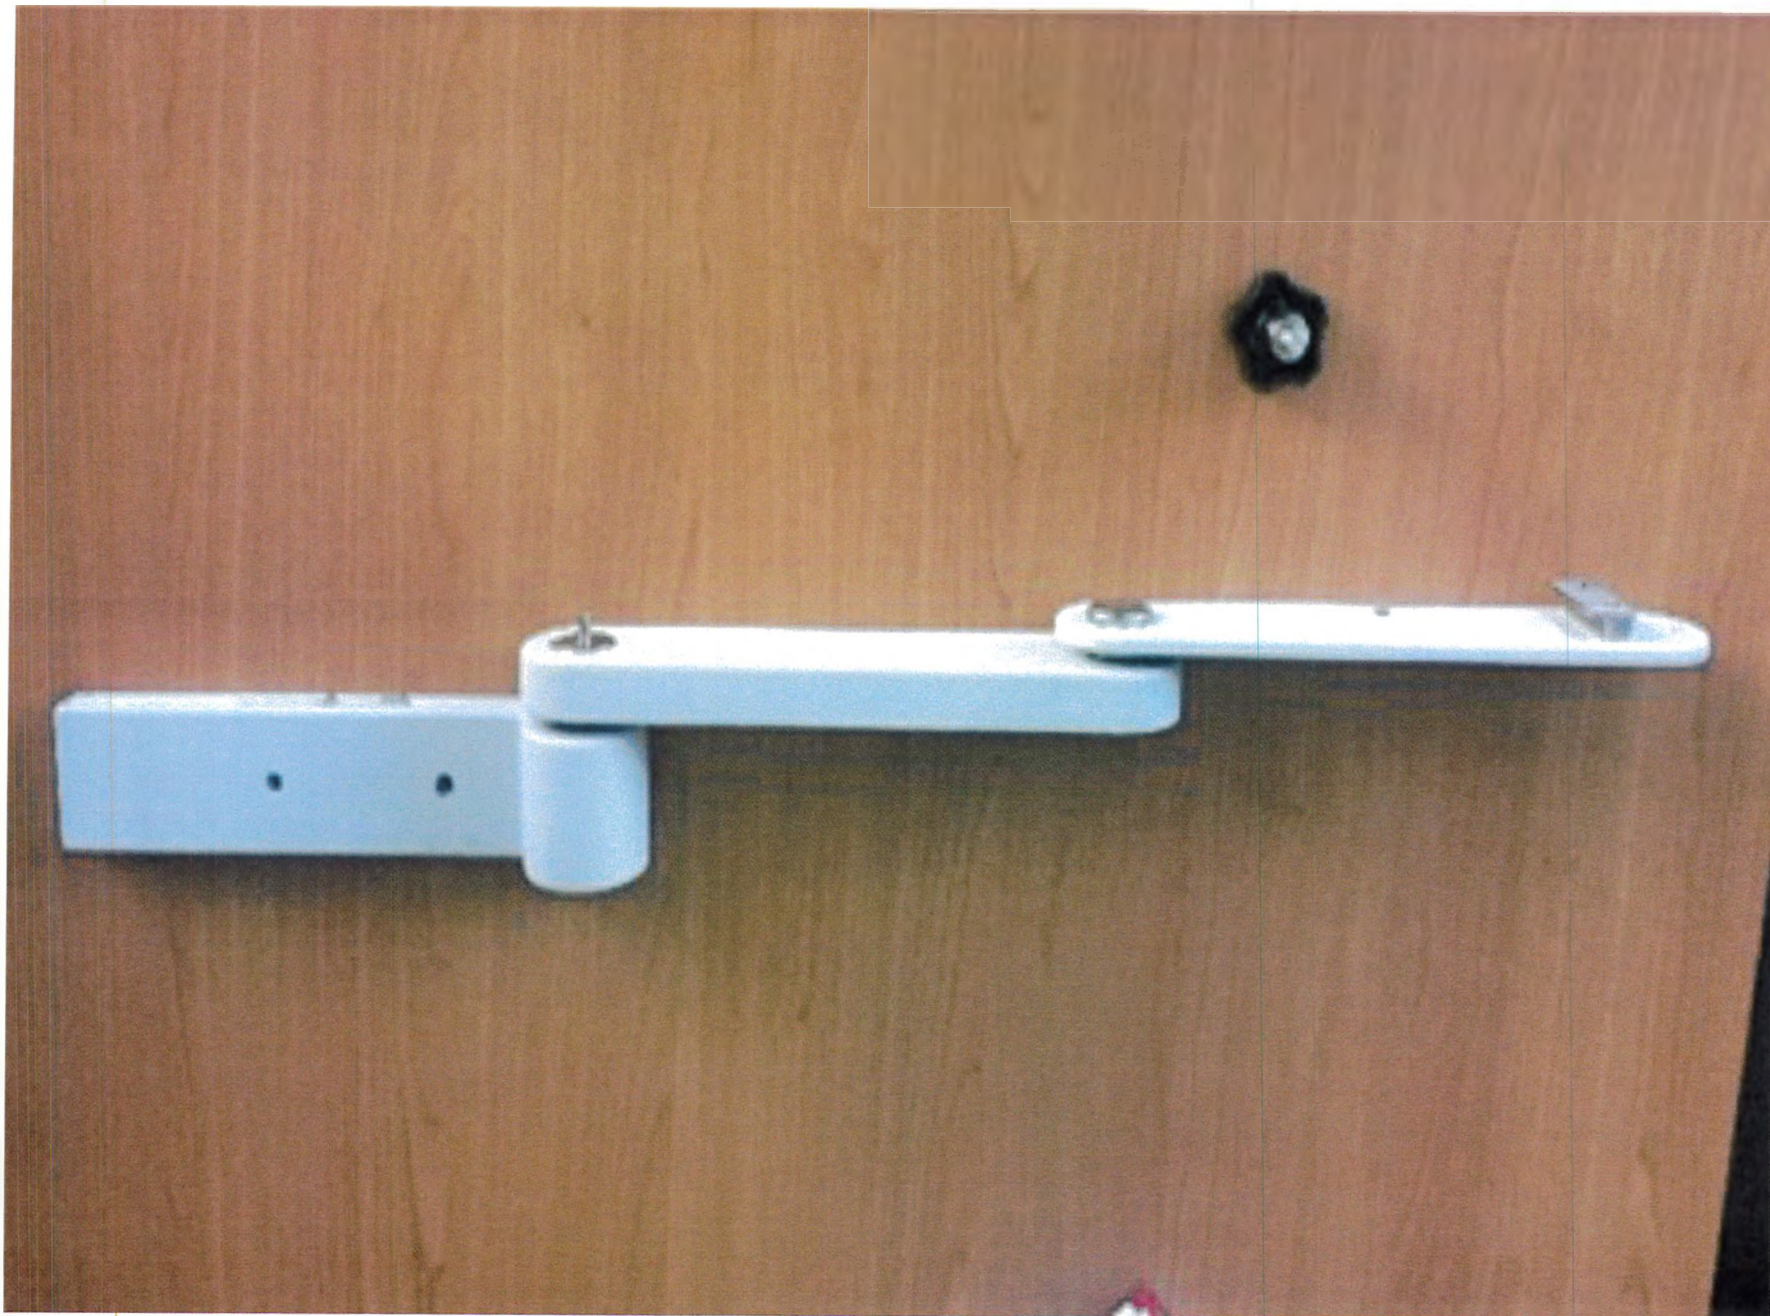

28. Набор для формирования поля в режиме мультимодальной визуализации.



28. Набор для формирования поля в режиме мультимодальной визуализации.



28. Набор для формирования поля в режиме мультимодальной визуализации.




28. Набор для формирования поля в режиме мультимодальной визуализации.




28. Набор для формирования поля в режиме мультимодальной визуализации.



28. Набор для формирования поля в режиме мультимодальной визуализации.

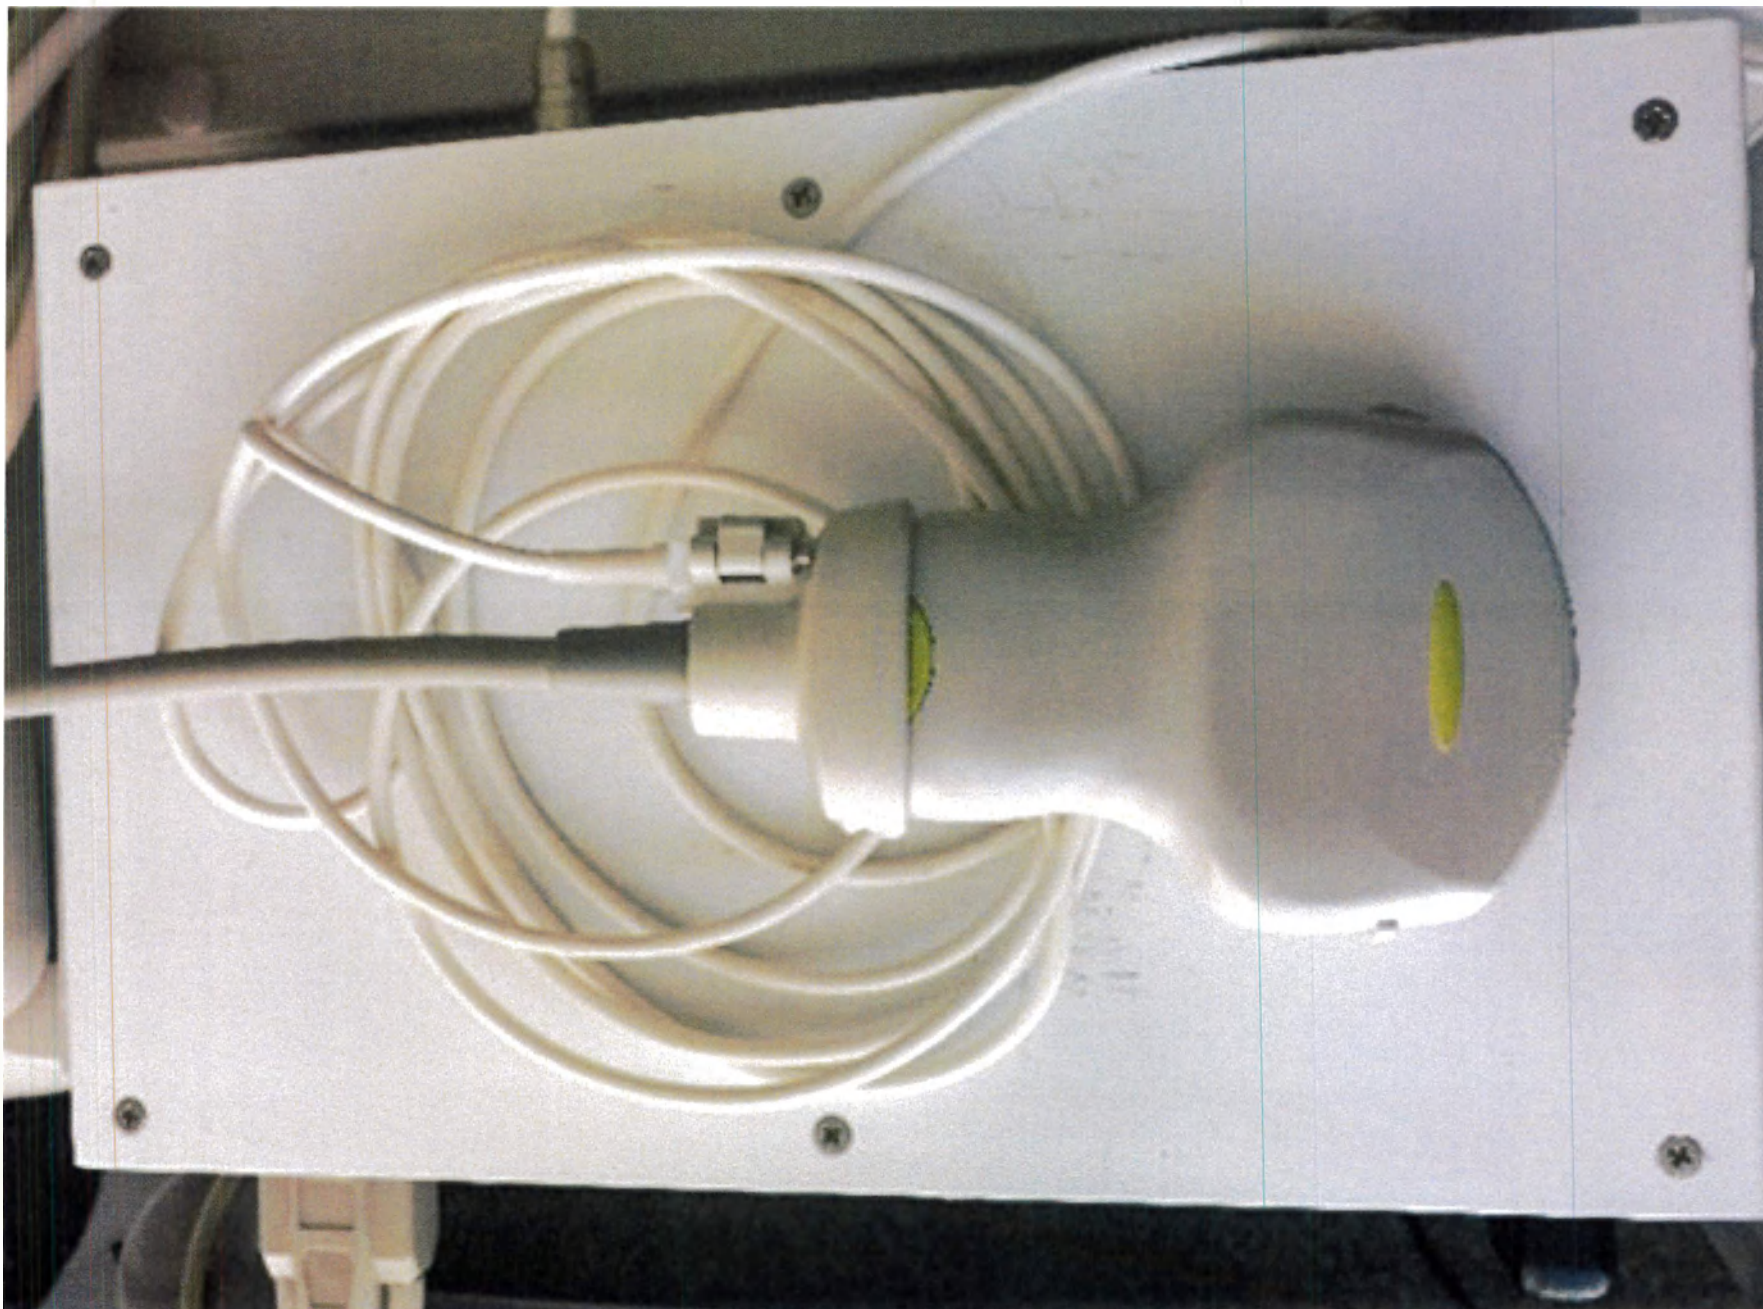

29. Стойка-тележка для позиционирования передающего устройства в режиме мультимодальной визуализации.

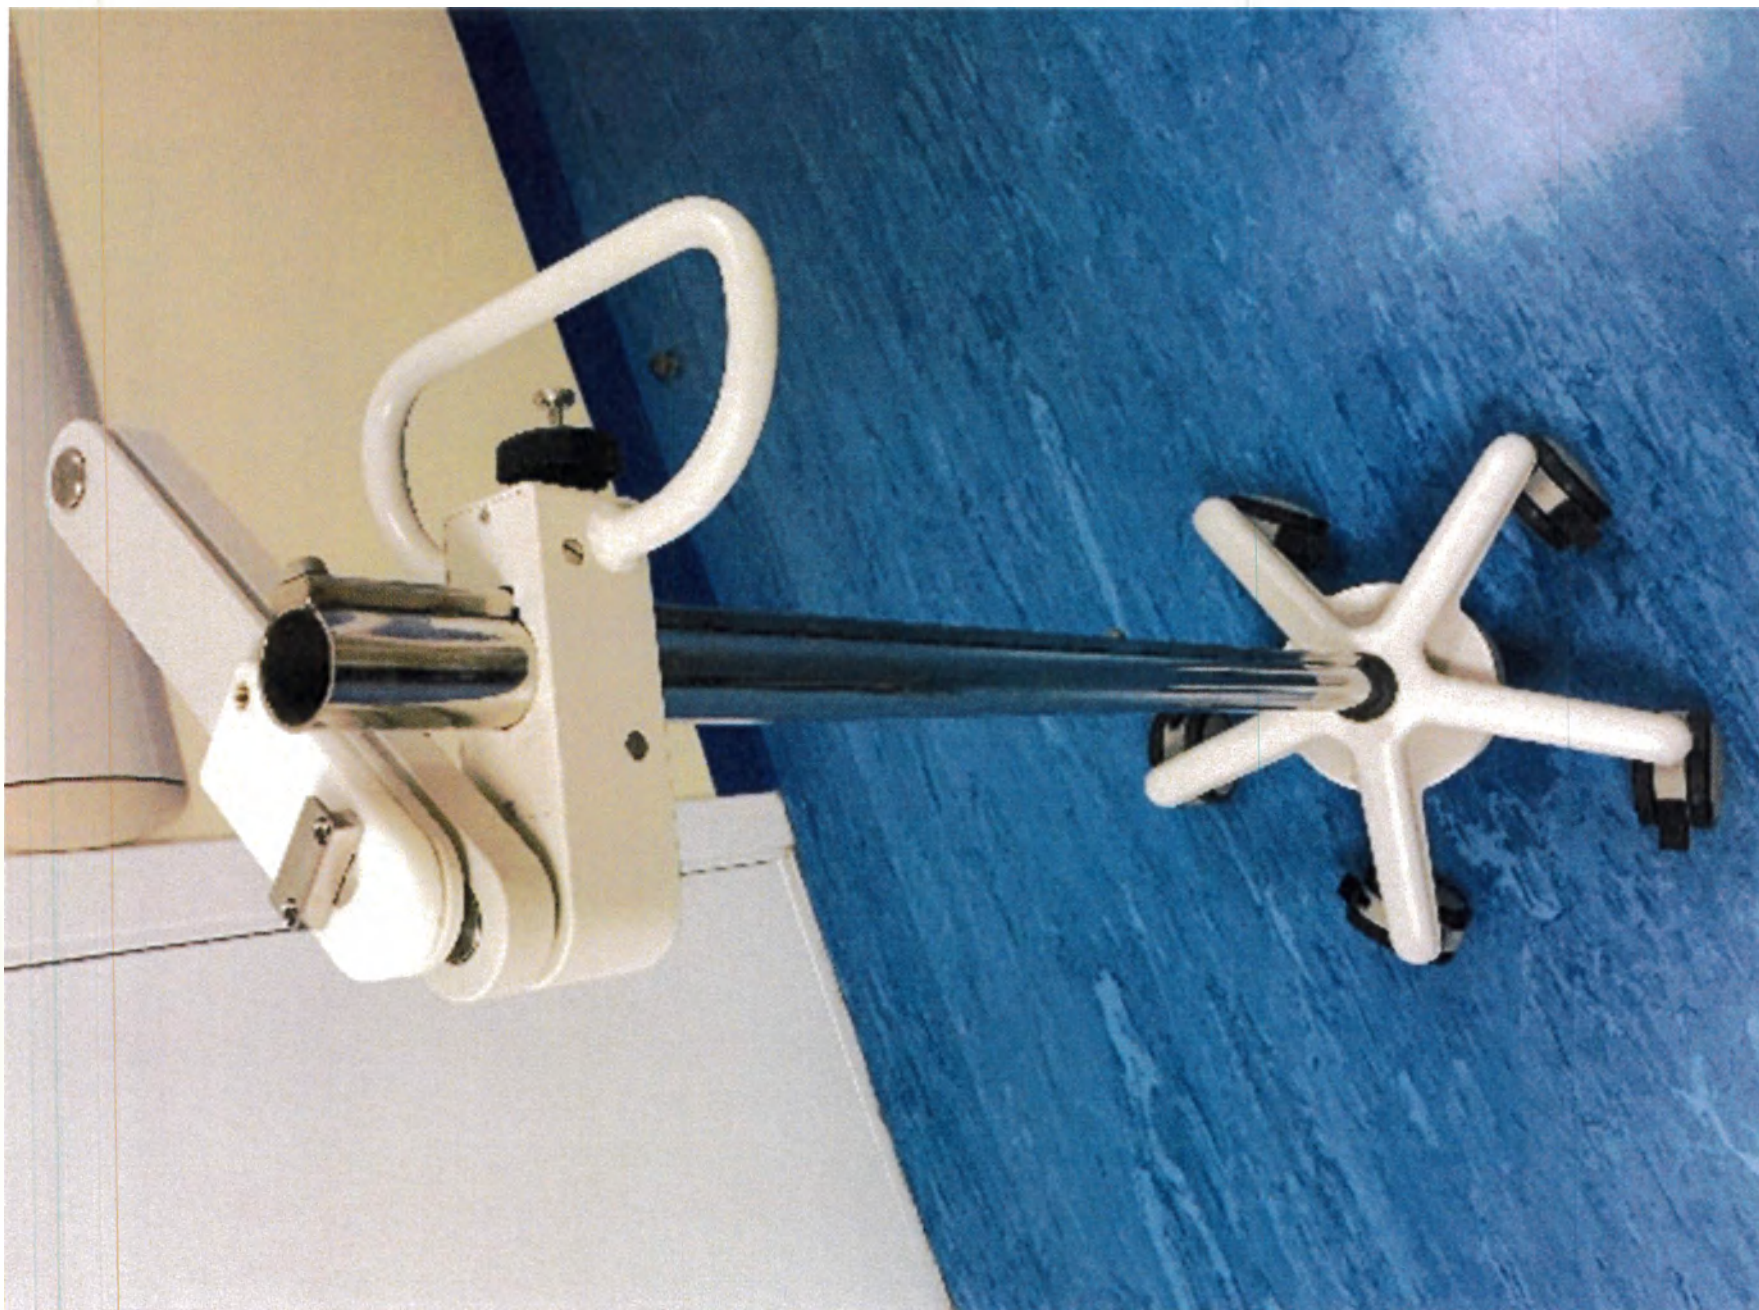


30. Дополнительный сенсор для функции Smart Fusion.


138



31. Модуль функции Smart Navigation.

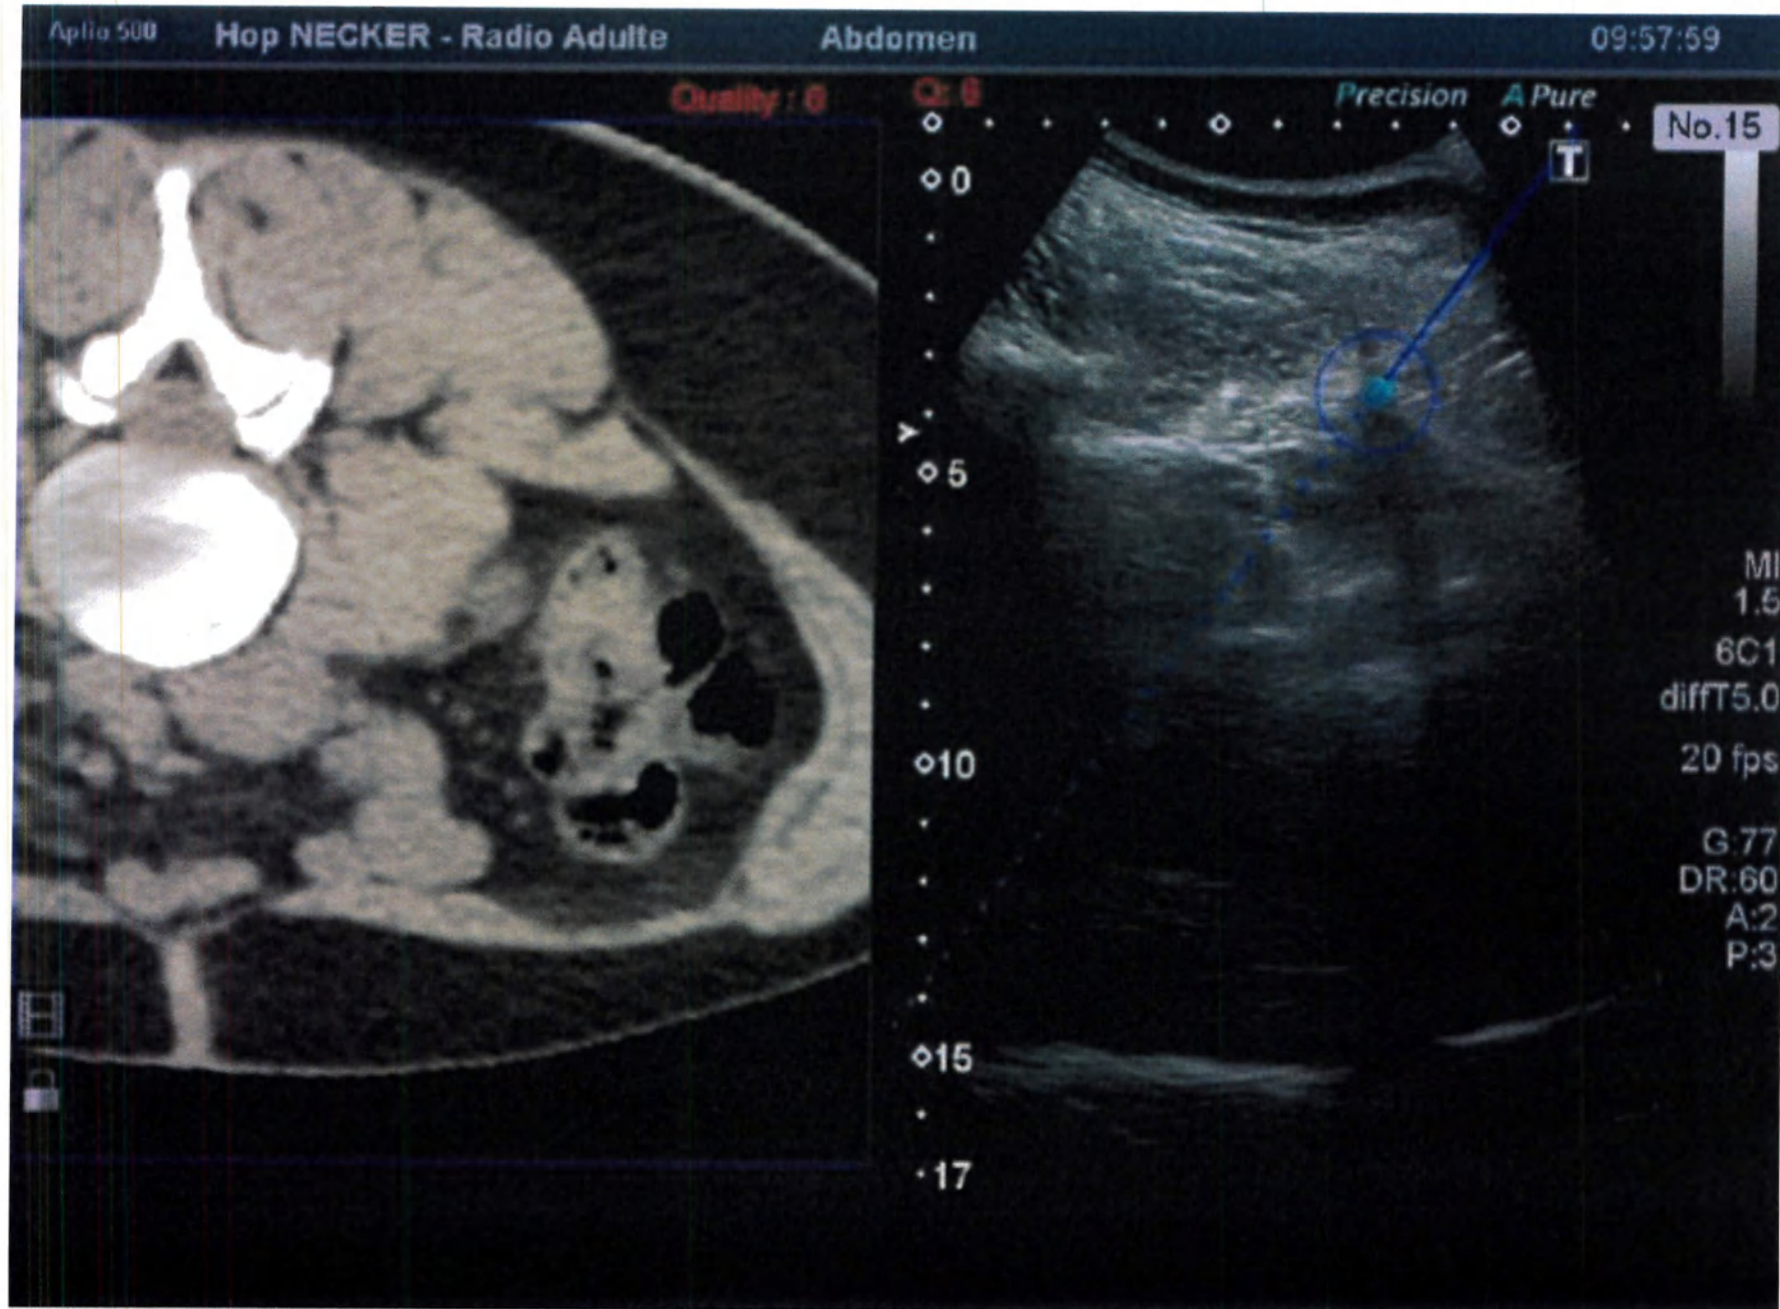


32. Адаптер для позиционирования сенсора, модель UAFS-001A.

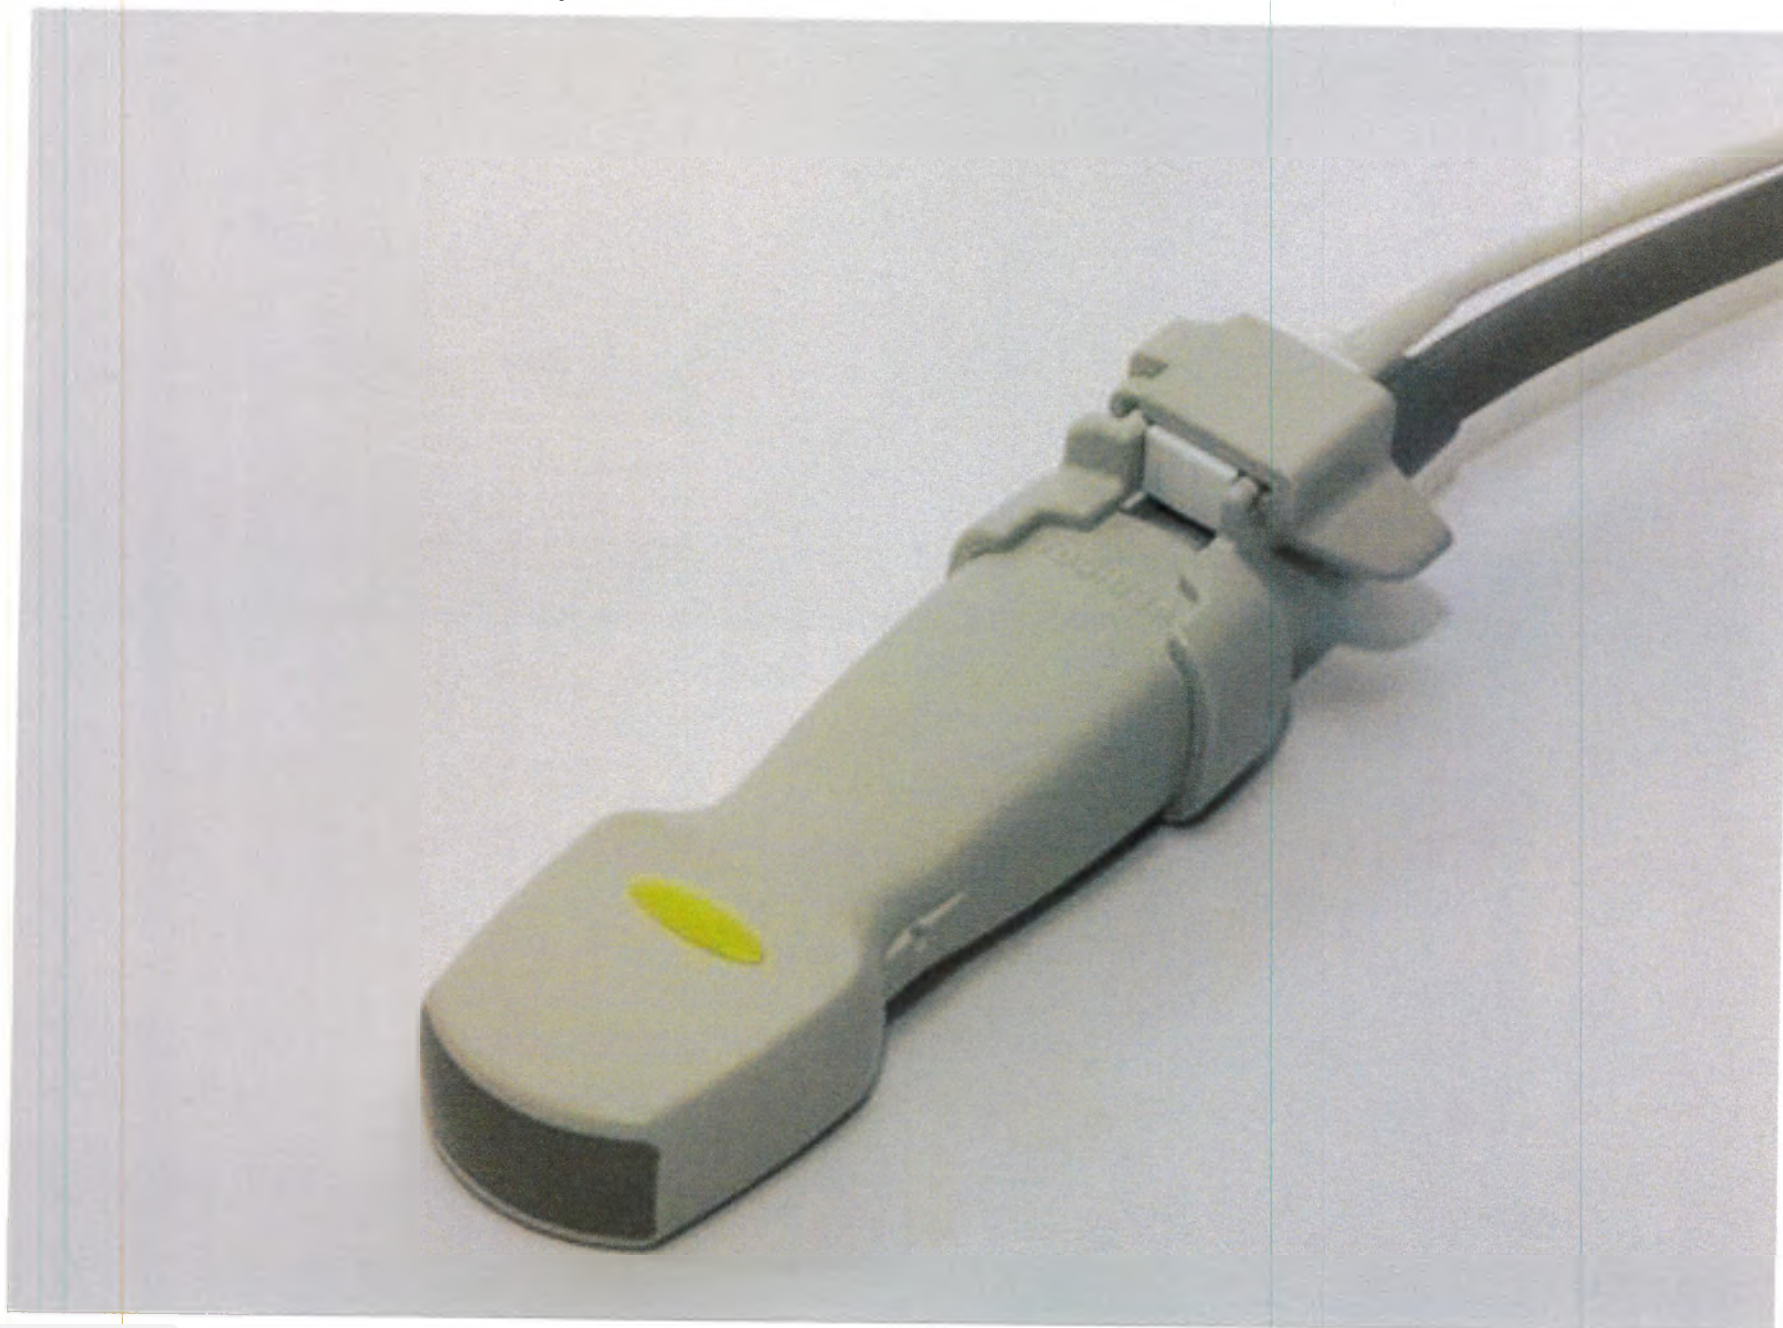

33. Адаптер для позиционирования сенсора, модель UAFS-002A.




34. Адаптер для позиционирования сенсора, модель UAFS-003A.

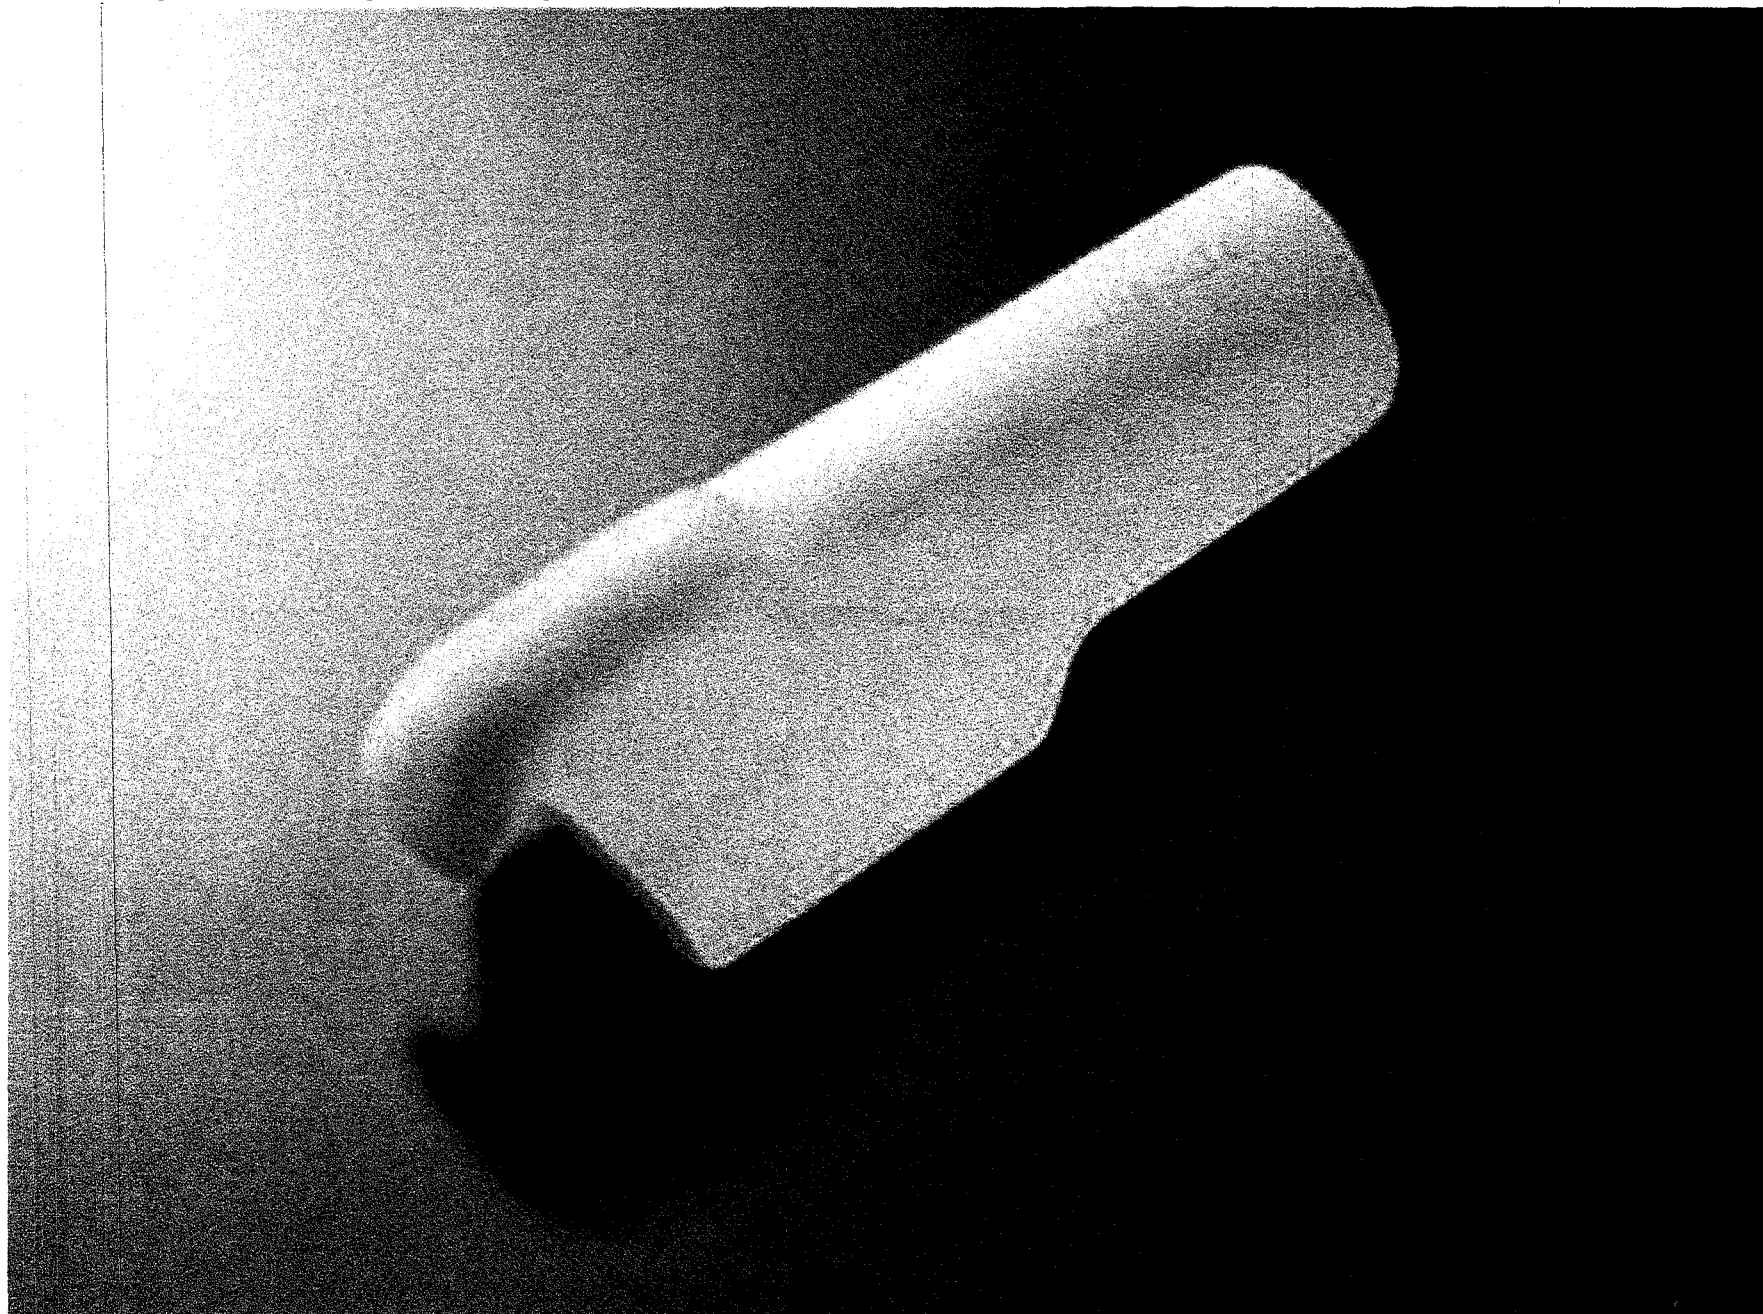


35. Адаптер для позиционирования сенсора, модель UAFS-004A.




36. Адаптер для позиционирования сенсора, модель UAFS-005A.

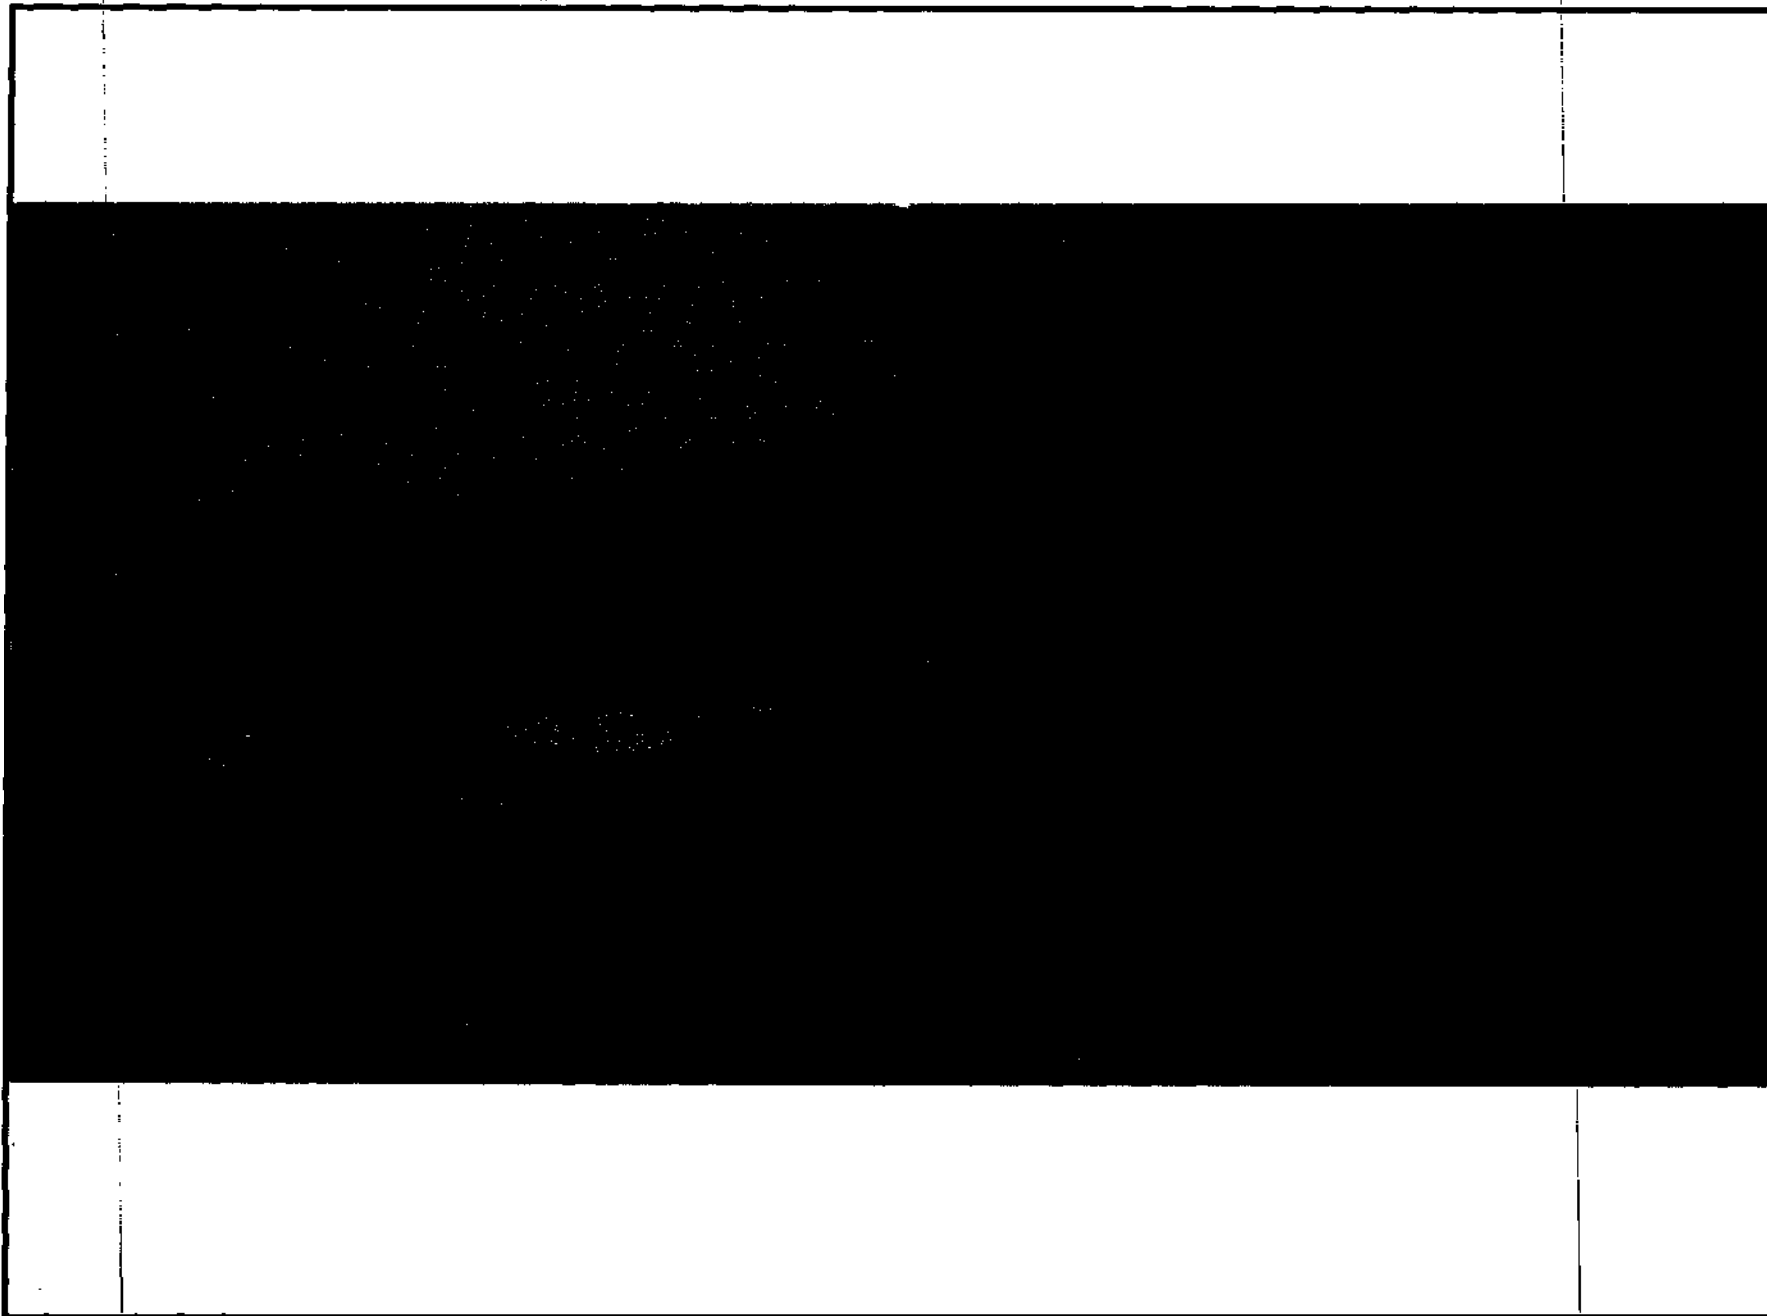

37. Адаптер для позиционирования сенсора, модель UAFS-006A.

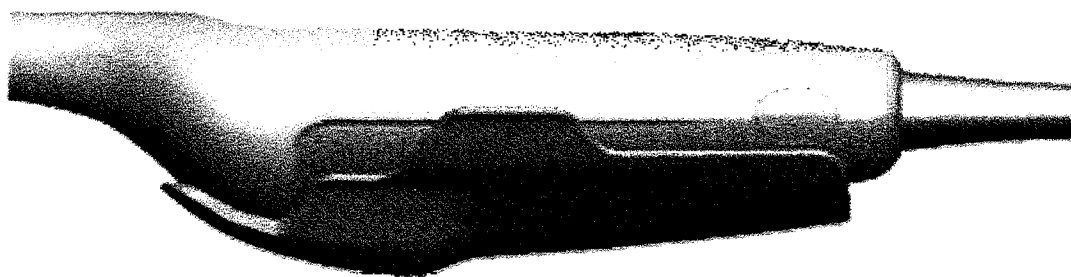

38. Держатель для датчика транспищеводного мультипланового моделей PET-512MC, PET-512MD.

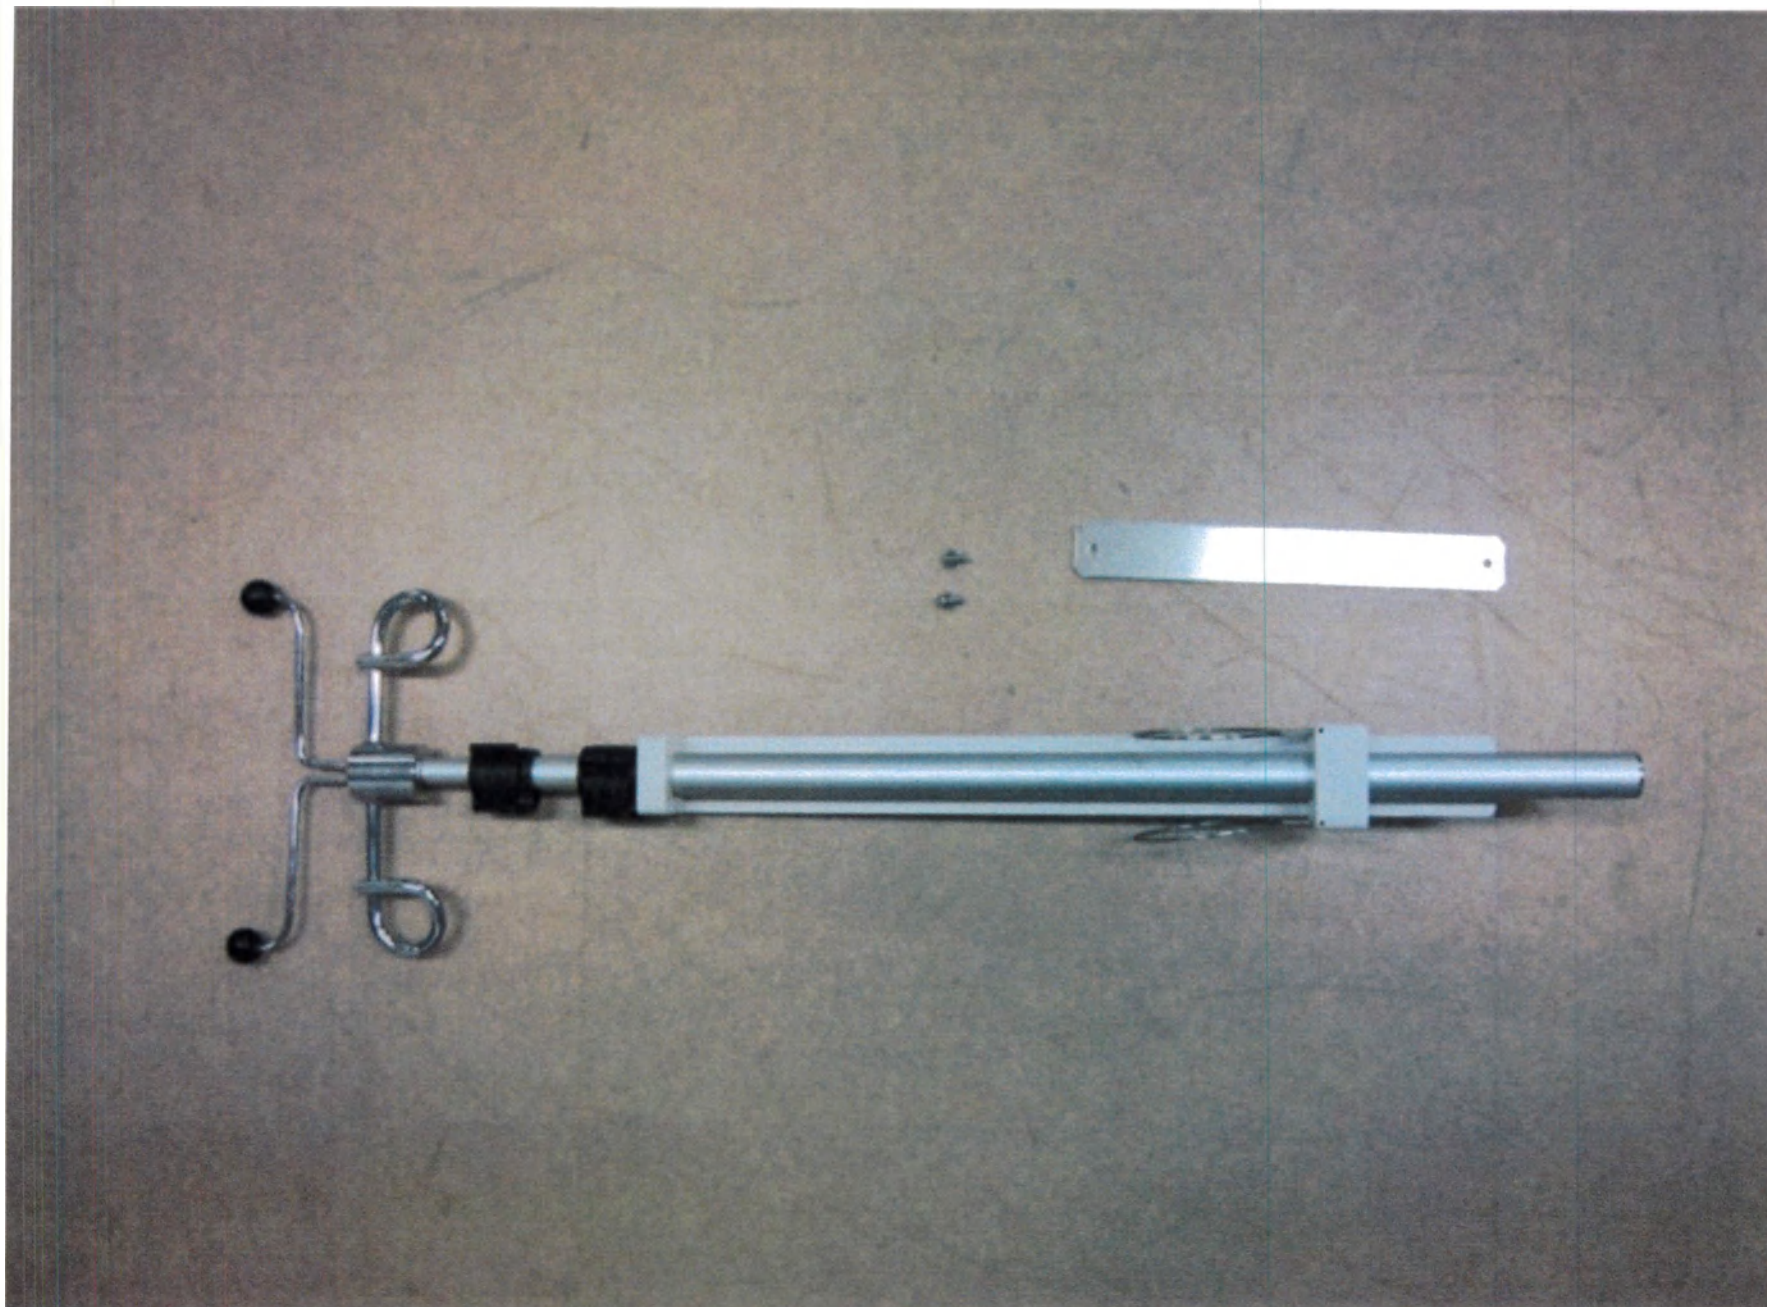

39. Модуль поддержки стандарта DICOM.

Home Config **URLs** Diag Logs

Site Description
 • System Management
 Network Settings
 • DICOM Management
 • Security Management
 Option Management
 System ID
Option Settings
 Backup
 Backup Restore
 Preset Link


License Code	Status	Expiration	Expiry Date	Description	Installation
1POMMBNLCTMYB8GNIII8444	Not Expired	11.12.2016	11.12.2016	USST-A500A	14.12.2016
165330DUHJQC9H3YVYYOKKK	Not Expired	11.12.2016	11.12.2016	USSE-A500A	14.12.2016
1EDB8304Y88J30B1WWWWWMIIG	Not Expired	11.12.2016	11.12.2016	USPA-A500A	14.12.2016
1A977POOY2B6NK7PKIKKKKA860	Not Expired	11.12.2016	11.12.2016	USOI-A500A	14.12.2016
1VUSS6PHLFHY1YCKFFFFF5110	Not Expired	11.12.2016	11.12.2016	USMS-A500A	14.12.2016
1JGGSLHEFZ1TQ1FAAAAAQWWW	Not Expired	11.12.2016	11.12.2016	USPM-A500A	14.12.2016
1WVTTL3OZTLV52O94444UQOK	Not Expired	11.12.2016	11.12.2016	USBL-A501A	14.12.2016
10ZOXDWVYK88PM7LGGGGG622W	Not Expired	11.12.2016	11.12.2016	USXM-A500A	14.12.2016
10NLLKJOPDOJKHIM4ZZZZPLLK	Not Expired	11.12.2016	11.12.2016	USVI-A500A	14.12.2016
1DCAAC41TG1PV57LGGGGG622W	Not Expired	11.12.2016	11.12.2016	USLM-A500A	14.12.2016
121ZZPM8JH4830N1WWWWWMIIC	Not Expired	11.12.2016	11.12.2016	USMI-A500A	14.12.2016
10ZOX8BLDE1M52AE99999ZVVS	Not Expired	11.12.2016	11.12.2016	US3W-A500A	14.12.2016
154228P2CK7V2ZCPKKKKKA864	Not Expired	11.12.2016	11.12.2016	US3N-A500A	14.12.2016
1XWLAJ4FDQ7D174U7222228000	Not Expired	11.12.2016	11.12.2016	USAN-A500A	14.12.2016
1UTSSL4YRZRXUZ777VVK8NNK	Not Expired	01.01.2017	01.01.2017	Service	09.02.2016

Details >>> Select All Add... Edit Remove...

Add Favorite Previous Next QUIT

Option Settings 20.07.2016 09:19:10


40. Беспроводное подключение модуля DICOM с внешней рабочей станцией.

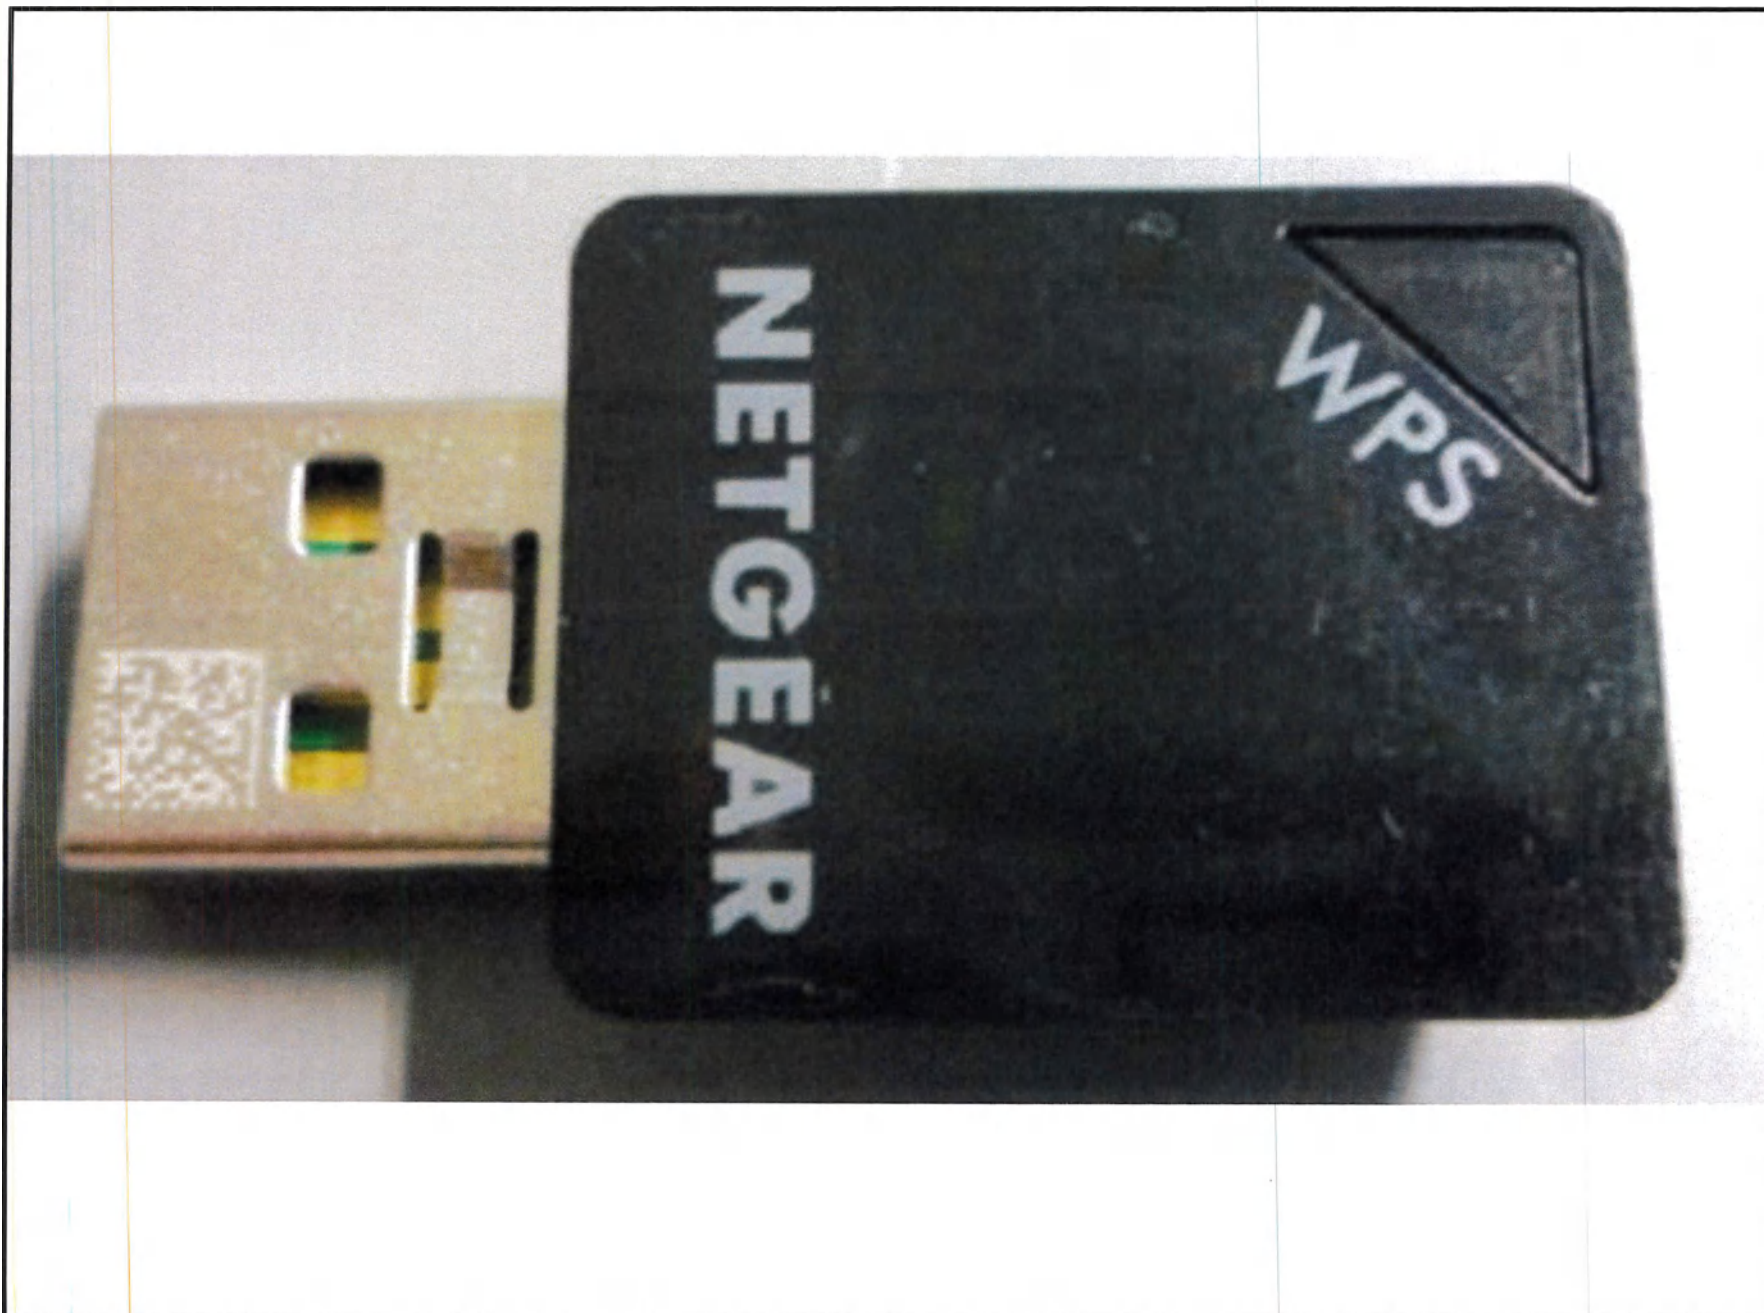


41. Комплект деталей для крепления черно-белого принтера.



42. Комплект деталей для крепления цветного принтера и/или DVD-рекодера.

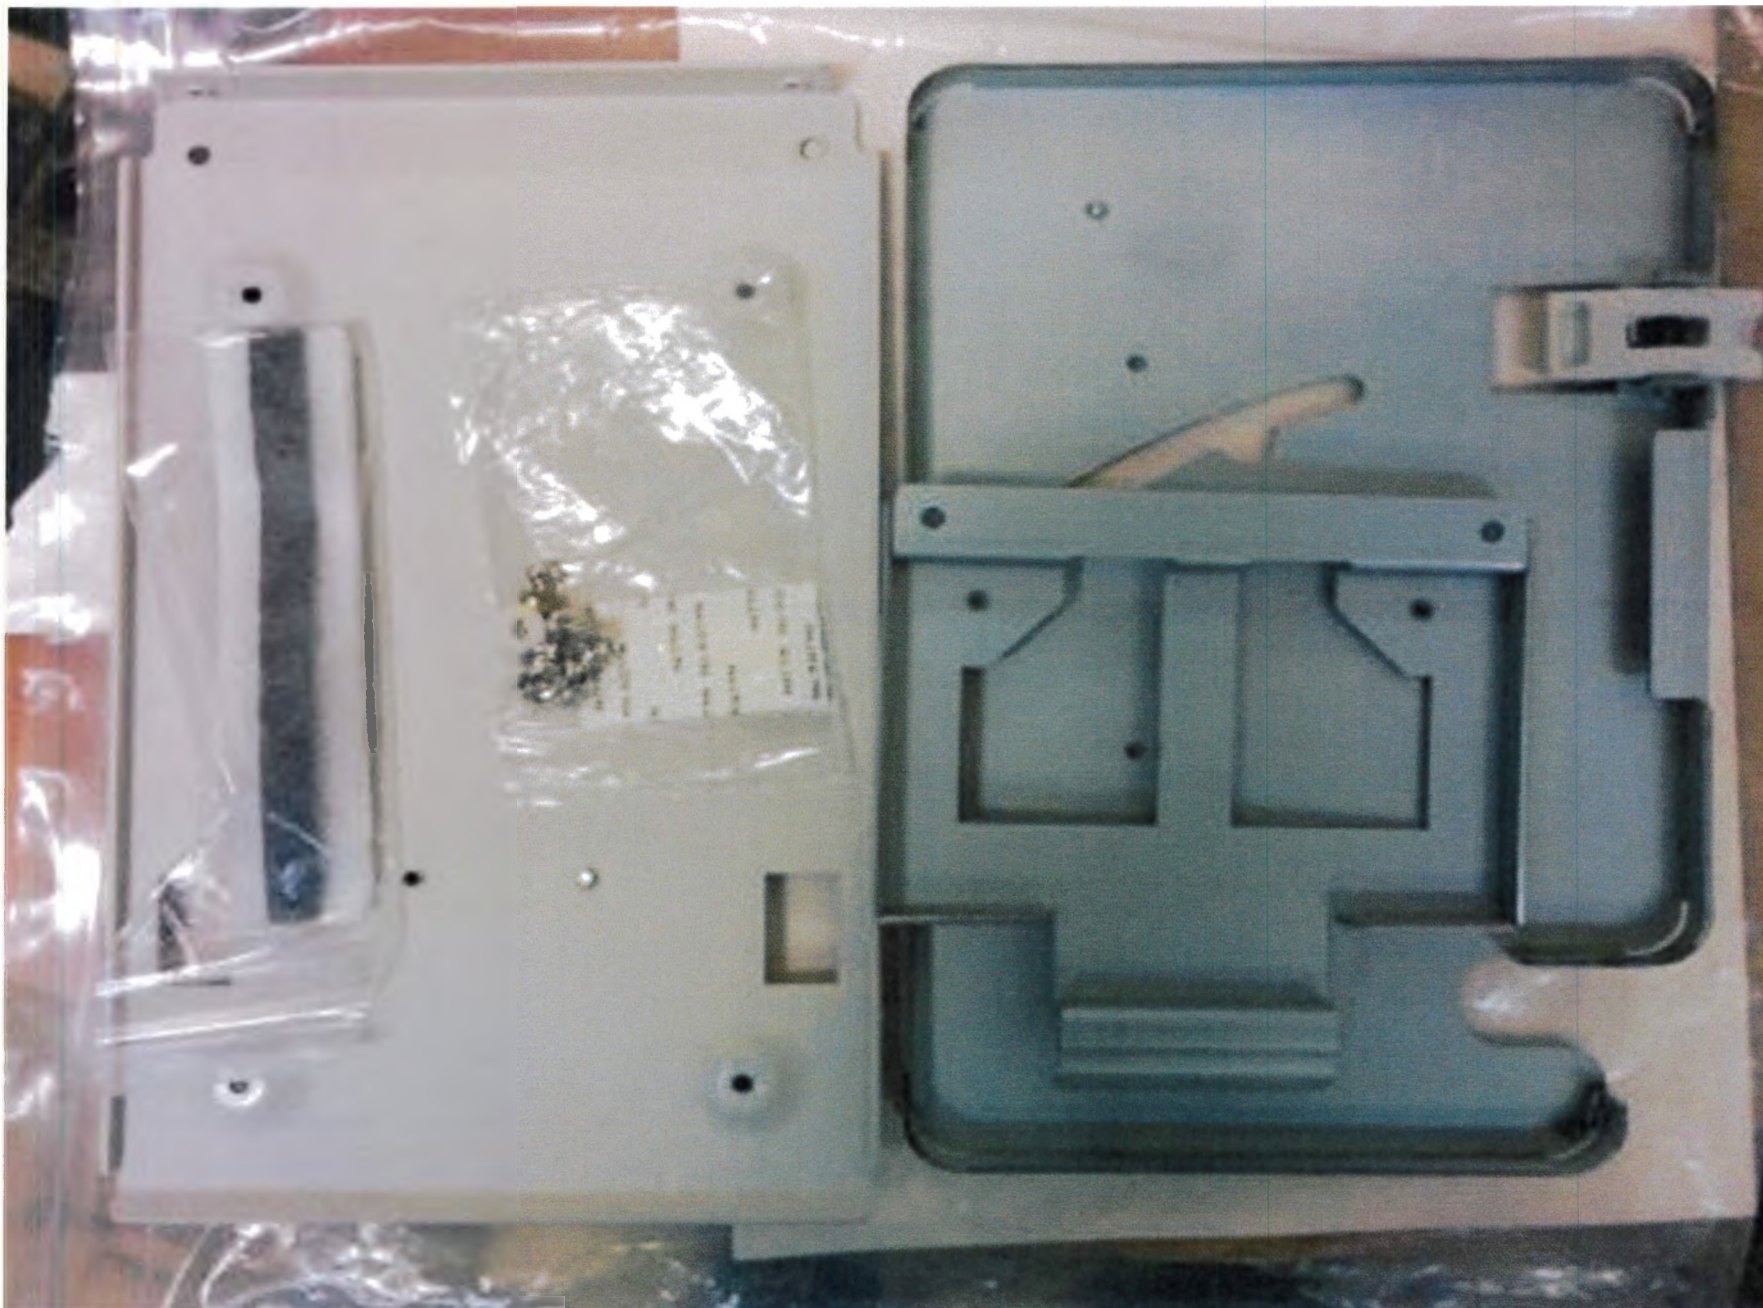

43. Модуль модернизации базового программного обеспечения.

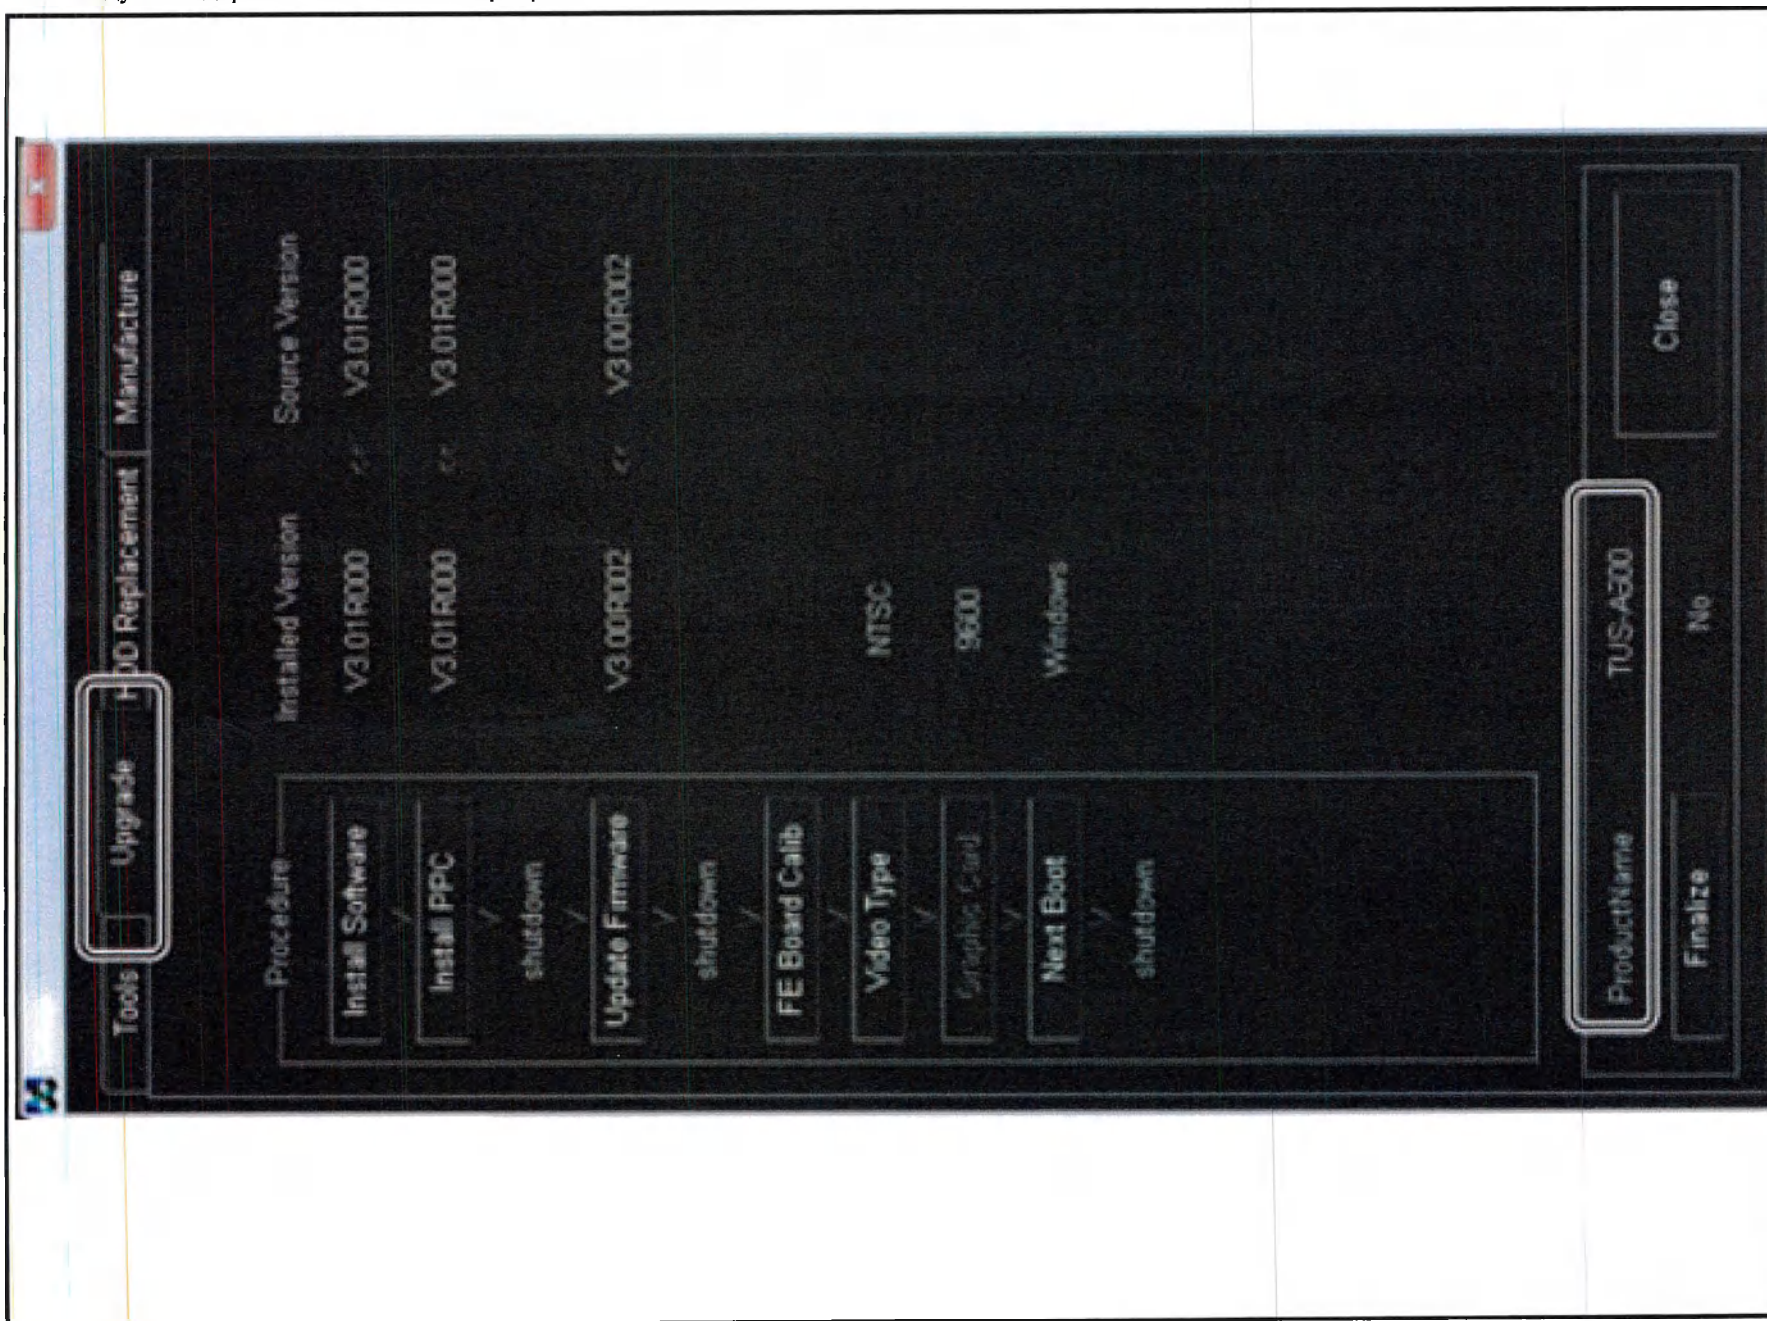

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 151 листов
Подпись _____

