

ООО «Смит энд Нефью»

Юр.адрес: 105120 г. Москва,
2-й Сыромятнический пер, 1
эт.9, пом.1, комн.1

Почт.адрес: 105120 г. Москва,
2-й Сыромятнический пер, 1

Т: + 7 495 755 55 03
www.smith-nephew.com
info.russia@smith-nephew.com

ПОДТВЕРЖДАЮ

Менеджер по регистрации и
нормативно-правовой документации
ООО "Смит энд Нефью"
Лихачев Д. Н.



Фотографические изображения медицинского изделия
«Система контролируемой абляции WEREWOLF COBLATION с
принадлежностями»

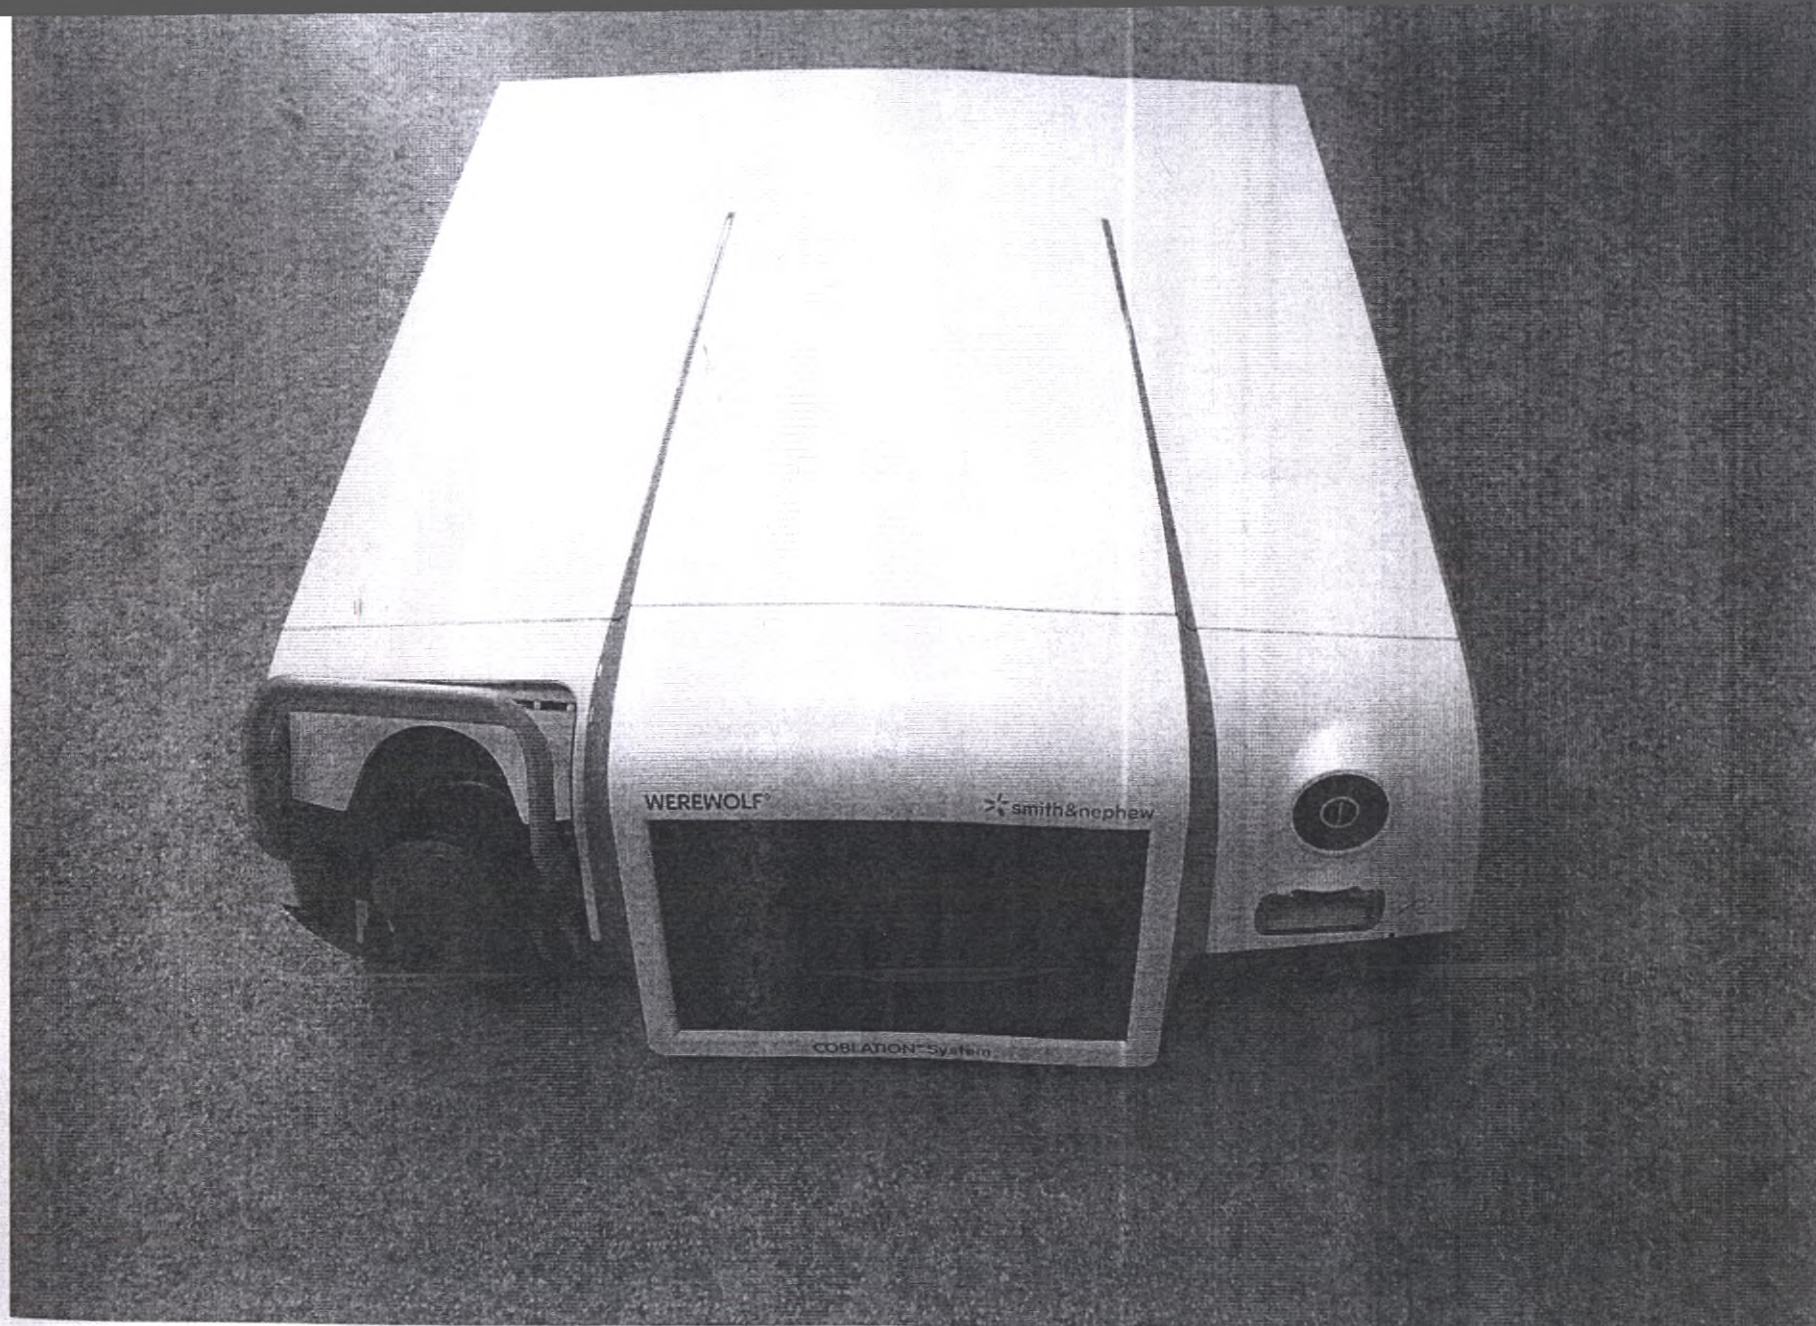


Рис.1. Биполярный радиочастотный контроллер

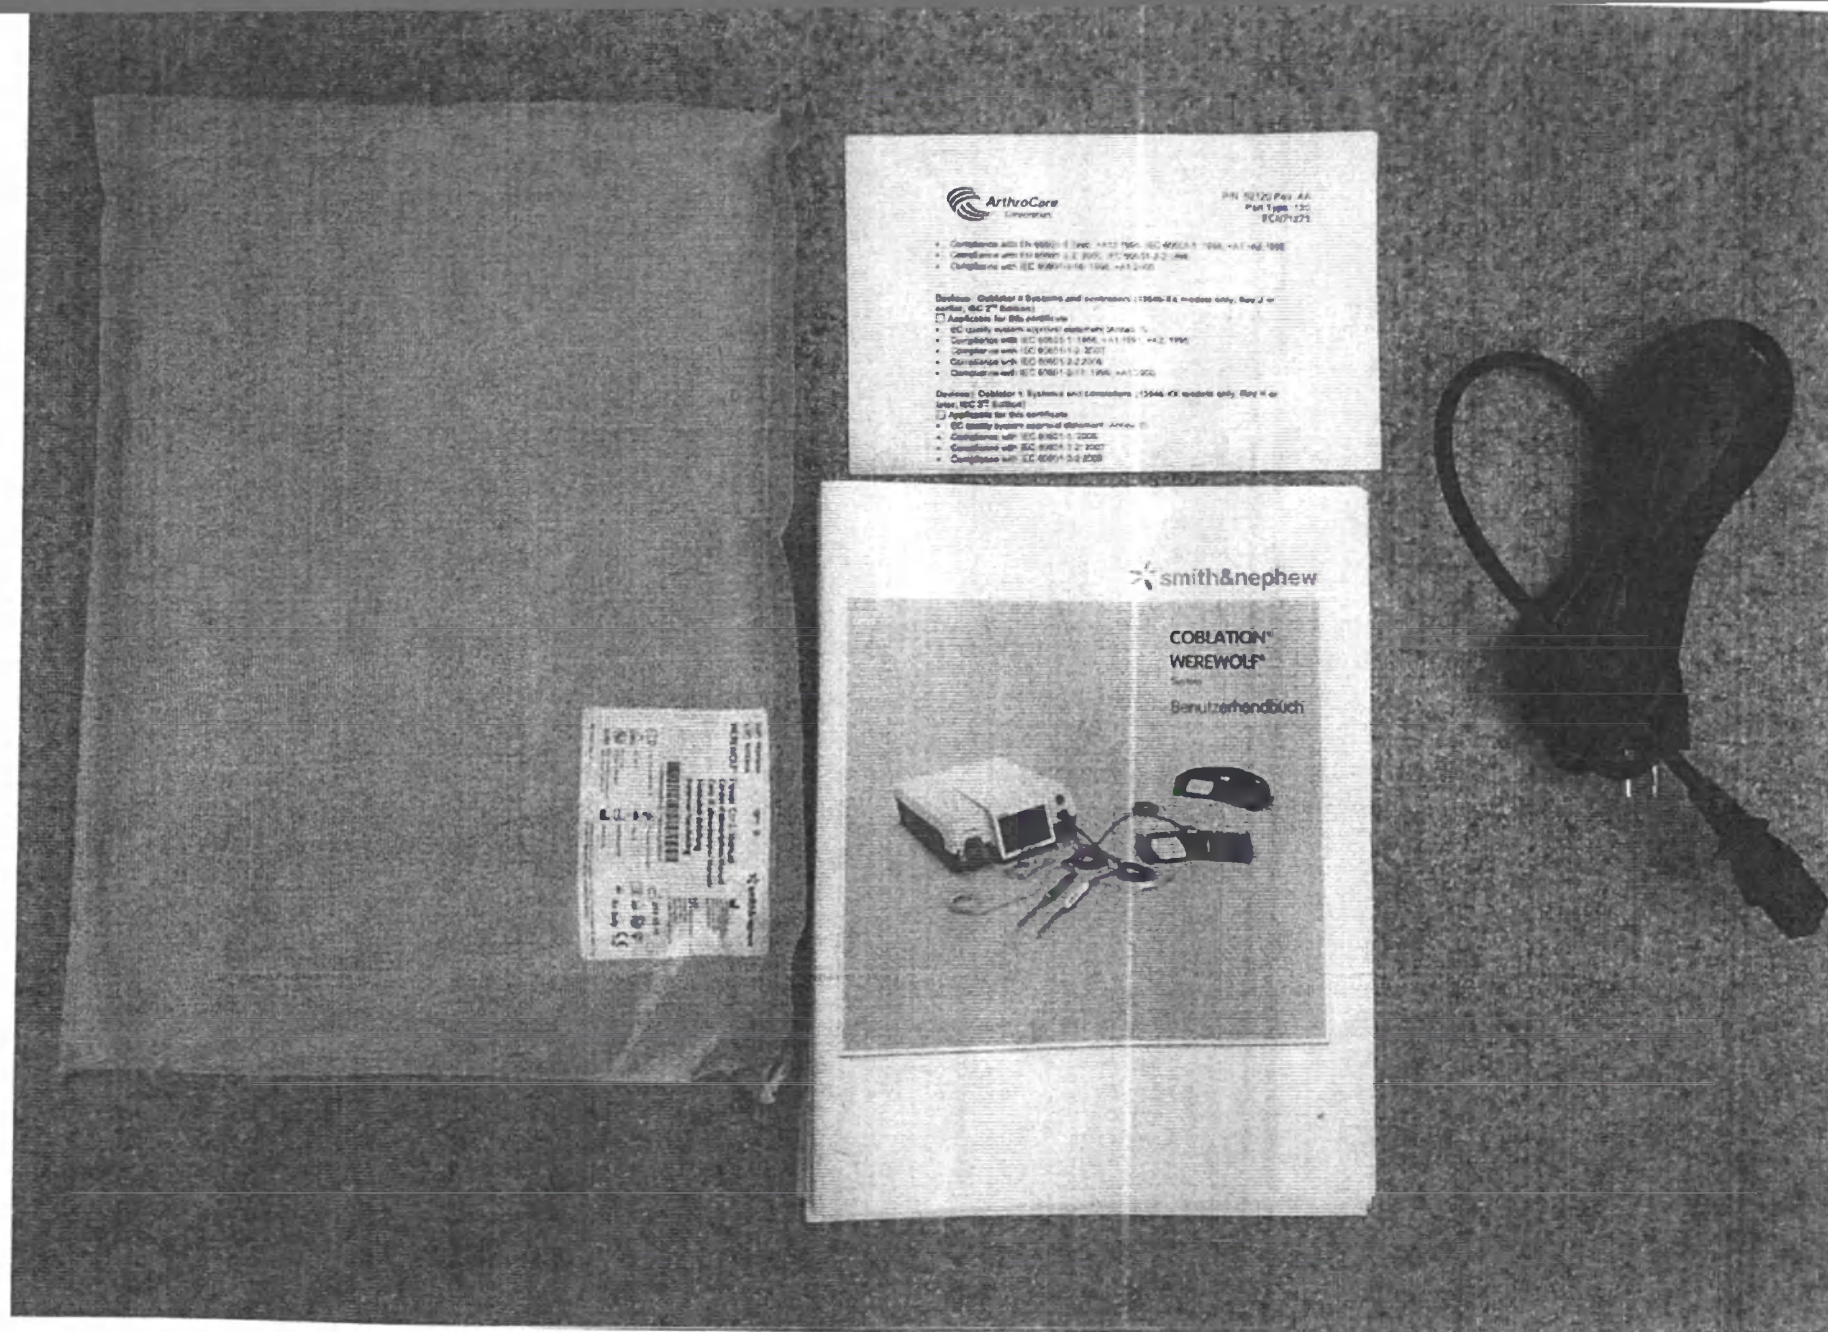


Рис.2. Кабель питания с эксплуатационной документацией



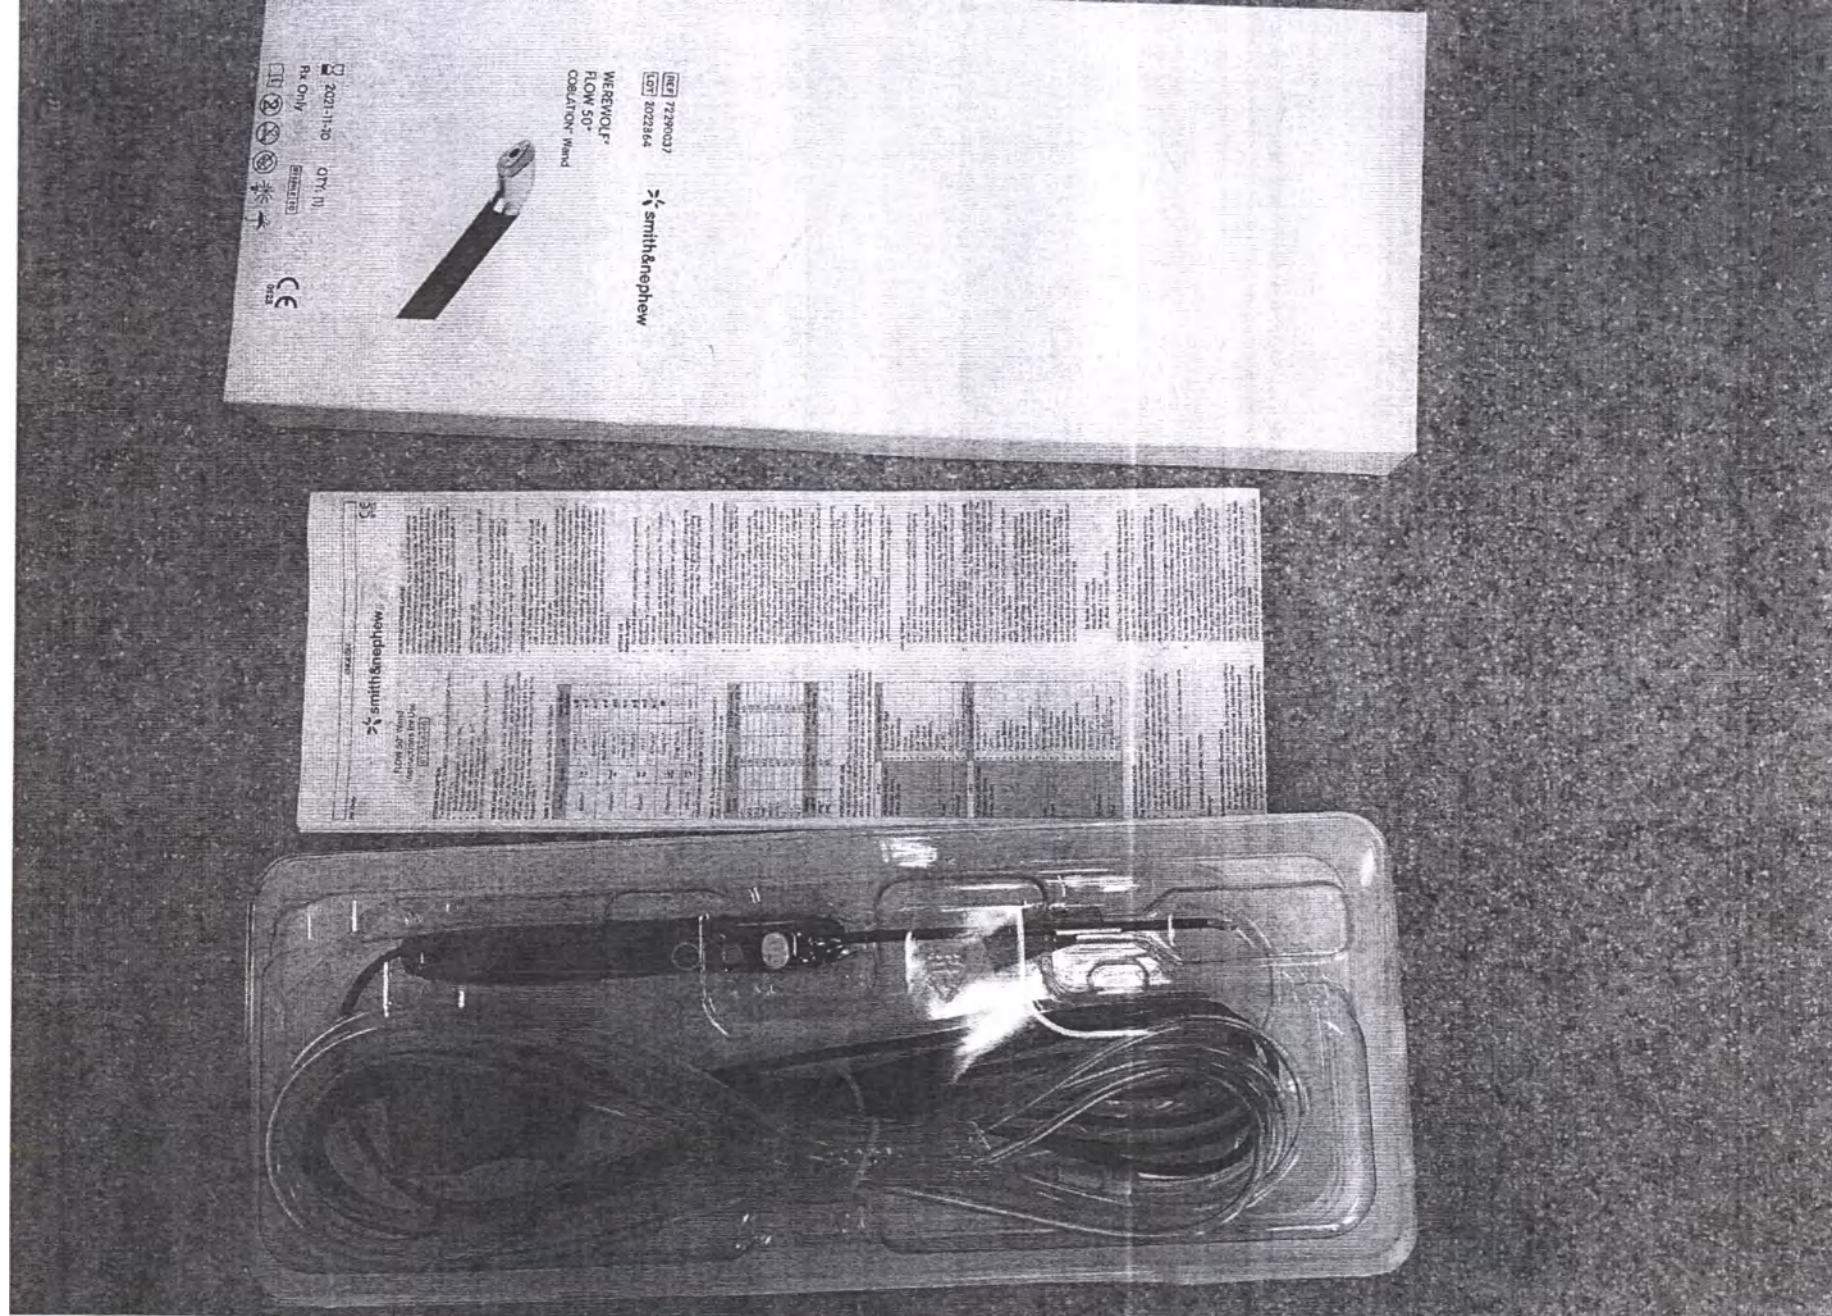


Рис.3. Электрод одноразовый FLOW 50 в упаковке с эксплуатационной документацией

smith&nephew

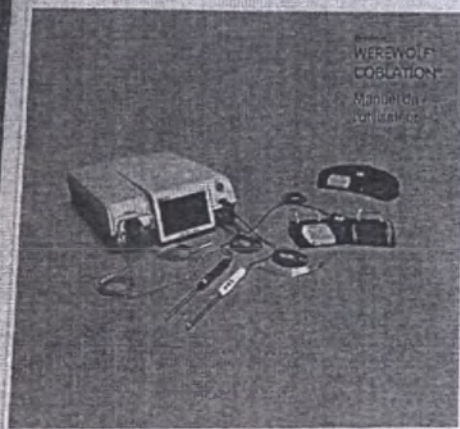

Addendum to COBLATION® WEREWOLF®
(RF20000) System User's Manual
(P/N 64999.EN Rev. C)

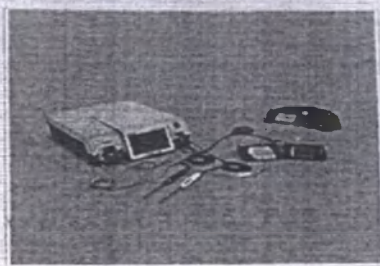


smith&nephew

COBLATION®
WEREWOLF®
System
Benutzerhandbuch



smith&nephew

COBLATION®
WEREWOLF®
System
User's Manual

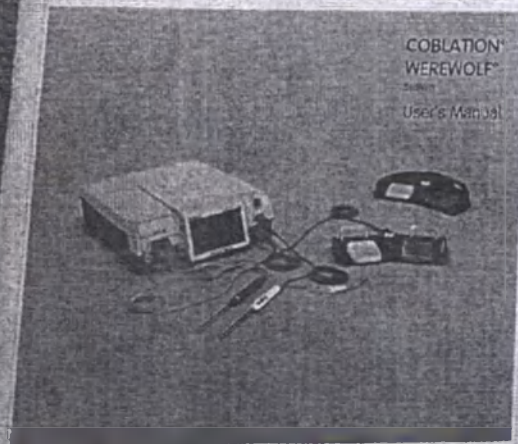

smith&nephew

COBLATION®
WEREWOLF®
System
Manuals
de l'utilisateur



smith&nephew

COBLATION®
WEREWOLF®
System
Gebruikershandleiding



Рис.4. Руководство по эксплуатации «Система контролируемой абляции WEREWOLF COBLATION». Мультиязычная версия

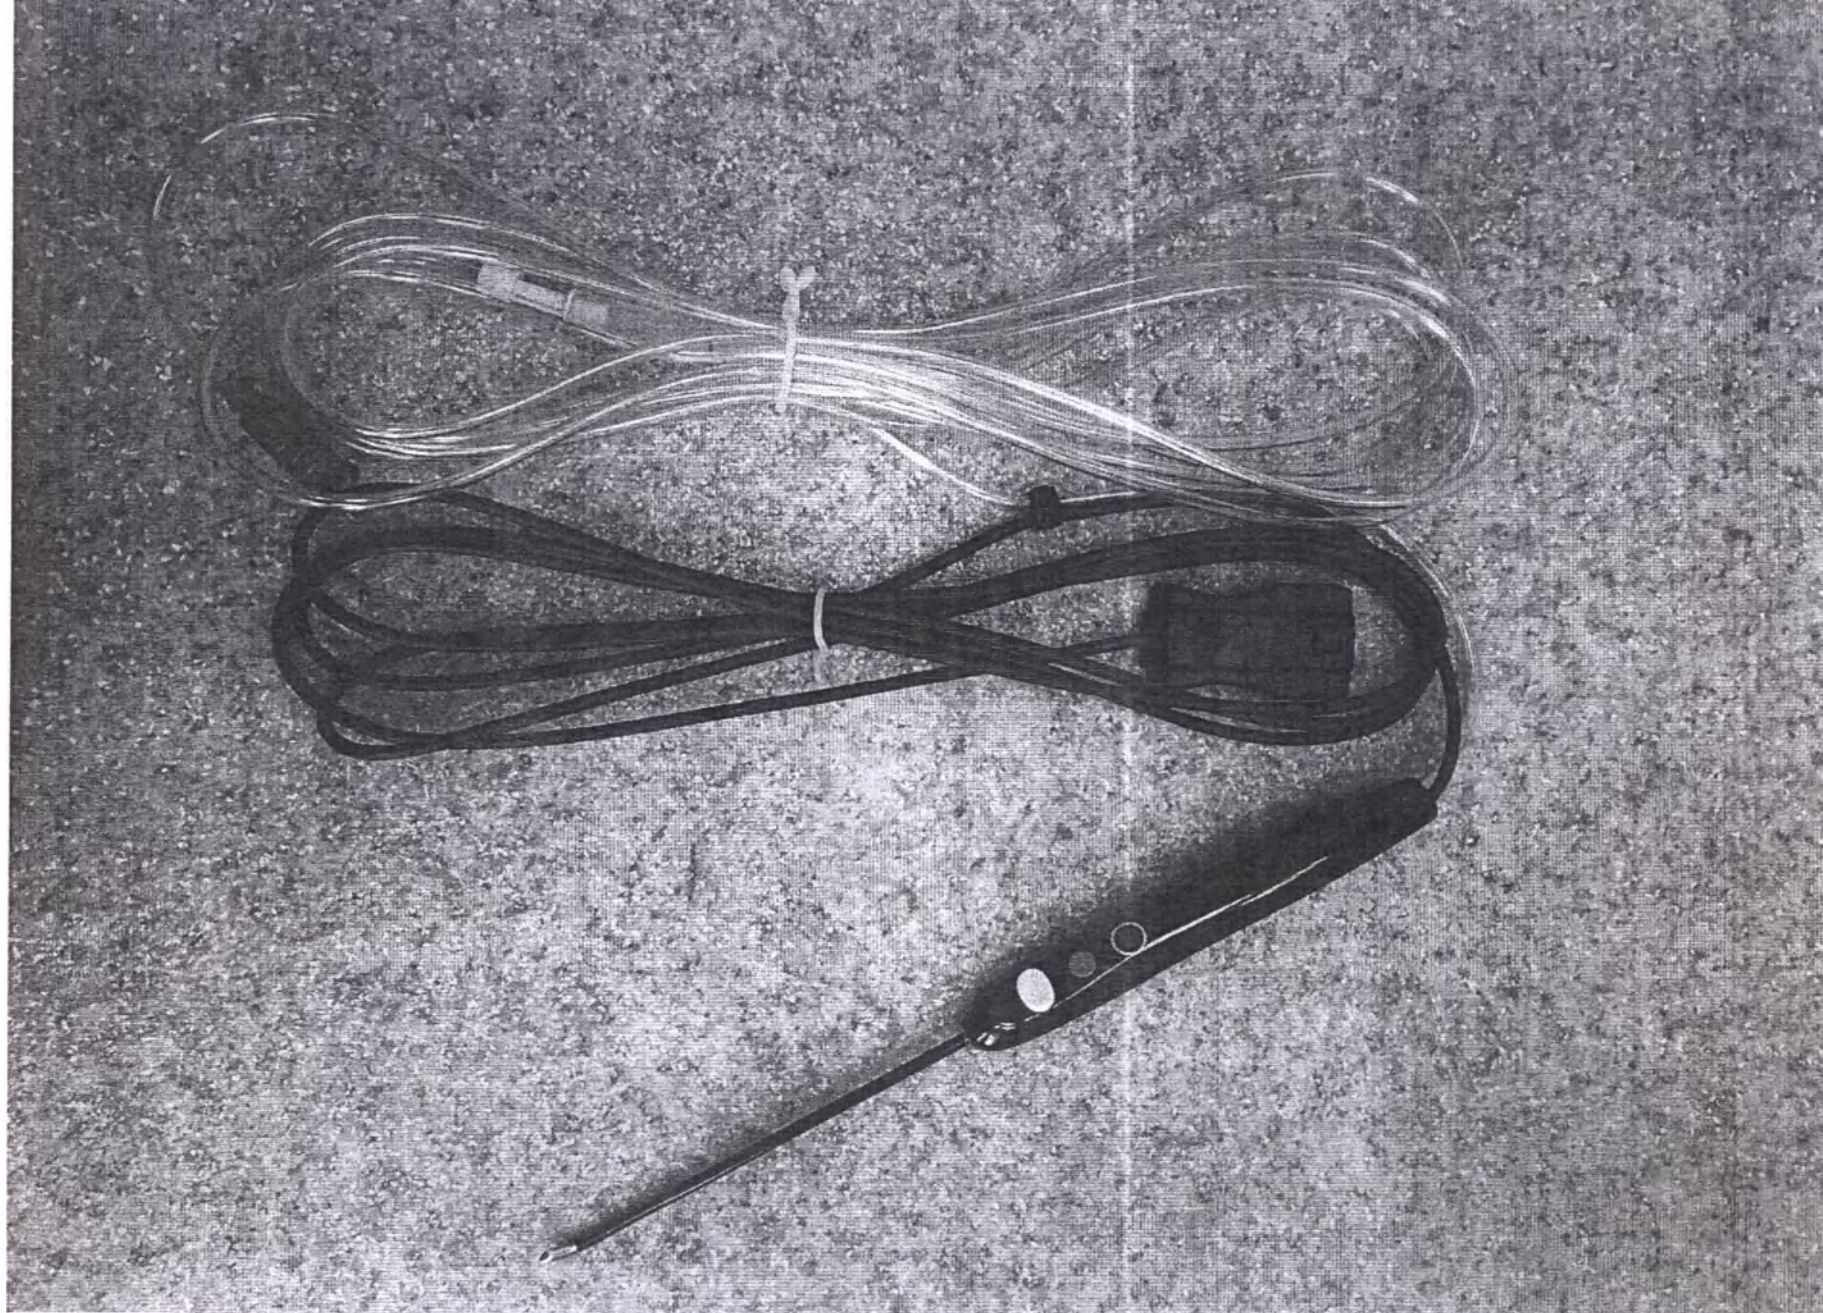


Рис.5. Электрод одноразовый FLOW 50



Рис.6. Педаль проводная

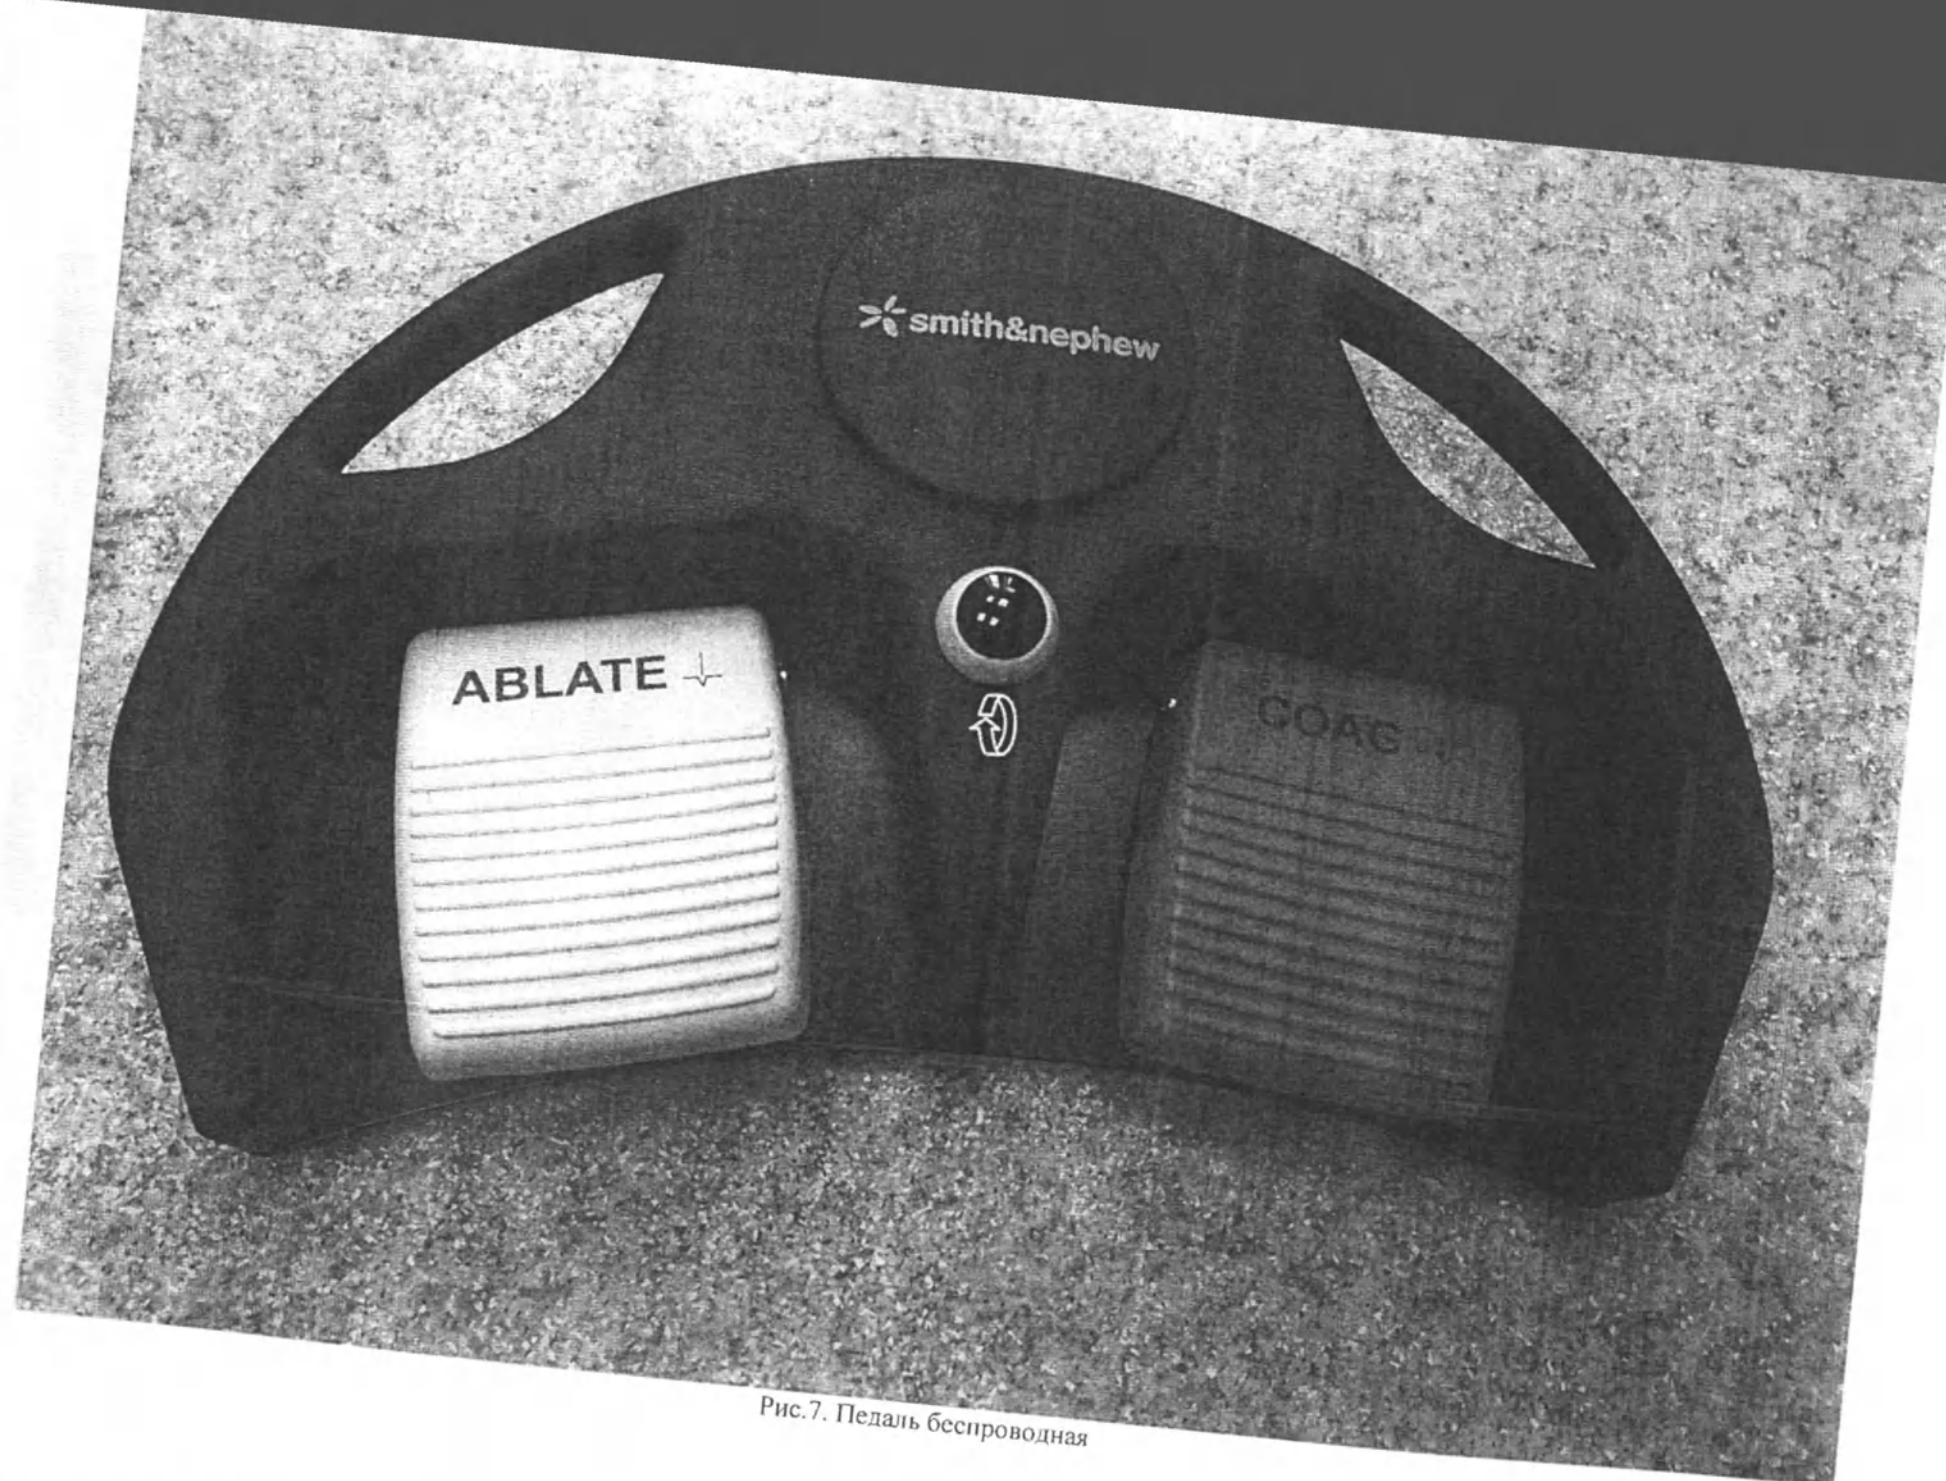


Рис. 7. Педаль беспроводная

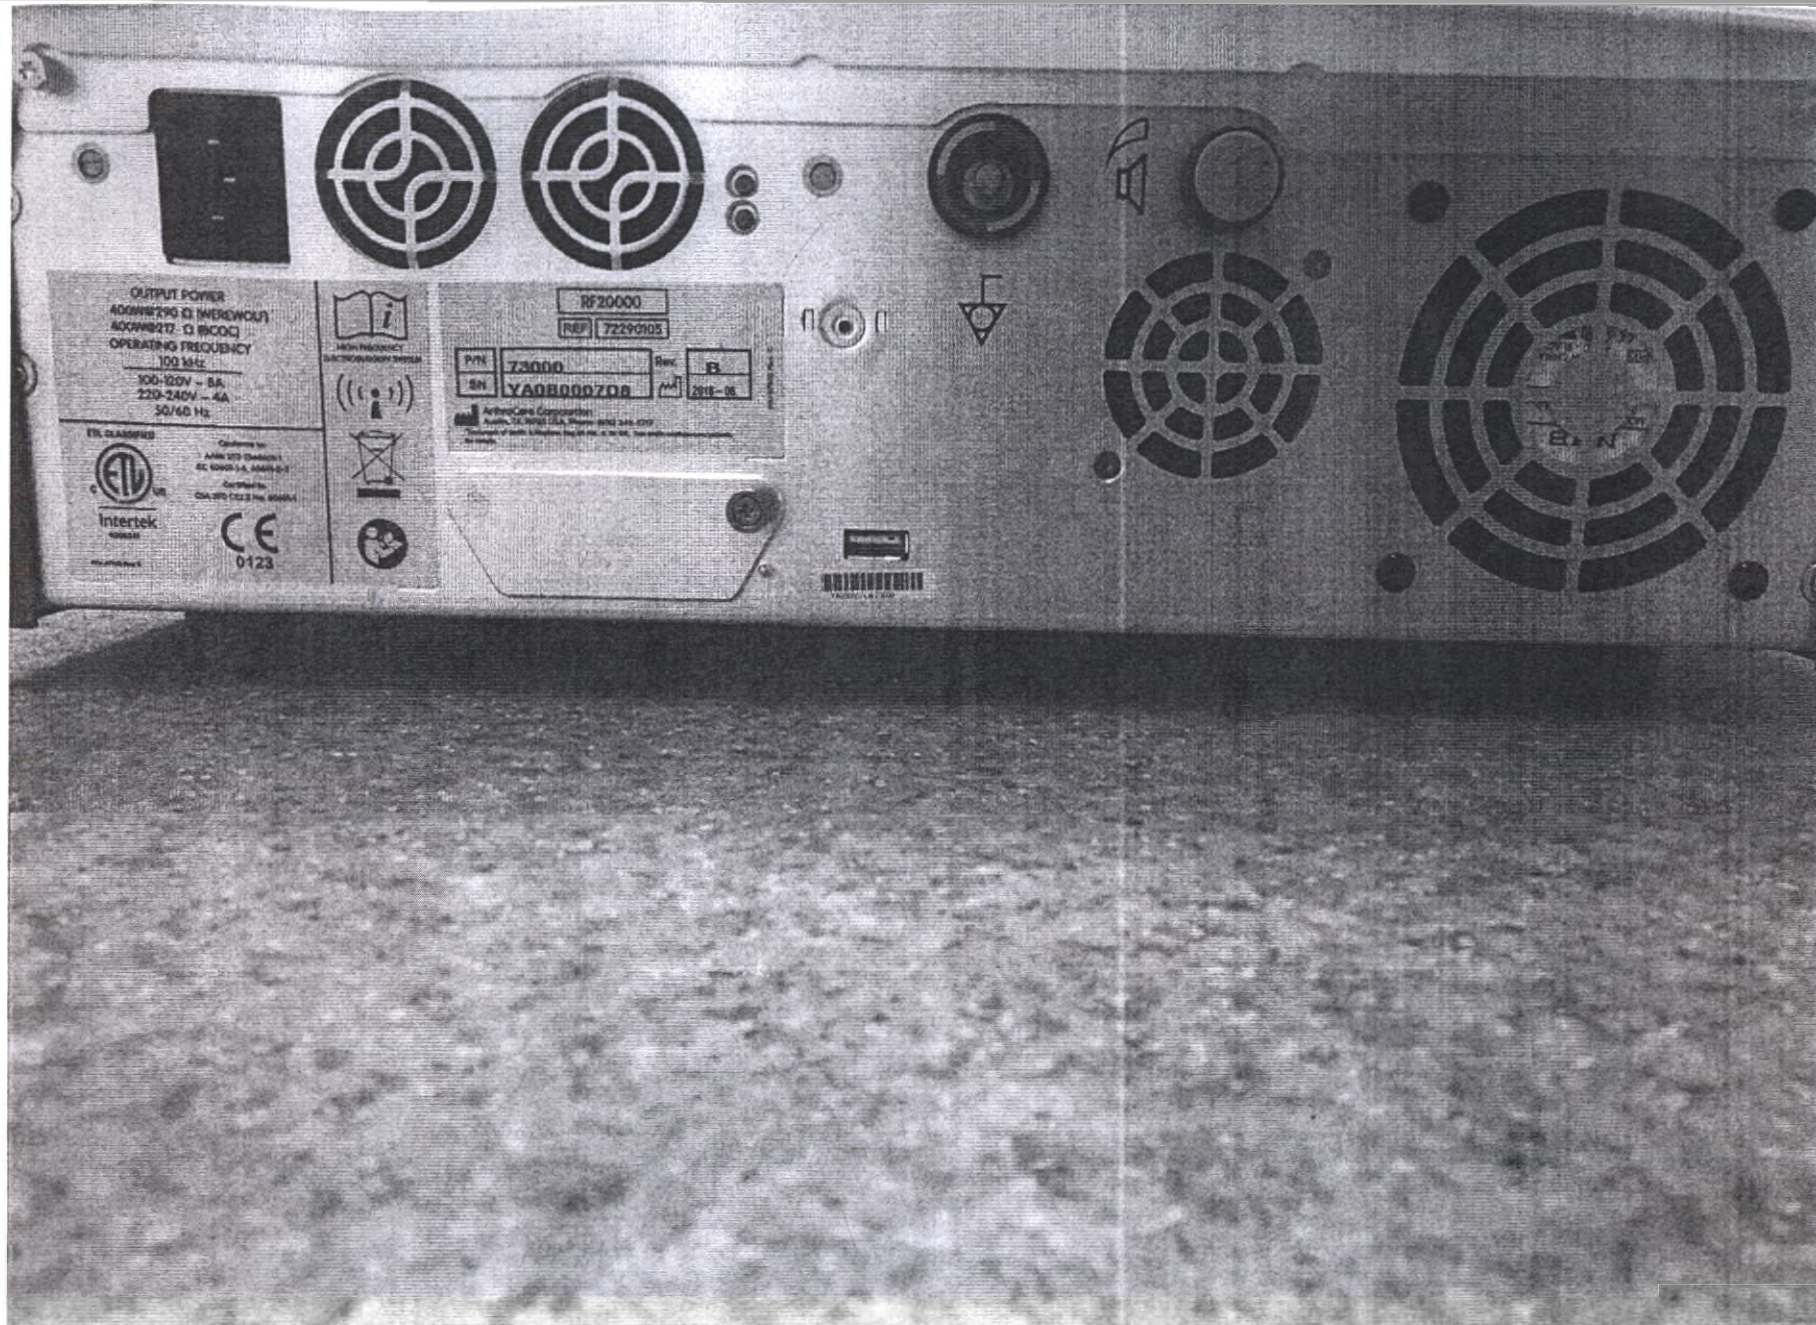


Рис.8. Маркировка производителя на задней панели системы контролируемой абляции

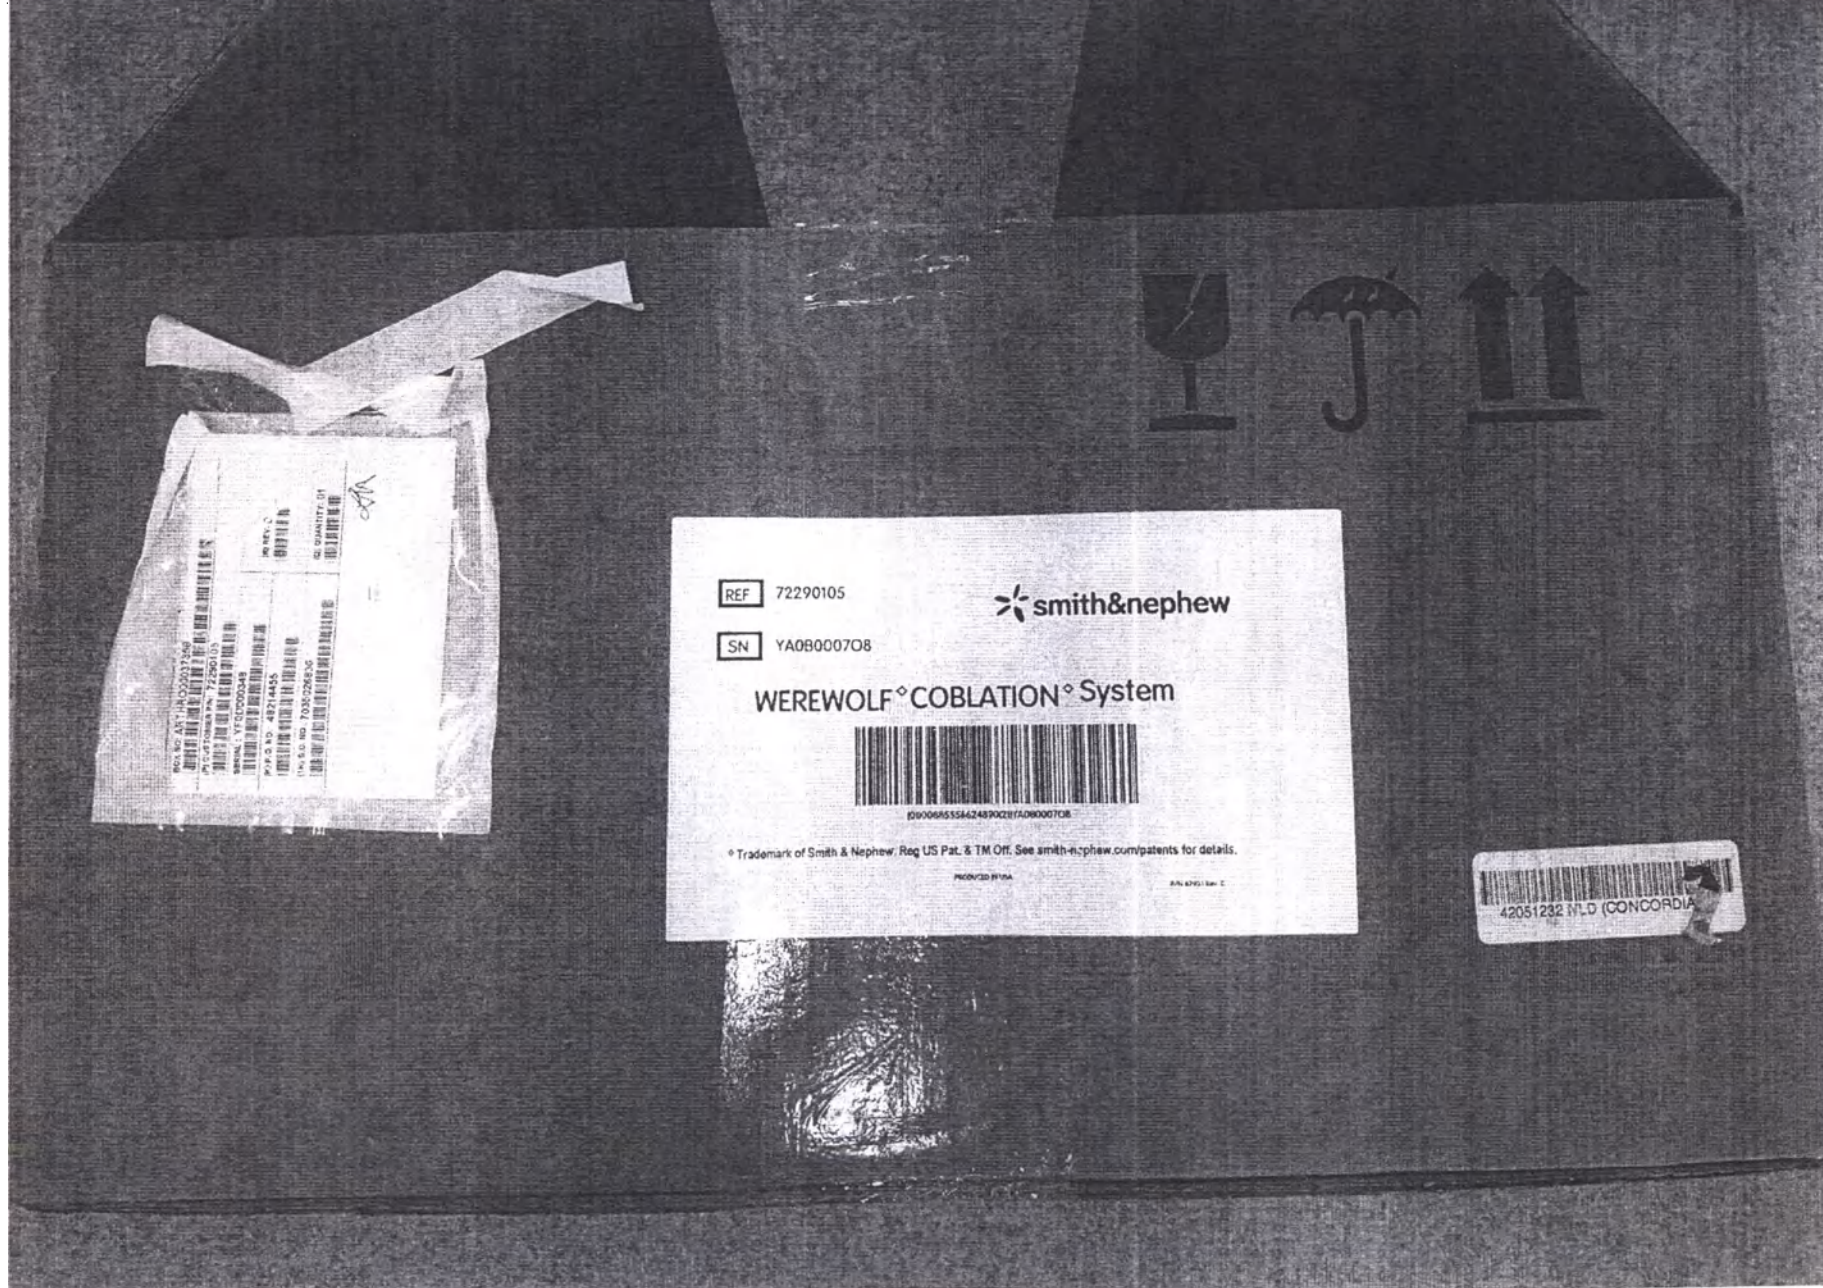


Рис.9. Маркировка производителя на транспортной упаковке системы контролируемой абляции

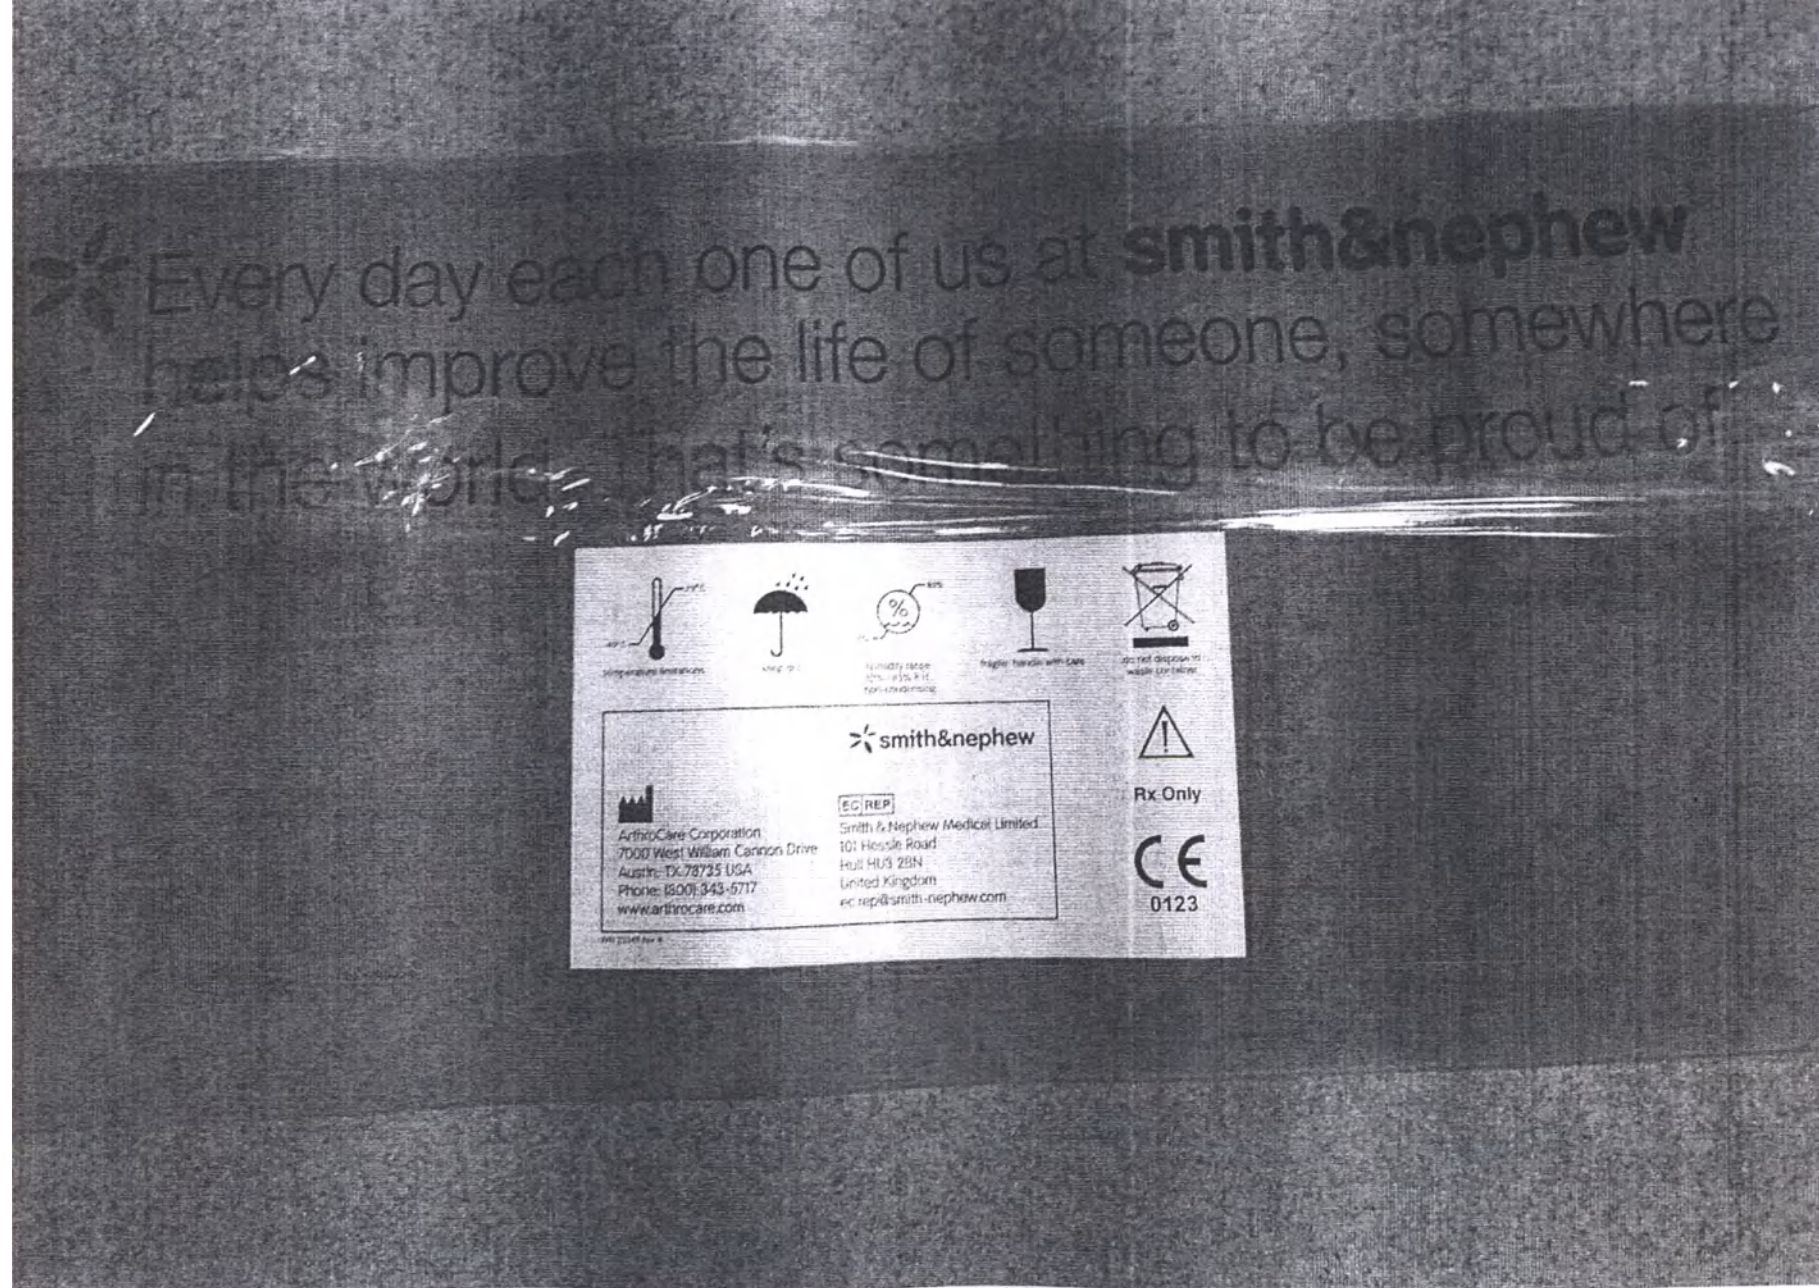


Рис.10. Маркировка производителя на транспортной упаковке системы контролируемой абляции, вторая сторона


REF 72290007
SN 331175196

 smith&nephew



(01)00885556618417(21)331175196

Wired Foot Pedal


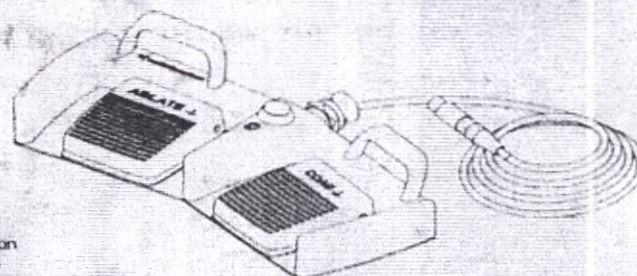


Linemaster Switch Corporation
29 Maine Hill Road POB 328
Woodstock, CT 06281 USA
TEL: +1 800 974 1000
www.linemaster.com

Dist. by:
ArthroCare Corporation
7000 West William Cannon Drive
Austin, TX 78735 USA
Tel: +1 800 343 5717
www.arthrocare.com

EC REP



Smith & Nephew Medical Limited
101 Hesse Road
Hull HU3 2BN
United Kingdom
ec.rep@smith-nephew.com

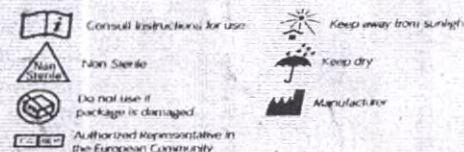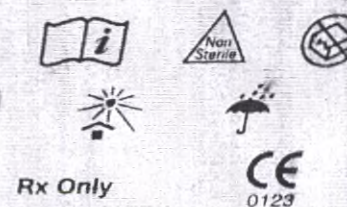

This product may be covered by one or more US Patents. See smith-nephew.com/patents for details.

PRODUCED IN USA

Рис.11. Маркировка производителя на индивидуальной упаковке педали проводной

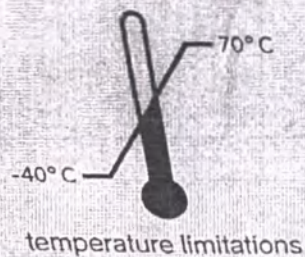

ArthroCare Corporation
7000 West William Cannon Drive
Austin, TX 78735 USA
Phone: (800) 343-5717
www.arthrocare.com

P/N 23349 Rev. K

 **smith&nephew**

EC REP

Smith & Nephew Medical Limited
101 Hessle Road
Hull HU3 2BN
United Kingdom
ec.rep@smith-nephew.com



Rx Only


CE
0123

Рис.12. Маркировка производителя на индивидуальной упаковке педалей, предупреждающие символы

REF 72290008


SN 320246018

smith&nephew

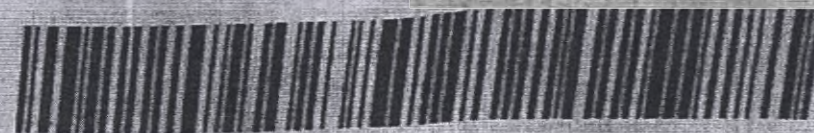

(01)0085556618226(21)320246018

Wireless Foot Pedal

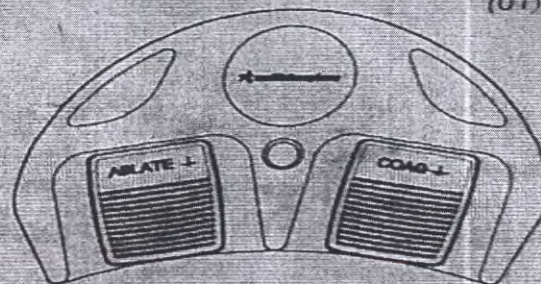


Linemaster Switch Corporation
29 Plaine Hill Road POB 328
Woodstock, CT 06281 USA
Tel: +1 800 974 1000
www.linemaster.com

Dist. by
ArthroCare Corporation
7000 West William Cannon Drive
Austin, TX 78735 USA
Tel: +1 800 343-5717
www.arthrocare.com

EC REP

Smith & Nephew
York Science Park
Horsington, York YO10 5DF
United Kingdom
Tel: +44 (0)1926 482400
ec.rep@smith-nephew.com



Rx Only

CE
0123



Consult instructions for use



Not Sterile



Do not use if
package is damaged



Authorized Representative in
the European Community



Keep away from sunlight



Keep dry



Manufacturer

This product may be covered by one or more US Patents. See smith-nephew.com/patents for details

PRODUCED IN USA

TRANSMITTER KIT 907-D17-A



CE

QTY: 1



LINEMASTER SWITCH CORP.
WOODSTOCK, CT USA



L32024600010018-TXA

Рис.13. Маркировка производителя на индивидуальной упаковке педали беспроводной


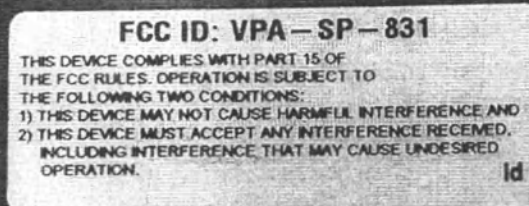


Рис.14. Маркировка производителя на задней панели педали беспроводной

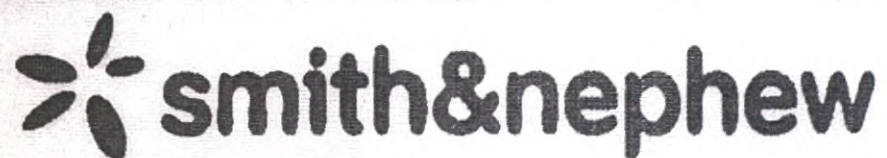

CE
0123

REF

72290007

SN

331175196

Rev.

C

Distributed by Smith & Nephew
Austin, TX 78735 USA. Phone: 1-800-343-5717


Рис.15. Маркировка производителя на задней панели педали проводной

REF 72290037

LOT 2022864

 smith&nephew

WEREWOLF°
FLOW 50°
COBLATION° Wand

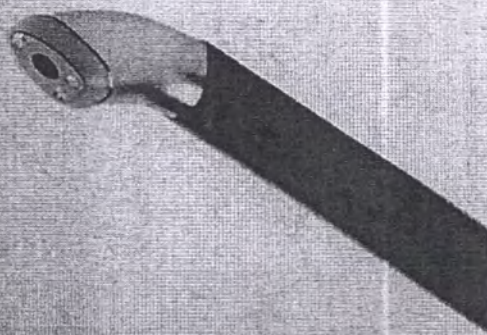

 2021-11-10

QTY: (1)

Rx Only

STERILE EO

CE
0123



Рис.16. Маркировка производителя на индивидуальной картонной упаковке электрода

WEREWOLF[°] FLOW 50[°] Wand

 smith&nephew

REF 72290037

LOT 2022864

 2021-11-10



(01)00885556617472(17)211110(10)2022864

Рис.17. Маркировка производителя на индивидуальной картонной упаковке электрода, 2 сторона

° Trademark of Smith & Nephew. This product may be covered by one or more US Patents. See smith-nephew.com/patents for details.



Consult instructions for use




Do not re-use



Do not re-sterilize



Do not use if
package is damaged



Authorized Representative in
the European Community



Keep away from sunlight



Keep dry



Use-by date



Sterilized using ethylene oxide



Manufacturer

Made in Costa Rica



ArthroCare Corporation
7000 West William Cannon Drive
Austin, TX 78735 USA
Phone: (800) 343-5717
www.arthrocare.com



Smith & Nephew Medical Limited
101 Hessle Road
Hull HU3 2BN
United Kingdom
ec.rep@smith-nephew.com


P/N 04337-151 Rev. B

Рис.18. Маркировка производителя на индивидуальной картонной упаковке электрода, 3 сторона

REF 72290037
LOT 2022864

 smith&nephew

WEREWOLF®
FLOW 50°
COBLATION® Wand

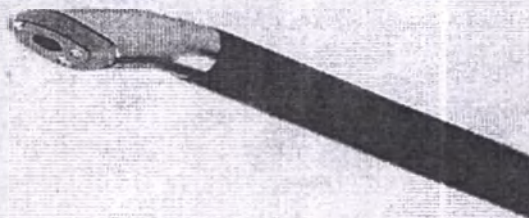


 2021-11-10 QTY: (1)



Rx Only

STERILE EO

CE
0123



ArthroCare Corporation
7000 West William Cannon Drive
Austin, TX 78735 USA
Phone: (800) 343-5717
www.arthrocare.com

EC REP

Smith & Nephew Medical Limited
101 Hesse Road
Hull HU3 2BN
United Kingdom
ec.rep@smith-nephew.com

P/N 04335-151 Rev. B

 smith&nephew

WEREWOLF® FLOW 50°
COBLATION® Wand

REF 72290037
LOT 2022864
 2021-11-10

 smith&nephew

WEREWOLF® FLOW 50°
COBLATION® Wand

REF 72290037
LOT 2022864
 2021-11-10

 smith&nephew

WEREWOLF® FLOW 50°
COBLATION® Wand

REF 72290037
LOT 2022864
 2021-11-10

 smith&nephew

WEREWOLF® FLOW 50°
COBLATION® Wand

REF 72290037
LOT 2022864
 2021-11-10

Рис.19. Маркировка производителя на первичной упаковке электрода

Всего прошито и пронумеровано:

20/2649476)

листов

Менеджер по регистрации
и нормативно-правовой
документации
ООО «Смит энд Нефью»

Лихаев Д.Н.

