

Фотографическое изображение медицинского изделия
Аптечка для оказания первой помощи работникам
по ТУ 21.20.24-020-85535470-2018, в вариантах исполнения:
Тип 02, Тип 03, Тип 03 Вариант 1, Тип 09, Тип 10/2,
Тип 10/2 Вариант 1, Тип 12, Тип 12 Вариант 1, Тип 13,
Тип 14/3, Тип 16, Тип 20, Тип 31, Тип 34



ВИТАЛ
ФАРМ

АПТЕЧКА

для оказания
первой помощи
РАБОТНИКАМ

 www.vitalfarm.ru  +7 (812) 335-05-85



Высокое качество

СЕВЕРНОЙ
СТОЛИЦЫ



Производитель/уполномоченная организация:
ЗАО «Витафарм», Россия, 187322, Ленинградская обл.,
Кировский р-н, городское поселение Синявино,
ул. Садовая д.2.





ВИТАЛ
ФАРМ

www.vitalfarm.ru

АПТЕЧКА для оказания
первой помощи
РАБОТНИКАМ



Высокое качество

СЕВЕРНОЙ
СТОАИЦЫ



Производитель/уполномоченная организация:
ЗАО «Витал-фарм» Россия, 187322, Ленинградская обл.
Кировский р-н, городское поселение Сингарино,
ул. Садовая, д.2.







СУЭК



АПТЕЧКА для оказания

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

РАБОТНИКАМ



АПТЕЧКА

для оказания

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

РАБОТНИКАМ



Перечень вложений

Аптечка для оказания первой помощи работникам

1. Медицинские изделия

1.1 Маска медицинская нестерильная одноразовая	10 шт.
1.2 Перчатки медицинские нестерильные, размер не менее М	2 пары
1.3 Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"	1 шт.
1.4 Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
1.5 Бинт марлевый медицинский, не менее 5 м x 10 см	4 шт.
1.6 Бинт марлевый медицинский, не менее 7 м x 14 см	4 шт.
1.7 Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16 x 14 см №10	2 уп.
1.8 Лейкопластырь рулонный, не менее 2 см x 500 см	1 шт.
1.9 Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9 см x 7,2 см	10 шт.
1.10 Лейкопластырь бактерицидный не менее 4 см x 10 см	2 шт.
1.11 Покрывало спасательное изотермическое не менее 160 x 210 см	2 шт.
1.12 Ножницы для разрезания повязок	1 шт.

2. Прочие средства

2.1 Инструкция по оказанию первой помощи	1 шт.
2.2 Футляр	1 шт.

Предназначена для оказания доврачебной само – и взаимопомощи при чрезвычайных ситуациях, травмах на предприятиях, учреждениях, дорожно-транспортных происшествиях, так и в любых других условиях

Зарегистрирована под названием: Аптечка для оказания первой помощи работникам по ТУ 21.20.24-020-85535470-2018, в вариантах исполнения. РУ № ФСР 2011/12283 от

Разработана в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 15.12.2020 № 1331н.

Аптечка пополняется по мере расходования или истечения срока годности комплектующих.

Внимание! Хранить в недоступном для детей месте!

Условия хранения и транспортирования при температуре от + 5°C до + 25°C.

Не подлежит обязательной сертификации.

Образующиеся отходы утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Тип

Дата изготовления/номер партии:

.....

Производитель/уполномоченная организация: ЗАО «Виталфарм».

Россия, 187322, Ленинградская обл., Кировский р-н, городское поселение Сняино,
ул. Садовая д.2 т/ф: +7(812) 335-05-85 www.vitalfarm.ru

Срок годности аптечки: 48 месяцев.

Гарантийный срок службы футляра: 12 месяцев.

Маска медицинская из нетканых материалов нестерильная, одноразовая, по ТУ 32.50.50-004-64015714-202,
производства ООО "Казанская фабрика "СпецМедЗащита", Россия, РУ РЗН 2020/10733

Маска медицинская из нетканых материалов
нестерильная, одноразовая" Арт.3(1)-Г-Ст.
ТУ 32.50.50-004-64015714-2020
"Стандарт" • НЕСТЕРИЛЬНО • Одноразовая • Тип 1
Размер 17,5 см х 9,5 см
Количество слоев - 3. Вариант расположения слоев:
СМС (12 г/м2), СМС (17 г/м2), СМС (17 г/м2)
Изготовитель: ООО "Казанская фабрика "СпецМедЗащита"
Юридический адрес: Россия, 196084, г.Санкт-Петербург,
ул.Цветочная, д.2 лит.В пом. 28Н, тел.: 8(812)400-81-00
Условия хранения: хранение изделий у изготовителя и потребителя
должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в
соответствии с условиями хранения 5 по ГОСТ 15150-99 (при
температуре от -40°C до +40 °C) и должны быть защищены от
солнечных лучей и атмосферных воздействий.
Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления.
Средний срок годности - не менее 5 лет
РУ № РЗН 2020/10733 от 10.06.2020 г.
Цвет: **Голубой** Количество: **50 шт.**
Дата изготовления: 07.2020 Номер партии: 072020Г-30П
4 603728 320656  смена 2
www.bakhty.ru

Маска медицинская нестерильная одноразовая по ТУ 9398-011-14959781-2015 следующих размеров: 8,0 см х 14,0 см; 9,5 см х 14,5 см; 9,5 см х 17,5 см, производства ООО "ЭВТЕКС", Россия, РУ РЗН 2016/4118



Маска медицинская одноразовая трехслойная на резинках нестерильная по ТУ 32.50.50-001-14382957-2020,
производства ООО КОМПАНИЯ "МЕДСКЛАД", Россия, РУ РЗН 2020/9944

**МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ ОДНОРАЗОВАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ НА РЕЗИНКАХ
НЕСТЕРИЛЬНАЯ ПО ТУ 32.50.50-001-14382957-2020**

Материалы слоев: спанбонд, СМС, СМС. 100 штук в пакете

Размер: длина (175±5) мм; ширина (95±5) мм; Срок годности: 3 года.

НЕСТЕРИЛЬНО, НЕТОКСИЧНО

ГОСТ Р 58396-2019

ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ТИП МАСКИ I

ме д с к л а д
многопрофильная компания

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ООО КОМПАНИЯ "МЕДСКЛАД", ИНН 5408002620

Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. РУССКАЯ, 41, ОФ. 607

ТЕЛ. 8-800-201-7-701, +7 (383) 304-78-01 (-02,03)

HTTP://МЕДСКЛАД.РФ, INFO@MED-SKLAD.RU



Маски медицинские из нетканого материала одноразовые по ТУ 32.50.50-009-71847378-2017,
производства ООО "НЬЮФАРМ", Россия, РУ РЗН 2018/7773



МАСКИ МЕДИЦИНСКИЕ трехслойные на резинках (50 штук)

из нетканого материала одноразовые «Стандарт» НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

ТУ 32.50.50-009-71847378-2017

Размер - 17,5 см х 9,5 см
Сырьевой состав: Спанбонд, МС/Спанбонд
РУ № РЗН 2018/7773 от 07.11.2018 г.
Дата изготовления: июль 2020 г.
Годен до: июль 2021 г.
Партия № 50720

Производитель: ООО «НЬЮФАРМ»
Юридический, почтовый адрес, место производства: Россия, 155815,
Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Шуйская, д. 1

www.nf-farm.ru, e-mail: info@nf-farm.ru, тел. (49331) 2-00-63

Условия хранения: хранить в сухом месте

Утилизация: относится к отходам класса Б,

утилизуются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10

Показания к применению: для предотвращения распространения
возбудителей инфекционных заболеваний. Противопоказаний не выявлено.

Способ применения: вскрыть упаковку, изделие использовать по назначению.



LDPE



Маска медицинская лицевая одноразовая, по ТУ 32.50.50-007-40393587-2020 варианты исполнения: - с логотипом, размер (ширина х длина) 9,5 см х 17,5 см; - без логотипа, размер (ширина х длина) 9,5 см х 17,5 см, производства ФГУП "МЭЗ", Россия, РУ РЗН 2020/12143

Маска медицинская лицевая одноразовая

Назначение

Создание фильтрующего барьера для предотвращения попадания в органы дыхания и распространения инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Область применения

Маска может быть использована медицинским персоналом и пациентами в стационарных, амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях, работниками органов исполнительной, судебной и законодательной власти, работниками не медицинских учреждений и организаций, лицами, по роду деятельности имеющими высокий риск заболевания в эпидемический период или заражения им других лиц, а также населением в случае повышенной эпидемиологической опасности для предотвращения распространения инфекционных заболеваний в общественных и торговых организациях, в транспорте, во время эпидемий, при чрезвычайных ситуациях, в быту.

Состав

Маска состоит из трех слоев:

- 1-й слой (к лицу, неокрашенный) – спанбонд;
- 2-й слой – фильтрующий (СМС, СММС, мультблаун) – антибактериальный фильтр;
- 3-й слой (внешний, окрашенный) – спанбонд.

50 штук



Рекомендации по использованию

1. Проверить срок годности, указанный на упаковке, в случае истекшего срока годности, изделие непригодно.
 2. Вскрыть упаковку, вынуть изделие из упаковки.
 3. Приложить маску к лицу неокрашенной стороной, жестким фиксатором к переносице.
 4. Закрепить ушные петли за уши.
 5. Расправить складки маски так, чтобы маска плотно закрывала нос, рот и подбородок.
 6. Прижать носовой зажим (фиксатор) к переносице.
- Маска выполняет защитную функцию в течение 2-х часов. Рекомендуется заменить маску по истечении указанного времени. После применения маску утилизируйте согласно действующим предписаниям.

Показания к применению

Применять по назначению с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в случаях, предусмотренных областью применения.

Противопоказания к применению

- Индивидуальная непереносимость материалов маски (наличие предрасположенности к аллергии);
- Истекший срок годности;
- Механические повреждения изделий в составе комплекта.

Побочные эффекты

Возможно развитие аллергических реакций при наличии индивидуальной непереносимости материалов маски.

ИЗДЕЛИЕ НЕСТЕРИЛЬНО, НЕ ПОДЛЕЖИТ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИЗДЕЛИЕ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ, НЕ ПОДЛЕЖИТ ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Условия хранения и транспортирования

Хранить в упаковке производителя при температуре от +10 °С до +35 °С и при относительной влажности не более 80 %, предохранять от воздействия атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей.

Условия хранения – 1 (Л) по ГОСТ 15150.

Условия транспортирования – 5 по ГОСТ 15150.

Условия утилизации

Не использованные по назначению маски и маски с истекшим сроком годности, с поврежденной упаковкой в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 утилизируют в порядке, предусмотренном для твердых коммунальных отходов. И использованные маски относятся к медицинским отходам класса «Б» и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Утилизация упаковки с твердыми коммунальными отходами.

Срок годности


5 лет с даты изготовления.

Дата изготовления
№ партии:

03.02.21
1050221C

Производитель, адреса производства

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Московский эндокринный завод», Россия,
243413, Брянская область, Почепский муниципальный район,
городское поселение Рамасухское, территория
Северная промзона, строение 2/2А, строение 2/2Б
Организация для принятия претензий от потребителей
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Московский эндокринный завод», Россия,
109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 25
Тел./факс: (495) 678-00-50/911-42-10
<http://www.endopharm.ru>
ТУ 32.50.50-007-40393587-2020
Тип I по ГОСТ Р 58396-2019
РУ № РЗН 2020/12143 от 01.10.2020



Перчатки медицинские смотровые «Супермакс», латексные и нитриловые,
производства «Супермакс Глов Мануфэкторинг СДН. БХД.», Малайзия, РУ ФСЗ 2008/02932

**ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ
СМОТРОВЫЕ ЛАТЕКСНЫЕ**

**ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ
СМОТРОВЫЕ
ЛАТЕКСНЫЕ**


- НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
- ОДНОРАЗОВЫЕ
- ОПУДРЕННЫЕ
- ГЛАДКИЕ

EN 455/ASTM D6319/EN374

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Перчатки предназначены для изоляции рук
медицинского персонала при осмотре
пациентов и лабораторных исследованиях в
клиниках, больницах, консультационных
центрах, диспансерах и других медицинских
учреждениях.

ПРОИЗВЕДENO
MFG DATE
ГОДЕН ДО
EXP DATE
ПАРТИЯ
LOT NO



LATEX EXAMINATION GLOVES
SMOOTH DISPOSABLE
NON-STERILE POWDERED


SIZE L 100 PCS

РУ №06-СЗ 1008/02932 ОТ 11.01.2009Г.
НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА:
ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ СМОТРОВЫЕ «СУПЕРМАКС» ЛАТЕКСНЫЕ
ИМПОРТЕР В РФ: ООО «ПЕДАТЕКСТИЛ»
151027, г. ИВАНОВО, УЛ. П. БОЛЬШЕВНИКОВА, Д. 27, СТ. 9
ТЕТ/ОАК: 77(4932) 37-11-11
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: SUPERMAX GLOVE MANUFACTURING SDN BHD,
LOT 42 PUTRA INDUSTRIAL PARK, 47000 SG. BUJONG, SELANGOR, MALAYSIA
«СУПЕРМАКС ГЛОВ МАНУФЭКТОРИНГ СДН. БХД.», МАЛАЙЗИЯ
ИЗДЕЛИЯ ХРАНИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +10°C ДО +30°C
УТИЛИЗИРОВАТЬ КАК МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ КЛАССА А В КРМ В
СООТВЕТСТВИИ С САНПИИ 31.07.79-10 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СПАСОЧНОСТИ

LARGE

LARGE

Перчатки медицинские смотровые (диагностические) нестерильные и стерильные,
производства «Хелиомед Хандельсгез м.б.Х.», Австрия, РУ ФСЗ 2009/04144

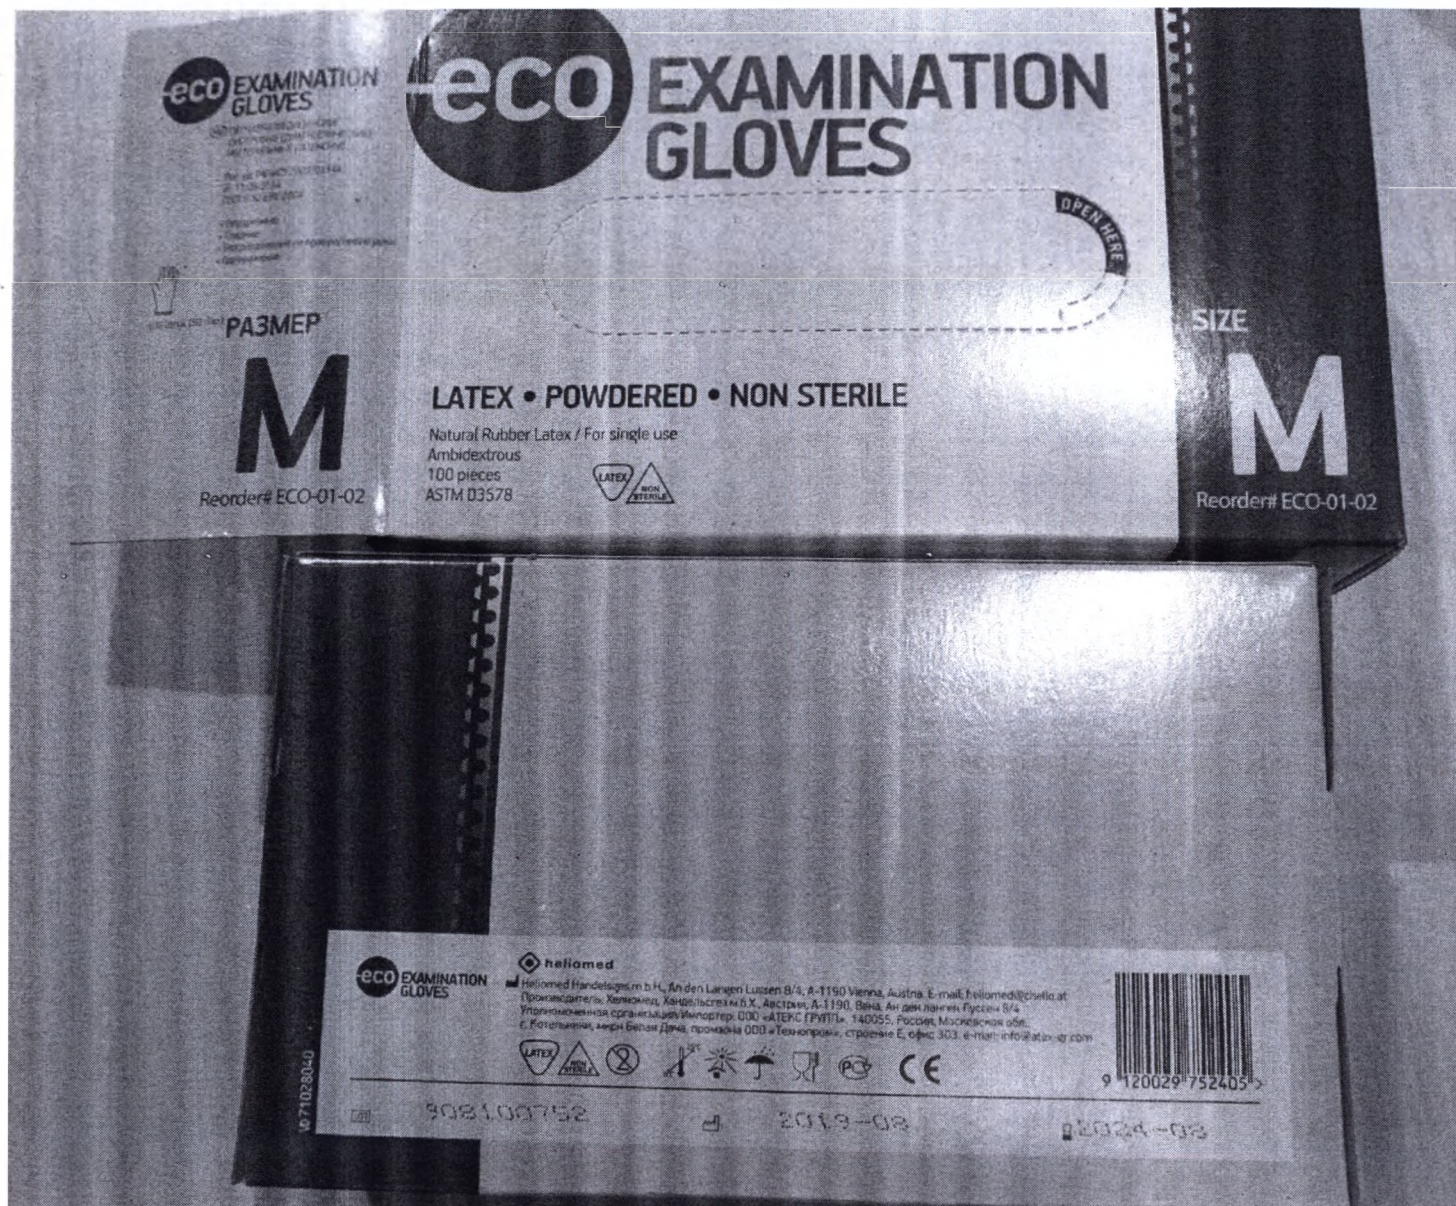

Перчатки нитриловые медицинские смотровые текстурированные неопудренные нестерильные одноразовые, торговой марки Bi-Safe, производства ВРГ Кхай Хоан Джоинт Сток Компани, Вьетнам, РУ РЗН 2017/6102

BI-SAFE®

Нитриловые перчатки
текстурированные на пальцах

Перчатки нитриловые медицинские смотровые текстурированные неопудренные нестерильные одноразовые, торговой марки "Bi-Safe"

Соответствуют ГОСТ Р 52239-2004, ГОСТ Р 32337-2013.

Нитриловые перчатки обеспечивают надёжный биологический барьер, но не являются химической защитой. Незаменимы для людей, имеющих аллергическую реакцию на латекс. Обеспечивают комфортную защиту кожи рук. Очень пластичные, плотно облегают руку. Сохраняют высокие тактильные ощущения при любых манипуляциях.

Хранить в сухом месте, вдали от солнечных лучей.



4 607031 210994



VRG Khai Hoan Joint Stock Company (Vietnam)
ВРГ Кхай Хоан Джоинт Сток Компани (Вьетнам)
Адрес: Cau Sat Hamlet, Lai Hung Commune,
Bau Bang District, Binh Duong Province, Vietnam
Tel: +84 650 3591 220


Регистрационное Удостоверение: N РЗН 2017 6102
от 17.02.2020

Номер партии:


Дата производства:

Срок годности: 5 лет

Перчатки смотровые одноразового использования нестерильные под товарным знаком matorpat: Ambulex латексные опудренные, Ambulex P латексные неопудренные, Ambulex VINYL виниловые опудренные и неопудренные, Ambulex NITRYL нитриловые опудренные и неопудренные в размерах: XS, S, M, L, XL, производства "ТЗМО С.А.", Польша, РУ ФСЗ 2007/00788

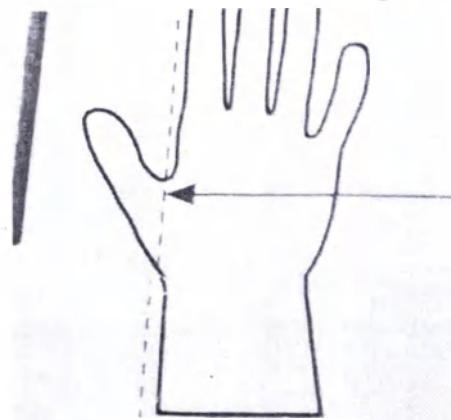

OT 68403 11722
2018-10
2021-10

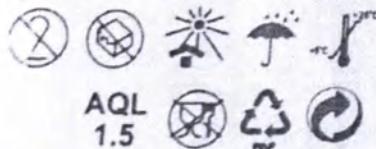

Per. № ФСЗ 2007/00788
от 15.03.2010 г.
Хранить в сухих помещениях
PZN 04941403
MA-144-L000-004



GB Caution: This product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions, including anaphylactic responses. Do not use if package is damaged.
DE Achtung: Dieses Produkt enthält Naturkautschuk, das allergische Reaktionen einschließlich einer Anaphylaxie auslösen kann. Verwenden solange Packung unversehrt.
RU Внимание: Данный продукт содержит натуральный латекс, который может вызывать аллергические реакции, в том числе анафилактический шок. Не использовать при повреждении упаковки.
PL Uwaga: Produkt zawiera lateksa kuczczu naturalnego, który może wywołać reakcje alergiczne, łącznie ze wstrząsem anafilaktycznym. Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

ES Distribuidor: TZMO S.A. d. Zoldevinskogo 20/28, 87-100 Toruń **DE** Vertrieb: TZMO Deutschland GmbH, Winkelmann 2, D-16359 Biesenthal **CH** Zweigniederlassung in der Schweiz: TZMO S.A. Zweigniederlassung Oltingen, Industriestrasse 40, 8112 Oltingen **AT** Totaleide Zakłady Materiałów Opatrunkowych - Spółka Akcyjna, Zwierzyńderlassung in Österreich, Wiedenburgerstrasse 11/12A, A-1100 Wien **DK** Distributor: TZMO Danmark ApS, Teglvej 5A, 2750 Ballerup **NL** TZMO Benelux BV, Rietveldweg 42, 5222 AR 's-Hertogenbosch **FR** Distributeur: TZMO France SASU, 680, Chemin des Blancs Minéraux, 75090 Longueuil, France **US** Distributor: TZMO USA, Inc. 1027 Pioneer Ferry Road, Building 5, Atlanta, GA 30339, USA **HU** Forgalmazó: Bella - Hungaria Kft, 3394 Egercsanak, Kőtelek u. 7/A **CZ** Prodávitel: TZMO SA Polonia; Importátor: S.C. Bella Romania Impex SRL, Sos. de centură nr. 3E, Com. Clingeni, jud. Ilfov, cod 077060 **SK** Výrobca: Totaleide Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Zoldevinskogo 20/28, 87-100 Toruń; Dávce a distribútor: Bella Sk s.r.o., Pri Šajbách 1, 631 08 Bratislava **LT** Distributor: Bella Lietuva UAB, Vieslėbald 2788/2, Haimi Pociūnė, 193 00 Praha **LV** Pārdotājs: TZMO SA, Zoldevinskogo 20/28, Toruń, Polija; Importatārs: SIA TZMO Latvija, Rūpniecības iela 11a, LV-1005, Rīga, Latvija **PT** Representante: SIA TZMO S.A., 87-100 Toruń, PAB TZMO Lietuva Severnortų pr. 363, Kaunas, Lietuva, Nemokama linija: 8 800 00226 **UA** Виробник: Тоталейд Заклади Матеріалів Оpatrunkowych - Spółka Akcyjna (TZMO S.A.) ul. Zoldevinskogo 20/28, 87-100 Toruń, Poland; «ТЗМО С.А.» вул. Жулівського, 20/28, 87-100 Торунь, Польща; Імпортер/уповноважений представник: «БЕЛЛА Україна» ТОВ «Белла-Трейд» 07543, Україна, Київська обл., м. Березинь, вул. Артем Милослав, буд. 16 А, тел. +380 944 585-05-97 **BY** Импортер: АО «ТЗМО С.А.» 87-100 Торунь, ул. Жулівського 20/28, Польша; Перевізник: АО «ТЗМО С.А.» в Республіці Беларусь, 223028, Мінская область, Мінський район, Ждановічкі в. 7, м. Ждановічкі, ул. Зайдары, 18А-7, пом. 7-25 **RU** Производители: ТЗМО С.А., Польша / TZMO S.A. POLSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A., Polska 87-100 Toruń, ul. Zoldevinskogo 20/28, Poland; Продавец/импортер/уповноваженный представитель: ООО «БЕЛЛА Беларусь» 193000, Республика Беларусь, Могилевская область, с. Егорьевск, ул. Промышленная, дом 9 **PL** Wytwórca: TZMO S.A., ul. Zoldevinskogo 20/28, 87-100 Toruń, Polska; Importer/autorizowany przedstawiciel: KAT 100 Toruń s. J. Żuliewski wch., 20/28, Toruń, Polska

Właściciel: KAT 100 Toruń s. J. Żuliewski wch., 20/28, Toruń, Polska
Dystrybutor: KAT 100 Toruń s. J. Żuliewski wch., 20/28, Toruń, Polska
Dystrybutor: KAT 100 Toruń s. J. Żuliewski wch., 20/28, Toruń, Polska

GB Latex examination gloves
Features: non sterile, it
DE Untersuchungshandsch
Eigenschaften: unsteril
HU Latex vizsgálókesztyű
Jellemzők: nem steril
CZ Latexové vyšetřovací
Vlastnosti: nesterilní
SK Rukavice vyšetřovací
Charakteristika rukav
RO Mănuși pentru exam
Caracteristici: nesteril
RU Перчатки смотров
Ambulex латексн
Изготавливаются
предотвращения
и биологическим
в смотровых, про
где эпидемиолог
парентеральных
По истечении сро
непереносимости

LT Pilišinės iš lateks
Pilišinių savybės:
LV Apvalītes cimdi no
Cimdi: nesterili, vi
DK Undersøgelses l
Handskarakterist
NL Latex onderzoek
Kenmerken: niet
FR Gants d'examen
Caractéristiques
PT Luvas de exam
Características
medicas
PL Rękawice zabi
Cechy rękawic
medycznych

TZMO SA
www.tzmo-g
matorpat

2020/10/15 10:34

Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM,
производства "СФМ Госпитал Продактс ГмбХ", Германия, РУ РЗН 2019/8284



OPEN HERE
HIER ÖFFNEN
ВІДКРИВАТИ ТУТ
ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ



SFM-SUPERSOFT

Nitrile Gloves

POWDER-FREE EXAMINATION GLOVES - NON-STERILE SFM®

• MATERIAL - NITRILE • FINGER TEXTURED • AMBIDEXTROUS • SINGLE USE •

PUDERFREIE UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE - UNSTERIL SFM®

• MATERIAL - NITRIL • FINGERTEXTURIERT • BEIDHÄNDIG • EINMALGEBRAUCH •

Рукавички нітрилові оглядові нестерильні неприпудрені СФМ

• МАТЕРІАЛ - НІТРИЛ • ТЕКСТУРОВАНІ НА ПАЛЬЦЯХ • НЕАНАТОМІЧНІ • ОДНОРАЗОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ •

Перчатки смотровые одноразовые нестерильные нитриловые SFM®,
Неопудренные, текстурированные, манжета с валиком, без адгезивной полосы, стандартные,
манжета стандартная, хлоринация однократная, цвет: фиолетово-голубой

ГОСТ Р 52238-2004

РУ № РЗН 2019/8284 от 15 апреля 2019 года

52035
23.07.2021

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ



50 пар по весу

Цвет – Белый

AQL 1.5

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

ЛАТЕКСНЫЕ ОПУДРЕННЫЕ

-гладкие-

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ЛАТЕКСНЫЕ ОПУДРЕННЫЕ

Уполномоченная организация/импортер

ООО «Глов-Эко», Россия, 111524, г. Москва, ул. Аносова, д.1, стр. 2

Тел. +7(495)786-34-91 www.pharm-global.com info@pharm-global.com

По заказу: ООО «Шаклина», Россия, 630128, г. Новосибирск, ул. Демакова, д.30

Р.У.в Р.Ф. № ФСЗ 2012/13037 от 15 октября 2012 года

ГОСТ Р 52239 – 2004

Производитель: «Тан Син Лян Индастриз Сдн. Бхд.», Малайзия.

Tan Sin Lian Industries Sdn. Bhd. (TSL), 1-14, Jalan Indah 2, Taman Indah,


Jalan Haji Abdullah, 84000 Muar, Johor, Malaysia

Tel. +606-951-05-26; Tel. +606-952-70-45; Fax: +606-951-04-00

Перчатки смотровые виниловые нестерильные одноразовые следующих типоразмеров: XS, S, M, L, XL, производства
Суцянъ Грин Глоув Компани Лимитед", Китай, РУ РЗН 2014/1985

Перчатки смотровые виниловые Нестерильные одноразовые

Лицензионное удостоверение на медицинское изделие
от 20 октября 2014 г. № РЗН 2014/1985

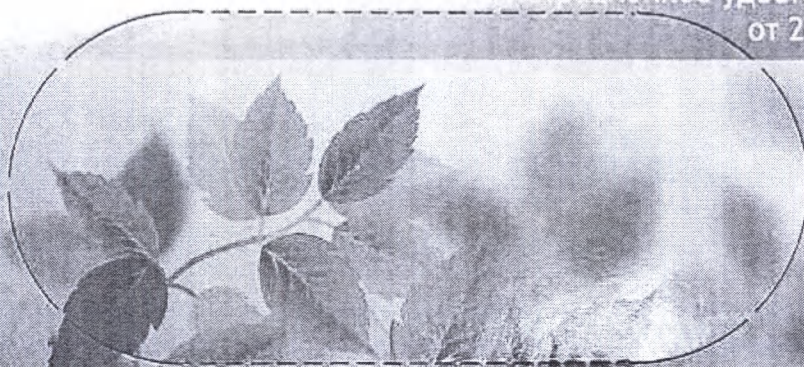

Больше
информации
об этой
продукции



M

100
штук

GV
400

Перчатки латексные медицинские смотровые текстурированные неопудренные нестерильные одноразовые, торговой марки Bi-Safe, производства «ВРГ Кхай Хоан Джоинт Сток Компани», Вьетнам, РУ РЗН 2017/6105

Латексные перчатки обеспечивают надёжный биологический барьер, но не являются химической защитой.

ВНИМАНИЕ: Данное изделие содержит натуральный латекс, который может вызвать аллергические реакции при соприкосновении с кожей.

Хранить в сухом месте вдали от солнечных лучей



4 607031 210147



VRG Khai Hoan Joint Stock Company (Vietnam)
ВРГ Кхай Хоан Джоинт Сток Компани (Вьетнам)
Адрес: Cau Sat Hamlet, Lai Hung Commune,
Bau Bang District, Binh Duong Province, Viet Nam
Tel.: +84 650 3591 220

Регистрационное Удостоверение: РЗН 2017/6105
от 06.08.2019

Номер партии: 1 5 7 2 0 2 0 3

Дата производства: 0 6 . 2 0 2 0

Срок годности: 5 лет

Импортёр / Уполномоченная организация в РФ:

ООО «Бисанс», тел./факс.: (812) 309-3669


Адрес: СПб, 192012, пр. Обуховской Обороны, 271.

 **BI-SAFE®**

Изделие из натурального латекса
Для использования в общей
медицинской практике

Перчатки латексные медицинские смотровые текстурированные
неопудренные нестерильные одноразовые, торговой марки "Bi-Safe"
Соответствует ГОСТ Р 52239-2004

Перчатки смотровые латексные опудренные, нестерильные,
производства "Топ Глов Сдн. Бхд.", Малайзия, РУ РЗН 2018/7426

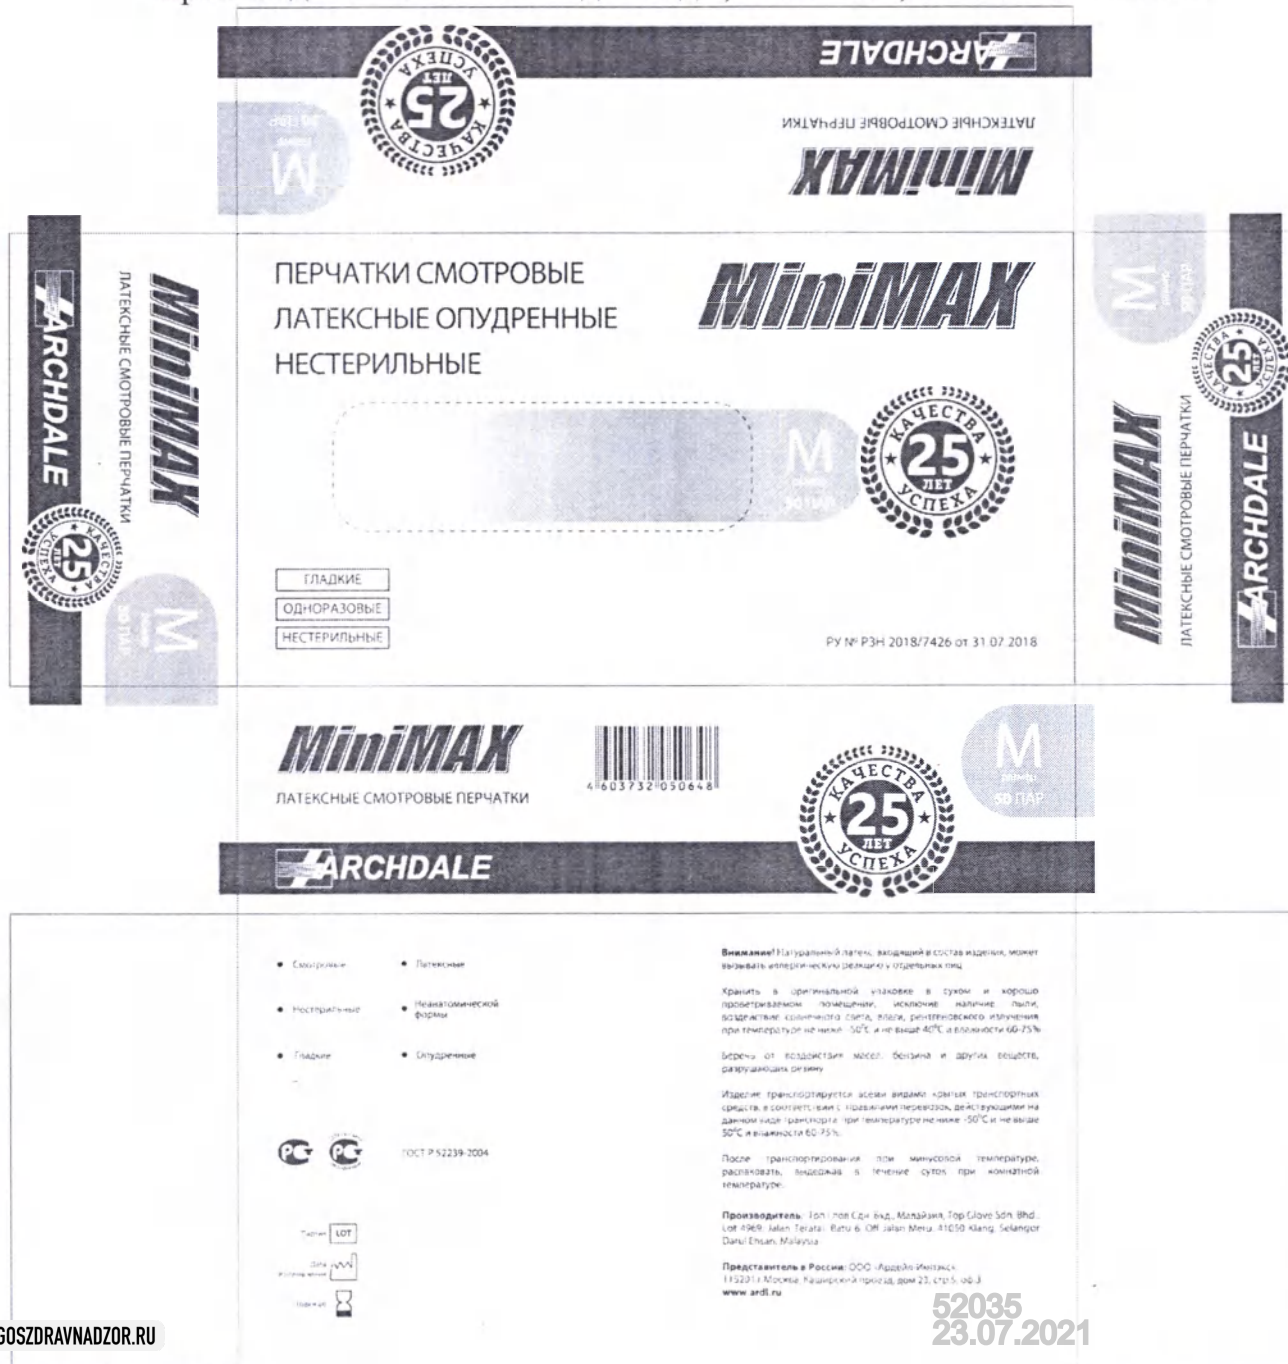

4100713143602091
БИНТ 5м x 10см

марлевый медицинский
по ГОСТ 1172-93 нестерильный

количество 1 шт.



28.

Количество 1 шт.

Производитель-изготовитель/прием претензий
ООО «Лейко» Россия, г. Тюмень

Разорвите по линии

Способ применения: вскрыть упаковку и применить по назначению.
предназначено для фиксации перевязочных средств и медицинских изделий.
в сухом, проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной
безопасности. Противопоказания: бинт утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.
2019 г. Партия №04. Регистрационное удостоверение: РУ № ФСР 2009/05650 от 07.03.2013г.


Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-005-10715071-2014,
производства ООО "ХБК Навтекс", Россия, РУ РЗН 2015/2557



Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004-10715071-2014,
производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2558

Производство ООО «ХБК Навтекс», г. Наволоки, ул. Промышленная, д.1. Тел.: (49331) 9-77-32.
100% хлопок.
Изготовлено из марли медицинской хлопчатобумажной по ТУ 9393-001-10715071-2014, арт. 6498/21
Датой 5 лет. Датой стерилизации смотри на упаковке.

2кв 2020г/14824

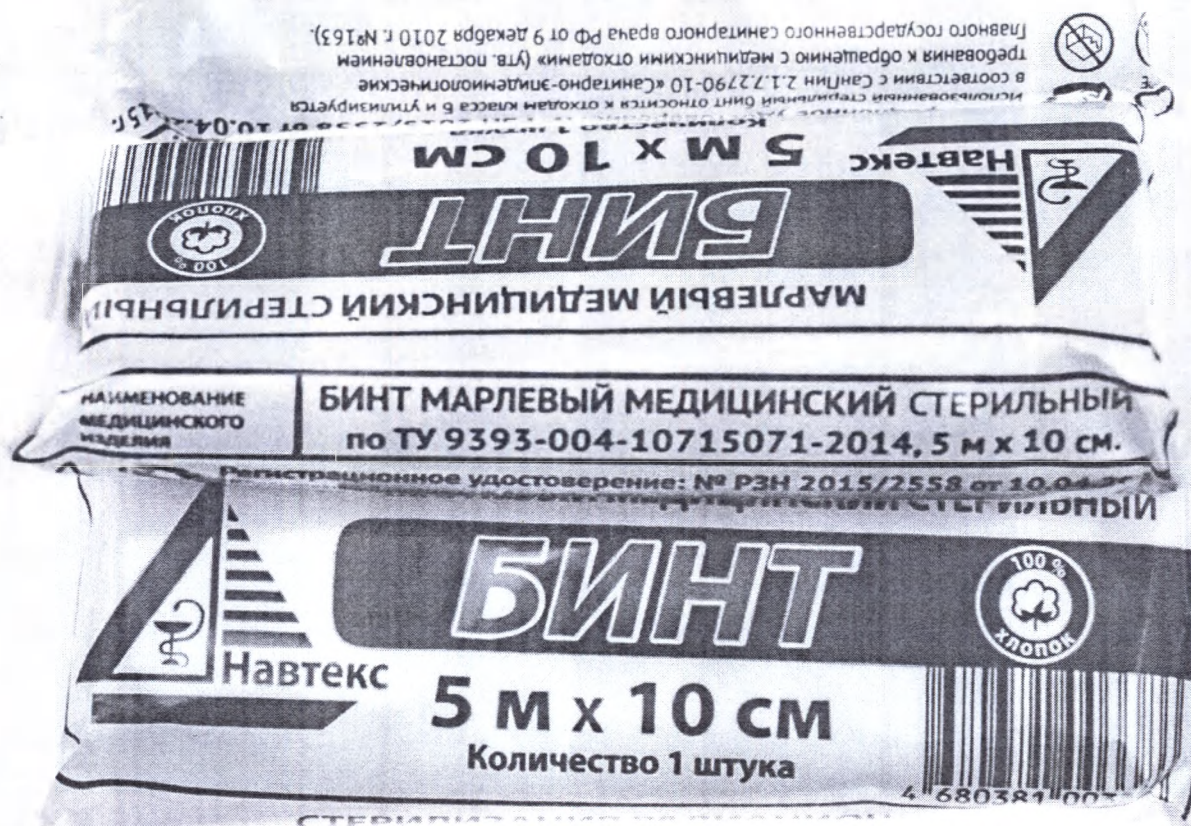



Бинты марлевые медицинские нестерильные по ТУ 9393-005-10715071-2014,
производства ООО "ХБК Навтекс", Россия, РУ РЗН 2015/2557

температуре от 0 °С до +30 °С. Беречь от огня и влаги
23.07.2021 14:32

Использованный бинт относится к отходам класса А или Б
и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением
Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2010 г. N 163)



МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ
по ТУ 9393-005-10715071-2014 7 м x 14 см
Регистрационное удостоверение: № РЗН 2015/2557 от 10.04.2015 г.
Использованный нестерилизованный бинт относится к отходам класса А или Б

МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ НЕСТЕРИЛЬНЫЙ

 **Навтекс**

БИНТ

 100% хлопок

7 м x 14 см

Количество 1 штука

4 680381 003379

Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004-10715071-2014,
производства ООО «ХБК Навтекс», Россия, РУ РЗН 2015/2558

Сделано в России. Гарантийный срок годности 5 лет. Дата стерилизации: смотри на упаковке. Адрес: ...

+ 2 кв. 2020г/14824

Использованный стерильный бинт относится к отходам класса Б и утилизируется
в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к медицинским отходам» (утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. №163).



МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ	БИНТ МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ по ТУ 9393-004-10715071-2014, 7 м x 14 см.
---	--

Регистрационное удостоверение: РЗН 2015/2558 от 10.04.2015.
Использованный стерильный бинт относится к отходам класса Б и утилизируется
в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к медицинским отходам» (утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. №163).

МАРЛЕВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

БИНТ

Навтекс

7 м x 14 см

Количество 1 штука

4 680381 003423

100% ХЛОПОК

СТЕРИЛИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННАЯ

Салфетки марлевые медицинские двухслойные стерильные 16см x 14см и 45см x 29см по ГОСТ 16427-93, производства ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2009/05649

4 607131 360285

САЛФЕТКИ

МАРЛЕВЫЕ 16x14см

МЕДИЦИНСКИЕ

ДВУХСЛОЙНЫЕ №10

СТЕРИЛЬНЫЕ

10 ШТ.

ГОСТ 16427-93



Производитель-изготовитель/приниматель претензий: ООО «ЛЕЙКО»
Россия, г.Тверь, проезд Стеклопластик, д.5
тел.: (4822) 56-07-89, 8-800-777-75-75, E-mail: leiko.lver@mail.ru, www.cle-leiko.ru


Рег. Уд. № ФСР 2009/05649 от 09 сентября 2009 г.

Дата изготовления указана на упаковке. Дата стерилизации указана на упаковке. Показания к применению: салфетки предназначены для использования в качестве готовых операционно-разовых средств.
СРОК ГОДНОСТИ 5 ЛЕТ.

Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский),
производства фирмы «Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР, РУ ФСЗ 2008/01442



Лейкопластырь медицинский фиксирующий, бактерицидный SFM-Plaster, SFM-Strip, производства «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2011/11252

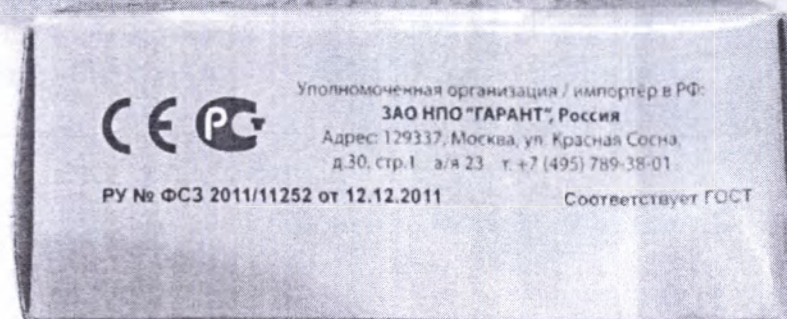

Лейкопластырь медицинский фиксирующий, производства ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2007/01017

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

медицинский фиксирующий

по ТУ 9393-004-56334457-2007

Способ применения: извлечь лейкопластырь из упаковки, отрезать нужное количество и применить по назначению.

Показания к применению: предназначен для фиксации медицинских приспособлений и перевязочных средств.

Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от света месте. Допустимая температура хранения от -30 °С до +40 °С.

Противопоказания:

индивидуальная непереносимость

Утилизация: лейкопластырь утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.2790-10



ООО "ЛЕЙКО"

Рег. уд.: ФСР 2007/01017
от 25 октября 2007 года
ТУ 9393-004-56334457-2007



Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах,
производства «ФармЛайн Лимитед», Великобритания. РУ ФСЗ 2008/01959

MASTER UNI

MASTER UNI

UNIFIX

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

медицинский
фиксирующий
на тканевой основе

- Натуральная тканевая основа
- Надежная фиксация
- Особая эластичность

2x500 cm

Дата изготовления/Mfg date:

Годен до:/Use before:

Партия №/LOT:



MASTER UNI



МАСТЕР ЮНИ

ЮНИФИКС

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ
ФИКСИРУЮЩИЙ
НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ

Эластичность

пластырь принимает
форму изгибов
тела и не стесняет
движения

Тканевая основа

натуральная основа для
любого типа кожи



Стойкая фиксация


плотно прилегает
и надёжно фиксируется
на коже

Пластиковая втулка


катушка отлично держит
форму и не сминается




Дейкопластыри медицинские фиксирующие катушечные на тканевой, нетканой и полимерной основе «Импэкс-Мед», производства «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», КНР, РУ ФСЗ 2008/02807

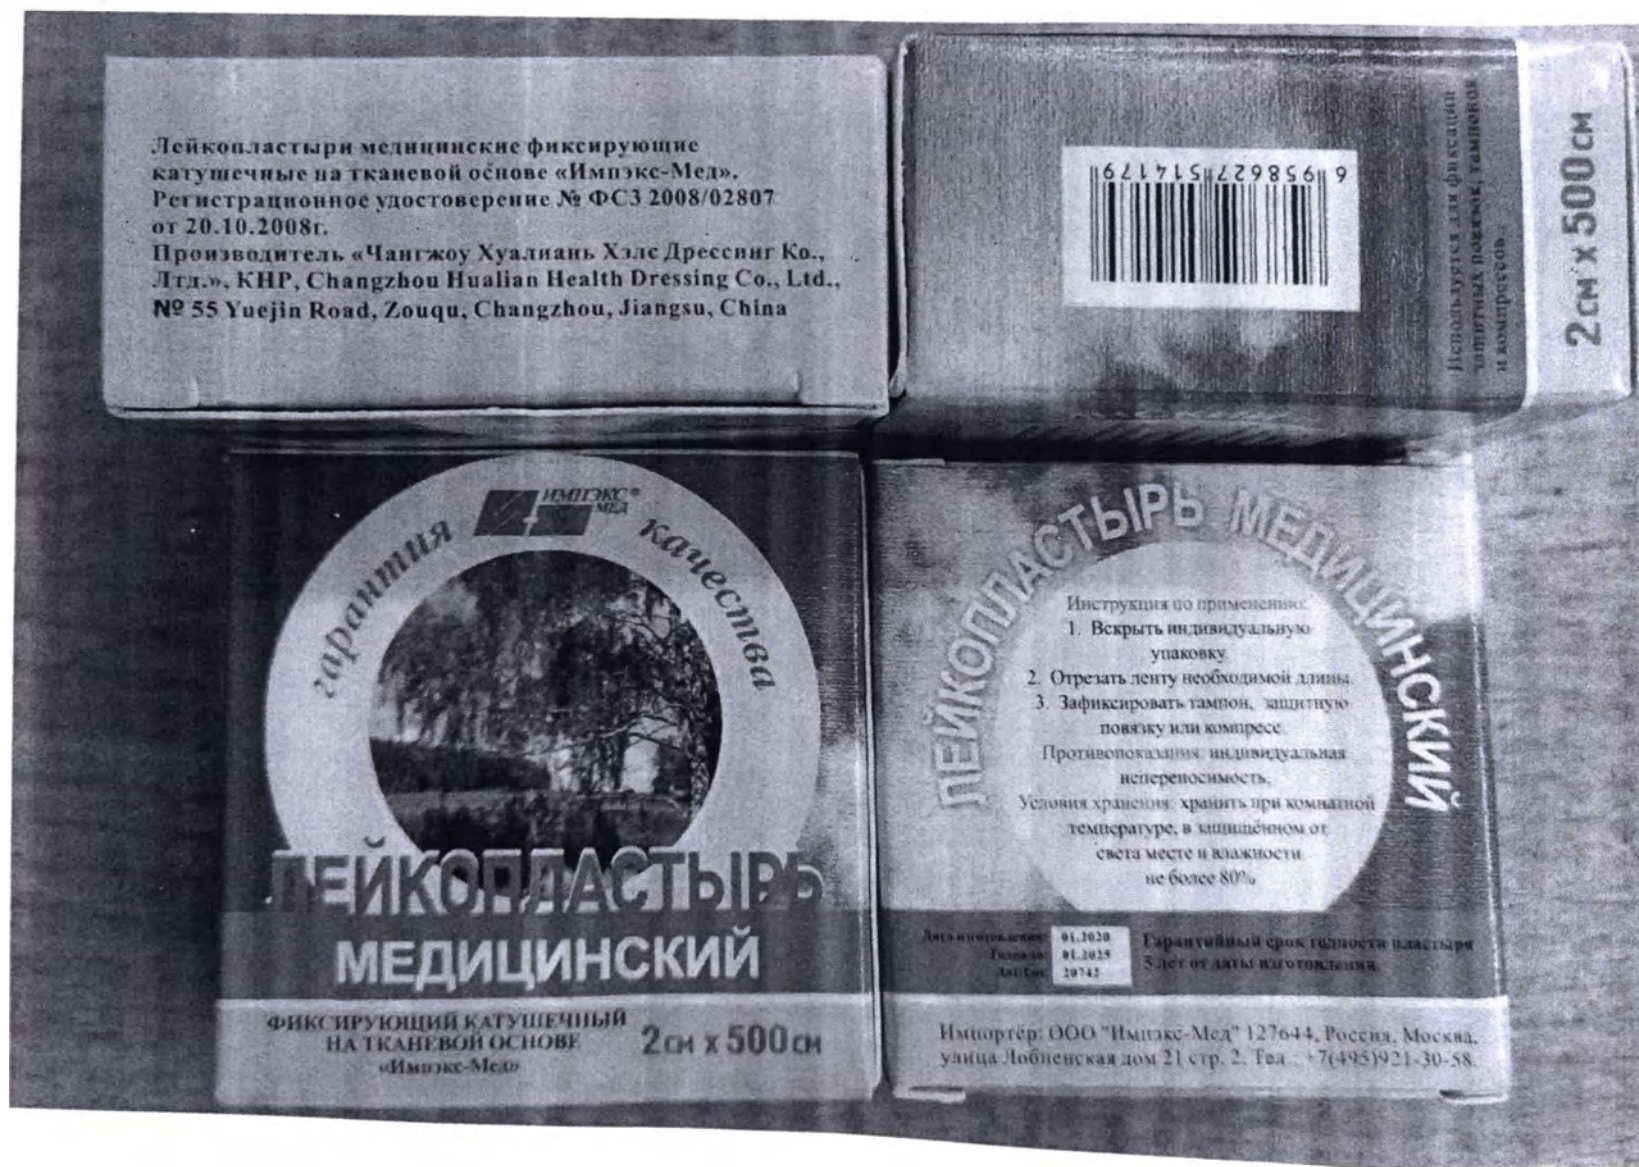

Лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393-015-45961725-2009, производства АО «ВЕРОФАРМ», Россия, РУ ФСР 2009/05363

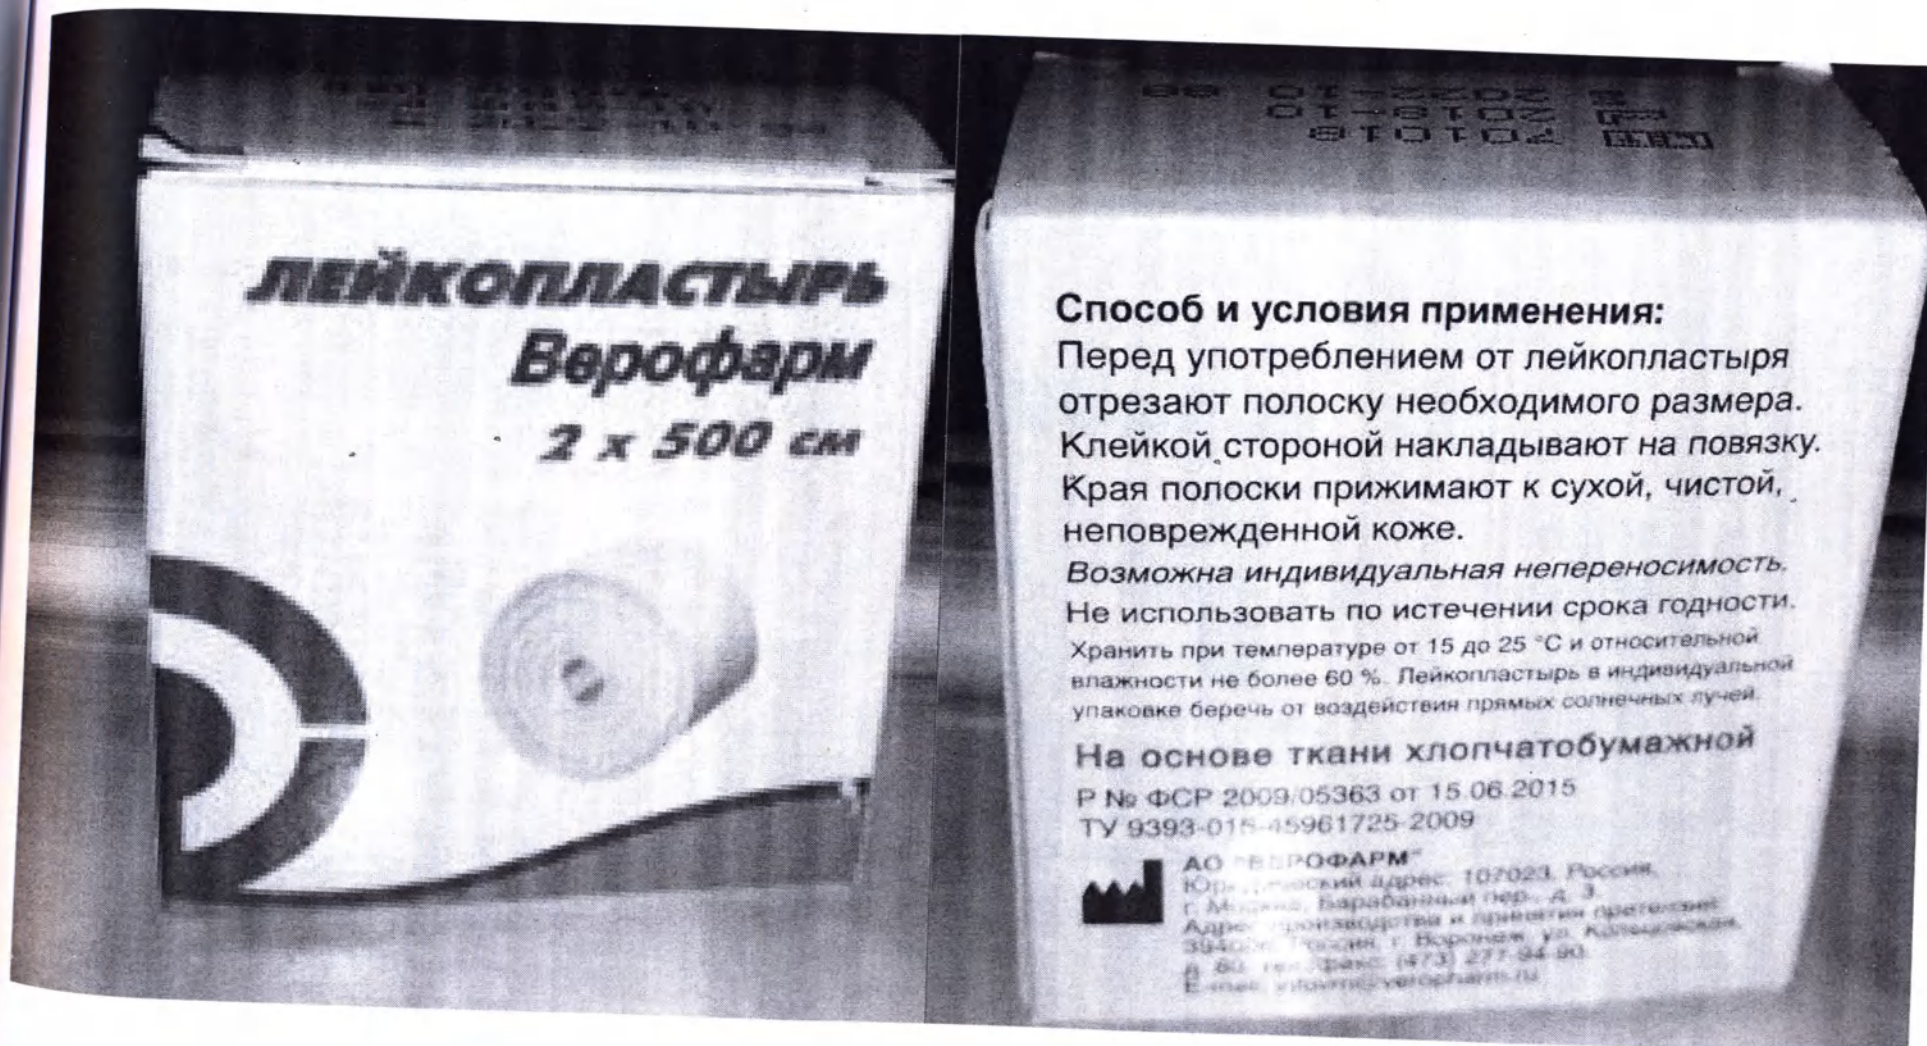

Лейкопластырь медицинский фиксирующий,
производства «Чанчжоу Хуалянь Неалф Дрессинг Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2011/09593

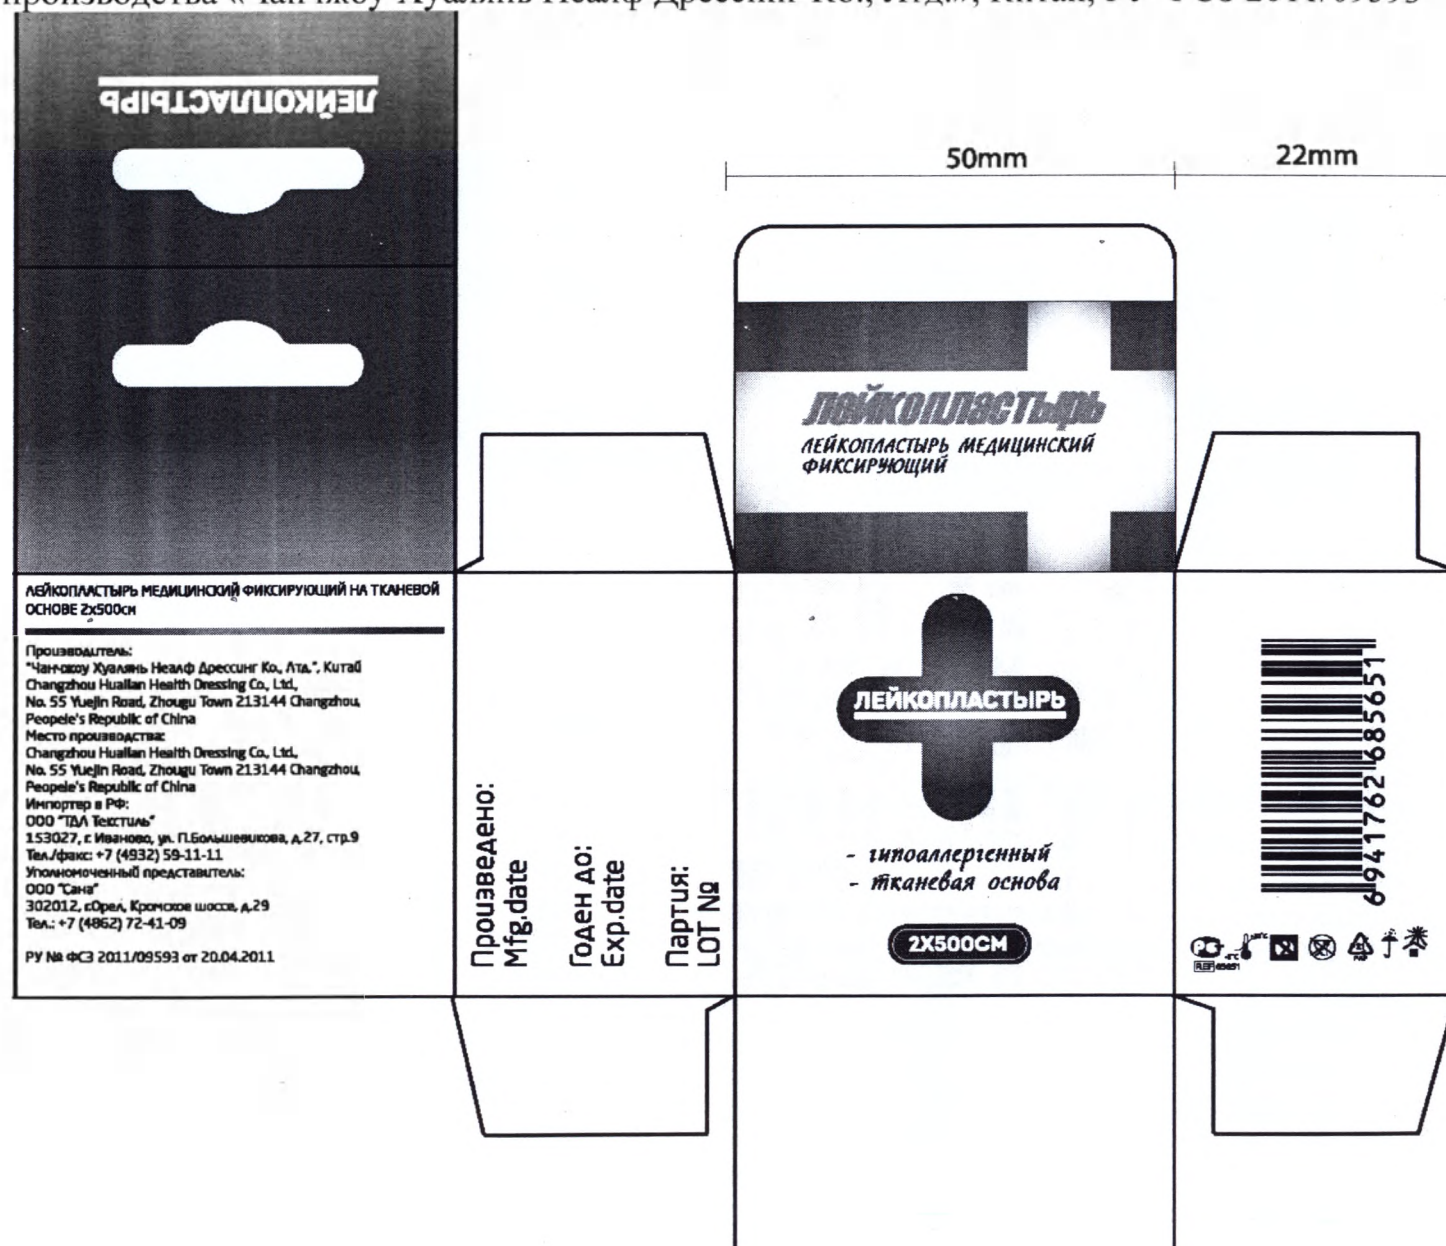

Лейкопластырь «УНИПЛАСТ® /UNIPLAST® фиксирующий» по ТУ 21.20.24-010-45961725-2019,
производства АО «ВЕРОФАРМ», Россия, РУ ФСР 2008/03212

на основе
натуральной
хлопчатобумажной
ткани

Лейкопластырь
унипласт®
фиксирующий

Гипоаллергенный клеевой слой

Из натуральной ткани,
незаметен на коже

Легко рвётся
без использования ножниц

Способ и условия применения:

От лейкопластыря отрезать полосу необходимого размера. Клейкой стороной наложить на повязку, трубку, зонд и т. д., края полосы прижать к сухой, чистой, неповрежденной коже.

Важно! Индивидуальная непереносимость.
Не использовать по истечении срока годности.

Свидетельство на товарный знак № 202223

Р. № ФСР-2008/03212 от 15.08.2015

ТУ 21.20.24-010-45961725-2019

2,5x500 см

Хранить при температуре от 15 до 25 °C


и относительной влажности не более 80 %.

Держать вдали от источников тепла.

Срок годности при правильном хранении — 3 года.


Срок годности лейкопластыря относится к состоянию клея

и не является гарантией его качества в течение всего срока годности.

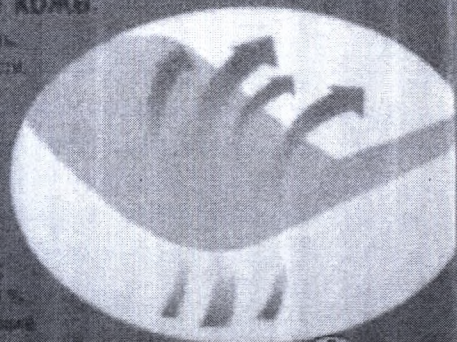

унипласт®
фиксирующий
ткань

натуральный
гипоаллергенный

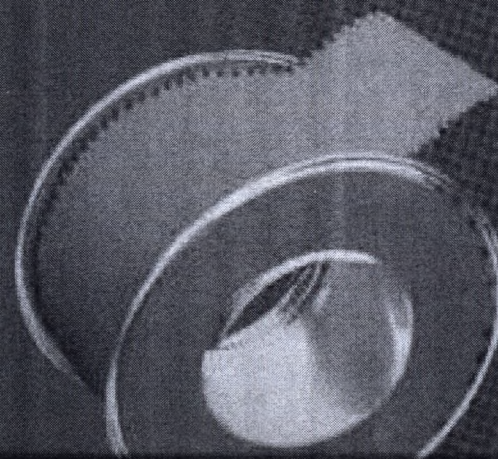


2,5x500 см


АРМА®

**Лейкопластырь
ФИКСИРУЮЩИЙ**

2.5x500 см



на тканевой основе

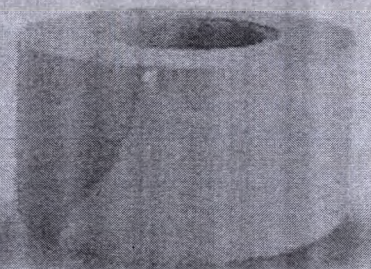

Лейкопластырь фиксирующий
по ТУ 9393-004-01716953-2017
телесного цвета: 2,5x500 см.

На тканевой основе

Для фиксации повязок или закрепления
предметов медицинского назначения.

Способ применения:

- Перед использованием необходимо убедиться в том, что срок хранения изделия не закончился.
- Извлечь лейкопластырь фиксирующий из потребительской упаковки. Отрезать ножницами полосу необходимого размера.
- Клейкой стороной наложить на повязку или на фиксируемое изделие. Края полосы прижать к сухой, чистой, неповрежденной коже.
- Лейкопластырь фиксирующий меняют по мере необходимости. Изделие можно использовать только один раз.

Противопоказания к применению: воспалительные заболевания кожи различной этиологии.

Меры предосторожности: при возникновении индивидуальной повышенной чувствительности к материалам изделия прекратите использование лейкопластыря фиксирующего и обратитесь к врачу.

Состав: тканевая основа, гипоаллергенный клей.

РУ № РЗН 2017/6112 от 17.08.2017 г.

Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +5 до +28 °С.



Пластырь медицинский стерильный и нестерильный, разных форм и размеров: - на тканевой основе. - на нетканой основе. - на полимерной основе, производства «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2007/00548



Лейкопластырь медицинский бактерицидный,
производства «Чанчжоу Хуалянь Неалф Дрессинг Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2011/09594

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ

Телесного цвета. На полимерной основе.

Предназначен для обработки мелких ран, порезов, царапин. Может приклеиваться непосредственно на поврежденную поверхность. Для нормальной и чувствительной кожи. Изготовлен с применением акрилового клея и антисептического вещества - акринол. Не использовать по истечении срока годности.

Хранить в сухом месте, при комнатной температуре. Не токсично, однократного применения. Не применять в случае нарушения целостности упаковки.

Per. Уд. № ФСЗ 2011/09594 от 20.04.2011



4 612734 830125

Производитель: Чанчжоу Хуалянь Неалф Дрессинг Ко., Лтд. / Changzhou Hualian Health Dressing Co., Ltd., No 55 Yuejin Road, Zhougu Town 213144 Changzhou, People's Republic of China.
По заказу: ООО Сана, 302008, Орел, ул. Высоковольная, д. 2Г,
тел: +7 (4862) 44-02-92,
e-mail: sanaorel@mail.ru.

Дата изготовления / Mfg date: 04.2018
Срок годности / Use before: 04.2023
Партия № / LOT: 042018



0123



STERILE EO

1000 шт.

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ
БАКТЕРИЦИДНЫЙ

1,9cm X 7,2cm

ARMA®

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ: Лейкопластырь медицинский на нетканой основе, размеры, мм: 19x72.

100 мм 19 мм X72 мм

НАЗНАЧЕНИЕ: изделие предназначено для использования в качестве наружного перевязочного средства при механических повреждениях кожи: небольших порезах, царапинах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: применяется для оказания помощи в лечебно-профилактических учреждениях, на производстве и в быту.

СОСТАВ: нетканая основа, гипоаллергенный клей, а травматичная нетканая подложка, защитное покрытие - силиконизированная бумага.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в сухом месте при температуре от +5 до +28 °C и влажности воздуха 60 - 80%.

Партия: 200403

Дата изготовления: 04.2020 г.
Годен до 03.2025 г.



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ медицинский
по ТУ 21.20.24-006-01716953-2017

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ: изделия эксплуатируют при температуре от +10 до +35 °C и влажности воздуха 60 - 80%.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ: условия транспортирования в диапазоне температур от -50 до +50 °C и влажности воздуха 60 - 80%.

Транспортирование изделий следует проводить в закрытом транспорте в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

СРОК ГОДНОСТИ: гарантийный срок службы - 5 лет со дня изготовления.

ТУ РЗН 2017/6618 от 02.04.2018 г.


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Бергус», 601270, Россия, Владимирская область, Суздальский район, пос. Боголюбово, ул. Ленина, 14

www.bergus24.ru


Претензии потребителей принимаются организацией-производителем.

Для отзывов: тел: 8 800 500 79 85,

director@bergus.ru.com

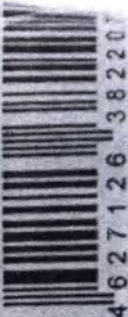

4 627 126 38220

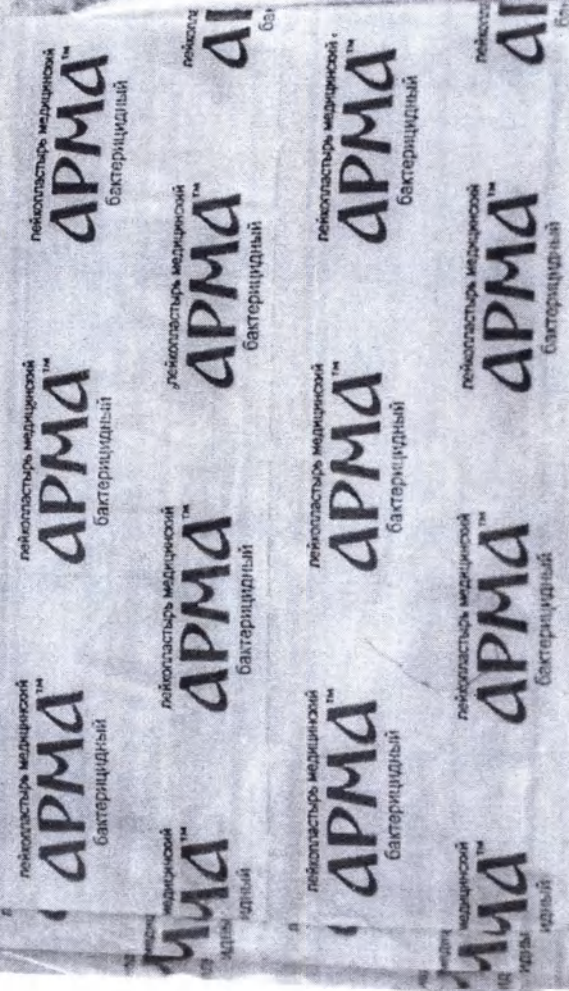

Лейкопластырь медицинский бактерицидный «Импэкс-Мед»,
производства «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2009/03549

Хранить при комнатной температуре, в защищённом от света месте и влажности не более 80%.



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

МЕДИЦИНСКИЙ

БАКТЕРИЦИДНЫЙ

"Импэкс-Мед"

4 см x 10 см

Применяется для оказания первой помощи
при ранениях кожи, ссадинах и порезах.
Срок годности 5 лет с даты производства.

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2009/03549 от 12.03.2015 г.

Импортер: ООО "Импэкс-Мед",

www.imprex-med.ru

Тел/факс: +7(495)921-30-58

127644, Россия, Москва, улица

Лобненская дом 21 строение 2.

Изготовитель: «Чангжоу Хуалиань Хэлс

Дрессинг Ко., Лтд.», КНР,

Changzhou Huailian Health Dressing Co., Ltd.,

№ 55 Yuejin Road, Zhoupu Town 213144

Changzhou, People's Republic of China.



ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Дата выпуска: 10.2017 Срок до: 10.2022 Lot/Lot: 17531 Основы: нетканый

2018.05.21 12:13

Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) бактерицидный,
производства «Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд», КНР, РУ ФСЗ 2008/01495

ТЕЛОСНОГО ЦВЕТА



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ на нетканой основе

гипоаллергенный

4 см x 10 см

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ ЛЕЙКО (ЛЕЙКО) БАКТЕРИЦИДНЫЙ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ

РУ № ФСЗ 2008/01495 от 12.04.2017 Соответствует требованиям ГОСТ Р 53498-2009

Для оказания первой неотложной помощи
Универсальный, эластичный, мягкий,
воздухопроницаемый, паропроницаемый

Назначение: для закрытия поверхностных ран, защиты от инфицирования и дополнительного травмирования. Показания: для корыстной и чувствительной кожи. Противопоказания: индивидуальная непереносимость. Способ применения: наклеить на сухую кожу, прижать; менять по мере необходимости. Форма выпуска: стрип 4см x 10см. Основа: нетканая (40% вискоза / 60% полиэстер) телесного цвета. Агрегат: акрилат сополимер. Впитывающая прокладка: 70% вискоза / 30% полипропилен, атравматичная сетка - полиэтилен. Антисептическое вещество: акрилат. Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 30°C и влажности не более 80%, вдали от источников тепла.

Стерильно до вскрытия. Не использовать при повреждении упаковки.
По истечении срока годности теряет свойства.
Не использовать по истечении срока годности - утилизировать.

Изготовитель/Адрес места производства:
Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд., ул. Госпи, 1, Зона экономического развития Учэнь, 213149,
г. Чанчжоу, провинция Цзянсу, КНР
Импортер/Уполномоченная организация:
ООО «Аарен ДК», 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2, тел.: +7(495) 43-29-40;
e-mail: info@leiko.ru

STERILE EO
REF 213873


Дата изготовления
упаковки/наклейки и стерилизации: 12.2017

Использовать до: 12.2022

Партия номер: 20171210

Масса нетто 2,30 г

Утилизация в ЛПУ: отходы класса Б




460715516409501



52035
23.07.2021

Лейкопластырь медицинский фиксирующий, бактерицидный SFM-Plaster, SFM-Strip,
производства «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2011/11252

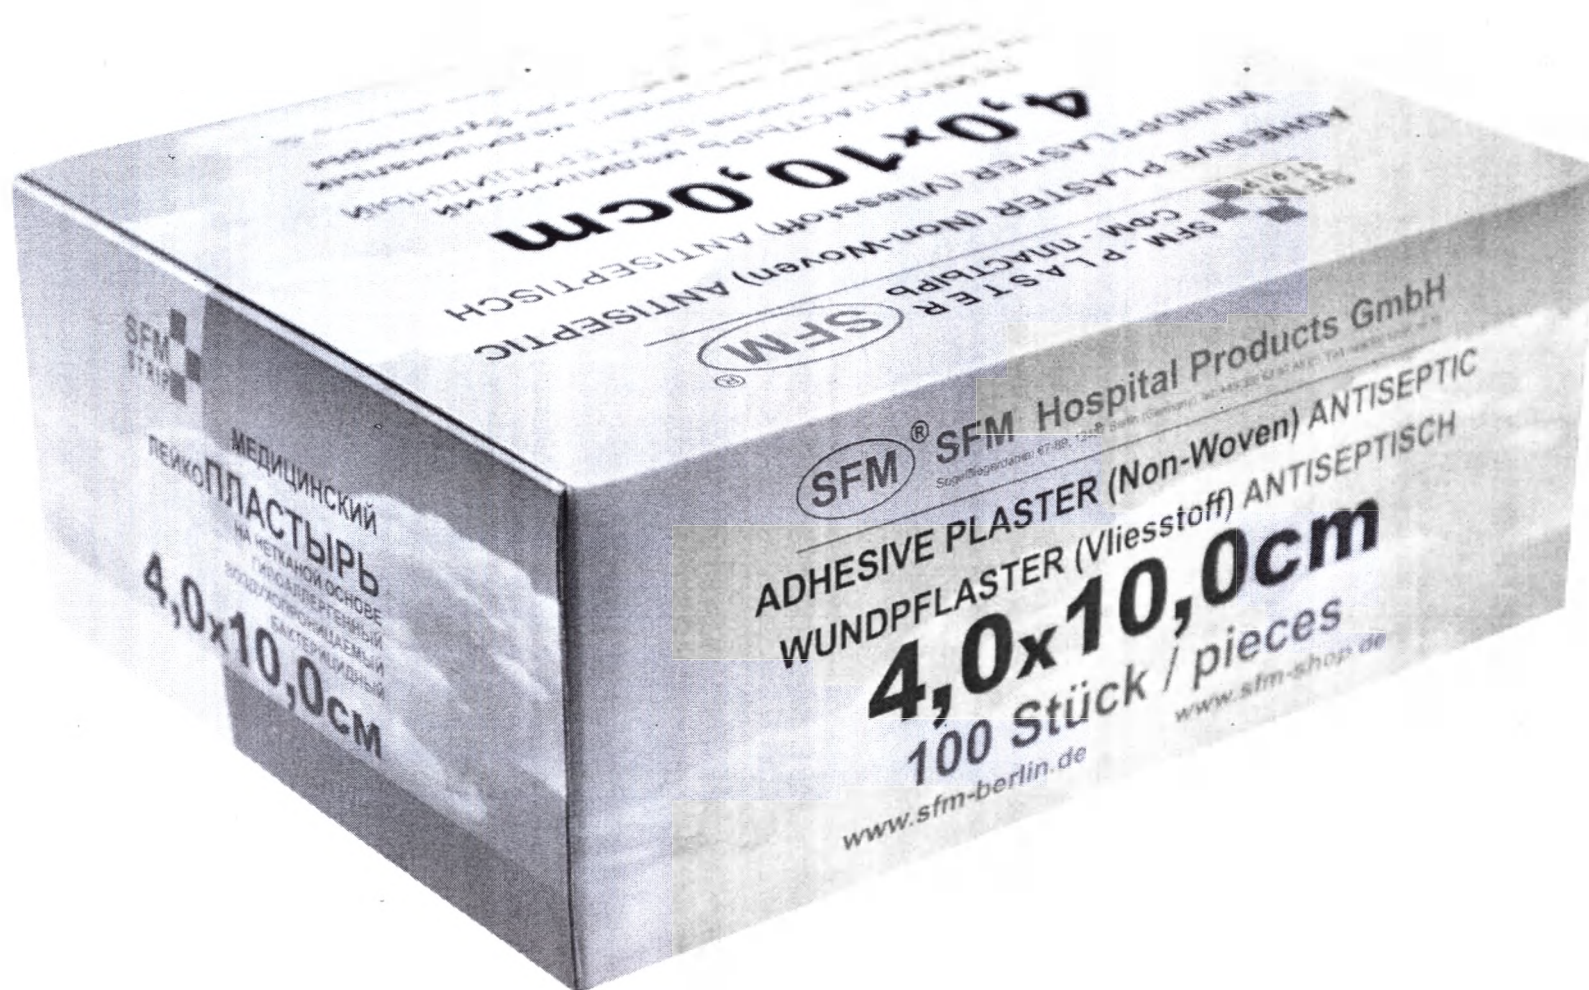


Лейкопластырь медицинский бактерицидный по ТУ 9393-011-56334457-2011 восьми типоразмеров: 1,9 см x 7,2 см; 2,5 см x 7,2 см; 3,8 см x 3,8 см; 4,0 см x 10,0 см; 4,1 см x 3,8 см; 6,0 см x 2,0 см; 6,0 см x 10,0 см; 10,0 см x 10,0 см, производства ООО «Лейко», Россия, РУ ФСР 2011/12017

ООО «ЛЕ



4 см x 10 см
**МЕДИЦИНСКИЙ
БАКТЕРИЦИДНЫЙ**

ТУ 9393-011-56334457-2011
Рег. уд. № ФСР 2011/12017
от 04 марта 2013 года.

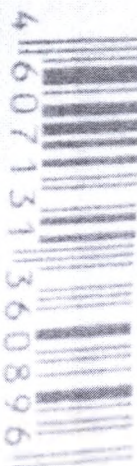

4 607131 360896

ООО «ЛЕЙКО»

Россия, г. Тверь, пр-д Стеклопластик, д.5 т. (4822) 56-07-69.
E-mail: leiko.tver@mail.ru www.leiko-medicine.ru




ЛЕЙКО ПЛАСТЫРЬ

Срок годности:
5 лет

4 см x 10 см

**МЕДИЦИНСКИЙ
БАКТЕРИЦИДНЫЙ**

ТУ 9393-011-56334457-2011
Рег. уд. № ФСР 2011/12017
от 04 марта 2013 года.

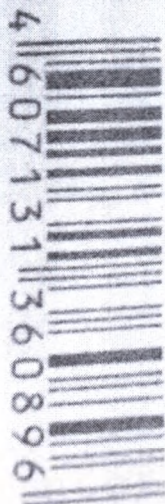

4 607131 360896

ООО «ЛЕЙКО»

Россия, г. Тверь, пр-д Стеклопластик, д.5 т. (4822) 56-07-69.
E-mail: leiko.tver@mail.ru www.leiko-medicine.ru




ЛЕЙКО ПЛАСТЫРЬ

Срок годности:
5 лет

4 см x 10 см


**МЕДИЦИНСКИЙ
БАКТЕРИЦИДНЫЙ**

ТУ 9393-011-56334457-2011
Рег. уд. № ФСР 2011/12017
от 04 марта 2013 года.

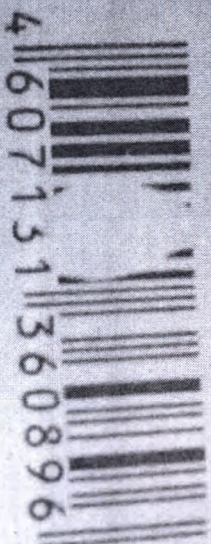

4 607131 360896


ООО «ЛЕЙКО»

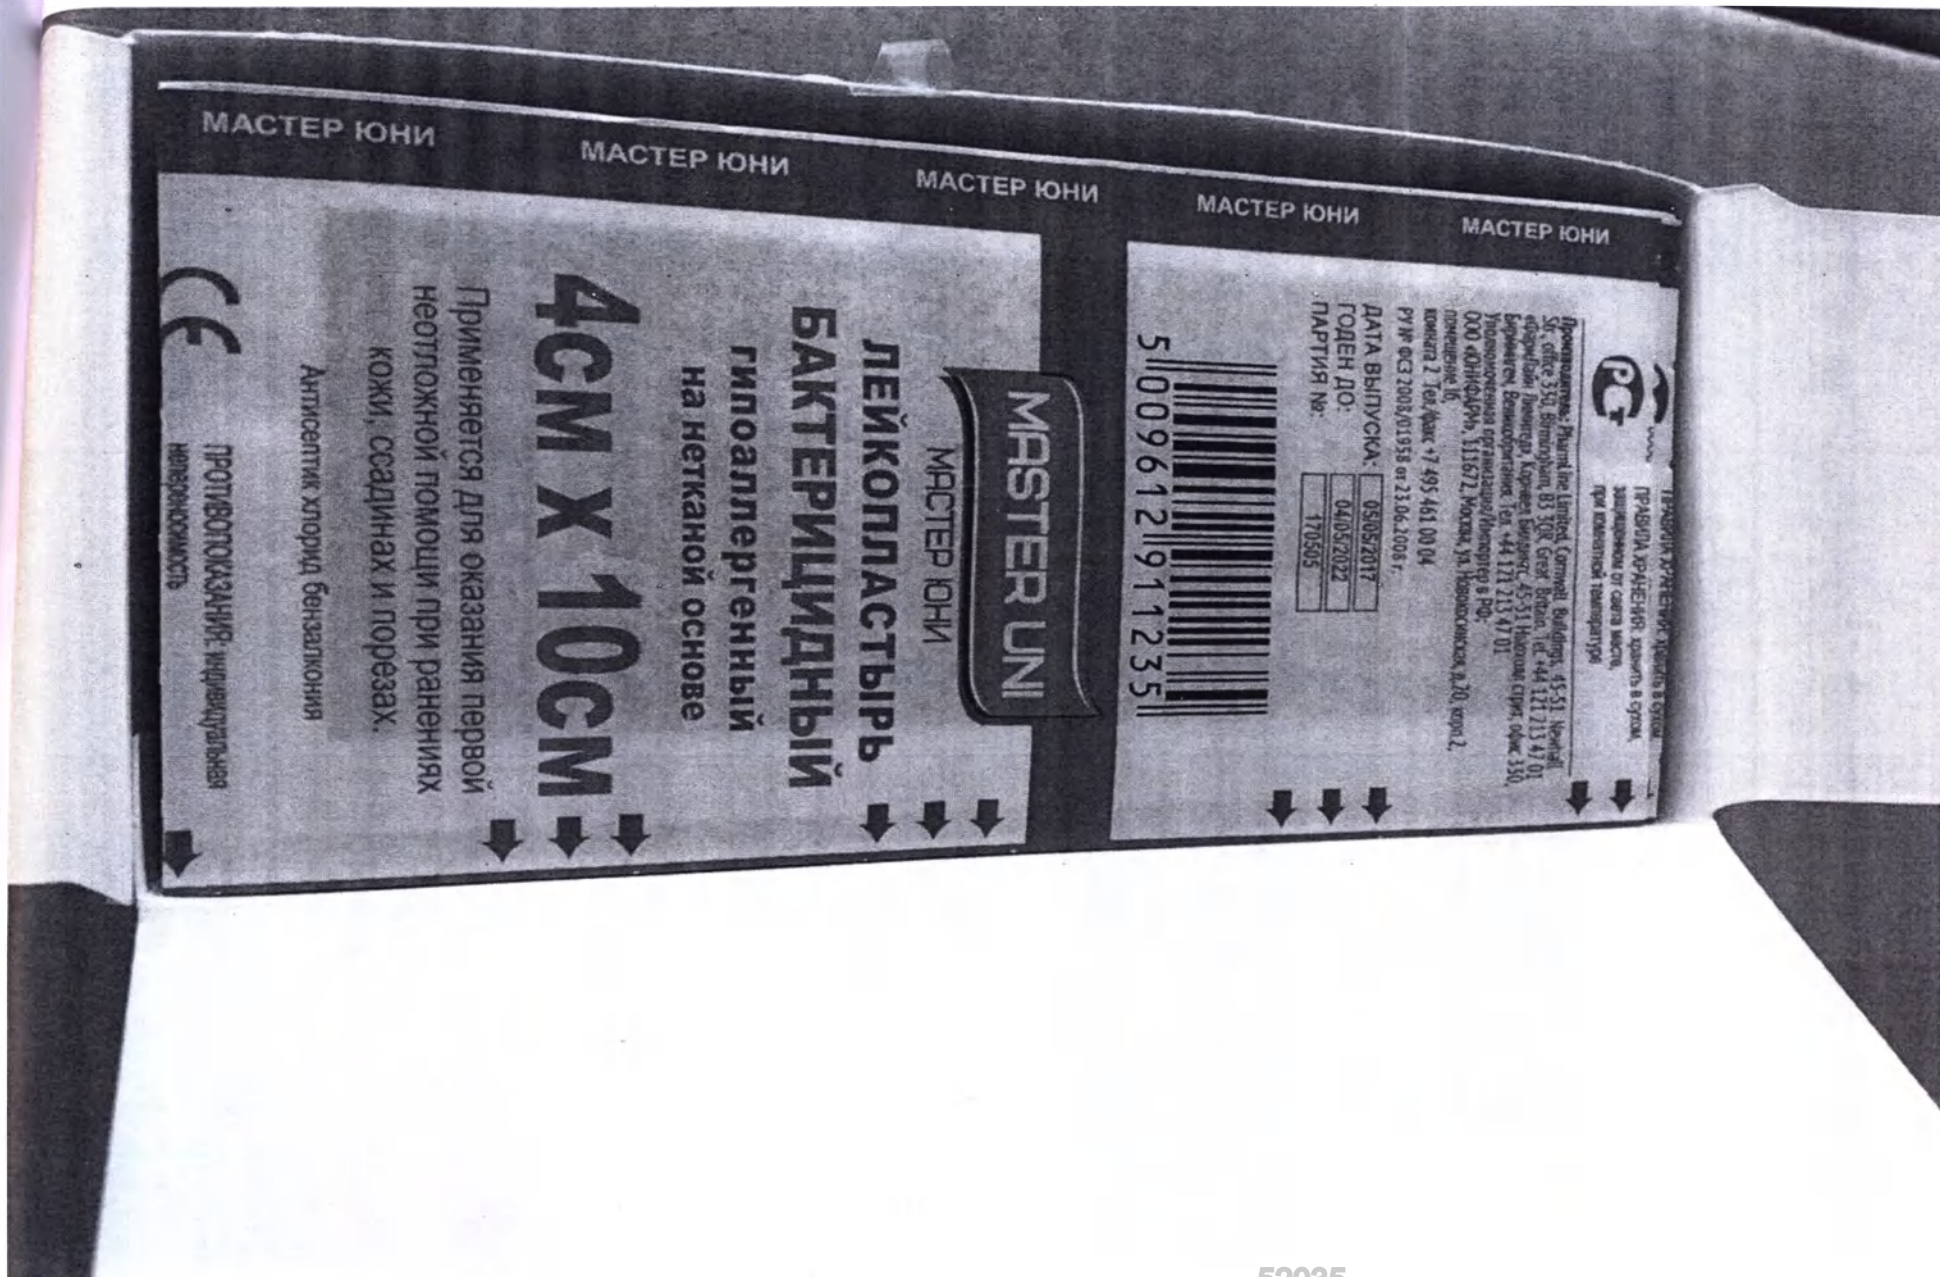

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393-017-45961725-2010,
производства АО «ВЕРОФАРМ», Россия, РУ ФСР 2008/03213

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм

6 x 10 см

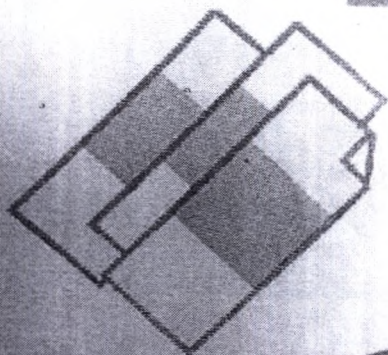

Бактерицидный лейкопластырь Верофарм

Хранить в сухом, защищенном от света месте.

Возможна индивидуальная непереносимость.

Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А или Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

Р № ФСР 2008/03213 от 15.06.2015

ТУ 9393-017-45961725-2010



АО «ВЕРОФАРМ»

Юридический адрес: 107023, Россия, г. Москва, Барабанный пер., д. 3

Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж,
ул. Кольцовская, д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90.

E-mail: infovfn@veropharm.ru

Предназначен для использования в качестве наружного антисептического перевязочного средства при небольших порезах, ссадинах, царапинах и других мелких повреждениях кожи.

Состав: Лейкопластырь Верофарм, подушечка из нетканого материала с антисептической пропиткой: фурацилин (нитрофура), синтомицин (хлорамфеникол), бриллиантовый зеленый.

Способ и условия применения:

Снять с поверхности пластыря защитное покрытие, не прикасаясь пальцами к подушечке, приложить ее на рану, а липкую часть пластыря приклеить к сухой, чистой коже, слегка прижав пальцами.

Менять каждые 3-4 часа для достижения оптимального заживляющего эффекта.

Хранить в сухом, защищенном от света месте.

Возможна индивидуальная непереносимость.

Не использовать по истечении срока годности.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А или Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

Р № ФСР 2008/03213 от 15.06.2015

ТУ 9393-017-45961725-2010



Лейкопластырь «УНИПЛАСТ®/UNIPLAST® бактерицидный» по ТУ 21.20.24-013-45961725-2019,
производства АО «ВЕРОФАРМ», Россия, РУ ФСР 2010/07192

Предназначен для использования в качестве антисептического перевязочного средства при малых повреждениях кожи.

Состав: Лейкопластырь Верофарм или Лейкопластырь Унипласт фиксирующий, подушечка из нетканого материала с антисептической пропиткой: хлорексидина биглюконат.

Способ и условия применения:

Наклеивать на чистую и сухую кожу. Менять каждые 3-4 часа для достижения оптимального заживляющего эффекта.

Хранить в сухом, защищенном от света месте.

Возможна индивидуальная непереносимость.

Не использовать по истечении срока годности.

ТУ 9393-013-45961725-2010

Р № ФСР 2010/07192 от 15.06.2015

Свидетельство на товарный знак № 202223

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А или Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

АО «ВЕРОФАРМ»

Юридический адрес: 107023, г. Москва, Барабанский пер., д. 3.

Адрес производства и принятия претензий: 394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90.

E-mail: info@veropharm.ru



4 602435 002862



Лейкопластырь «Унипласт бактерицидный»

На основе ткани (100% хлопок)

Предназначен для использования в качестве антисептического перевязочного средства при малых повреждениях кожи.

Состав: Лейкопластырь Верофарм или Лейкопластырь Унипласт фиксирующий, подушечка из нетканого материала с антисептической пропиткой: хлорексидина биглюконат.

Способ и условия применения:

Наклеивать на чистую и сухую кожу. Менять каждые 3-4 часа для достижения оптимального заживляющего эффекта.

Хранить в сухом, защищенном от света месте.

Возможна индивидуальная непереносимость.

Не использовать по истечении срока годности.

ТУ 9393-013-45961725-2010

Р № ФСР 2010/07192 от 15.06.2015

Свидетельство на товарный знак № 202223

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам классов А или Б и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

АО «ВЕРОФАРМ»

Юридический адрес: 107023, г. Москва, Барабанский пер., д. 3.

Адрес производства и принятия претензий: 394006, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90.

E-mail: info@veropharm.ru




4 602435 002862



Лейкопластырь «Унипласт бактерицидный»

На основе ткани (100% хлопок)

Предназначен для использования в качестве

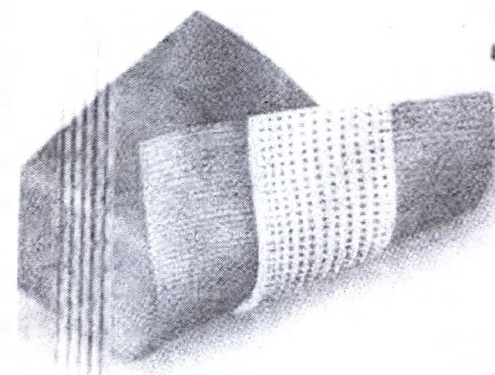


6x10 см

унипласт®
бактерицидный



натуральный

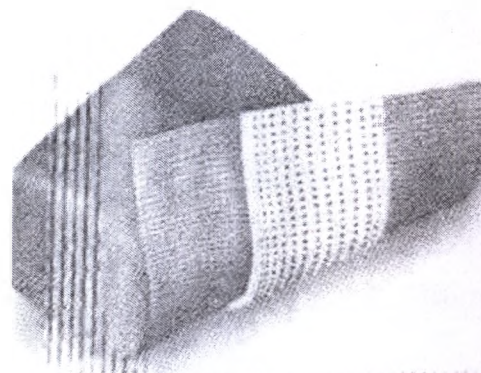

6x10

унипласт®
бактерицидный



натуральный

Лейкопластырь медицинский бактерицидный,
производства «Чанчжоу Хуалянь Неалф Дрессинг Ко., Лтд.», Китай, РУ ФСЗ 2011/09594



открывать здесь

open here

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ
Лейкопластырь используется для профилактики травматизации и внешнего инфицирования поверхностей травм кожи и уштых кожных ран. Лейкопластырь применяется для оказания первой медицинской помощи, быстрой обработки мелких ран, порезов и царапин.
Способ применения: Перед применением от изделия отделяют защитную пленку. Подушкой, в центре изделия, накладывают на рану. Края полоски прижимают к коже.
Меры предосторожности: Не использовать, если упаковка повреждена. Избегать попадания прямых солнечных лучей и высоких температур.
Утилизировать после использования.
Утилизировать как медицинские отходы класса А или Б в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10. Хранение производится в закрытых помещениях, исключающих попадание влаги и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, при комнатной температуре.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.
РУ № ФСЗ 2011/09594 от 20.04.2011
Производитель: «Чанчжоу Хуалянь Неалф Дрессинг Ко., Лтд.», Китай, Changzhou Hualian Health Dressing Co., Ltd., No.55 Yuejin Road, Zhongguo Town 213144 Changzhou, People's Republic of China. Место производства: Changzhou Hualian Health Dressing Co., Ltd., No.55 Yuejin Road, Zhongguo Town 213144 Changzhou, People's Republic of China
Импортер в РФ: ООО «ТДЛ Текстиль», 153027, г. Иваново, ул. Павла Боровикова, д. 27, строение 9. Тел: +7 (495) 59 11 11
Уполномоченный представитель: ООО "Сана", 302012, г. Орел, Кронное шоссе, д. 29. Тел: +7 (4862) 72-41-09



REF 86016

STERILE EO

Дата изготовления/ Mfg date:

20180830

Годен до /Use before:

20230829

Партия №/ Lot №:

180A307ED

Покрывало спасательное для оказания первой медицинской помощи пострадавшим от перегрева или переохлаждения, производства «Имеко ГмбХ энд Ко. КГ», Германия, РУ РЗН 2013/891

АЛПРО

111123, Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 20
Тел./факс: +7 (485) 215-08-13 e-mail: info@alpro.ru [http: www.alpro.ru](http://www.alpro.ru)

ПОКРЫВАЛО СПАСАТЕЛЬНОЕ

4 602902 001176

Размер: 160x210 см. Количество: 1 штука.

Защита от перегрева:

Золотистым покрытием к телу. Вследствие отражения солнечных лучей тело предохраняется от нагревания.

Защита от переохлаждения:

Серебристым покрытием к телу. Путем рефлектирования сохраняется тепло тела. Опасность переохлаждения уменьшается.

Правила использования:

140242

1. Расстелить спасательное покрывало.
2. Пострадавшего положить набок. Лицо оставить открытым.
3. Край покрывала обернуть вокруг тела и закрепит.
4. Обеспечить вызов скорой помощи.

Произведено для ООО «АЛПРО» Россия
РУ № РЗН 2013/891 от 25.09.2013

Производитель: Имеко ГмбХ энд Ко.л, Германия,
Imeco GmbH & Co. KG, Boschstraße 5, D-63768, Nöbisch, Sektgau

Зарег. под названием: «Покрывало спасательное для оказания первой помощи пострадавшим от перегрева или переохлаждения»

Срок годности 10 лет.



52035
23.07.2021

ПОКРЫВАЛО СПАСАТЕЛЬНОЕ ЗАЩИТА

для предохранения
от переохлаждения или перегрева.

160x210 см серебристый/золотистый

Защита от переохлаждения,
серебристой стороной к телу:

1. Расстелить спасательное покрывало;
2. Уложить пострадавшего поверх покрывала на бок;
3. Обернуть покрывалом, оставив лицо открытым;
4. Зафиксировать край покрывала липкой лентой;
5. Вызвать «Скорую помощь».



Защита от перегрева,
золотистой стороной к телу:

1. Накрыть пострадавшего покрывалом, обеспечив свободный доступ воздуха к телу;
2. Вызвать «Скорую помощь».

Экстренная транспортировка:

Удерживать покрывало с пострадавшим за 4 угла.
Избегайте повреждения покрывала острыми предметами!

Рег. уд. № РЗН 2015/3146 от 07.10.2015 г.
ТУ 9398-001-27955879-2014

ГОСТ Р ИСО 10993-99, ГОСТ Р 50444-92

Срок годности: 20 лет

Дата изготовления: март 2018 г.

Хранить при температуре: от -50°C до +40°C
(условия хранения 2 по ГОСТ 15150)

Утилизировать в соответствии с СанПин
2.1.7.1386-03 и СанПин 2.1.7.2790-10

Производитель:

ЗАО «ВИБА»

Россия,


117405, г. Москва,

ул. Дорожная, д. 54 корп. 5

Тел.: (495) 795-3350, (495) 225-1408

E-mail: viba@viba.ru

www.viba.ru



2018.05.21 12:11

2018.05.21 12:11

ООО ШАНС

ПОКРЫВАЛО СПАСАТЕЛЬНОЕ
от перегрева или переохлаждения
пострадавших
(LIFECOVER)
(RETTUNGSDECKE)

160 x 210 см золотистый/серебристый

Защита от перегрева:
Золотистой стороной к телу.
Путем светотражения солнечных лучей
тело предохраняется от нагрева.



Защита от переохлаждения:
Серебристой стороной к телу.
Путем рефлектирования сохраняется
тепло тела. Опасность переохлаждения
уменьшается.

Правило пользования:

1. Расстелить спасательное покрывало.
2. Пострадавшего положить набок.
Лицо оставить открытым.
3. Концы покрывала забить и закрепить.

4 606735 669015
ТУ 9398-001-74050508-2005

Характеристики и область применения:

- масса — 80 г
- толщина 12 мм
- размер 210x160 см
- высокая прочность позволяет
подносить пострадавшего
весом до 90 кг, вставшись
за четыре угла покрывала (рис. 1)
- сохраняет тепло до 20 часов при низких
температурах (см. Правило пользования)
- Является незаменимым средством для людей,
попадающих в сложные или чрезвычайные
ситуации, в которых могут оказаться водители
автомобилей и пассажиры, шахтеры, рыбаки,
охотники, военнослужащие и рабочие
на объектах Сибири и севера.
- В быту используется в холодных квартирах, дачах
и т.д. для защиты растений от заморозков.
- Низкая стоимость делает спасательное покрывало
доступным для каждого и дает каждому шанс
спастись и быть спасенным.

(Рис. 1)

Срок годности — 11.2025 г.

Покрывало спасательное изотермическое по ТУ 9398-014-26528997-2011, производства ООО НПФ «МИРАЛ», Россия, РУ
ФСР 2011/11915



МИРАЛ
НАУЧНО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ФИРМА

ПОКРЫВАЛО

спасательное изотермическое (160 см - 210 см)

Рекомендации по использованию:

Расстелить спасательное покрывало (серебристой стороной к телу для защиты от переохлаждения; золотистой стороной к телу для защиты от перегрева), пострадавшего положить набок, лицо оставить открытым, край покрывала загнуть и закрепить.

ТУ 9398-014-26528997-2011

Пер.Уд. № ФСР 2011/11915 от 15.08.2016 г.

ГОСТ Р 50444-92

Производитель: ООО НПФ «МИРАЛ»

394036, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 34-33.

Тел./факс: (437) 221-12-12, www.npfmiral.ru


Количество в упаковке: 1 шт.

Срок годности: 10 лет.


Дата выпуска: март 2018 г.



Покрывало спасательное для пострадавших от перегрева или переохлаждения, для комплектации аптечек первой медицинской помощи (Rettungsdecke), производства «Лайна-Верке ГмбХ», Германия, РУ ФСЗ 2011/08867

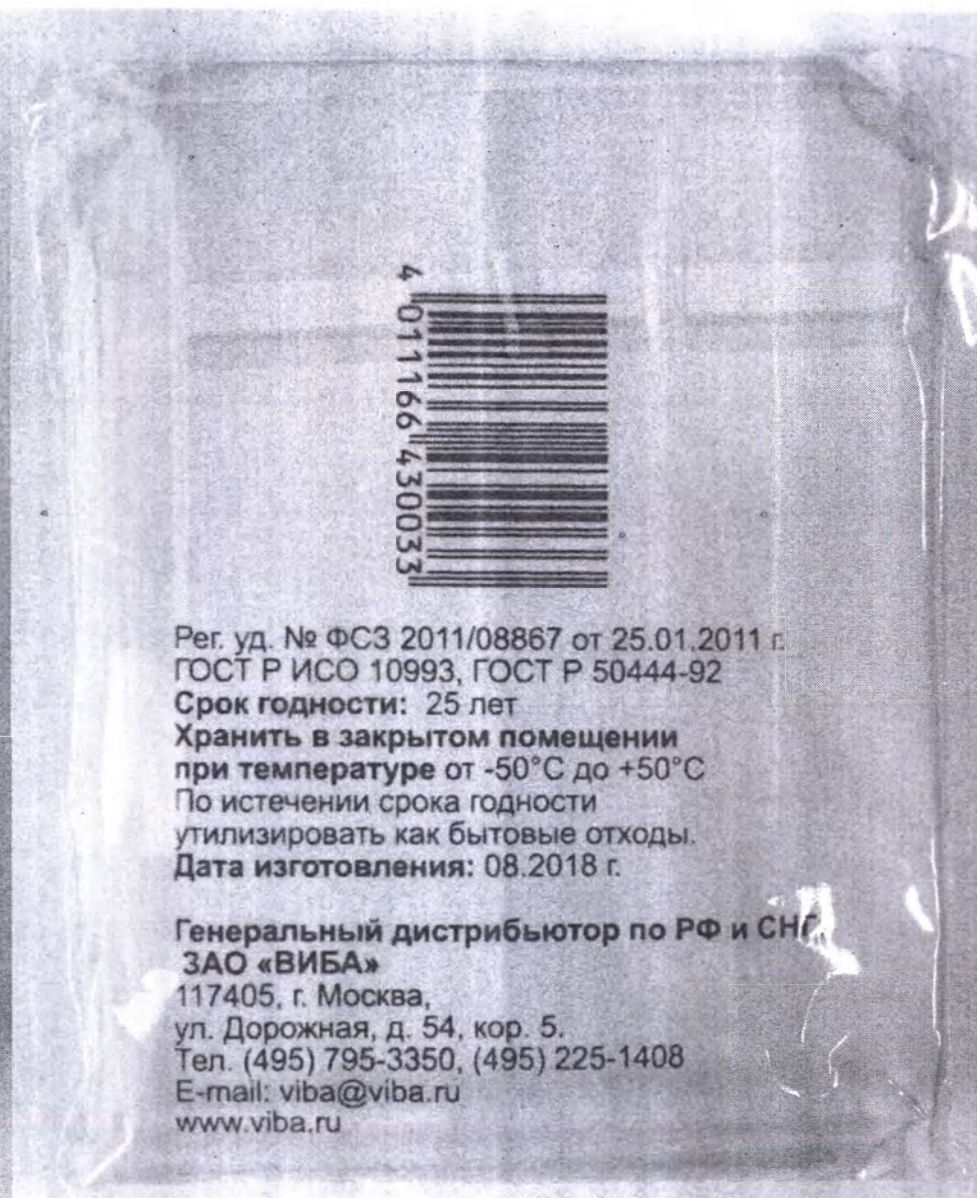

Инструменты режущие по ТУ 9433-285-07613444-2010, производства ОАО «МИЗ им. М.Горького», Россия, РУ ФСР 2010/07370

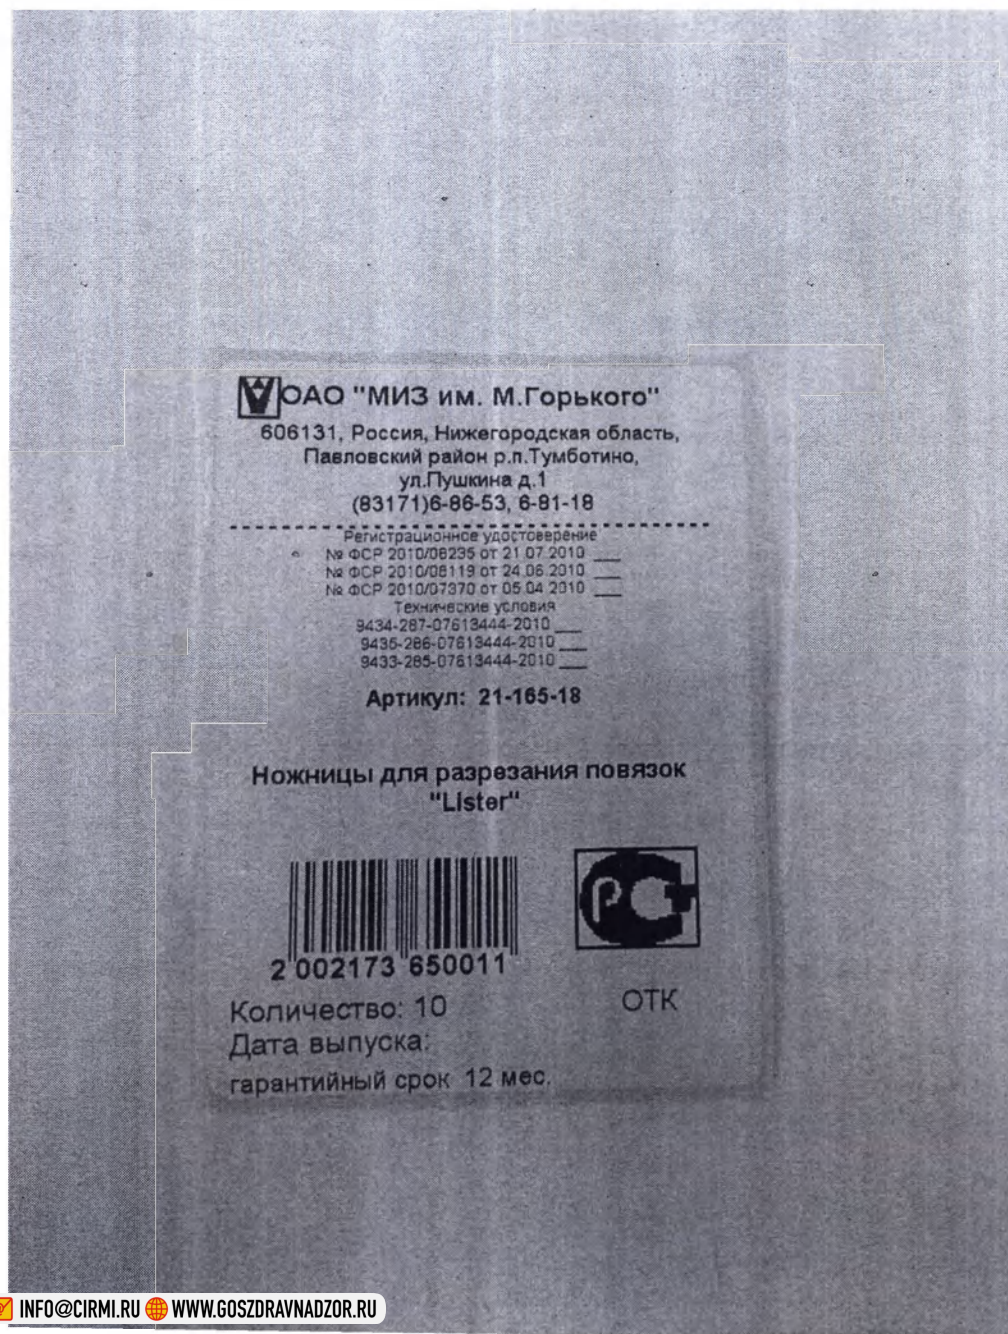

Инструменты хирургические ЦИЛИТА режущие и ударные с острой (режущей) кромкой, производства ООО «ЦИЛИТА»,
Россия, РУ ФСЗ 2008/02700



Инструменты хирургические «ЦИЛИТА» режущие
и ударные с острой (режущей) кромкой:
Хирургические ножницы SU-DGS-1101

Размер: 120 мм

Изготовлено: июль 2019 год

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев

Срок службы: 5 лет

НЕСТЕРИЛЬНО!

Хранить в сухом и защищенном от пыли месте.

Условия хранения: при температурном режиме -

50°C до + 50°C

и относительной влажности воздуха до 100% (без
образования конденсата).

Производитель: «ЦИЛИТА» ЛТД,

Великобритания

CILITA LTD, 1 Straits Parade, Bristol, BS16 2LA

United Kingdom.

Поставщик: ООО «ЦИЛИТА», 390044, г. Рязань,

Московское ш., д.20, офис 702

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2008/02700 от 11 марта 2019 года



Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью

55 листа (ов)
Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

Андросов В.

